

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

2022 г.




по ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАЙЛО Р.В.

Фотографические изображения изделия:


**Набор реагентов для количественного определения тестостерона
электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для
диагностики in vitro (Testosterone (Electrochemiluminescence Immunoassay) /
TESTO)**

«Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.»
(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай

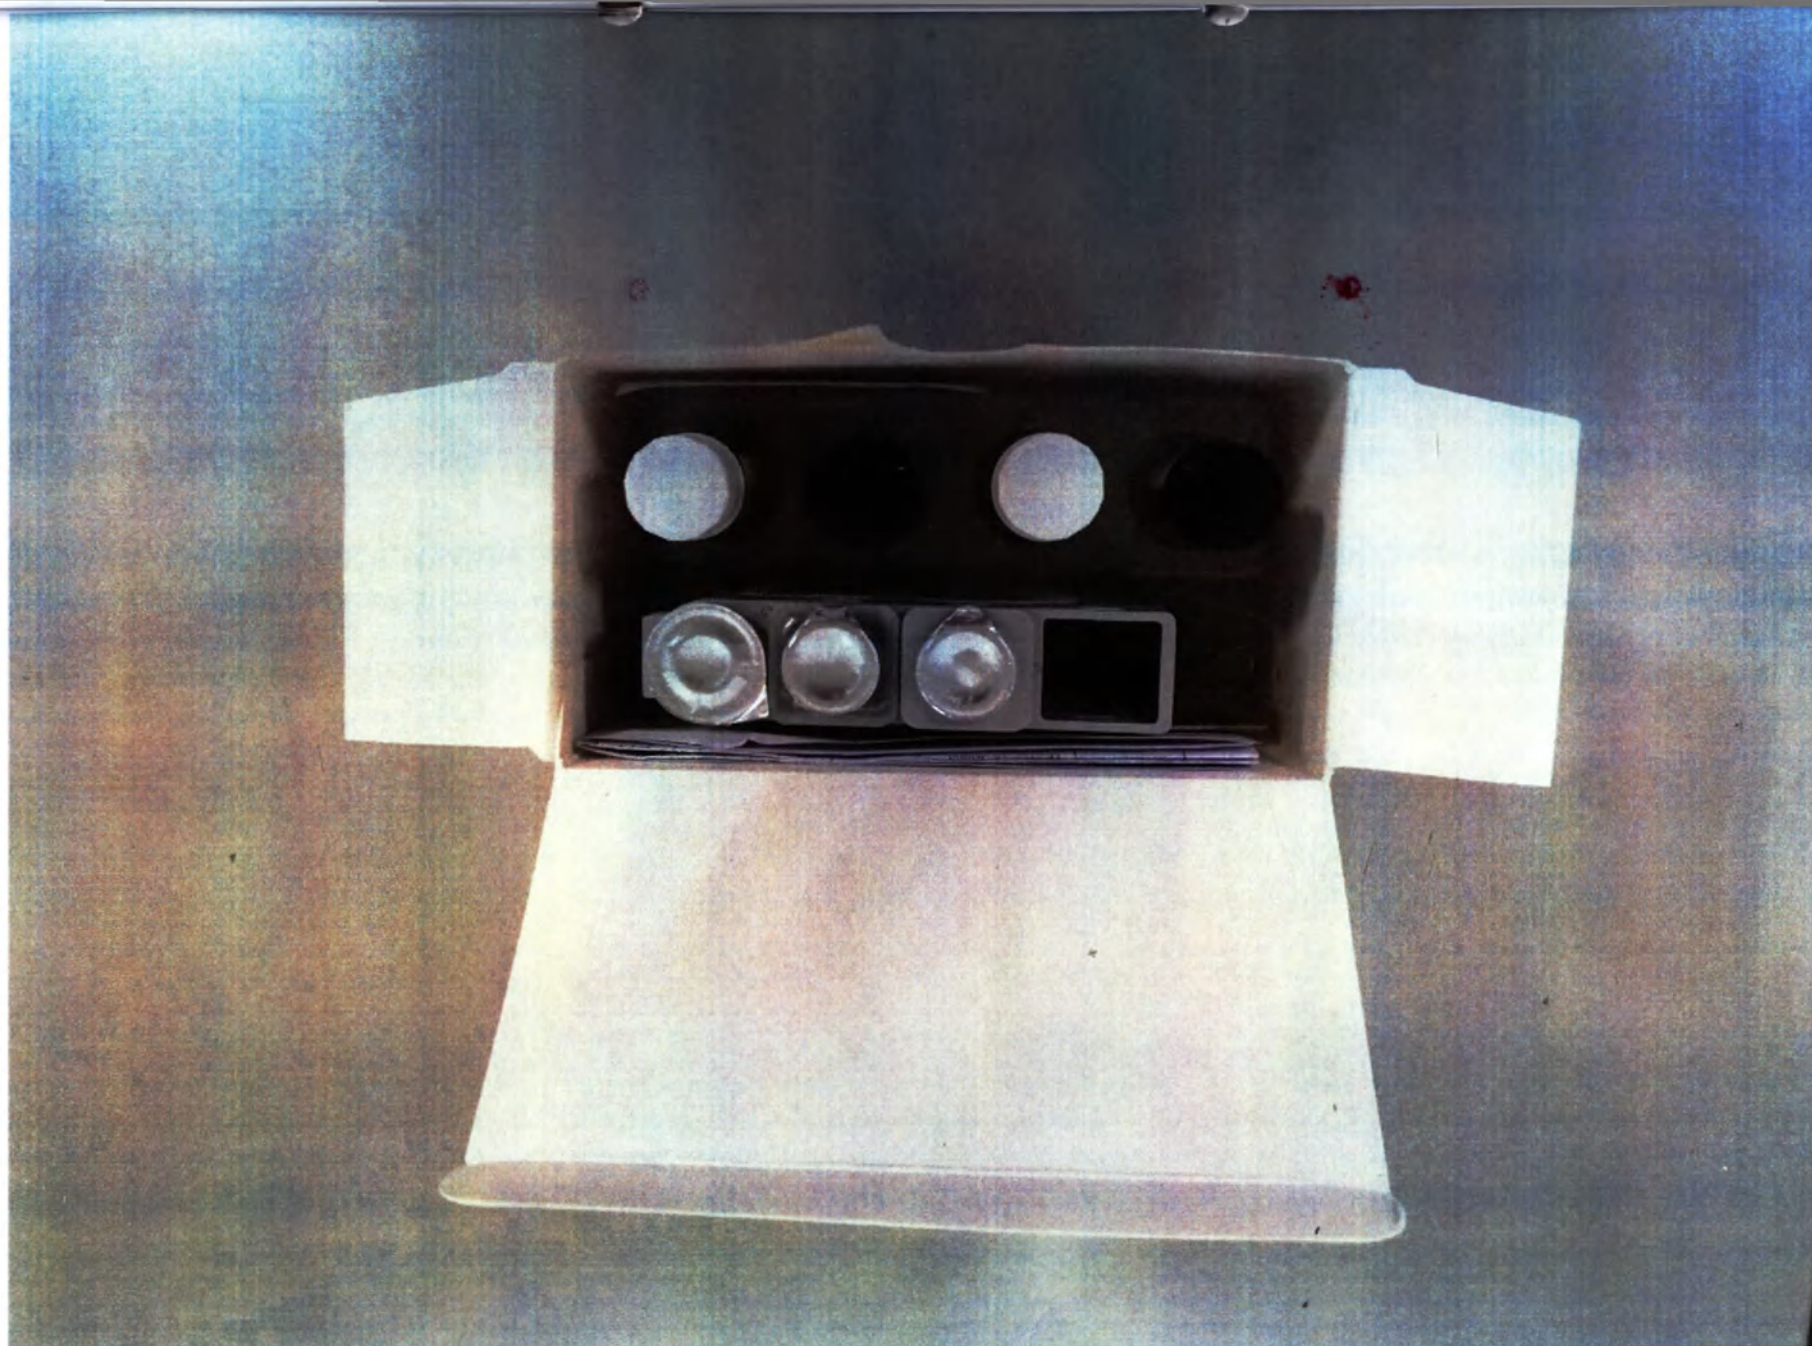


Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения тестостерона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Testosterone (Electrochemiluminescence Immunoassay) / TESTO))



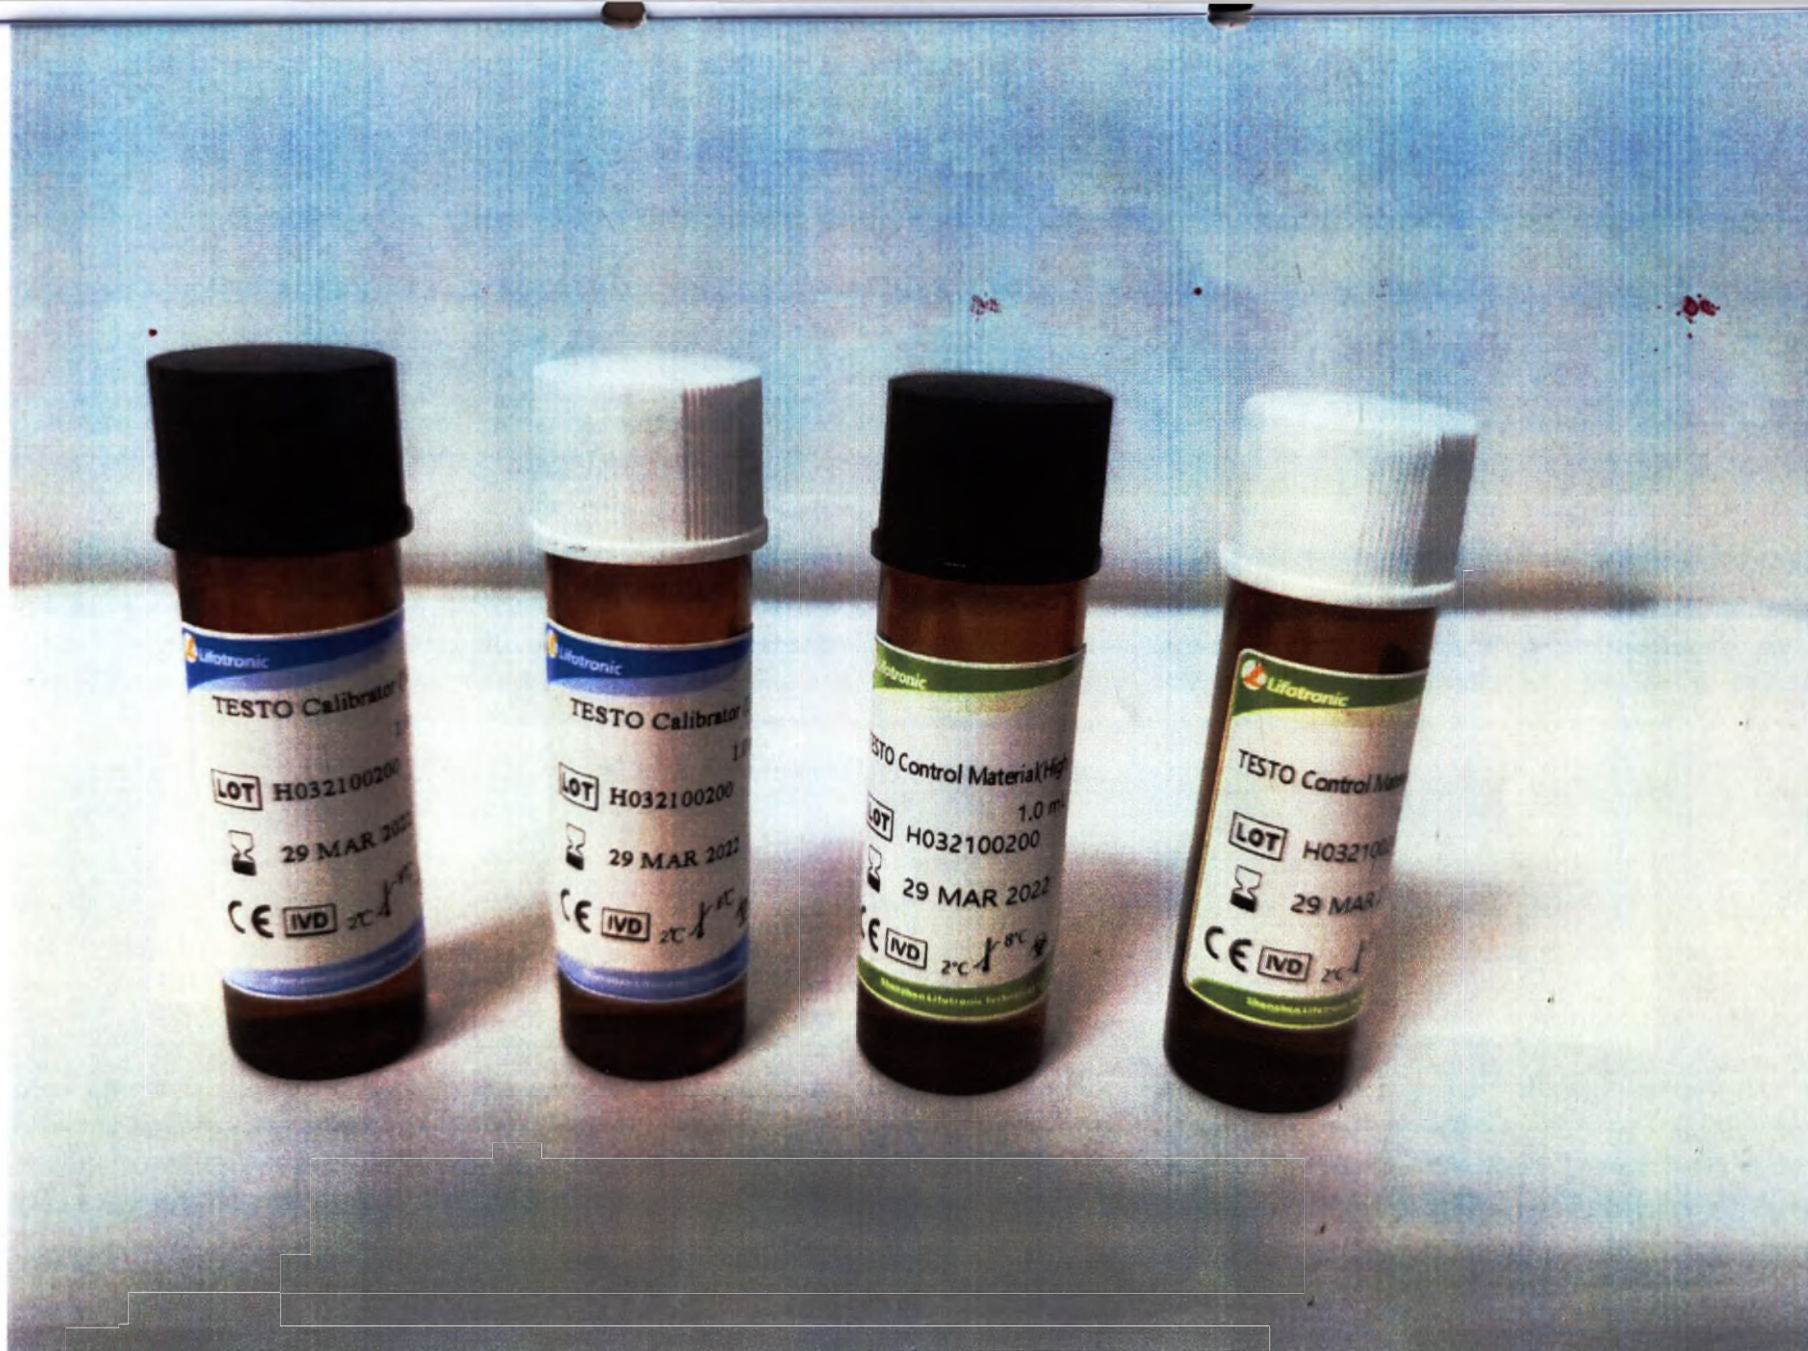


Калибратор (низкий и высокий уровень), Материал контрольный (низкий и высокий уровень) (Набор реагентов для количественного определения тестостерона


методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Testosterone (Electrochemiluminescence Immunoassay) / TESTO))

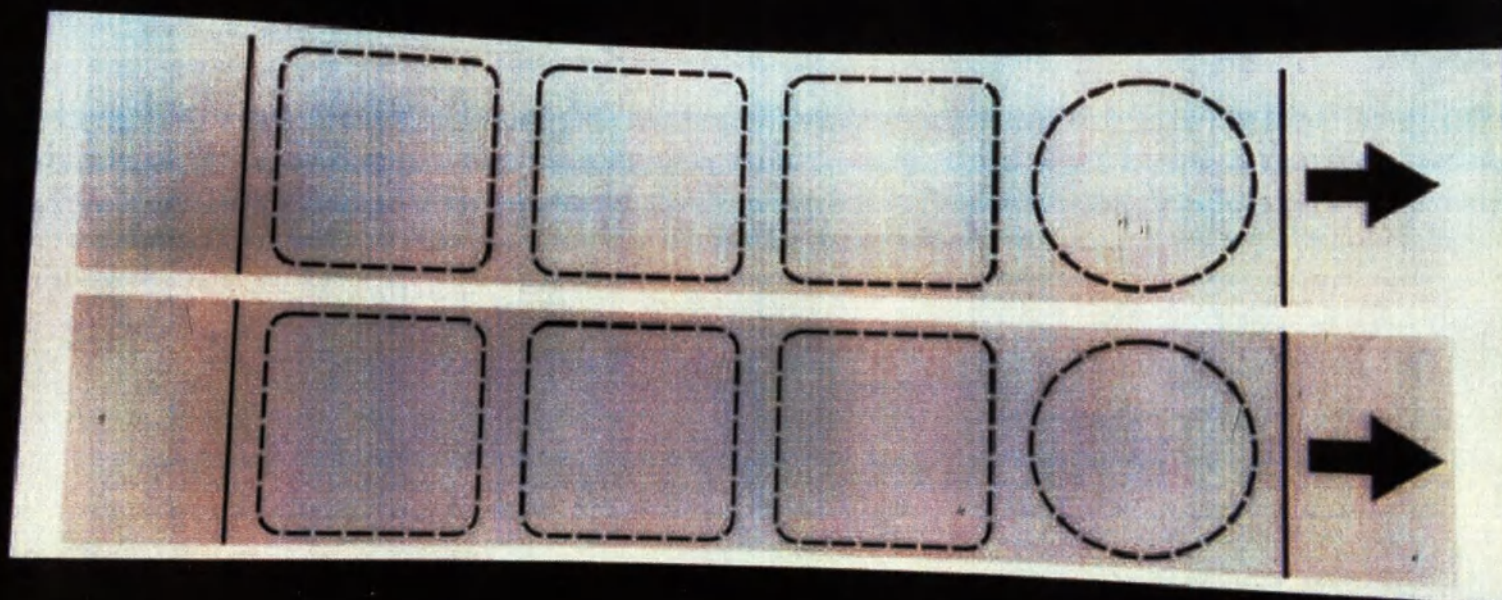

Этикетки для запечатывания флаконов (Набор реагентов для количественного определения тестостерона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики *in vitro* (Testosterone (Electrochemiluminescence Immunoassay) / TESTO))

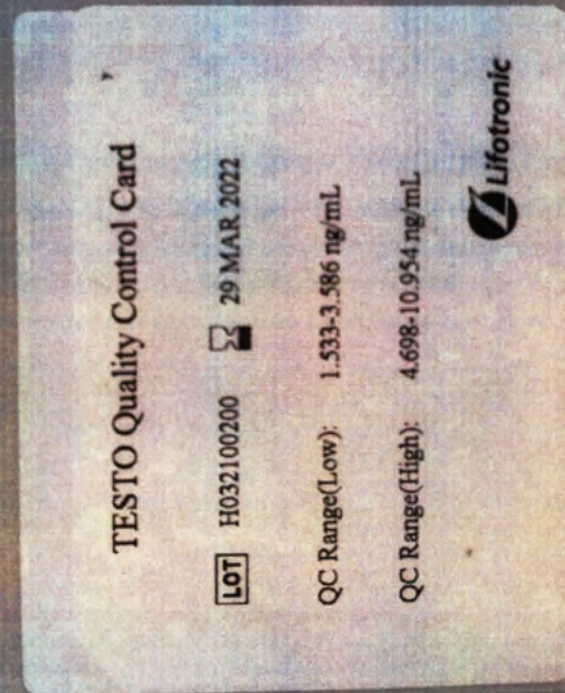

Этикетка результатов значений материалов контрольных (Набор реагентов для количественного определения тестостерона электрохемилюминесцентным методом на

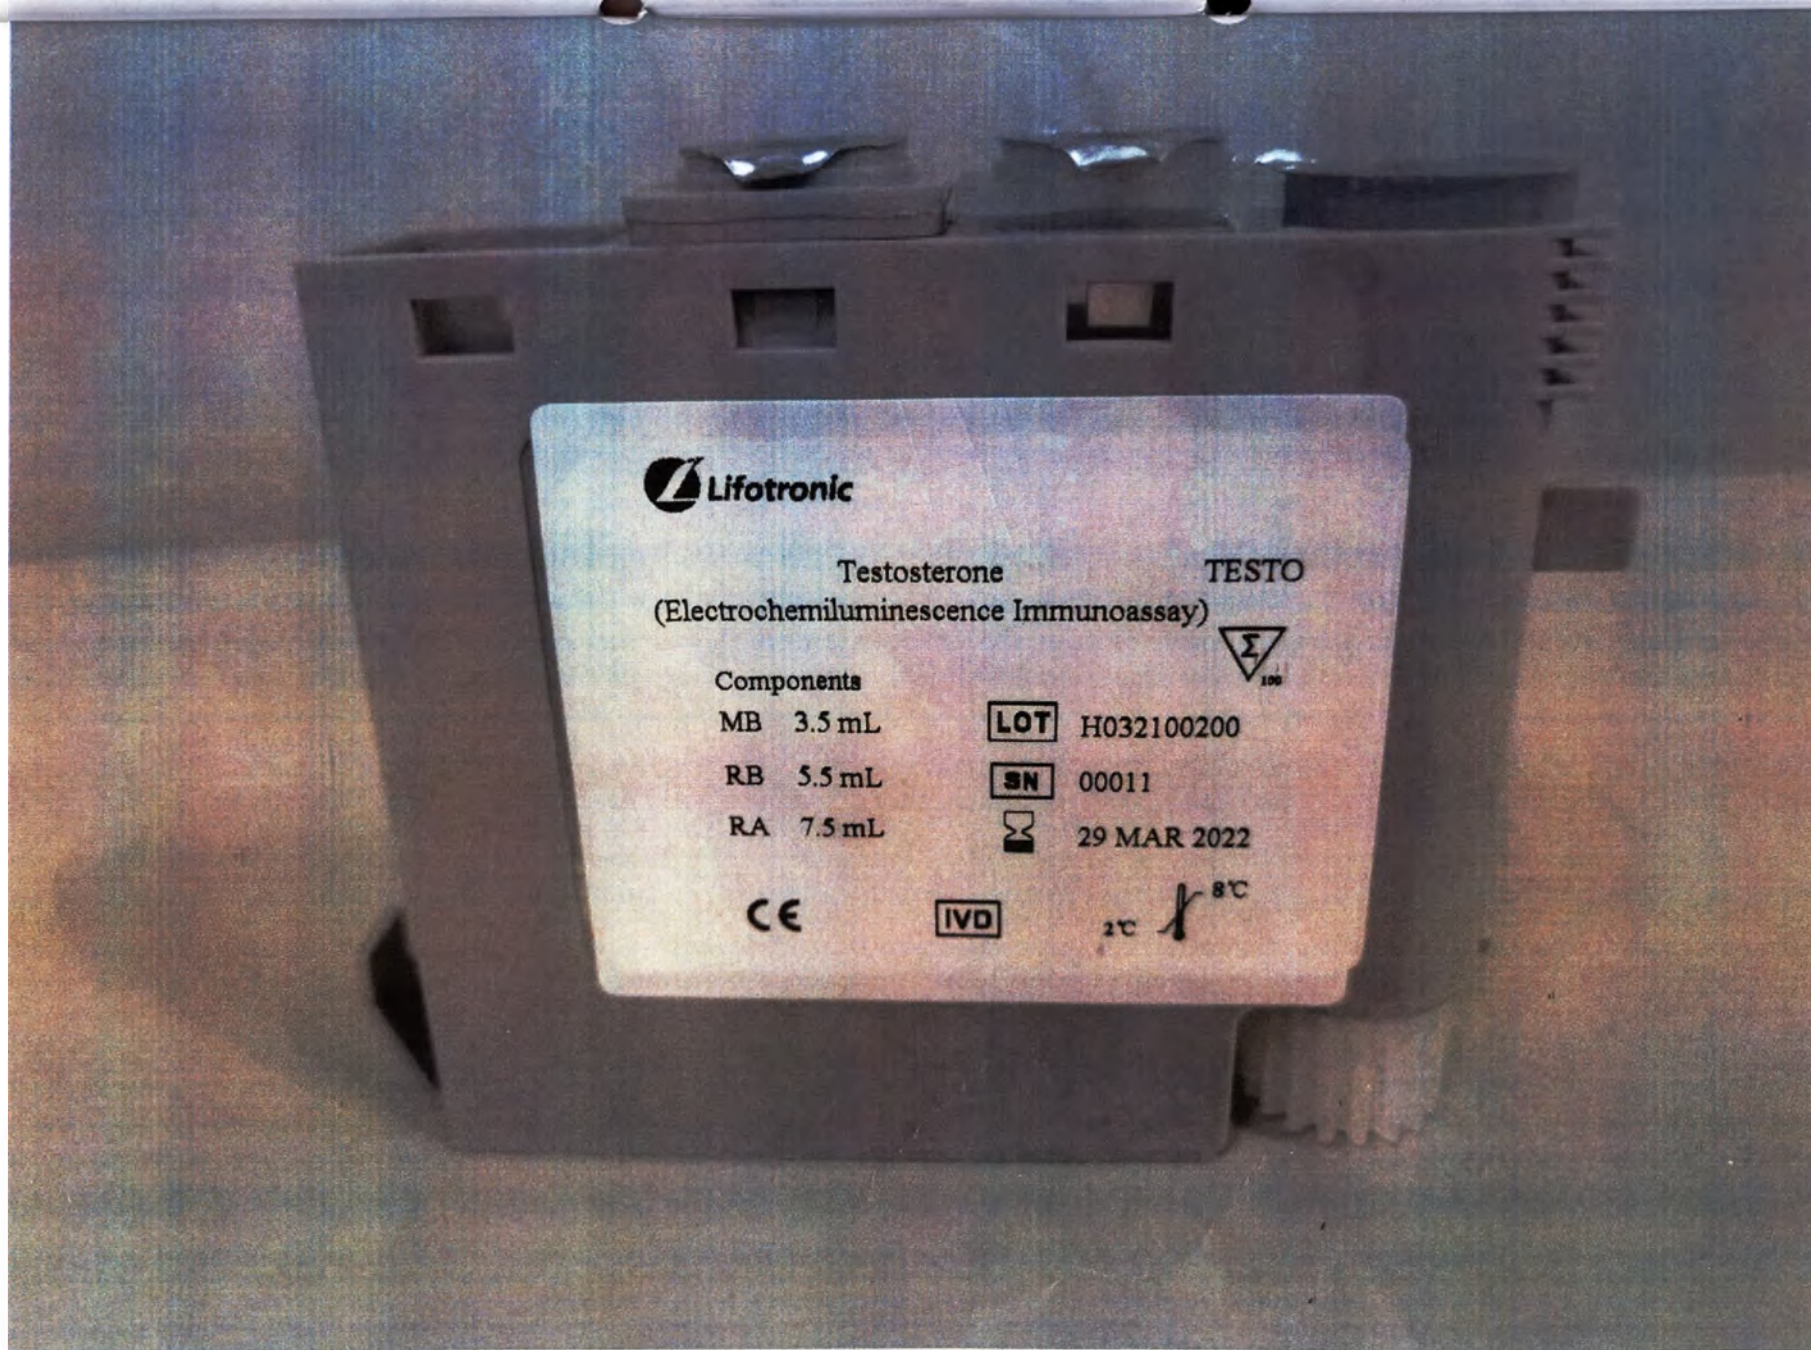

Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения тестостерона электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Testosterone (Electrochemiluminescence Immunoassay) / TESTO))

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 8 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.

