

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО Компания «ТерраМед»




Э.Д. Болашвили

«24» декабря 2021 года

**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:****Индикаторы контроля стерилизации биологические,
одноразовые «ТерраМед»
по ТУ 32.50.50-004-01432322-2021**


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия:

**Индикаторы биологические, одноразовые для контроля воздушной стерилизации, автономные
«ТерраМед»**

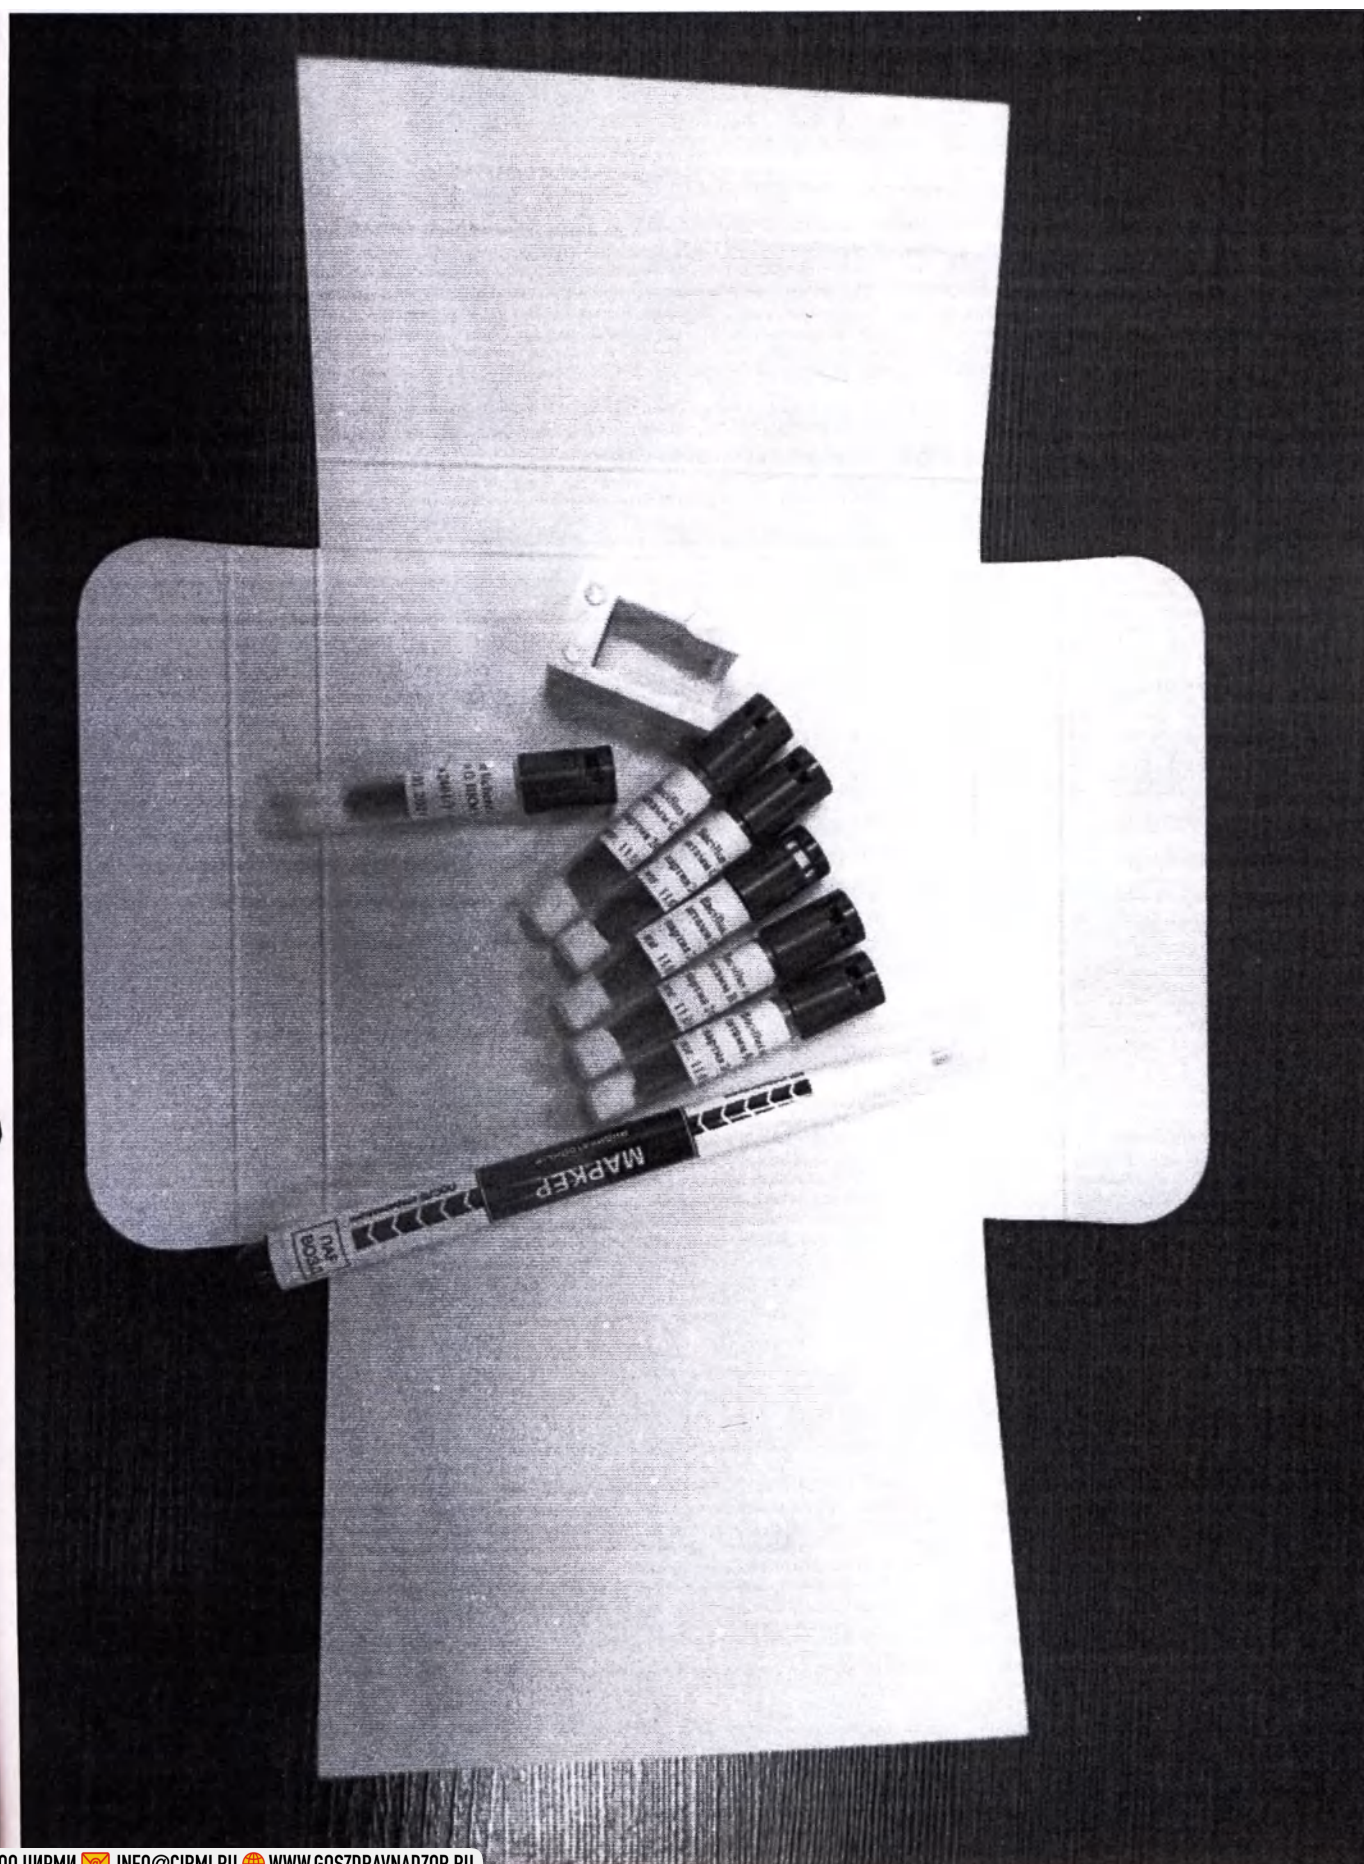


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия:

**Индикаторы биологические, одноразовые для контроля воздушной стерилизации, автономные
«ТерраМед»**

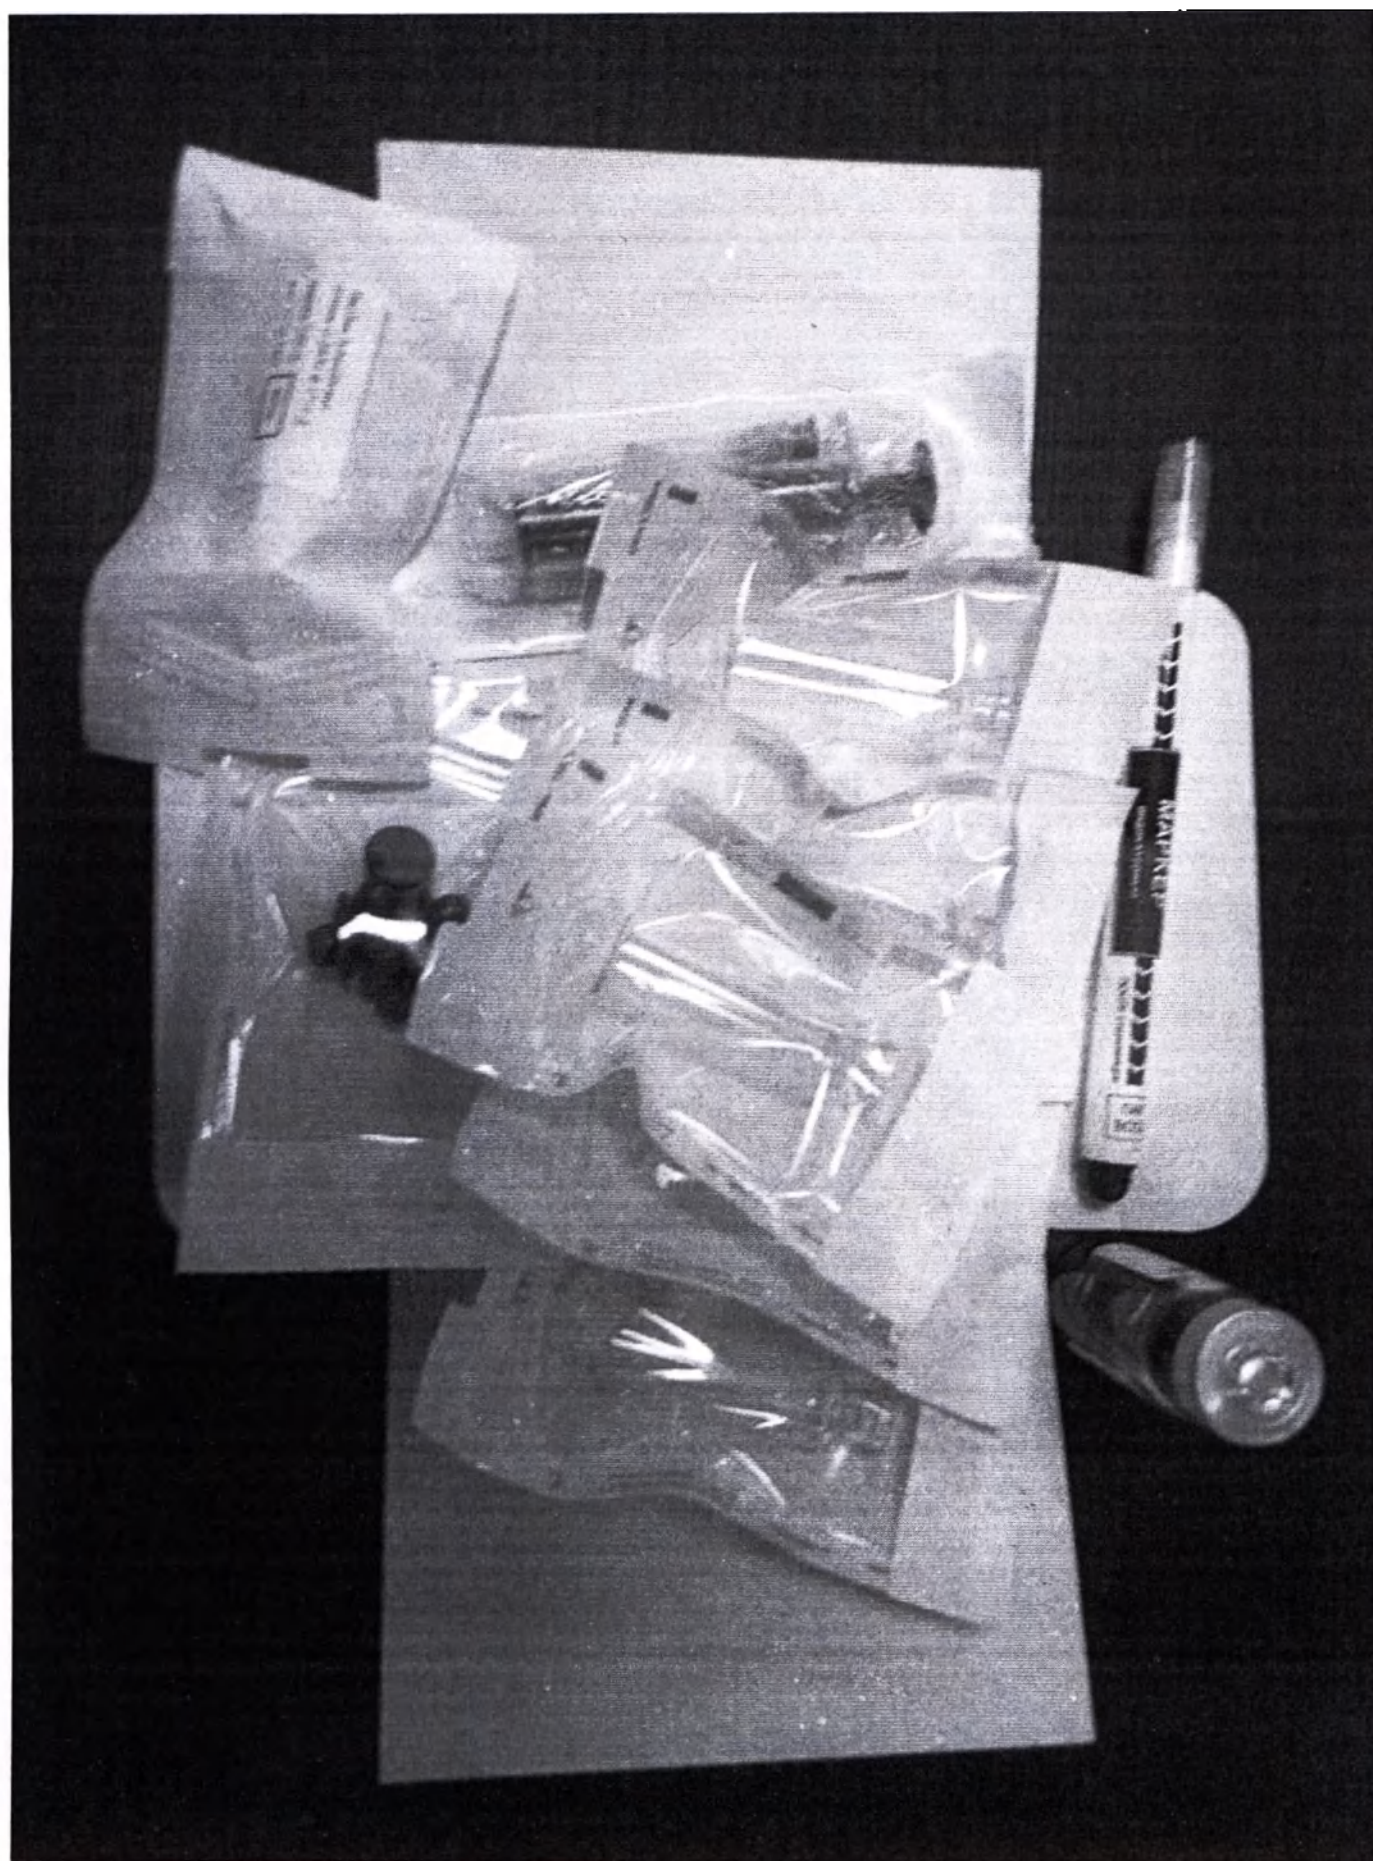


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия:

Индикаторы биологические, одноразовые для контроля паровой и воздушной стерилизации, автономные «ТерраМед»

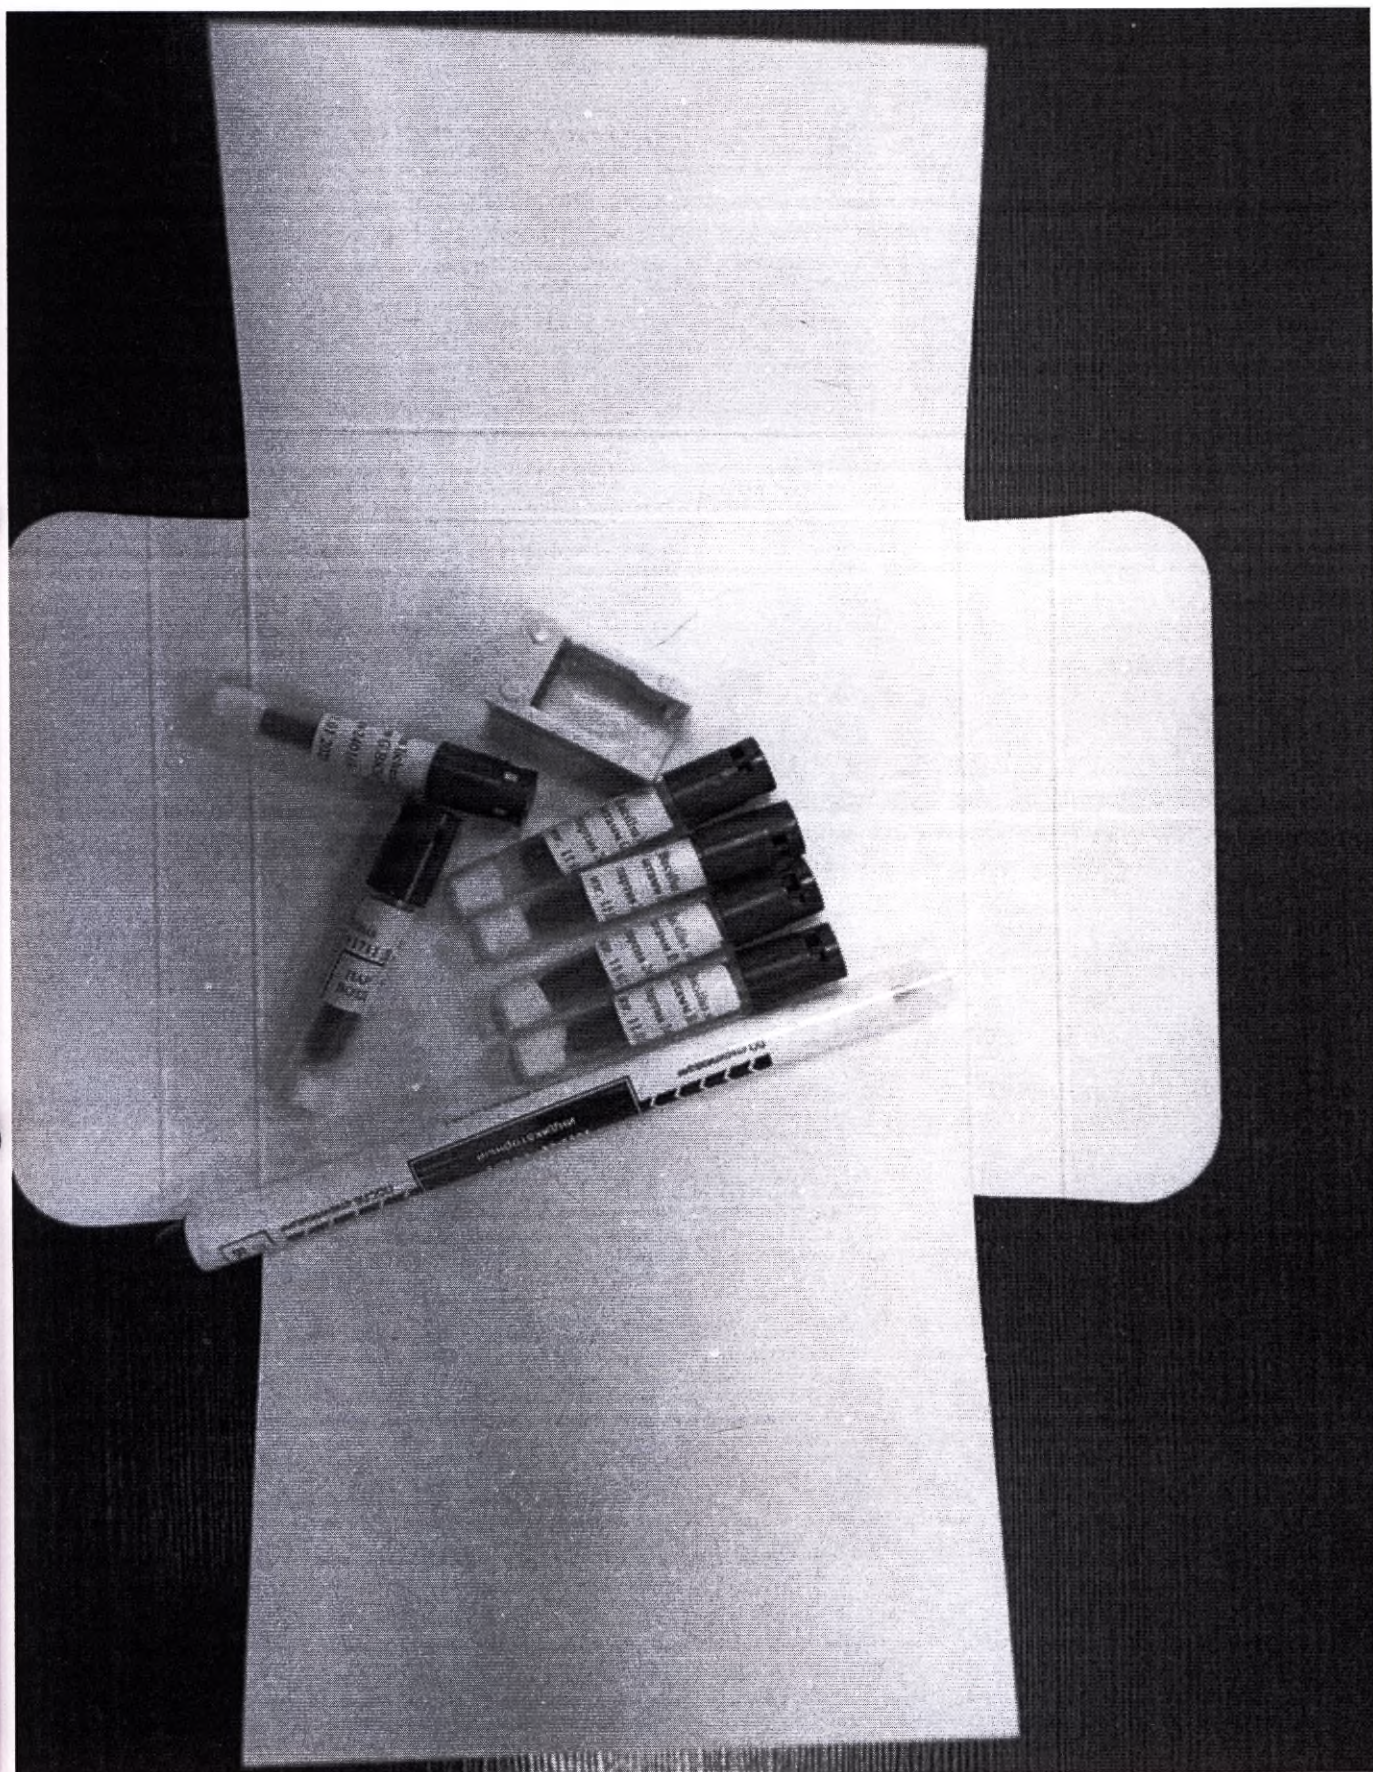


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия:

**Индикаторы биологические, одноразовые для контроля стерилизации оксидом этилена, автономные
«ТерраМед»**

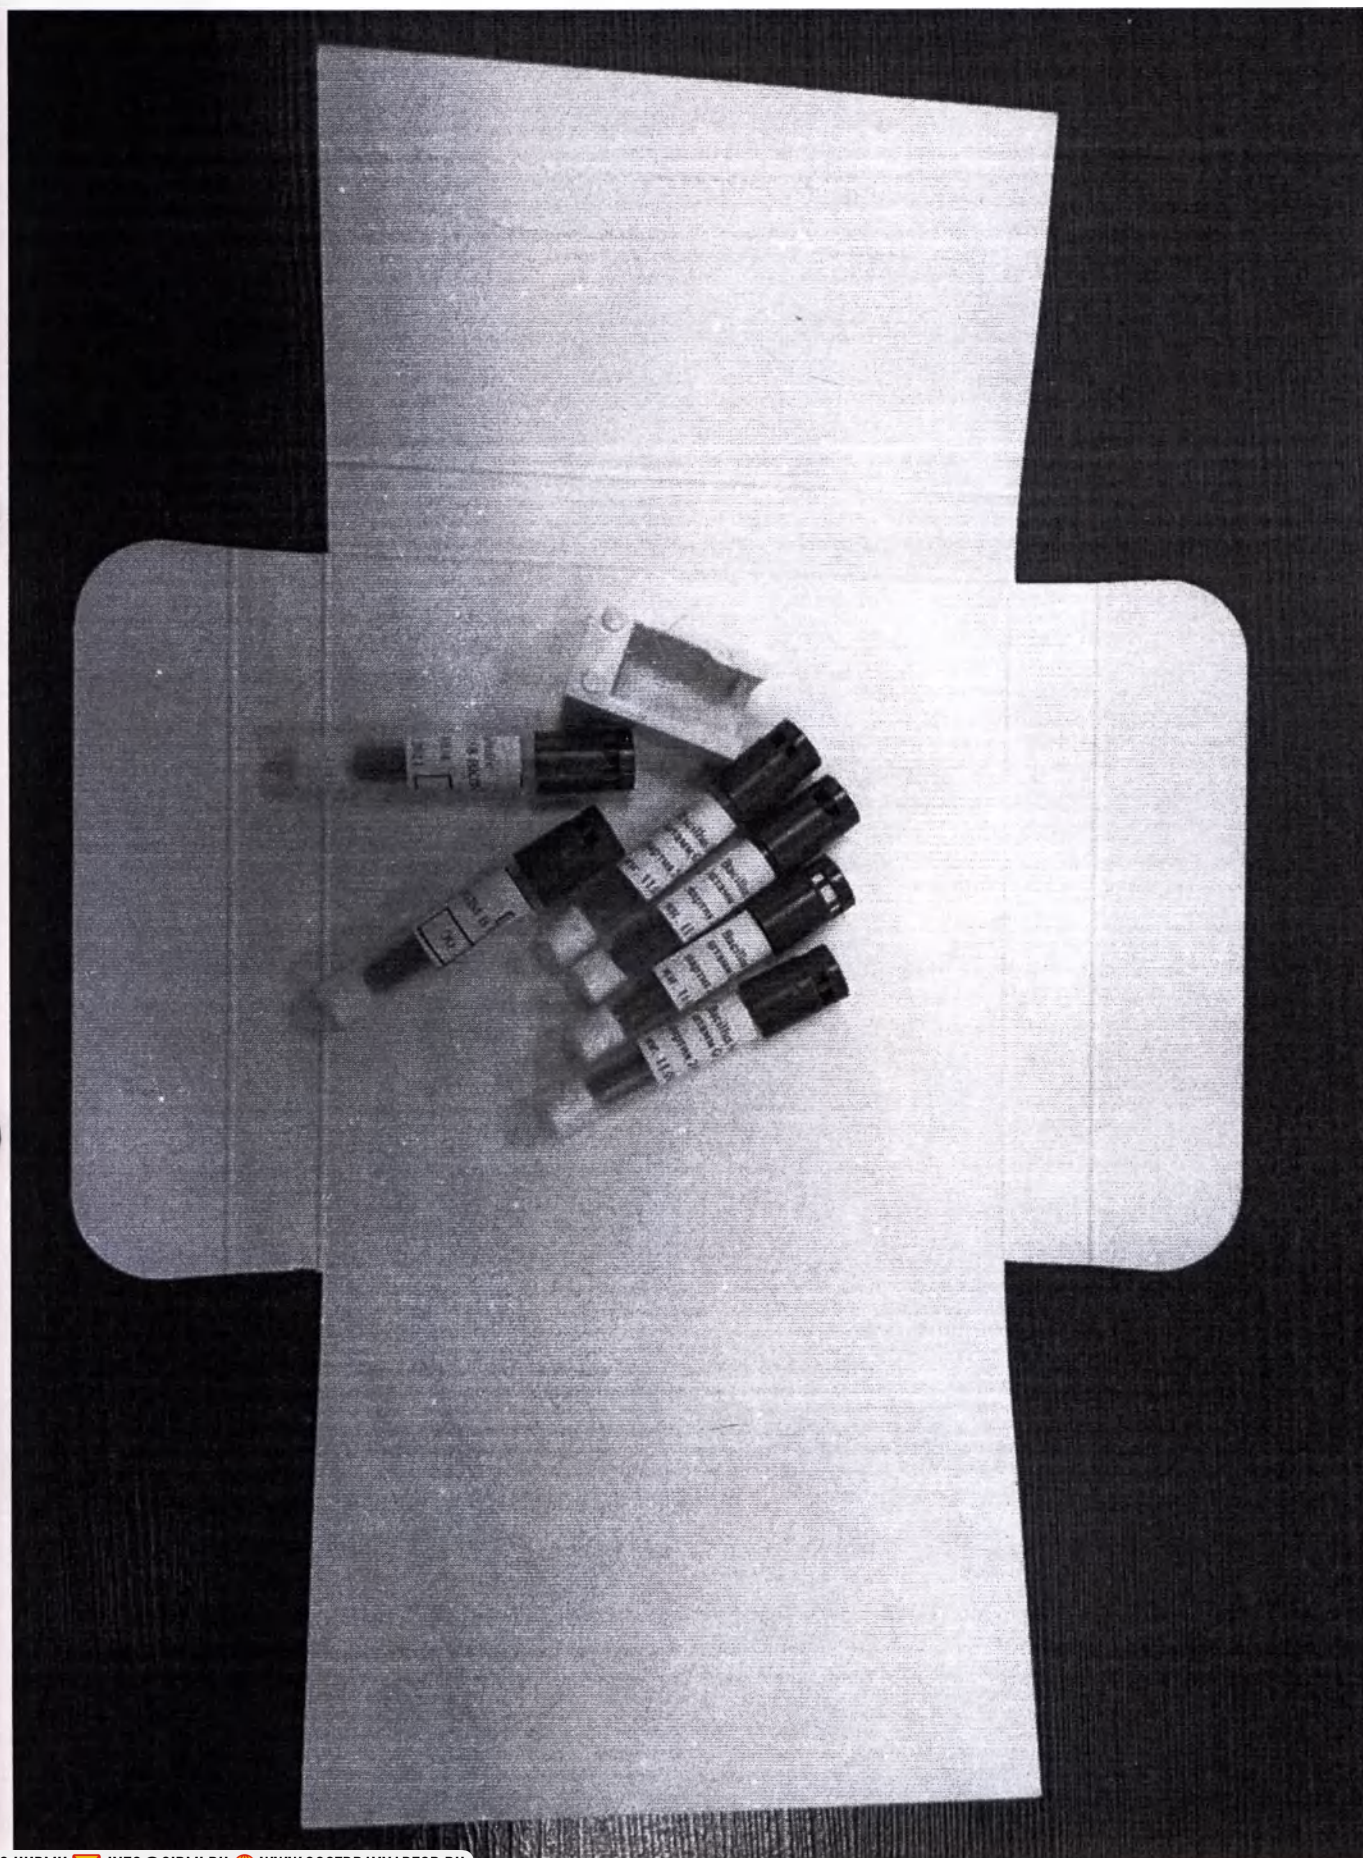


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия:

Индикаторы биологические, одноразовые для контроля стерилизации оксидом этилена «ТерраМед»

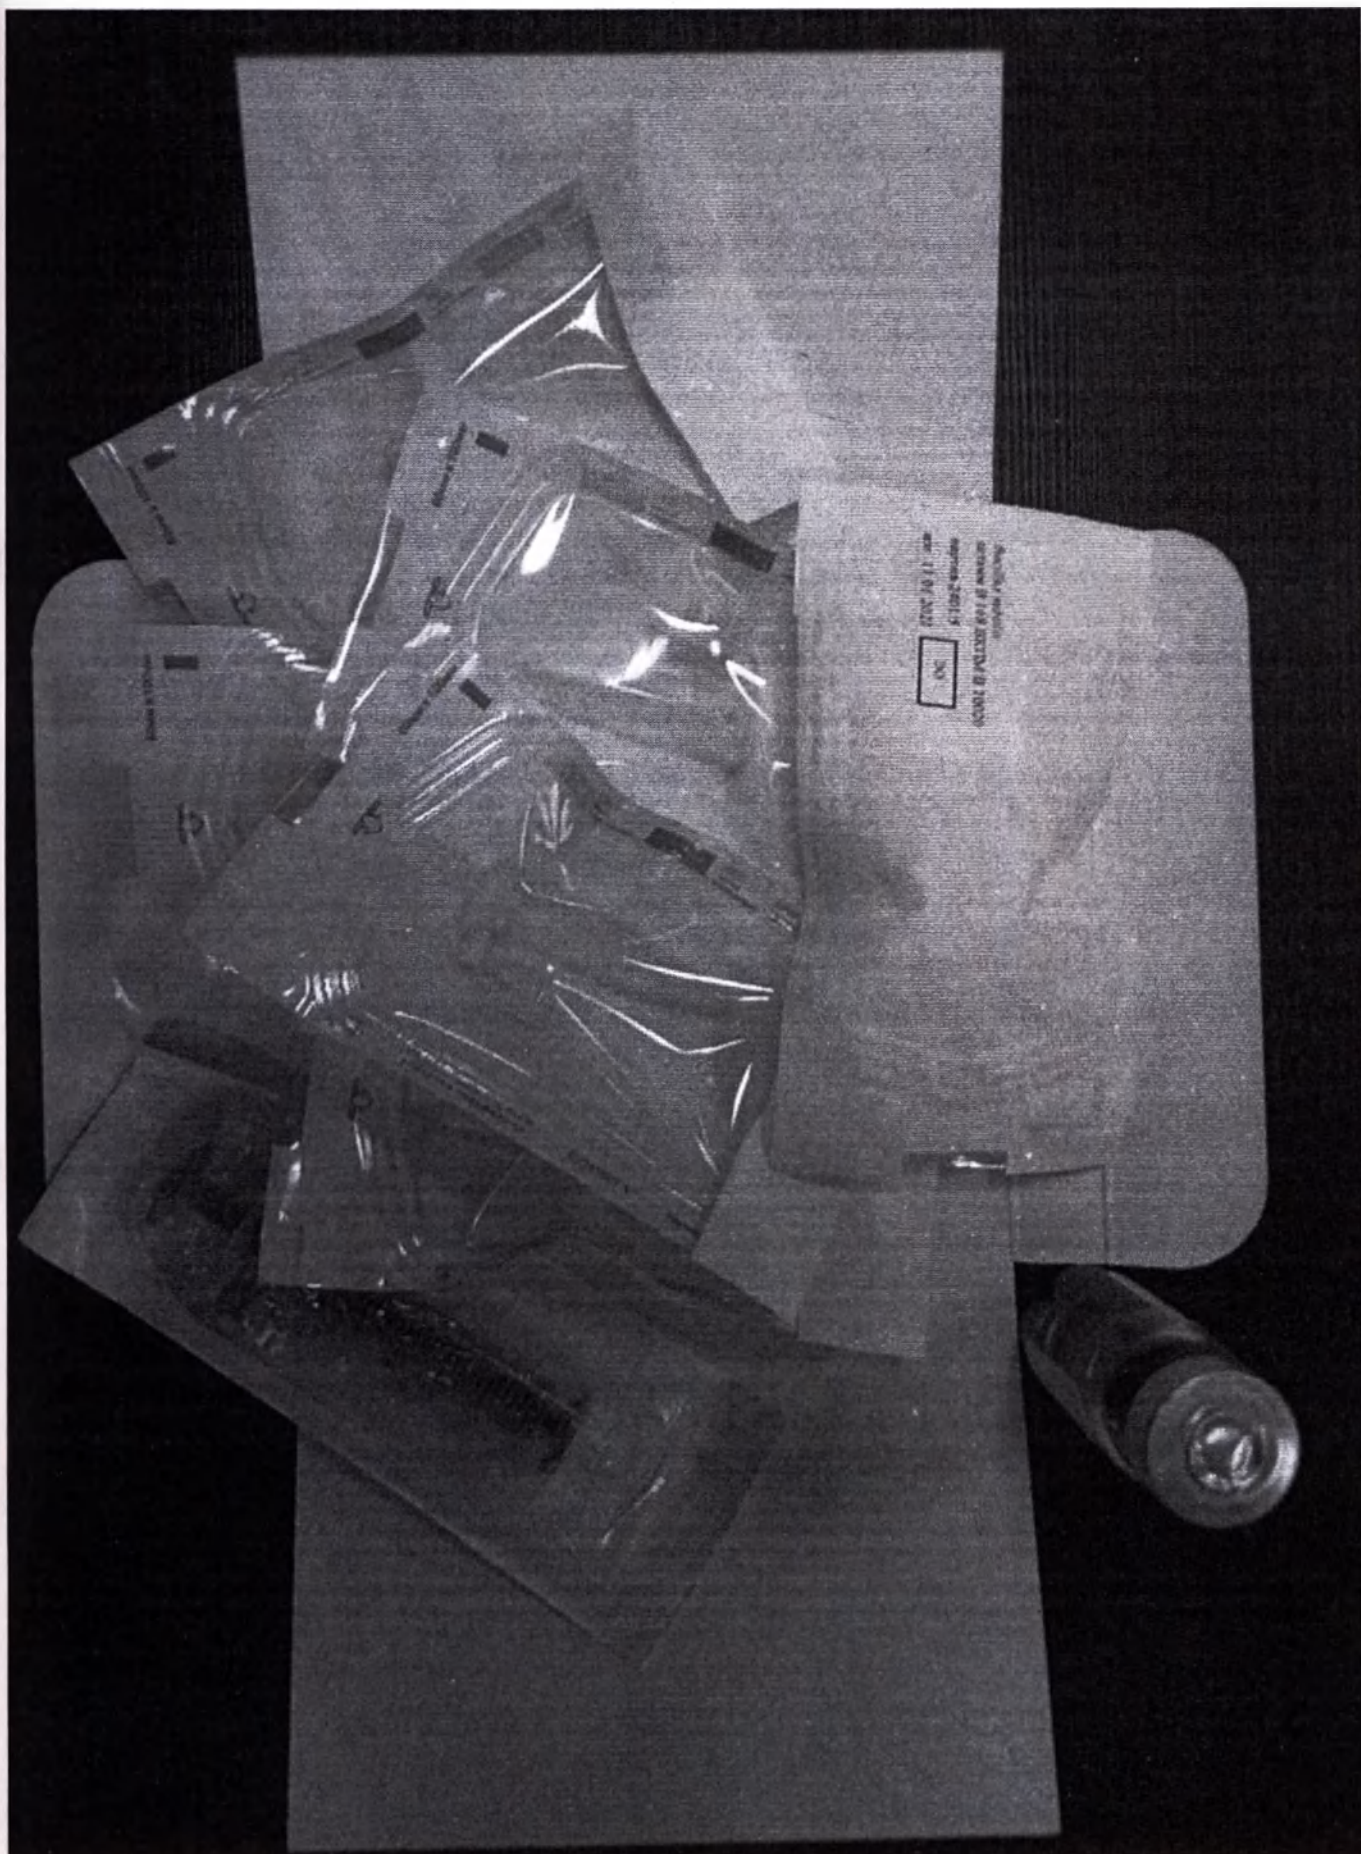


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия:

**Индикаторы биологические, одноразовые для контроля паровой стерилизации, автономные
«ТерраМед»**

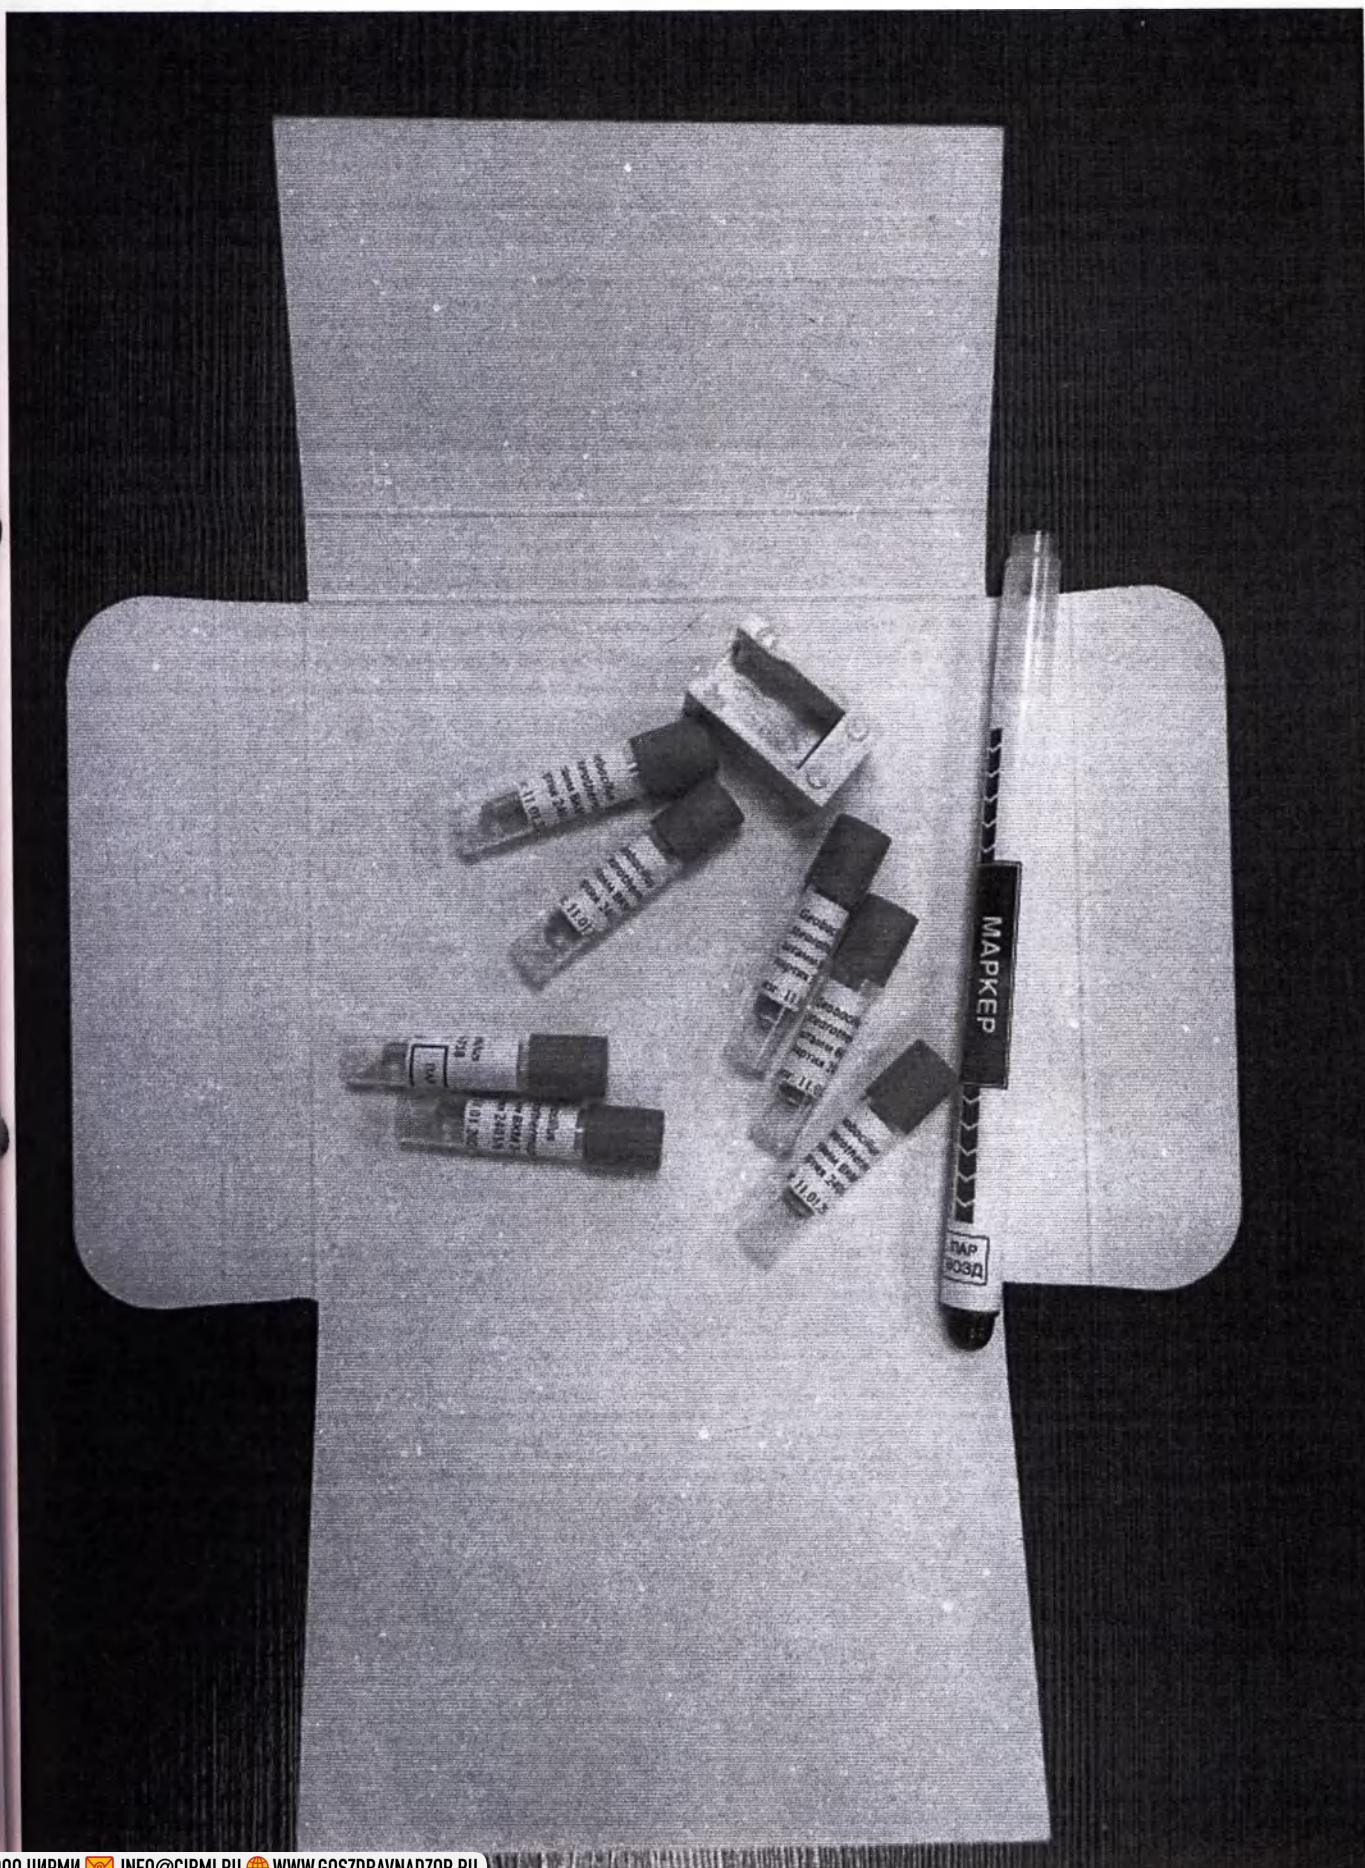


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия:

Индикаторы биологические, одноразовые для контроля паровой стерилизации «ТерраМед»

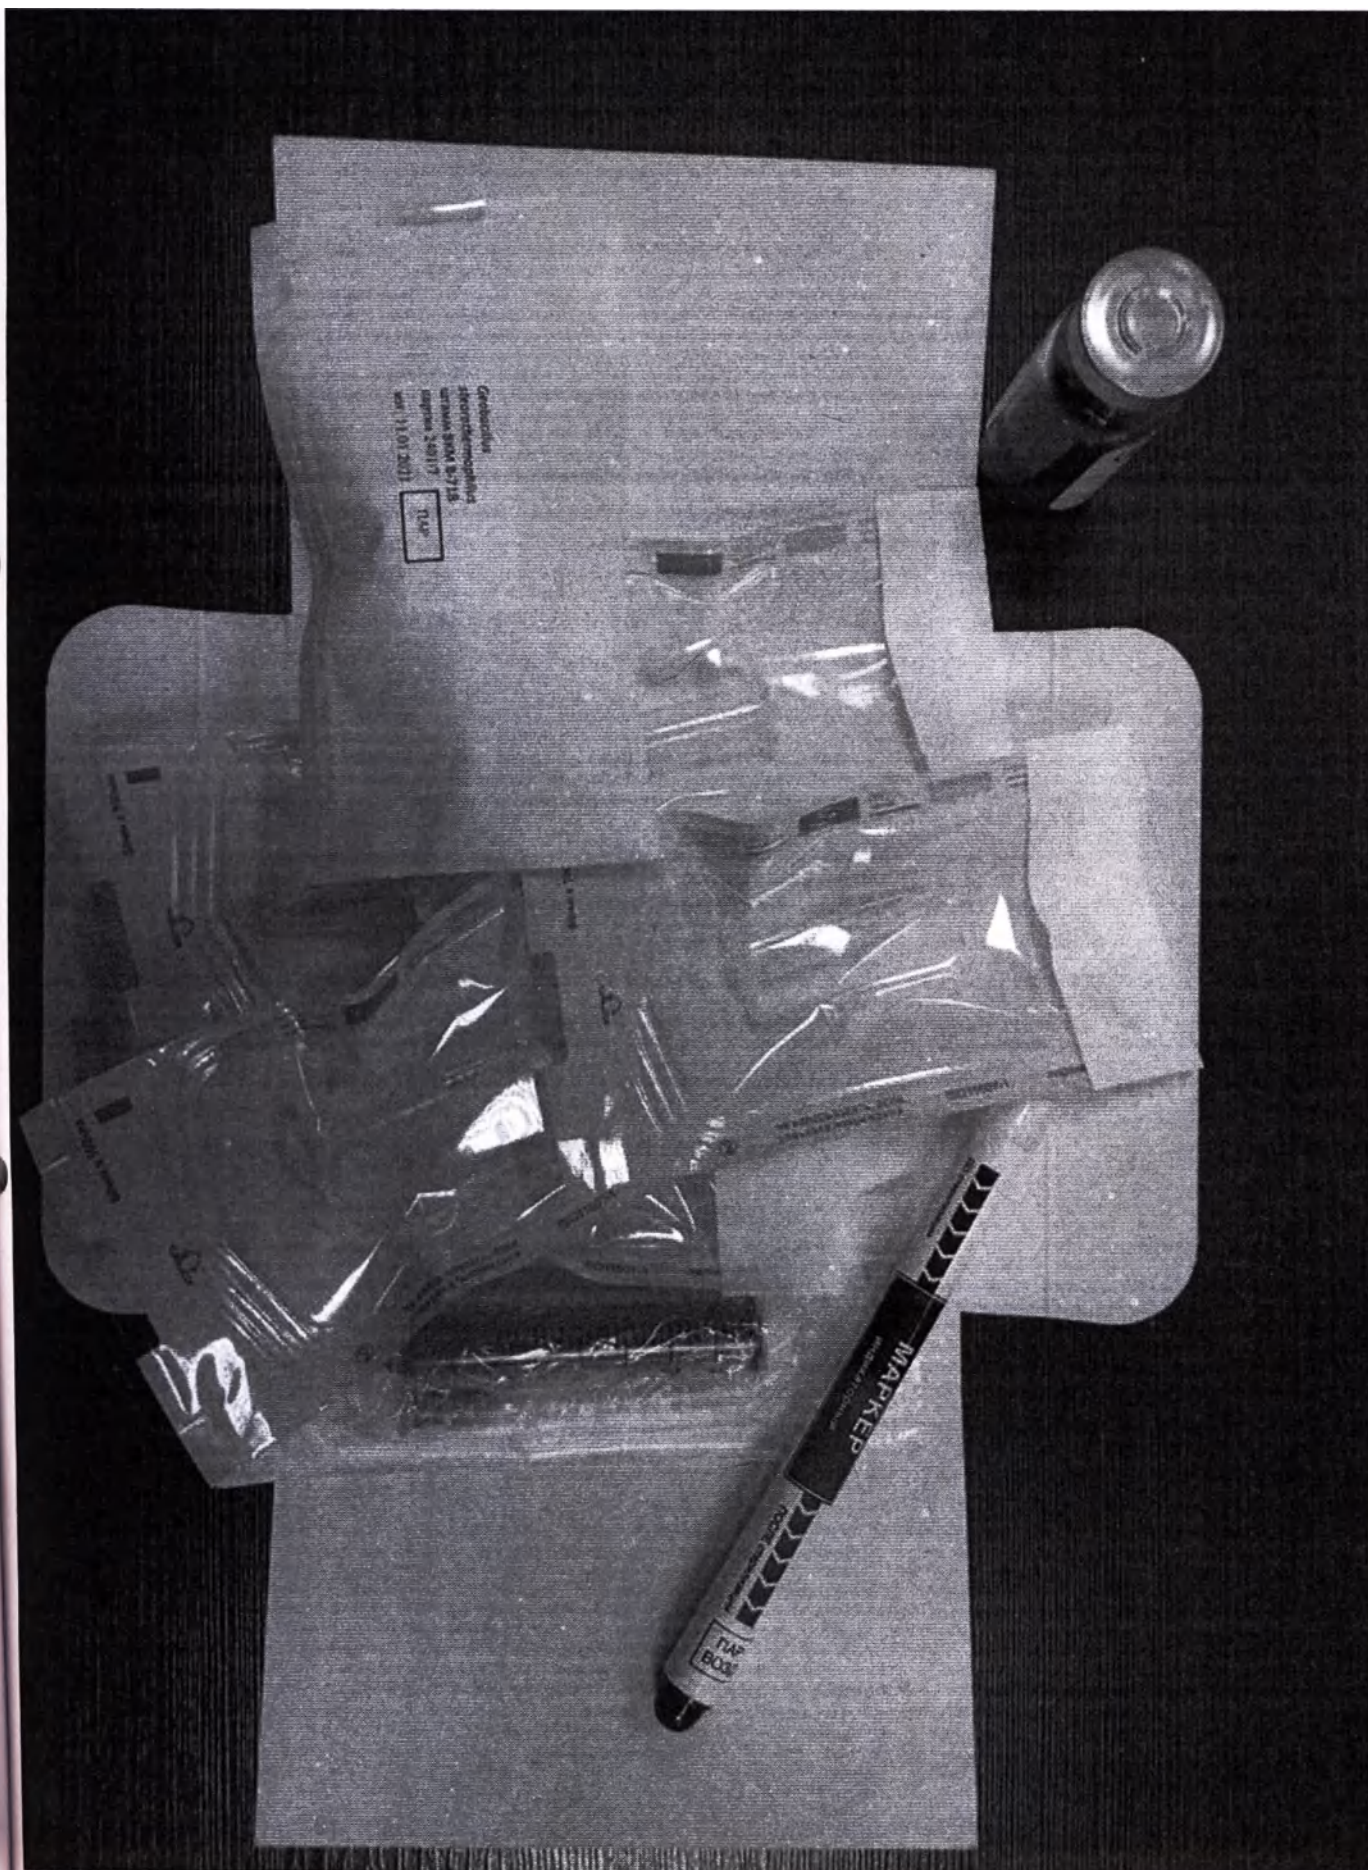

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия:

Индикаторы биологические, одноразовые для контроля газовой (пароформальдегидной) стерилизации, автономные «ТерраМед»

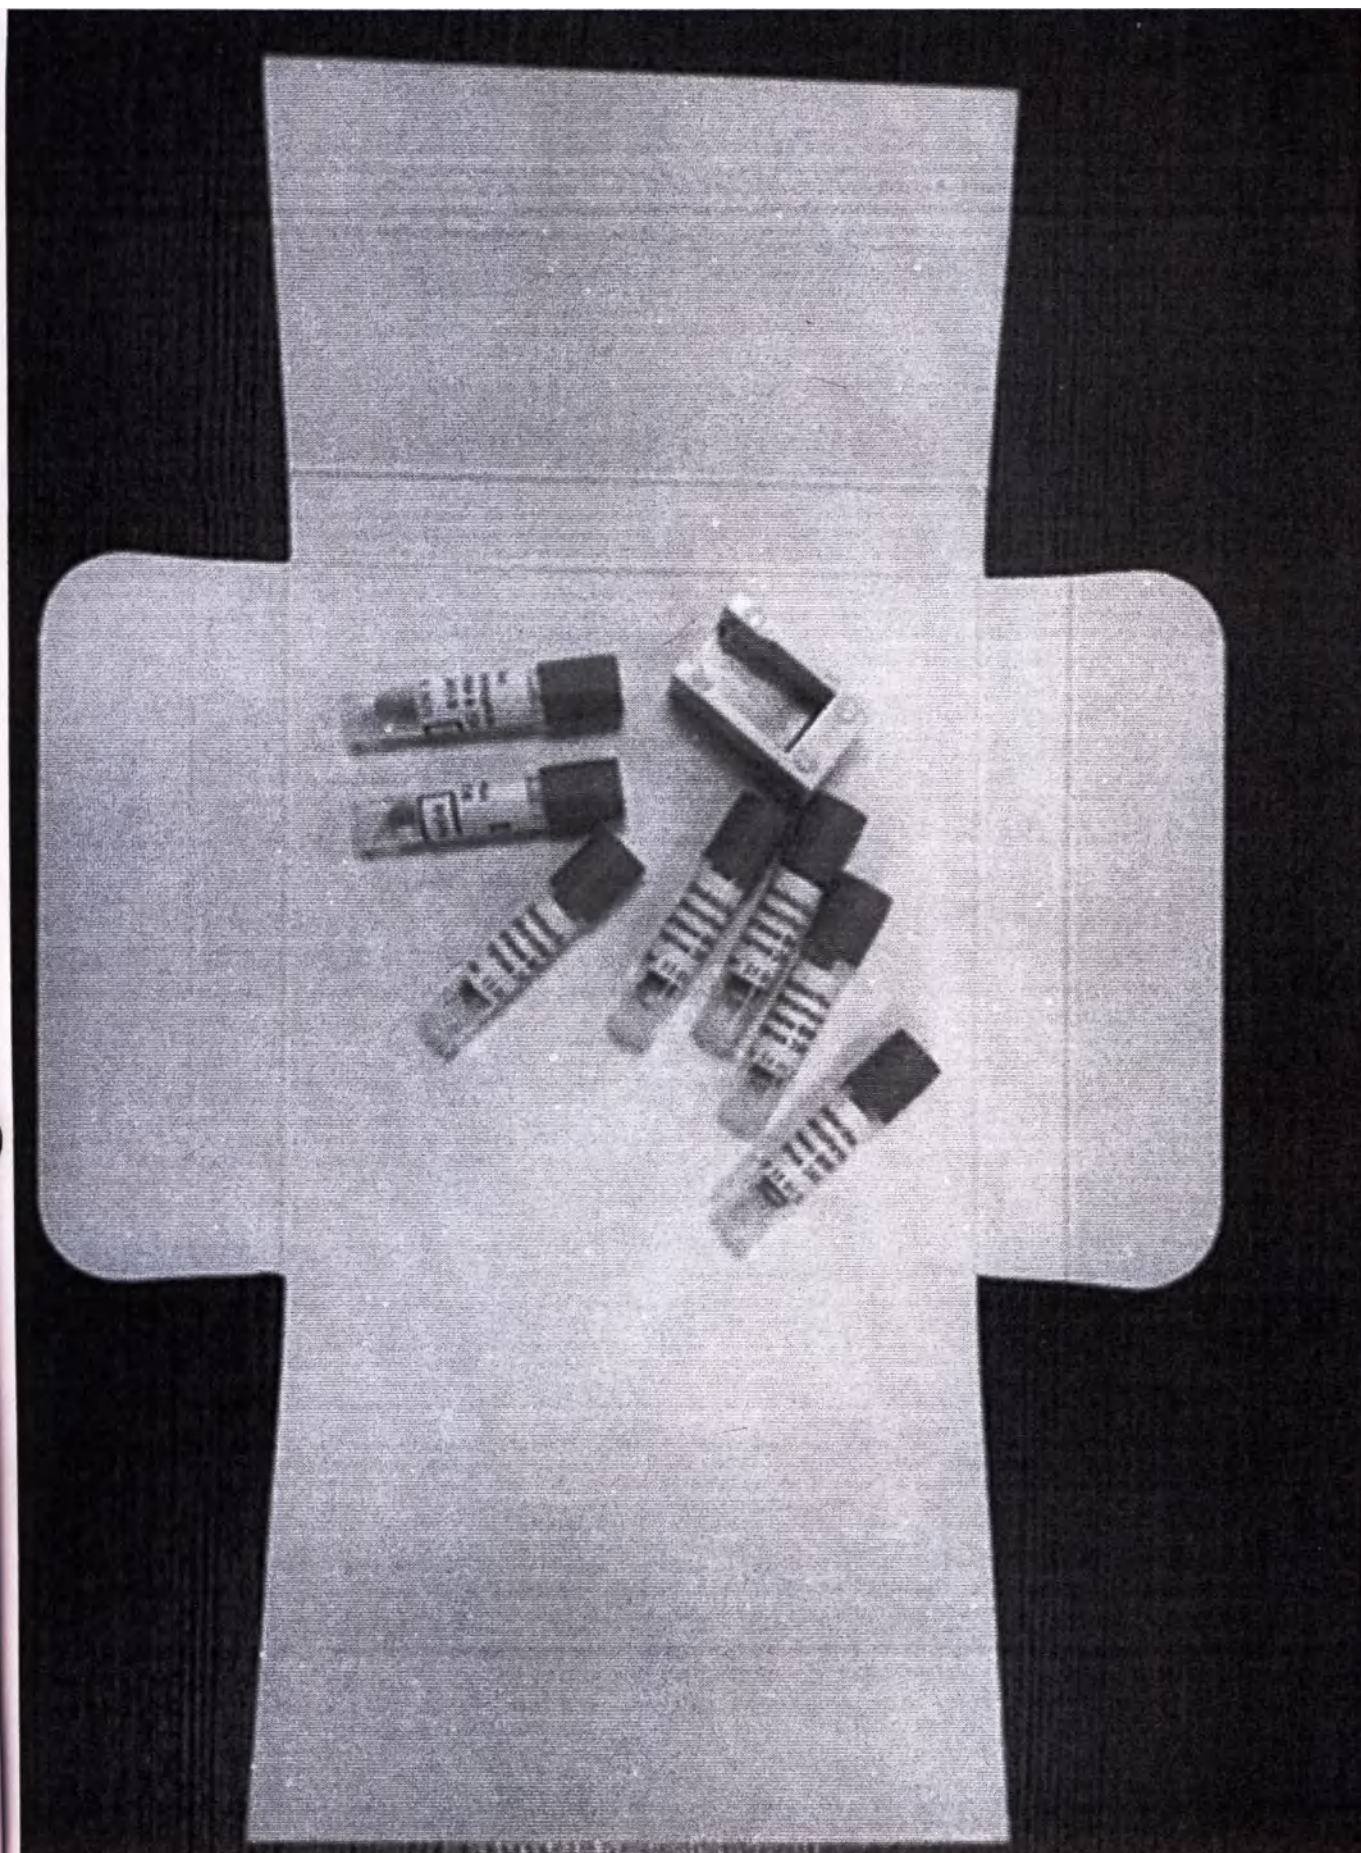


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия:

**Индикаторы биологические, одноразовые для контроля газовой (пароформальдегидной) стерилизации
«ТерраМед»**



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия:

**Индикаторы биологические, одноразовые для контроля стерилизации парами перекиси водорода
(плазменная стерилизация), автономные «ТерраМед»**

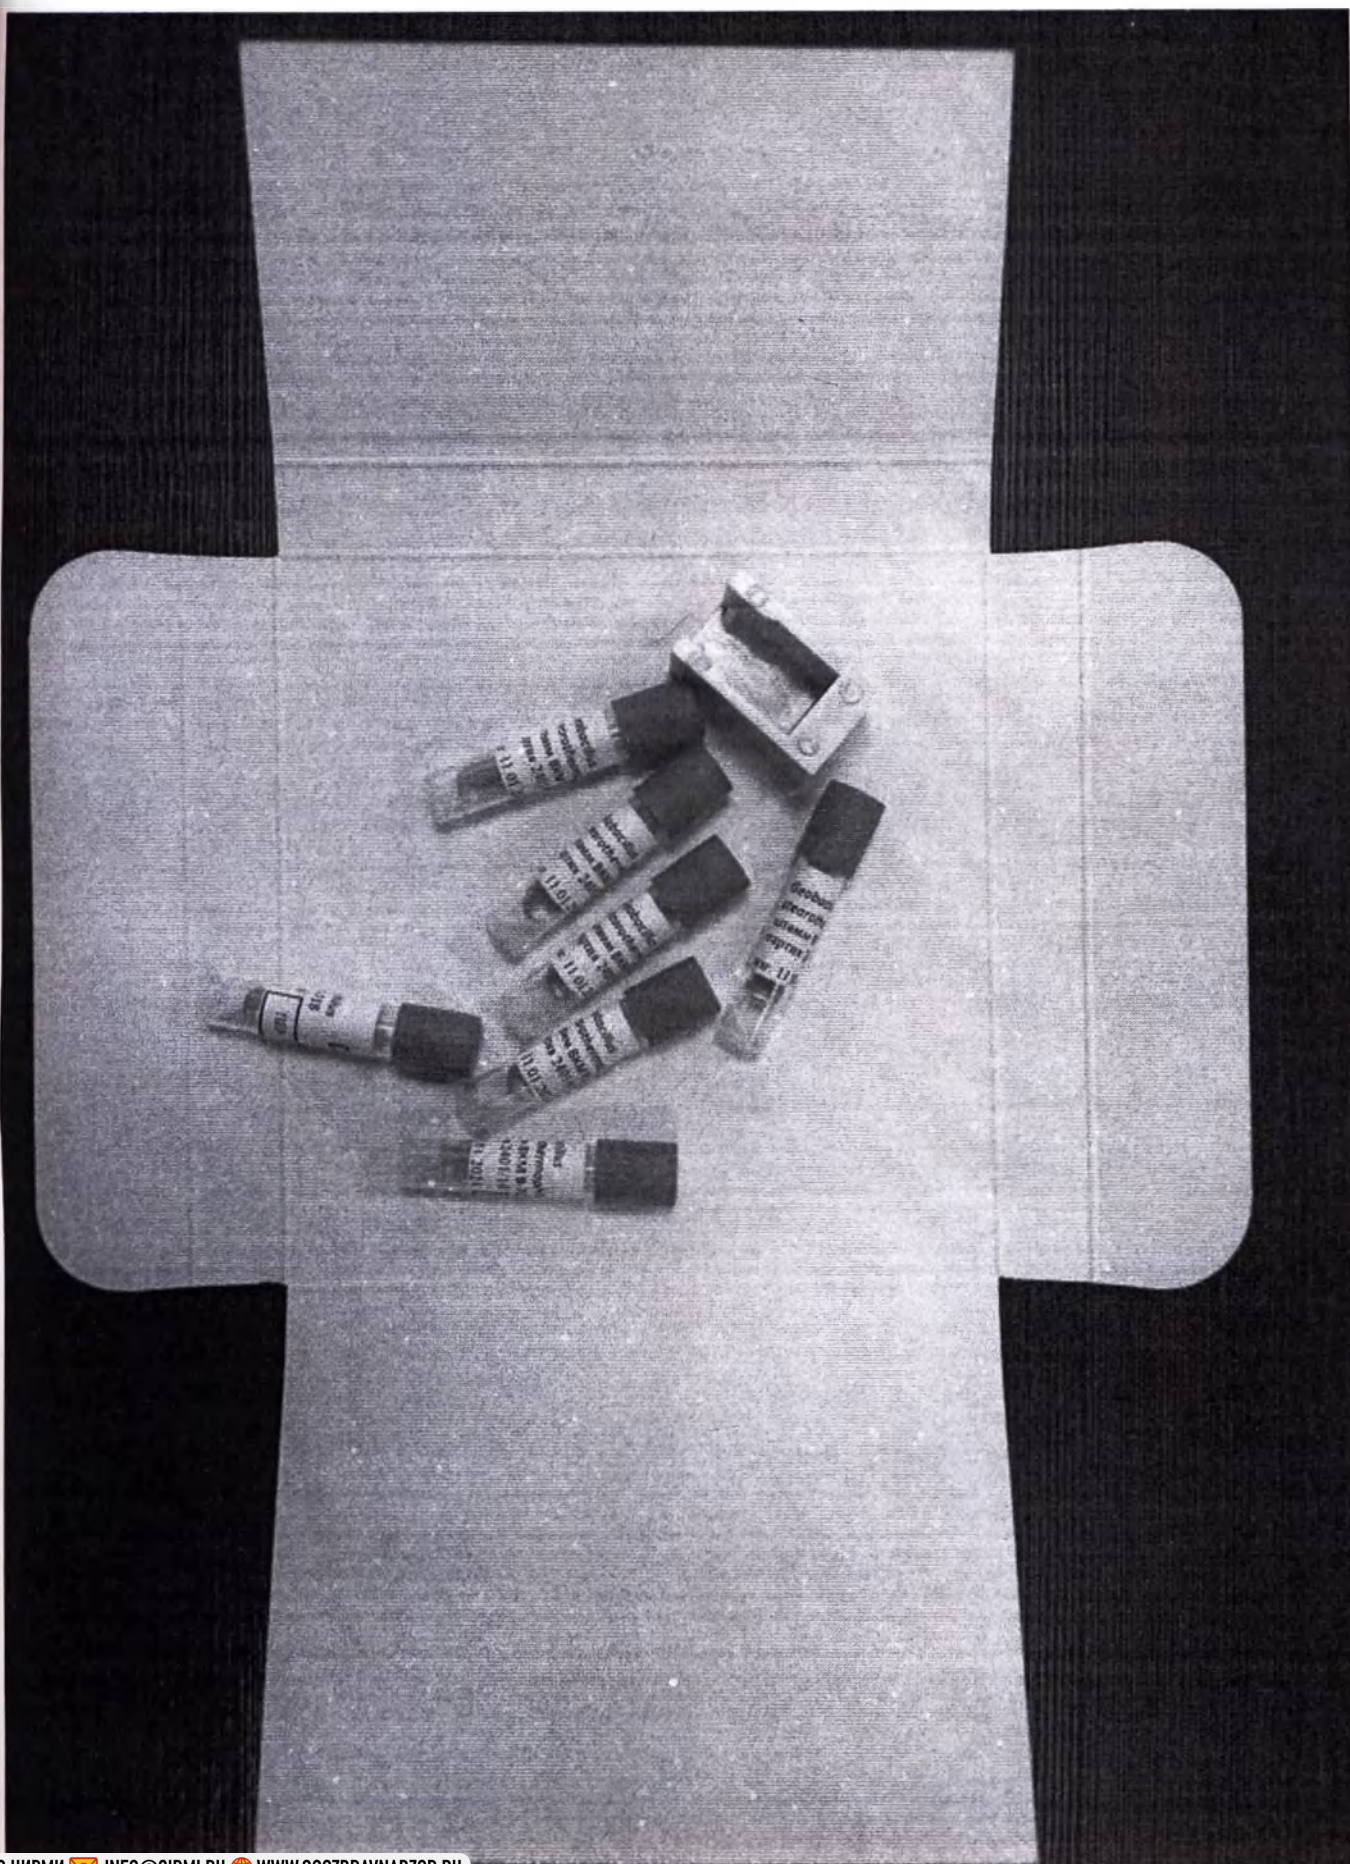

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия:

**Индикаторы биологические, одноразовые для контроля стерилизации парами перекиси водорода
(плазменная стерилизация) «ТерраМед»**



Фотографическое изображение тарной упаковки:

**Индикаторы биологические, одноразовые для контроля воздушной стерилизации, автономные
«ТерраМед»**

ООО Компания «ТерраМед»
141401, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001,
тел. +7(499) 391-66-45

Сделано в России

Индикаторы биологические одноразовые для контроля стерилизации «ТерраМед»
по ТУ 32.50.50-003-01432322-2021:

Индикаторы биологические, одноразовые для контроля воздушной стерилизации,
автономные «ТерраМед»

Рег.уд. № ОТ

Количество в упаковке: индикаторов - 5 шт. + 1 «контроль»

Дата изготовления: янв 2021г.

Годеи до: янв 2024г.

Номер партии: 2401/1

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C,
относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей,
нагревательных приборов

Фотографическое изображение тарной упаковки:

**Индикаторы биологические, одноразовые для контроля воздушной стерилизации, автономные
«ТерраМед»**

ООО Компания «ТерраМед»
141401, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001,
тел. +7(499) 391-66-45

Сделано в России

Индикаторы биологические одноразовые для контроля стерилизации «ТерраМед»
по ТУ 32.50.50-003-01432322-2021:

Индикаторы биологические, одноразовые для контроля воздушной стерилизации
«ТерраМед»

Рег. уд. № от

Количество в упаковке: индикаторов - 2 шт. + 1 «контроль»

Дата изготовления: янв 2021г.

Годен до: янв 2024г.

Номер партии: 2401/2

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C,
относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей,
нагревательных приборов

Фотографическое изображение тарной упаковки:

Индикаторы биологические, одноразовые для контроля паровой и воздушной стерилизации, автономные «ТерраМед»

ООО Компания «ТерраМед»
141401, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001,
тел. +7(499) 391-66-45

Сделано в России

Индикаторы биологические одноразовые для контроля стерилизации «ТерраМед»
по ТУ 32.50.50-003-01432322-2021;

Индикаторы биологические, одноразовые для контроля паровой и воздушной
стерилизации, автономные «ТерраМед»

Рег.уд. № 01

Количество в упаковке: индикаторов - 5 шт. + 1 «контроль»

Дата изготовления: янв 2021г.

Годен до: янв 2024г.

Номер партии: 2401/3

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C,
относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей,
нагревательных приборов

Фотографическое изображение тарной упаковки:

Индикаторы биологические, одноразовые для контроля стерилизации оксидом этилена, автономные
«ТерраМед»

ООО Компания «ТерраМед»

141401, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001,
тел. +7(499) 391-66-45

Сделано в России

Индикаторы биологические одноразовые для контроля стерилизации «ТерраМед»
по ТУ 32.50.50-003-01432322-2021:

Индикаторы биологические, одноразовые для контроля стерилизации оксидом
этилена, автономные «ТерраМед»

Сер. уа. № от

Количество в упаковке: индикаторов - 5 шт. + 1 «контроль»

Дата изготовления: янв 2021г.

Годен до: янв 2024г.

Номер партии: 2401/4

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C,
относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей,
нагревательных приборов

Фотографическое изображение тарной упаковки:

Индикаторы биологические, одноразовые для контроля стерилизации оксидом этилена «ТерраМед»

ООО Компания «ТерраМед»

141401, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001,
тел. +7(499) 391-66-45

Сделано в России

Индикаторы биологические одноразовые для контроля стерилизации «ТерраМед»
по ТУ 32.50.50-003-01432322-2021;

Индикаторы биологические, одноразовые для контроля стерилизации
оксидом этилена «ТерраМед»

Рег. уд. № от

Количество в упаковке: индикаторов - 2 шт. + 1 «контроль»

Дата изготовления: янв 2021г.

Годен до: янв 2024г.

Номер партии: 2401/5

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C,
относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей,
нагревательных приборов

Фотографическое изображение тарной упаковки:

**Индикаторы биологические, одноразовые для контроля паровой стерилизации, автономные
«ТерраМед»**

ООО Компания «ТерраМед»
141401, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001,
тел. +7(499) 391-66-45

Сделано в России

**Индикаторы биологические одноразовые для контроля стерилизации «ТерраМед»
по ТУ 32.50.50-003-01432322-2021:**

**Индикаторы биологические, одноразовые для контроля паровой стерилизации,
автономные «ТерраМед»**

Рег.уд. № ОТ

Количество в упаковке: индикаторов - 5 шт. + 1 «контроль»

Дата изготовления: июль 2021г.

Годен до: июль 2024г.

Номер партии: 2401/6

**Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C,
относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей,
нагревательных приборов**

Фотографическое изображение тарной упаковки:

Индикаторы биологические, одноразовые для контроля паровой стерилизации «ТерраМед»

ООО Компания «ТерраМед»

141401, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001,
тел. +7(499) 391-66-45

Сделано в России

Индикаторы биологические одноразовые для контроля стерилизации «ТерраМед»
по ТУ 32.50.50-003-01432322-2021:

Индикаторы биологические, одноразовые для контроля паровой стерилизации
«ТерраМед»

Рег.уд. № от

Количество в упаковке: индикаторов - 2 шт. + 1 «контроль»

Дата изготовления: янв 2021г.

Годен до: янв 2024г.

Номер партии: 2401/7

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C,
относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей,
нагревательных приборов

Фотографическое изображение тарной упаковки:

Индикаторы биологические, одноразовые для контроля газовой (пароформальдегидной) стерилизации, автономные «ТерраМед»

ООО Компания «ТерраМед»

141401, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001,
тел. +7(499) 391-66-45

Сделано в России

Индикаторы биологические одноразовые для контроля стерилизации «ТерраМед»
по ТУ 32.50.50-003-01432322-2021:

Индикаторы биологические, одноразовые для контроля газовой
(пароформальдегидной) стерилизации, автономные «ТерраМед»

Рег.уд. № от

Количество в упаковке: индикаторов - 5 шт. + 1 «контроль»

Дата изготовления: янв 2021г.

Годен до: янв 2024г.

Номер партии: 2401/8

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C,
относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей,
нагревательных приборов

Фотографическое изображение тарной упаковки:

Индикаторы биологические, одноразовые для контроля газовой (пароформальдегидной) стерилизации
«ТерраМед»

ООО Компания «ТерраМед»

141401, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001,
тел. +7(499) 391-66-45

Сделано в России

Индикаторы биологические одноразовые для контроля стерилизации «ТерраМед» по
ТУ 32.50.50-003-01432322-2021:

Индикаторы биологические, одноразовые для контроля газовой
(пароформальдегидной) стерилизации «ТерраМед»

Рег.уд. № от

Количество в упаковке: индикаторов - 2 шт. + 1 «контроль»

Дата изготовления: янв 2021г.

Годен до: янв 2024г.

Номер партии: 2401/9

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C,
относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей,
нагревательных приборов

Фотографическое изображение тарной упаковки:

Индикаторы биологические, одноразовые для контроля стерилизации парами перекиси водорода (плазменная стерилизация), автономные «ТерраМед»

ООО Компания «ТерраМед»

141401, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001,
тел. +7(499) 391-66-45

Сделано в России

Индикаторы биологические одноразовые для контроля стерилизации «ТерраМед»:
ТУ 32.50.50-003-01432322-2021;

Индикаторы биологические, одноразовые для контроля стерилизации парами
перекиси водорода (плазменная стерилизация), автономные «ТерраМед»

Рег. уд. № ОТ

Количество в упаковке: индикаторов - 5 шт. + 1 «контроль»

Дата изготовления: янв 2021г.

Годен до: янв 2024г.

Номер партии: 2401/10

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C,
относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей,
нагревательных приборов

Фотографическое изображение тарной упаковки:

**Индикаторы биологические, одноразовые для контроля стерилизации парами перекиси водорода
(плазменная стерилизация) «ТерраМед»**

ООО Компания «ТерраМед»

141401, Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001,
тел. +7(499) 391-66-45

Сделано в России

Индикаторы биологические одноразовые для контроля стерилизации «ТерраМед» по
ТУ 32.50.50-003-01432322-2021:

Индикаторы биологические, одноразовые для контроля стерилизации парами
перекиси водорода (плазменная стерилизация) «ТерраМед»

Рег. уд. № от

Количество в упаковке: индикаторов - 2 шт. + 1 «контроль»

Дата изготовления: янв 2021г.

Годен до: янв 2024г.

Номер партии: 2401/11

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C,
относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей,
нагревательных приборов



Директор

ООО Компания "ТерраМед"

Э.Д. Болашвили

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

23 (двадцать три)

ЛИСТОВ