

Фотографии медицинского изделия

«Набор реагентов для калибровки «MagnaLIA SARS-CoV-2 IgM», производства ООО «Компания Алкор Био»

Вариант исполнения 1	стр. 2,3,4
Вариант исполнения 2	стр. 5,6,7
Фотографическое изображение калибраторов	стр. 8,9

**Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»**



Полынцев Д.Г.

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для калибровки
«MagnoLIA SARS-CoV-2 IgM»,
по ТУ 21.20.23-554-98539446-2020

Кат. № 2730101 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики in vitro

«Набор реагентов для калибровки «MagnoLIA SARS-CoV-2 IgM»,

по ТУ 21.20.23-554-98539446-2020

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA SARS-CoV-2 IgM»,
по ТУ 21.20.23-554-98539446-2020

Кат. № 2730101 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.




ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для калибровки
«MagnoLIA SARS-CoV-2 IgM»,
по ТУ 21.20.23-554-98539446-2020

Кат. № 2730101 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.



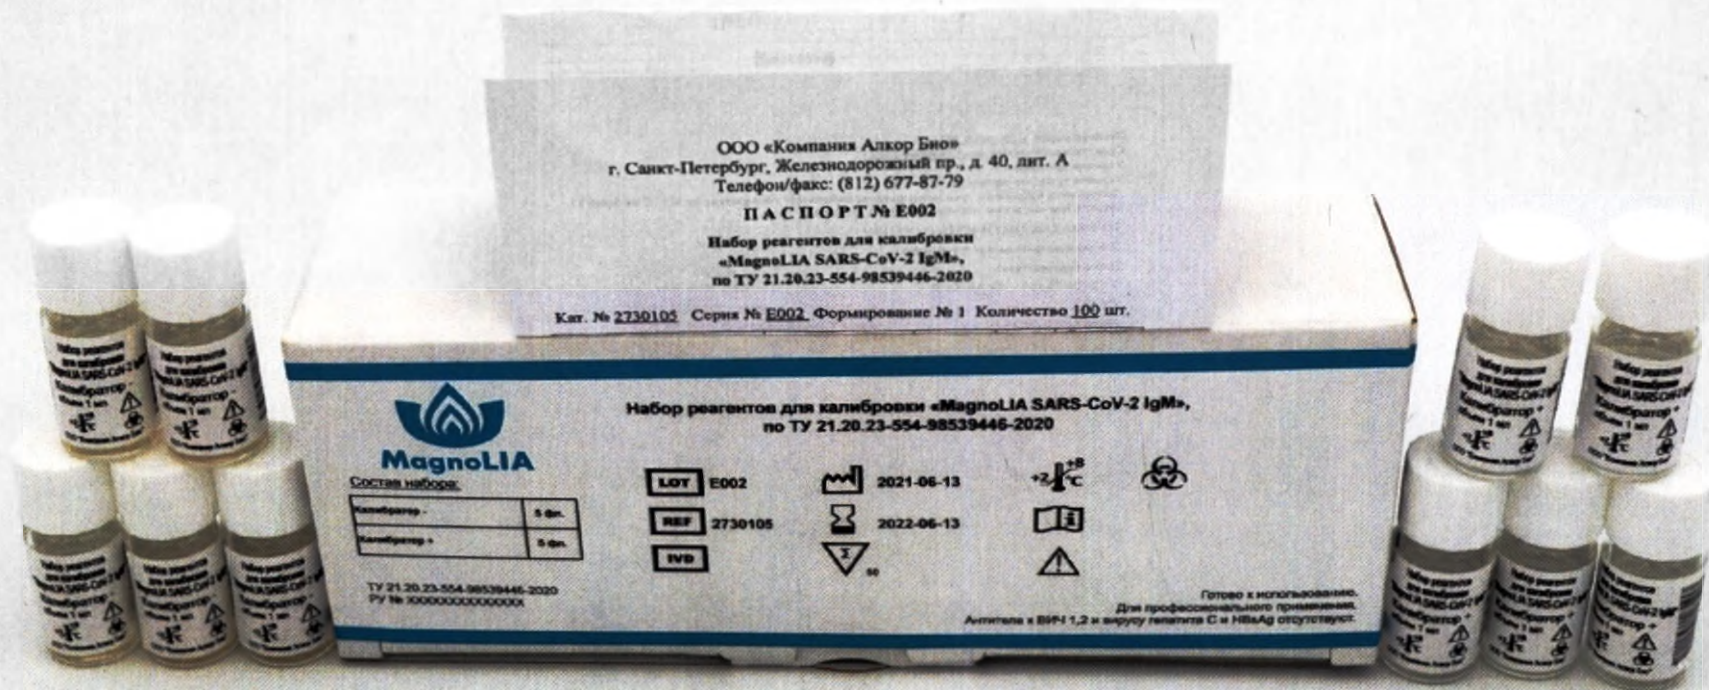

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики in vitro
«Набор реагентов для калибровки «MagnoLIA SARS-CoV-2 IgM»,
по ТУ 21.20.23-554-98539446-2020

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для калибровки
«MagnoLIA SARS-CoV-2 IgM»,
по ТУ 21.20.23-554-98539446-2020

Кат. № 2730105 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.

MagnoLIA SARS-CoV-2 IgM

LOT E002 2022-08-13

REF 2730105 +2⁺8
°C

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79


ПАСПОРТ № E002

Набор реагентов для калибровки
«MagnoLIA SARS-CoV-2 IgM»,
по ТУ 21.20.23-554-98539446-2020

Кат. № 2730105 Серия № E002 Формирование № 1 Количество 100 шт.



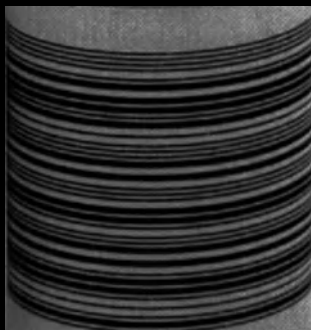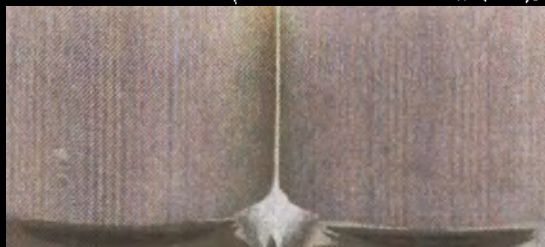

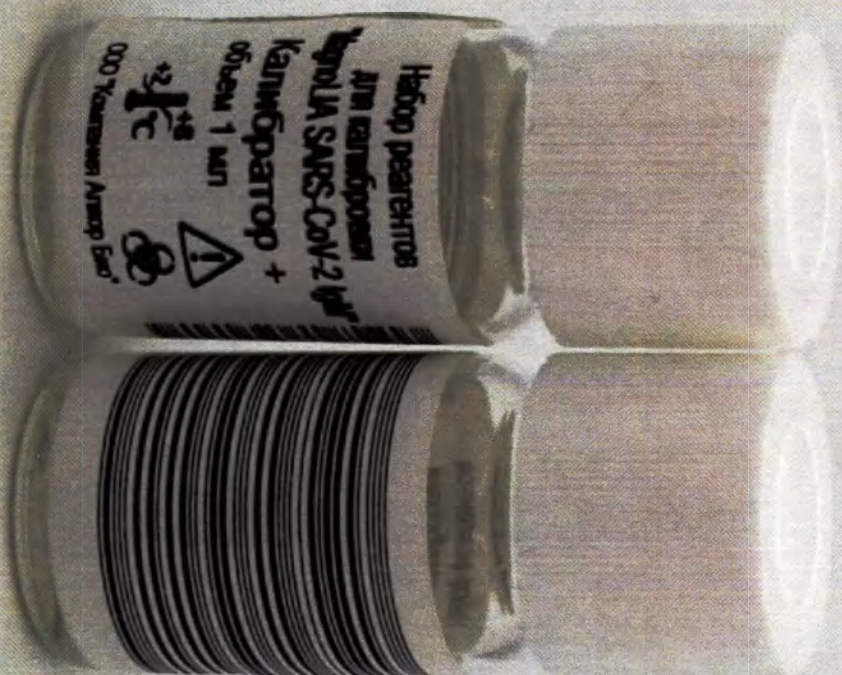


Набор реагентов
для исследования
Hepatitis SARS-CoV-2
Калибратор +
объем 1 мл
000 "Центральный Антисептик"
ИЗМ

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 9 (девятка) лист 86

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Польшцев

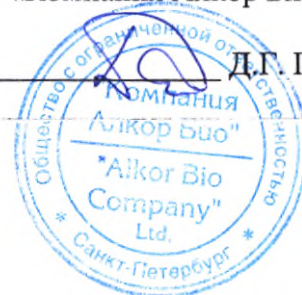

Макеты этикеток на медицинское изделие

**«Набор реагентов для калибровки «MagnoLIA SARS-CoV-2 IgM»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»



Полынцев Д.Г.

Вариант исполнения 1

Кат. № 2730101

На коробку:





Набор реагентов для калибровки
«MagnaLIA SARS-CoV-2 IgM»,
по ТУ 21.20.23-554-98539446-2020

Состав набора:

Калибратор -	1 фл.
Калибратор +	1 фл.

Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

LOT E002

REF 2730101

IVD

2021-06-12

2022-06-12

Σ₁₀

Icons: -20°C, biohazard, book, warning

ТУ 21.20.23-554-98539446-2020
ПУ № XXXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

На флаконы:



«Набор реагентов для калибровки «MagnaLIA SARS-CoV-2 IgM»

Макет этикеток



Вариант исполнения 2

Кат. № 2730105

На коробку:



ООО «Компани Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Митяевское шоссе, д. 40, лит. А
Тел./факс: +7(812)6787878, 6721062
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

MagnaLIA SARS-CoV-2 IgM



Состав набора:

Калибратор -	5 фл.
Калибратор +	5 фл.

ТУ 21.20.23-554-98539446-2020
РУ № XXXXXXXXXXXXXXX


Набор реагентов для калибровки «MagnaLIA SARS-CoV-2 IgM»,
по ТУ 21.20.23-554-98539446-2020

LOT E002	 2021-06-13	 +2 ⁺ 8 ⁺ °C	
REF 2730105	 2022-06-13		
IVD	 50		



Готово к использованию.
Для профессионального применения.
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

На флаконы:

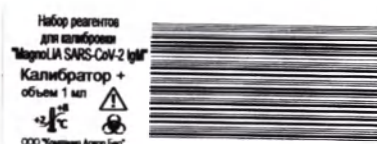

- 5 шт



- 5 шт

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 3 (Три) лист а

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев

