

2

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН»
Фомина Н.В.
«27» 04 2023 г.
М.П.

Фотографические изображения медицинского изделия

Тест-полоски для экспресс-измерителя концентрации глюкозы в капиллярной крови АйЧек.РУ
по ТУ 21.20.23-002-18023326-2018










3 вид флакона для тест-полосок



■ Pantone 302 C ■ Black

А)

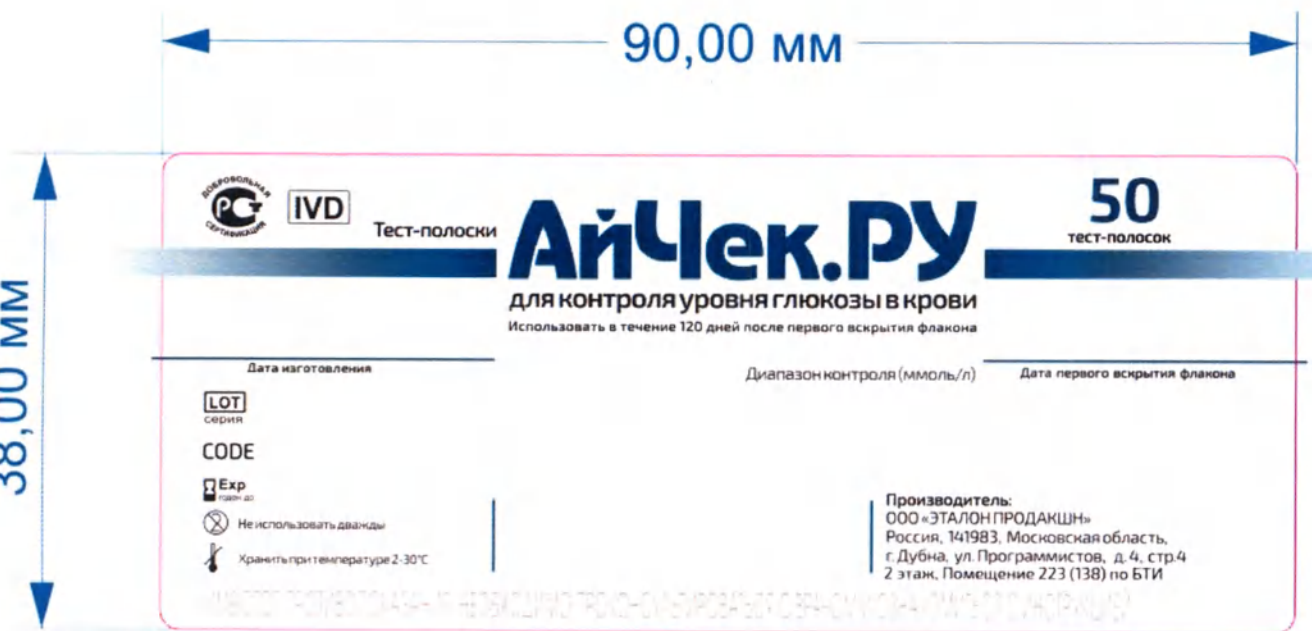


■ Pantone 302 C ■ Black

Б)

иный вид маркировки флакона для тест-полосок.

вариант исполнения 1, Вариант исполнения 4.

вариант исполнения 2, Вариант исполнения 3, Вариант исполнения 5, Вариант исполнения 6.

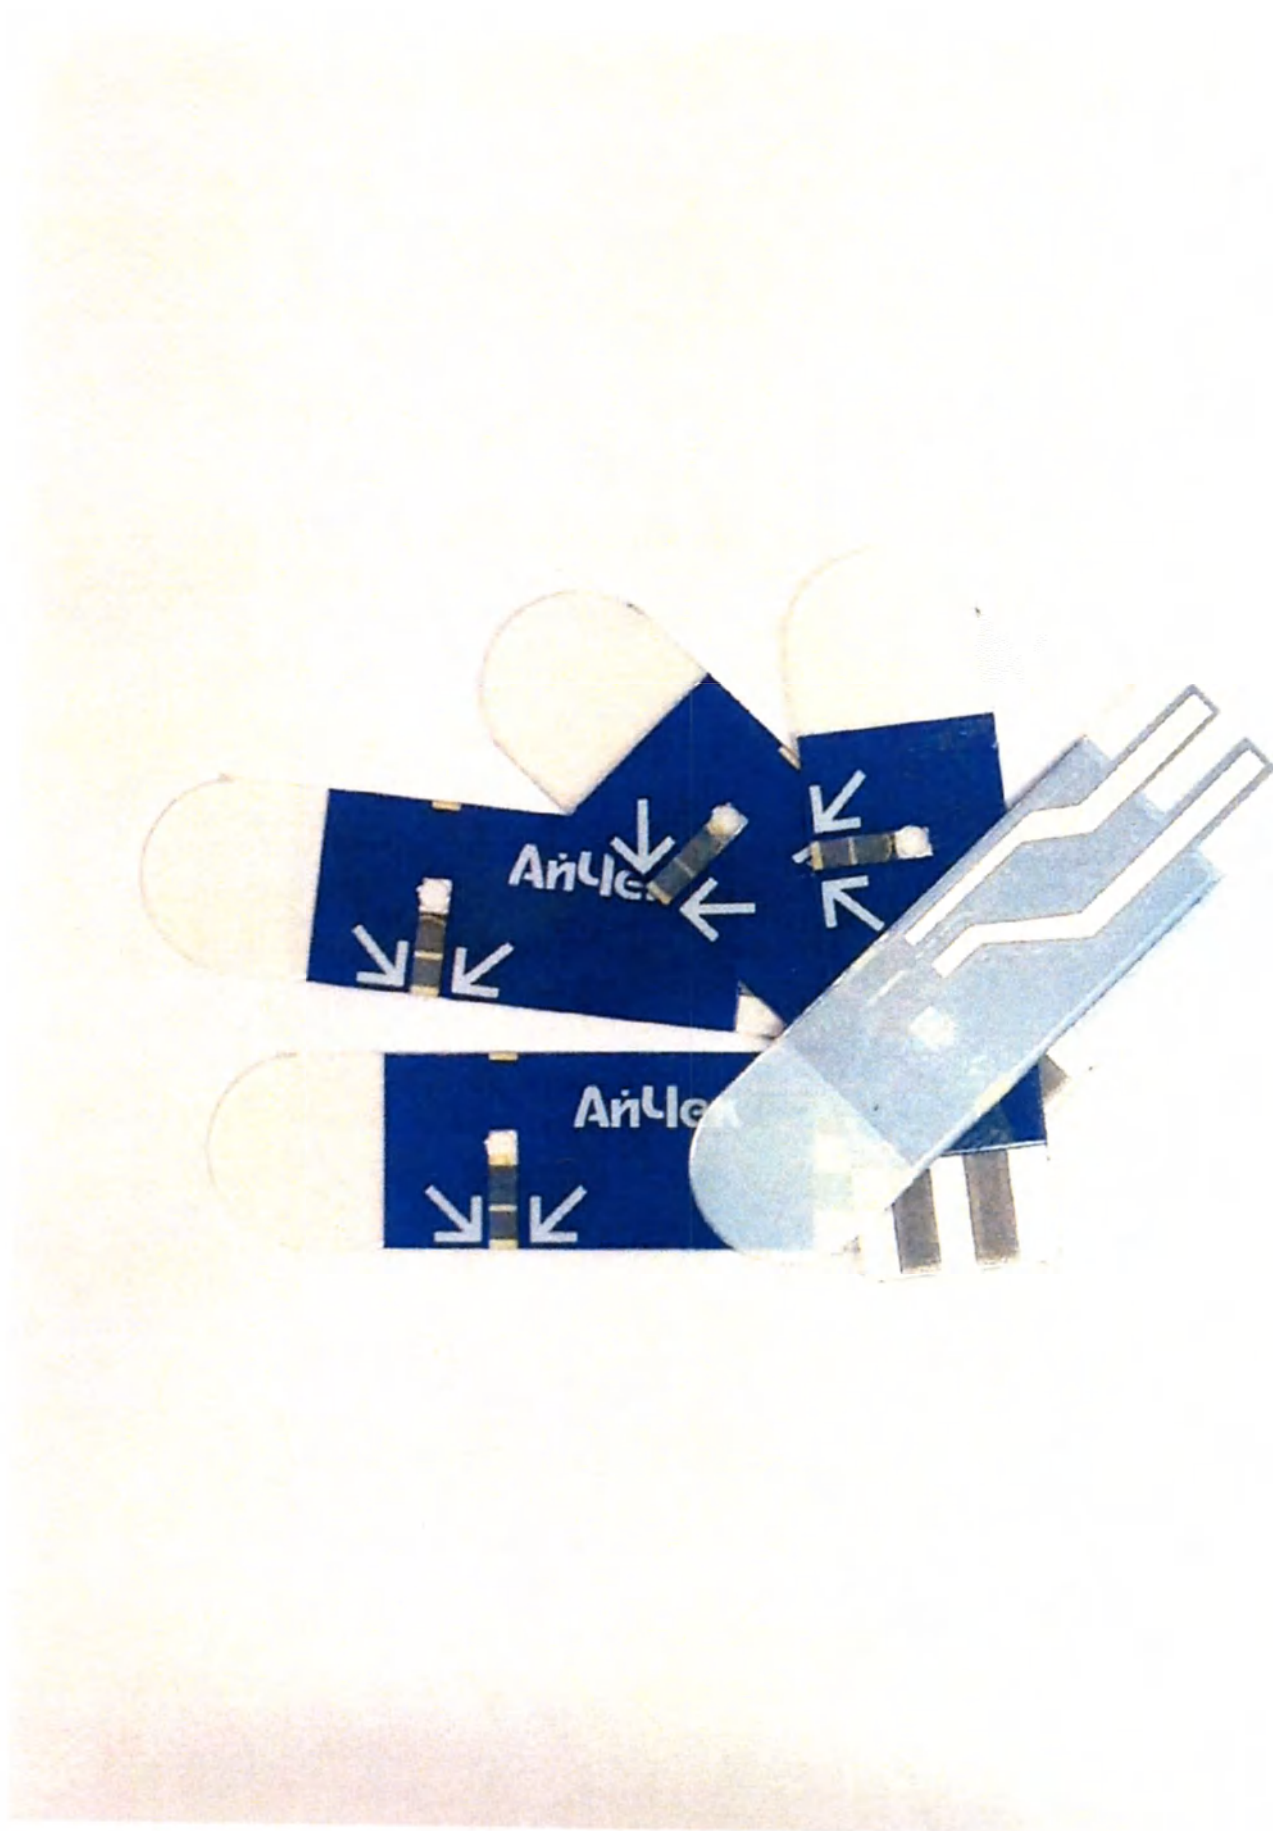

й вид тест-полосок

АйЧек.РУ

ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

 09/2022
дата изготовления

LOT 225CA020051

 **EXP** 08/2024



ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

АйЧек.РУ

Тест-полоски для экспресс-измерителя
концентрации глюкозы
в капиллярной крови АйЧек.РУ
по ТУ 21.20.23-002-18023326-2018

Регистрационное удостоверение:
№ _____ от _____

Производитель:
ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН»,
Россия



Адрес производителя:
Россия, 141983, Московская область,
г. Дубна, ул. Программистов, д. 4,
стр. 2, офис 317.


Адрес производства:
Россия, 141983, Московская область,
г. Дубна, ул. Программистов, д. 4,
стр. 4, 2 этаж, помещение 223 (138)
по БТИ.

Информационный центр:
8 800 555 46 00
e-mail: ivd_dubna@mail.ru

АйЧек.РУ

ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

50
ТЕСТ-ПОЛОСОК

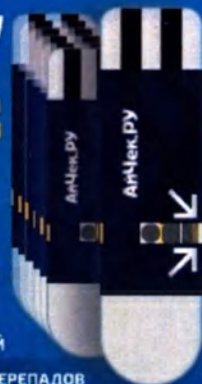

ИМЕЮТ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, НЕОБХОДИМО ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ В ВНИМАНИЕ
СРАЗУ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ ПОЛОСКИ

- ✓ ЗАБОР КРОВИ ЗА 1 СЕКУНДУ
- ✓ УНИКАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ
- ✓ ЗАЩИТА ОТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПЕРЕПАДОВ



Расходные материалы
к экспресс-измерителю АйЧек.РУ

Тест-полоски..... 50 шт.
Флакон для тест-полосок..... 2 шт.
Руководство по эксплуатации..... 1 шт.

Смотри на верхнем клапане упаковки:



Условия эксплуатации и хранения:

Тест-полоски могут храниться 24 месяца
с даты изготовления и в течение 120 дней
после первого вскрытия флакона.

Хранить при температуре:
от +2°C до +30°C

Не использовать дважды!


Внимание!
Прочтите инструкцию
перед применением



АйЧек.РУ

ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

*Для использования с экспресс-измерителем АйЧек.РУ



50
ТЕСТ-ПОЛОСОК

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ



ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

АйЧек.РУ

V3/DA01012

Тест-полоски для экспресс-измерителя
концентрации глюкозы
в капиллярной крови АйЧек.РУ
по ТУ 21.20.23-002-18023326-2018

Регистрационное удостоверение:
№ _____ от _____

Производитель:
ООО «СТАЛОН ПРОДАКШН»,
Россия

IVD

Адрес производителя:
Россия, 141983, Московская область,
г. Дубна, ул. Программистов, д. 4,
стр. 2, офис 317.

Адрес производства:
Россия, 141983, Московская область,
г. Дубна, ул. Программистов, д. 4,
стр. 4, 2 этаж, помещение 223 (13В)
по БТИ.

Информационный центр:
8 800 555 49 00
email: ivd_dubna@mail.ru

АйЧек.РУ

ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

50
ТЕСТ-ПОЛОСОК

- ✓ ЗАБОР КРОВИ
ЗА 1 СЕКУНДУ
- ✓ УНИКАЛЬНЫЙ
ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ
- ✓ ЗАЩИТА
ОТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ
ПЕРЕПАДОВ



НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОСЛЕДНИЙ СЛОЙ

Расходные материалы
к экспресс-измерителю АйЧек.РУ

Тест-полоски.....50 шт.
Флакон для тест-полосок.....1 шт.
Руководство по эксплуатации.....1 шт.

Смотри на верхнем клапане упаковки:

LOT Серия | Exp Срок | Data Дата

Условия эксплуатации и хранения:

Тест-полоски могут храниться 24 месяца
с даты изготовления и в течение 120 дней
после первого вскрытия флакона.

Хранить при температуре:
от -2°C до +30°C

Не использовать дважды!

Внимание!
Прочтите инструкцию
перед применением

АйЧек.РУ

ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

50
ТЕСТ-ПОЛОСОК

СДЕЛАНО
В РОССИИ

* Для использования
с экспресс-измерителем
АйЧек.РУ

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ



АйЧек.РУ
ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

Тест-полоски для экспресс-измерителя
концентрации глюкозы
в капиллярной крови АйЧек.РУ
по ТУ 21.20.23-002-18023326-2018

Регистрационное удостоверение:
№ _____ от _____

Производитель:
ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН»,
Россия



Адрес производителя:
Россия, 141983, Московская область,
г. Дубна, ул. Программистов, д. 4,
стр. 2, офис 317.

Адрес производства:
Россия, 141983, Московская область,
г. Дубна, ул. Программистов, д. 4,
стр. 4, 2 этаж, помещение 223 (138)
по БТИ.

Информационный центр:
8 800 555 49 00
e-mail: ivd_dubna@mail.ru

АйЧек.РУ

ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

100
ТЕСТ-ПОЛОСОК

- ✓ ЗАБОР КРОВИ ЗА 1 СЕКУНДУ
- ✓ УНИКАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ
- ✓ ЗАЩИТА ОТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПЕРЕПАДОВ



ИМЕЮТ ПРИМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫЕ ПРОСРОЧЕННЫЕ С РИЗКОМ
СВЯЗАННЫМ С РИЗКОМ ПО ЖИЗНИ



Расходные материалы
к экспресс-измерителю АйЧек.РУ

Тест-полоски.....100 шт.
Флакон для тест-полосок.....4 шт.
Руководство по эксплуатации.....1 шт.

Смотри на верхнем клапане упаковки:



Условия эксплуатации и хранения:

Тест-полоски могут храниться 24 месяца
с даты изготовления и в течение 120 дней
после первого вскрытия флакона.


- Хранить при температуре:
от +2°C до +30°C
- Не использовать дважды!
- Внимание!
Прочтите инструкцию
перед применением



АйЧек.РУ

ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

*Для использования с экспресс-измерителем АйЧек.РУ



100
ТЕСТ-ПОЛОСОК

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

АйЧек.РУ

Тест-полоски для экспресс-измерителя
концентрации глюкозы
в капиллярной крови АйЧек.РУ
по ТУ 21.20.23-002-18023326-2018

Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____

Производитель:
ООО «СТАЛОН ПРОДАКШН»,
Россия



Адрес производителя:
Россия, 141983, Московская
область, г. Дубна,
ул. Программистов, д. 4,
стр. 2, офис 317

Адрес производства:
Россия, 141983, Московская
область, г. Дубна,
ул. Программистов, д. 4,
стр. 4, 2 этаж, помещение 223
(138) по БТИ

Информационный центр:
8 800 555 49 00
e-mail: ivd_dubna@mail.ru

АйЧек.РУ

ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

100
ТЕСТ-ПОЛОСОК

- ✓ ЗАБОР КРОВИ ЗА 1 СЕКУНДУ
- ✓ УНИКАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ
- ✓ ЗАЩИТА ОТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПЕРЕПАДОВ



ИМЕЮТСЯ ПРОТОКОЛЫ ЗАМЕРОВ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ
ОСНАЩАЮТСЯ С РАЗОДРЕТНЫМ ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ



Расходные материалы
к экспресс-измерителю АйЧек.РУ

Тест-полоски..... 100 шт.
Флакон для тест-полосок..... 2 шт.
Руководство по эксплуатации..... 1 шт.

Смотри на верхнем клапане упаковки:



Условия эксплуатации и хранения:

Тест-полоски могут храниться 24 месяца
с даты изготовления и в течение 120 дней
после первого вскрытия флакона.

- Хранить при температуре:
от +2 °C до +30 °C
- Не использовать дважды!
- Внимание!
Прочтите инструкцию
перед применением



АйЧек.РУ

ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

*Для использования с экспресс-измерителем АйЧек.РУ



ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

АйЧек.РУ

Тест-полоски для экспресс-измерителя
концентрации глюкозы
в капиллярной крови АйЧек.РУ
по ТУ 21.20.23-002-18023326-2018

Регистрационное удостоверение:
№ _____ от _____

Производитель:
ООО «СТАЛОН ПРОДАКШН»,
Россия

IVD

Адрес производителя:
Россия, 141983, Московская область,
г. Дубна, ул. Программистов, д. 4,
стр. 2, офис 317.

Адрес производства:
Россия, 141983, Московская область,
г. Дубна, ул. Программистов, д. 4,
стр. 4, 2 этаж, помещение 223 (138)
по БТИ.

Информационный центр:
8 800 555 49 00
e-mail: ivd_dubna@mail.ru

АйЧек.РУ

ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

200
ТЕСТ-ПОЛОСОК

- ✓ ЗАБОР КРОВИ ЗА 1 СЕКУНДУ
- ✓ УНИКАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ
- ✓ ЗАЩИТА ОТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПЕРЕПАДОВ



ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ СЛЮЗЫ ИЛИ КРОВИ. СРОК ХРАНЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Расходные материалы
к экспресс-измерителю АйЧек.РУ

Тест-полоски..... 200 шт.
Флакон для тест-полосок..... 4 шт.
Руководство по эксплуатации..... 1 шт.

Смотри на верхнем клапане упаковки:

LOT Серия | Exp Срок | Date изготовления |

Условия эксплуатации и хранения:

Тест-полоски могут храниться 24 месяца
с даты изготовления и в течение 120 дней
после первого вскрытия флакона.

- Хранить при температуре:
от +2°C до +30°C
- Не использовать дважды!
- Внимание!
Прочтите инструкцию
перед применением



АйЧек.РУ

ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

*Для использования с экспресс-измерителем АйЧек.РУ

СДЕЛАНО
В РОССИИ

200
ТЕСТ-ПОЛОСОК

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ





МЕСТО: 520x240x275



ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН»

141983, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДУБНА, УЛ. ПРОГРАММИСТОВ, Д. 4, СТР.2,
офис 317

НАИМЕНОВАНИЕ:

**ТЕСТ-ПОЛОСКИ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ИЗМЕРИТЕЛЯ
КОНЦЕНТРАЦИИ ГЛЮКОЗЫ В КАПИЛЛЯРНОЙ
КРОВИ АЙЧЕК.РУ ПО ТУ 21.20.23-002-18023326-
2018, вариант исполнения 5**

LOT

222CA020053



ДАТА ИЗГ.:

09/2022



ГОДЕН ДО:

08/2024

Кол-во, шт.: 120

Брутто, кг.: 8,8

Место №

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 16 листа(ов).

Генеральный директор
ООО «ЭТАЛОН ПРОДАКШН»
_____ Фомина Н.В.

