

2021 г.



**Инструмент хирургический с электрическим приводом Zimmer Biomet X Series
Power System в различных вариантах исполнения, с принадлежностями**

1.1. Рукоятка однокнопочная.



1.2. Насадка для сверления АО малая (при необходимости).



1.3. Насадка для сверления Hudson (при необходимости).



1.4. Насадка для сверления Trinkle (при необходимости).



1.5. Насадка для сверления Zimmer/Hudson (при необходимости).



1.6. Насадка для сверления 1/4"(дюймы) с гибридным патроном с ключом (при необходимости).



7. Насадка для сверления 5/32" (дюймы) с гибридным патроном с ключом (при необходимости).



8. Насадка для рими́рования АО с высоким крутящим моментом (при необходимости).



9. Насадка для рими́рования Hattis с высоким крутящим моментом (при необходимости).



10. Насадка для рими́рования Hudson с высоким крутящим моментом (при необходимости).



.11. Насадка для римиования Trinkle с высоким крутящим моментом (при необходимости).



1.12. Насадка для рими́рования DCS/DHS с высоким крутящим моментом (при необходимости).



1.13. Насадка для рими́рования Zimmer/Hudson с высоким крутящим моментом (при необходимости).



14. Насадка для рими́рования 1/4"(дюймы) с высоким крутящим моментом с гибридным патроном с
кочом (при необходимости).



15. Насадка для рими́рования АО со стандартным крутящим моментом (при необходимости).



16. Насадка для рими́рования АО малая со стандартным крутящим моментом (при необходимости).



17. Насадка для рими́рования Harris со стандартным крутящим моментом (при необходимости).



18. Насадка для римиrowания Hudson со стандартным крутящим моментом (при необходимости).



19. Насадка для рими́рования Trinkle со стандартным крутящим моментом (при необходимости).



20. Насадка для рими́рования DCS/DHS со стандартным крутящим моментом (при необходимости).



21. Насадка для рими́рования Zimmer/Hudson со стандартным крутящим моментом (при необходимости).



2. Насадка для римиования 1/4"(дюймы) со стандартным крутящим моментом с гибридным патроном
спочом (при необходимости).



23. Проводник спиц 2,0-4,0 мм (при необходимости).



4. Проводник для проводников 0,6-2,2 мм (при необходимости).



25. Насадка для реципрокной пилы (при необходимости).



26. Насадка для сагиттальной пилы (при необходимости).



27. Асептический аккумулятор (при необходимости).





28. Асептический футляр для аккумулятора (при необходимости).



29. Асептическая воронка для аккумулятора (при необходимости).





30. Зарядное устройство для асептического аккумулятора (при необходимости).








33. Кабель питания (при необходимости).





Zimmer Surgical SA,
Chemin du Pré-Fleur 3
1228 Plan-les-Ouates
Switzerland
Tel: 0041 22 706 21 00
www.zimmerbiomet.com

Certification for Information in Dossier

The submitted document is for application in Russian for medical device "Surgical power tool Zimmer Biomet X Series Power System in various versions, with accessories" and contains the following:

- Owner's Manual

I certify that the documents which are submitted are true and accurate to the best of my knowledge. In addition, Zimmer Surgical SA takes responsibility for any legal obligations related to this submission.

06 Dec. 2021
Reto Mueller
Global research and development Director and Site Lead

ZIMMER SURGICAL SA
3, Chemin du Pré-Fleur
1228 Plan-les-Ouates
Switzerland
Phone : +41 22 706 21 00

1. Рукоятка двухкнопочная.




Принадлежности:

Ключ 1/4"(дюймы) для патрона.




Ключ 5/32" (дюймы) для патрона.




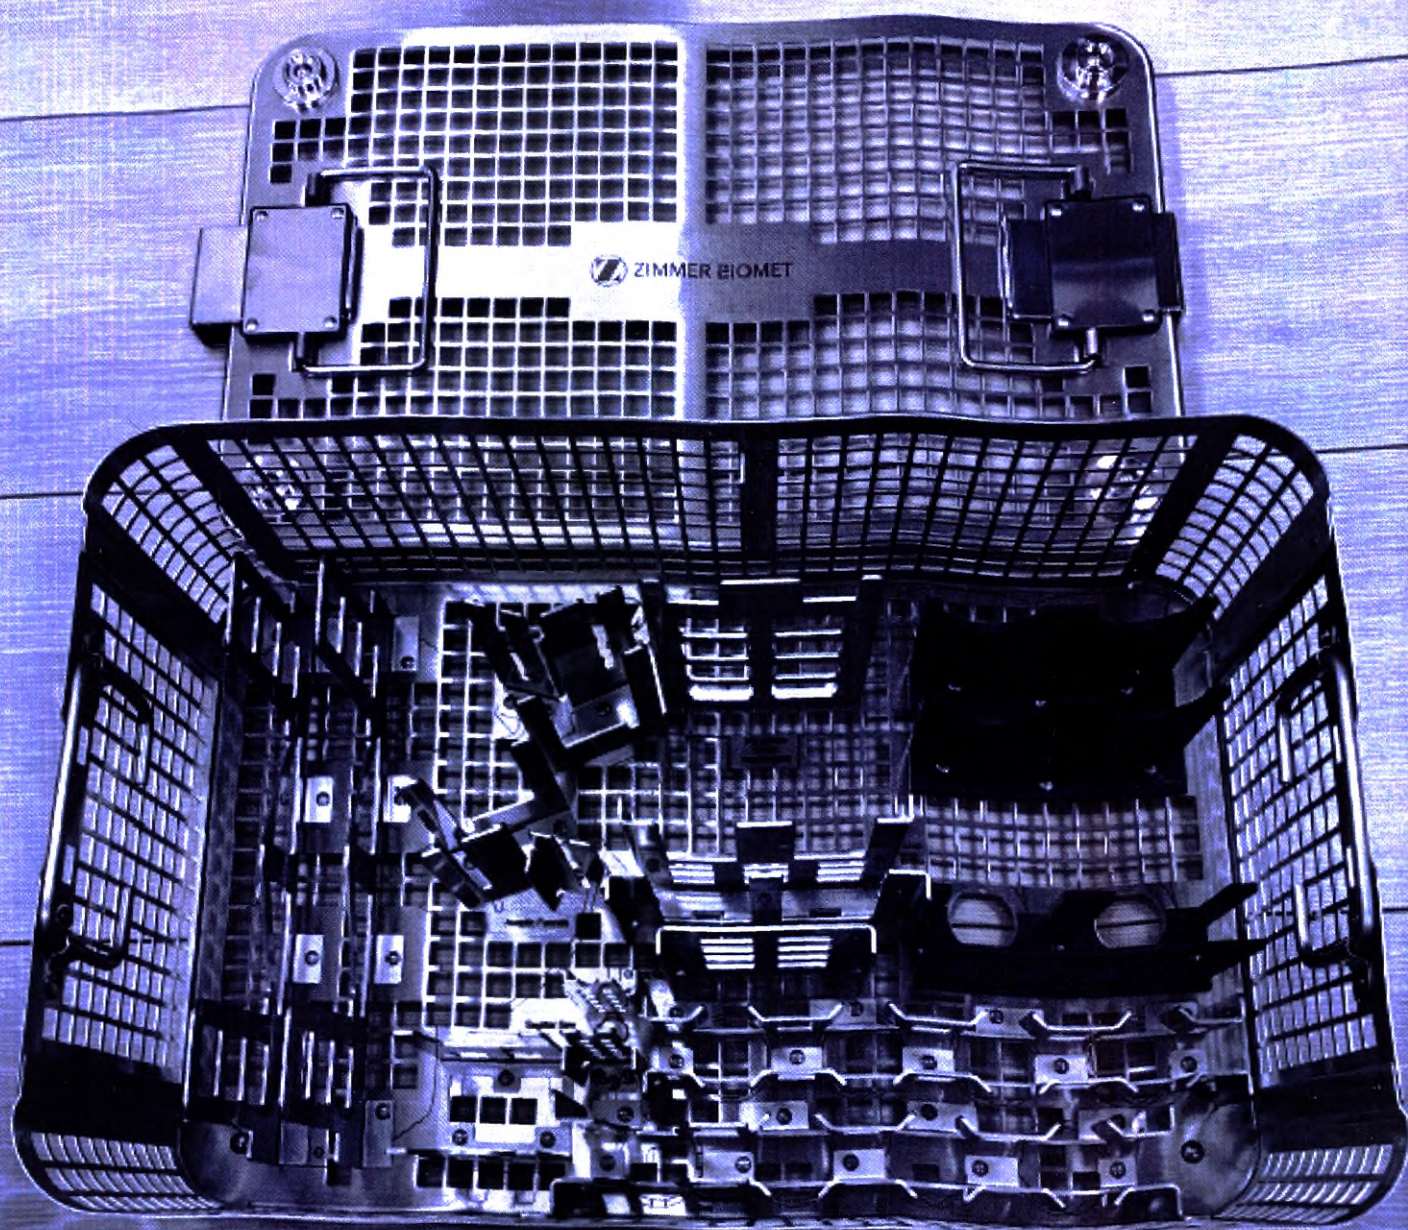


Корзина стерилизационная для одной рукоятки.

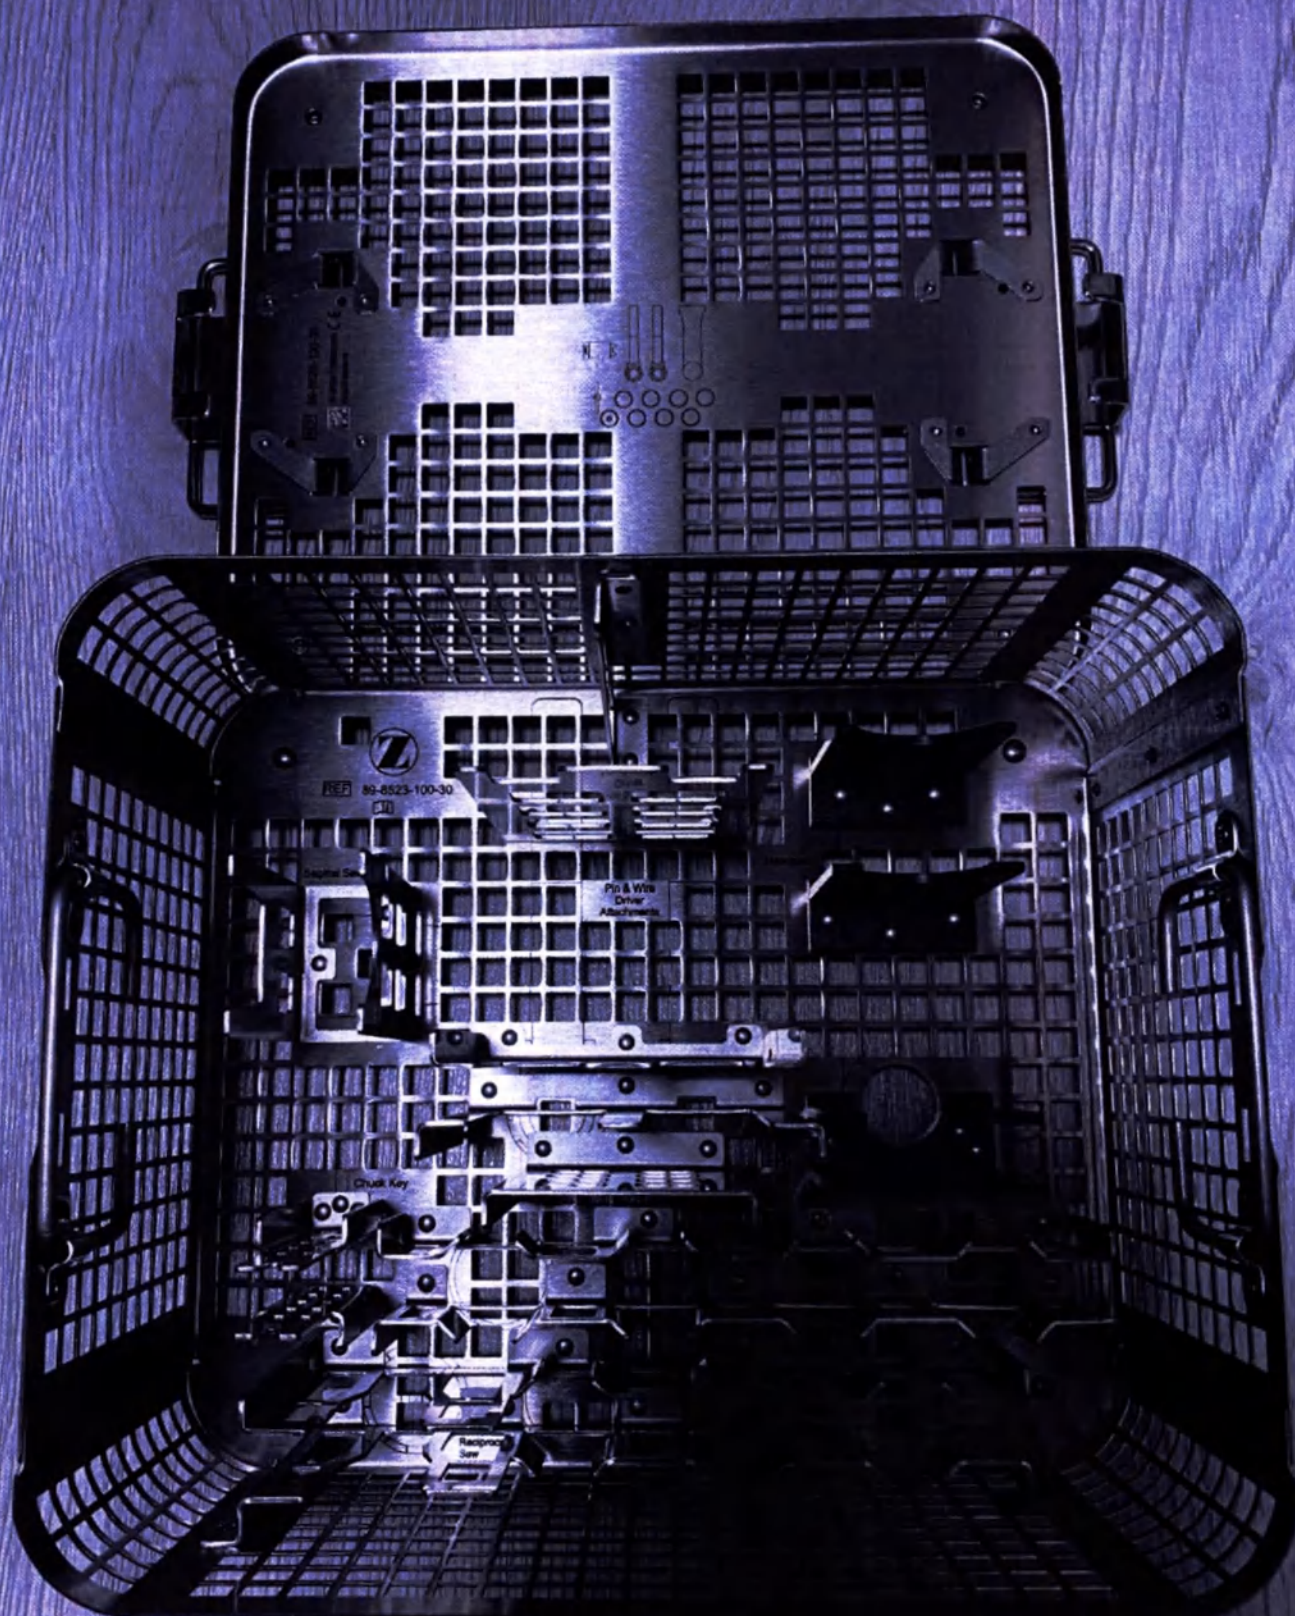


Корзина стерилизационная для двух рукояток со слотами для футляра аккумулятора.

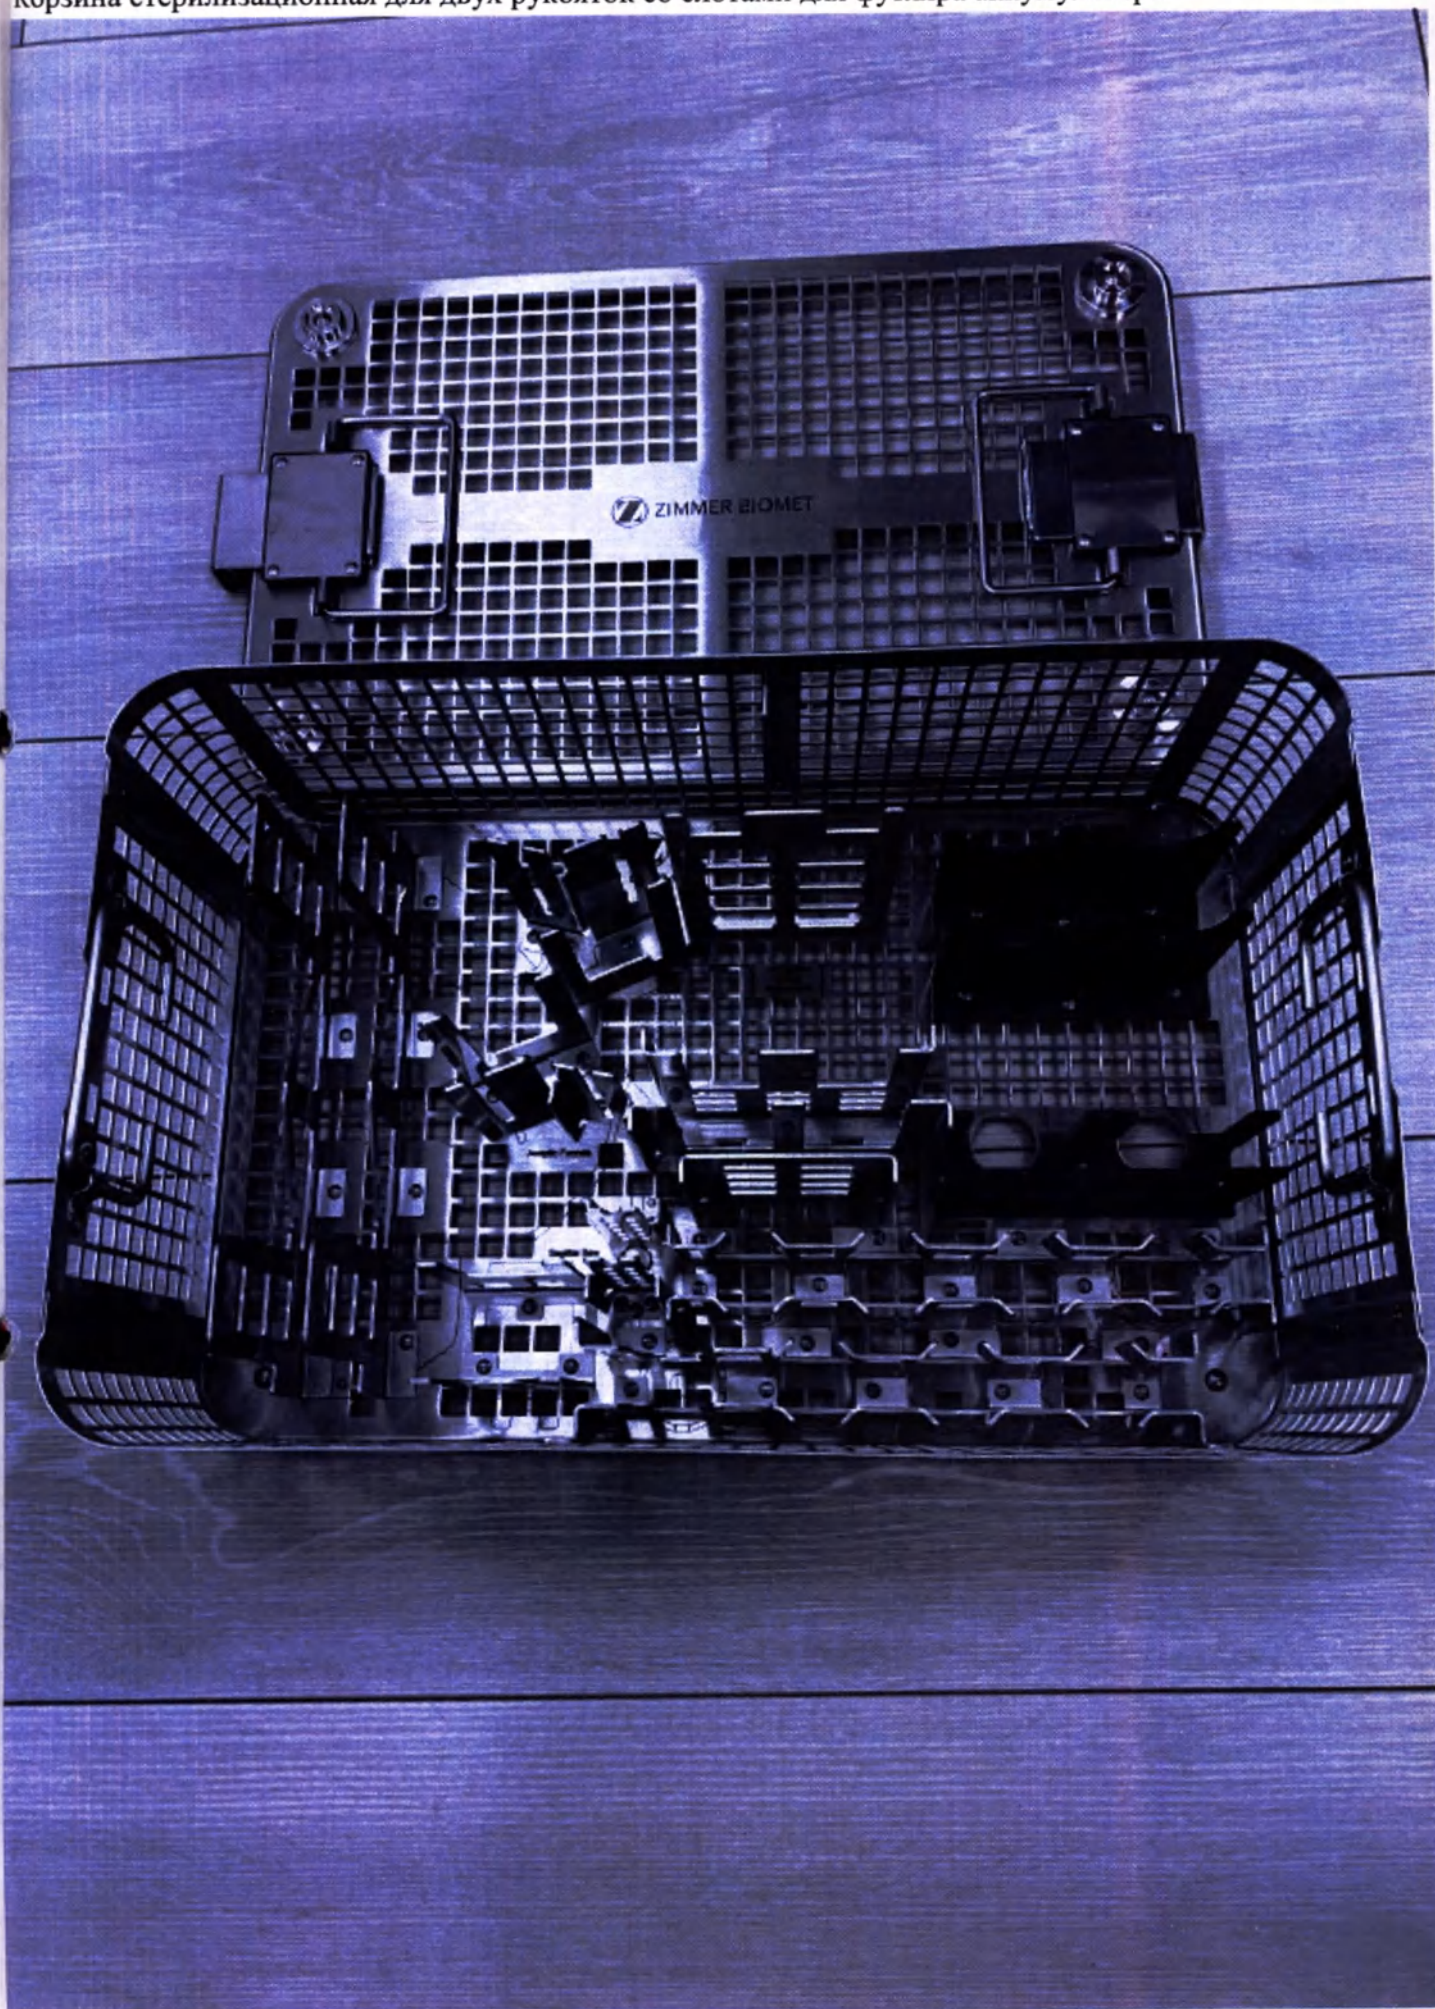

Корзина стерилизационная для одной рукоятки со слотами для футляра аккумулятора.

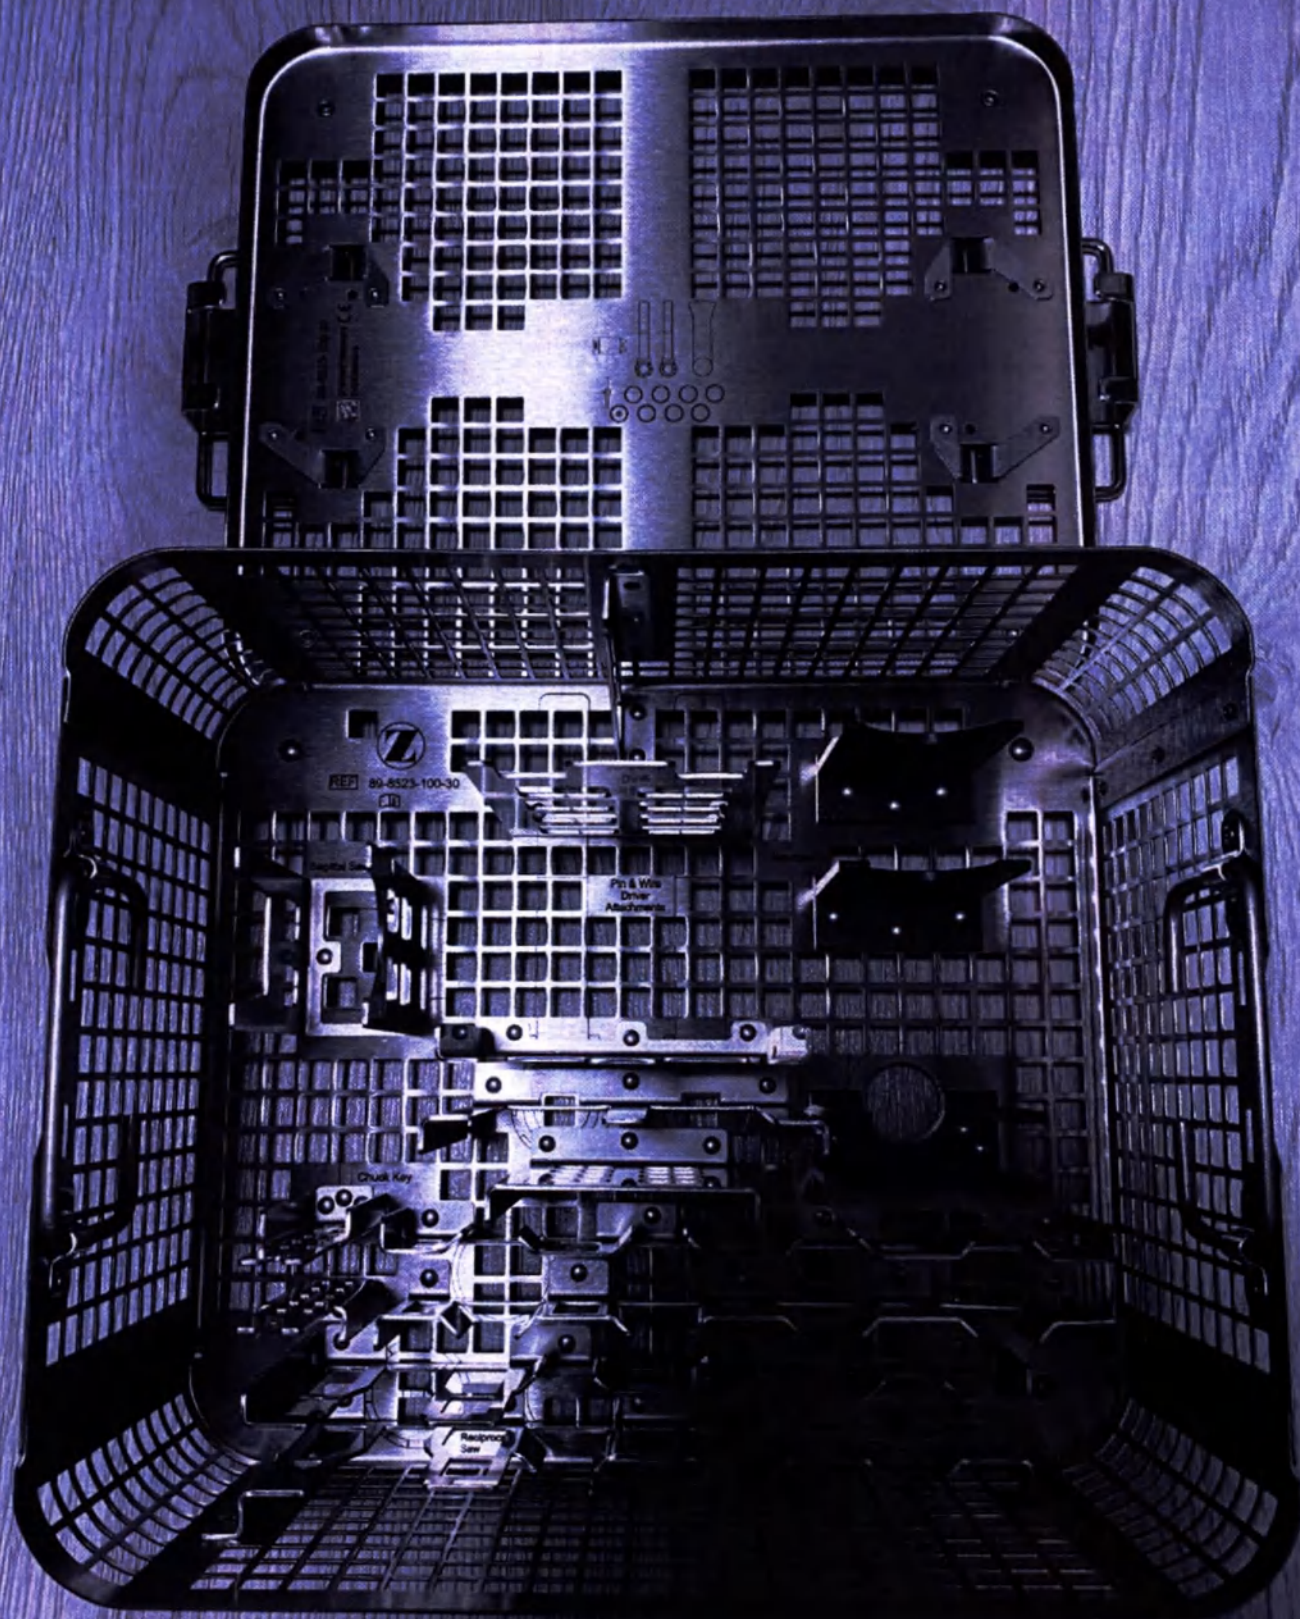

корзина стерилизационная для одной рукоятки со слотом для футляра аккумулятора.

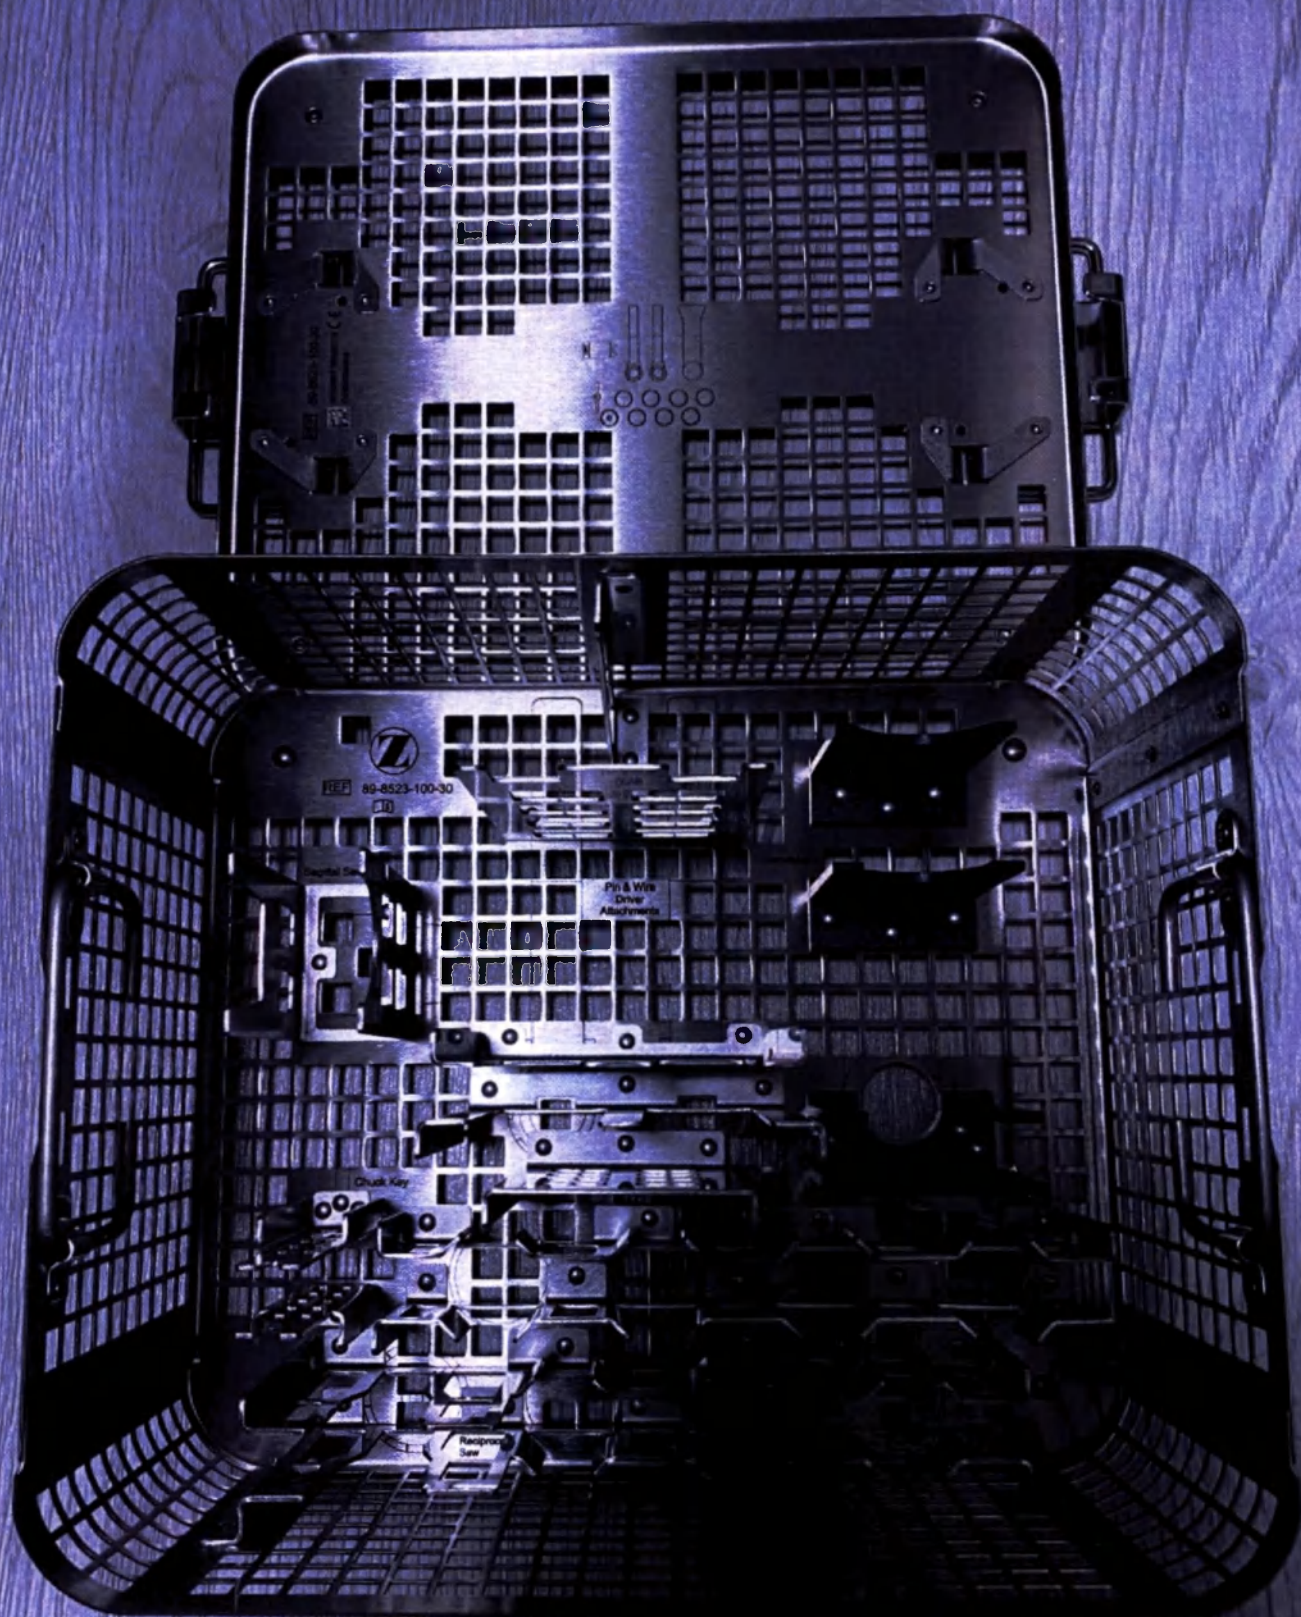

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

45 (сорок пять) листа (ов)

Руководитель отдела регистрации и
качества

Камнева А.И.

«27» декабря 2024

