

Руководитель группы регистрации

Пичугова Н.А.

2021 г.



Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Материал контрольный газов крови, электролитов и метаболитов Eurotrol (Eurotrol ерос GAS-ISE Metabolites)

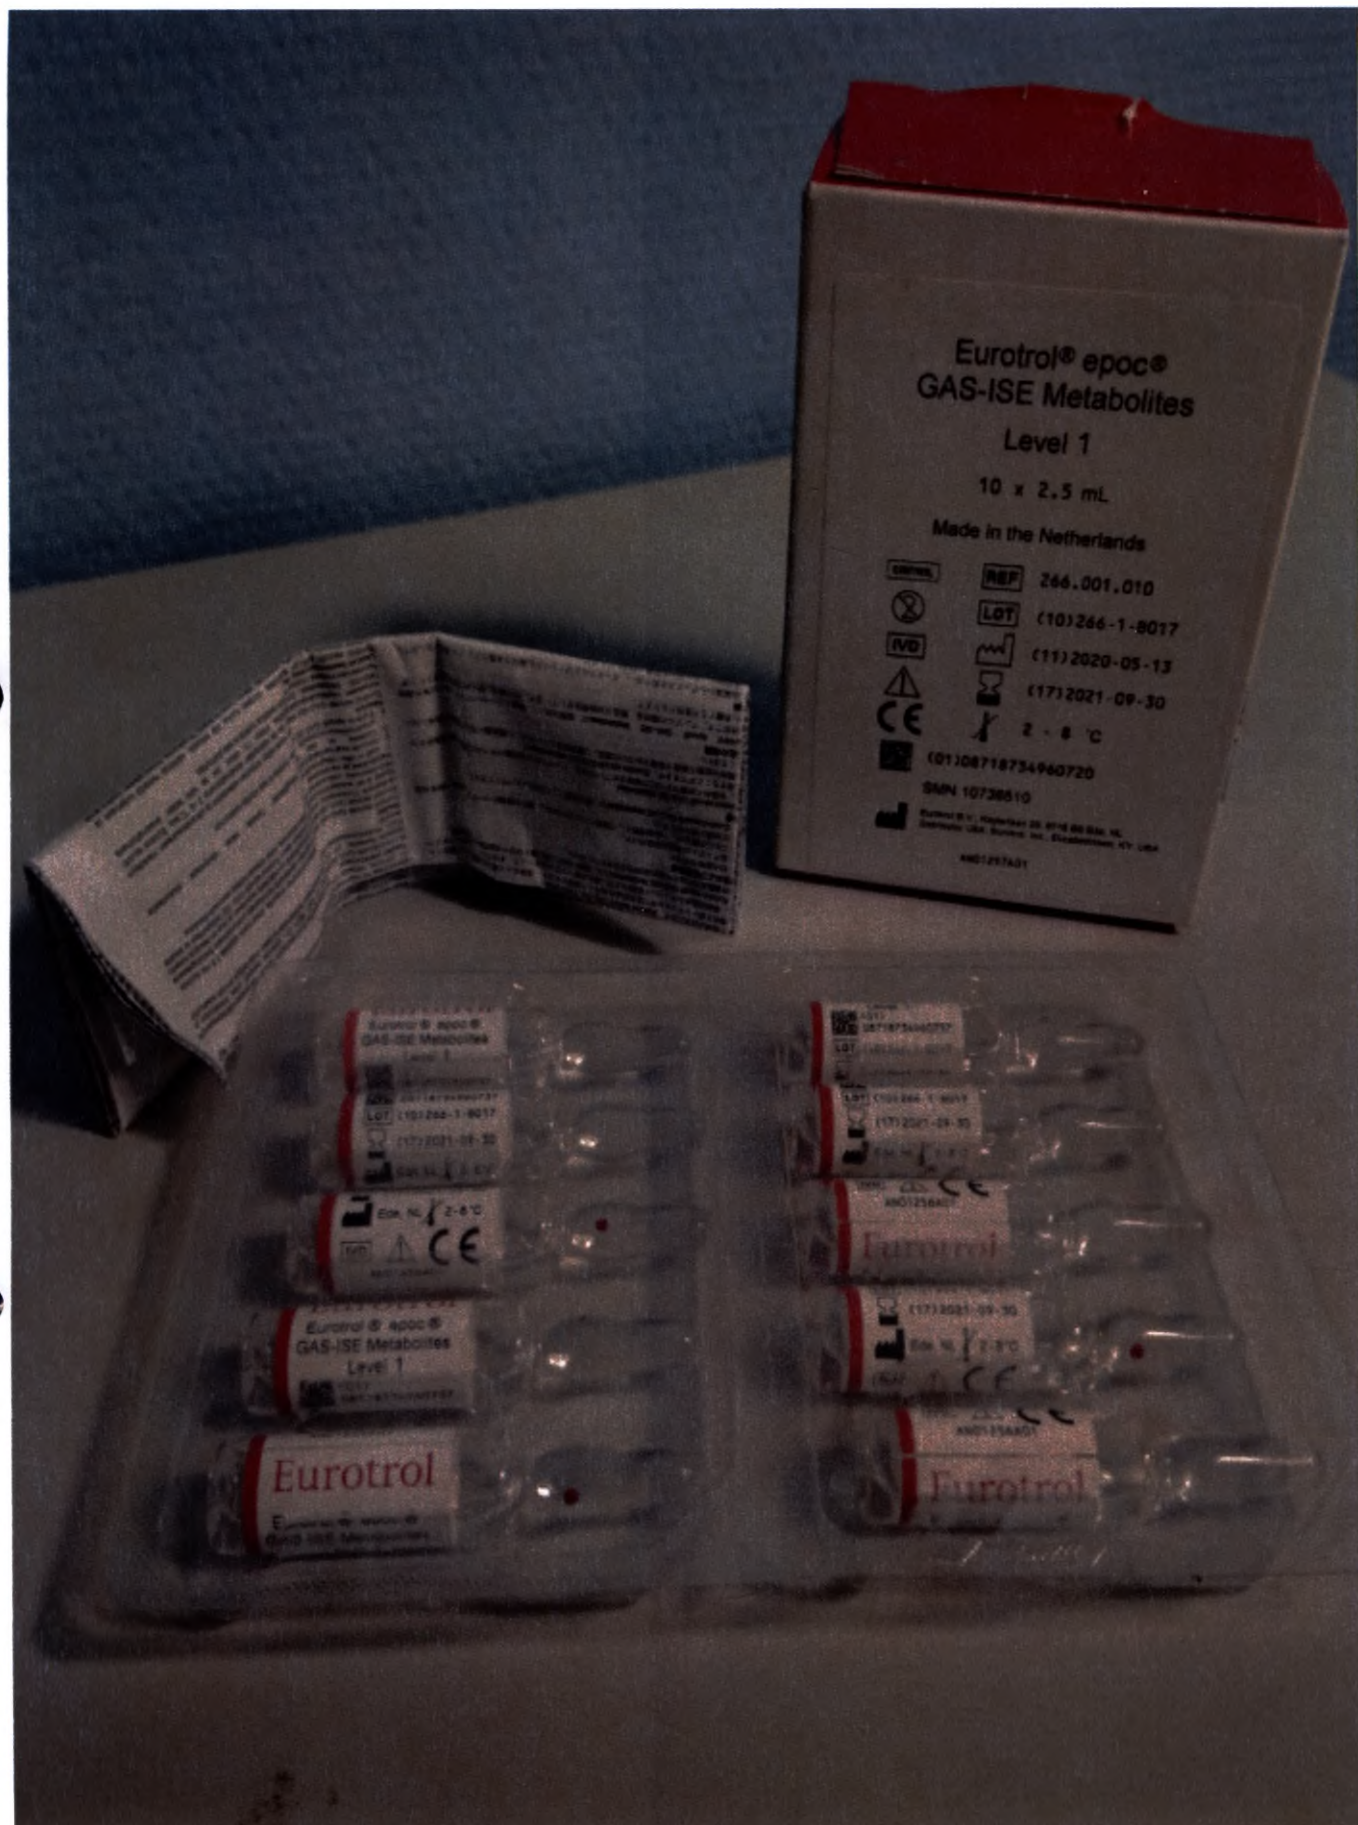


Рисунок 1 Вариант исполнения 1:

- Материал контрольный газов крови, электролитов и метаболитов Eurotrol (Eurotrol epoc GAS-ISE Metabolites) (уровень 1) – 10 ампул по 2, 5 мл.
- Инструкция по применению

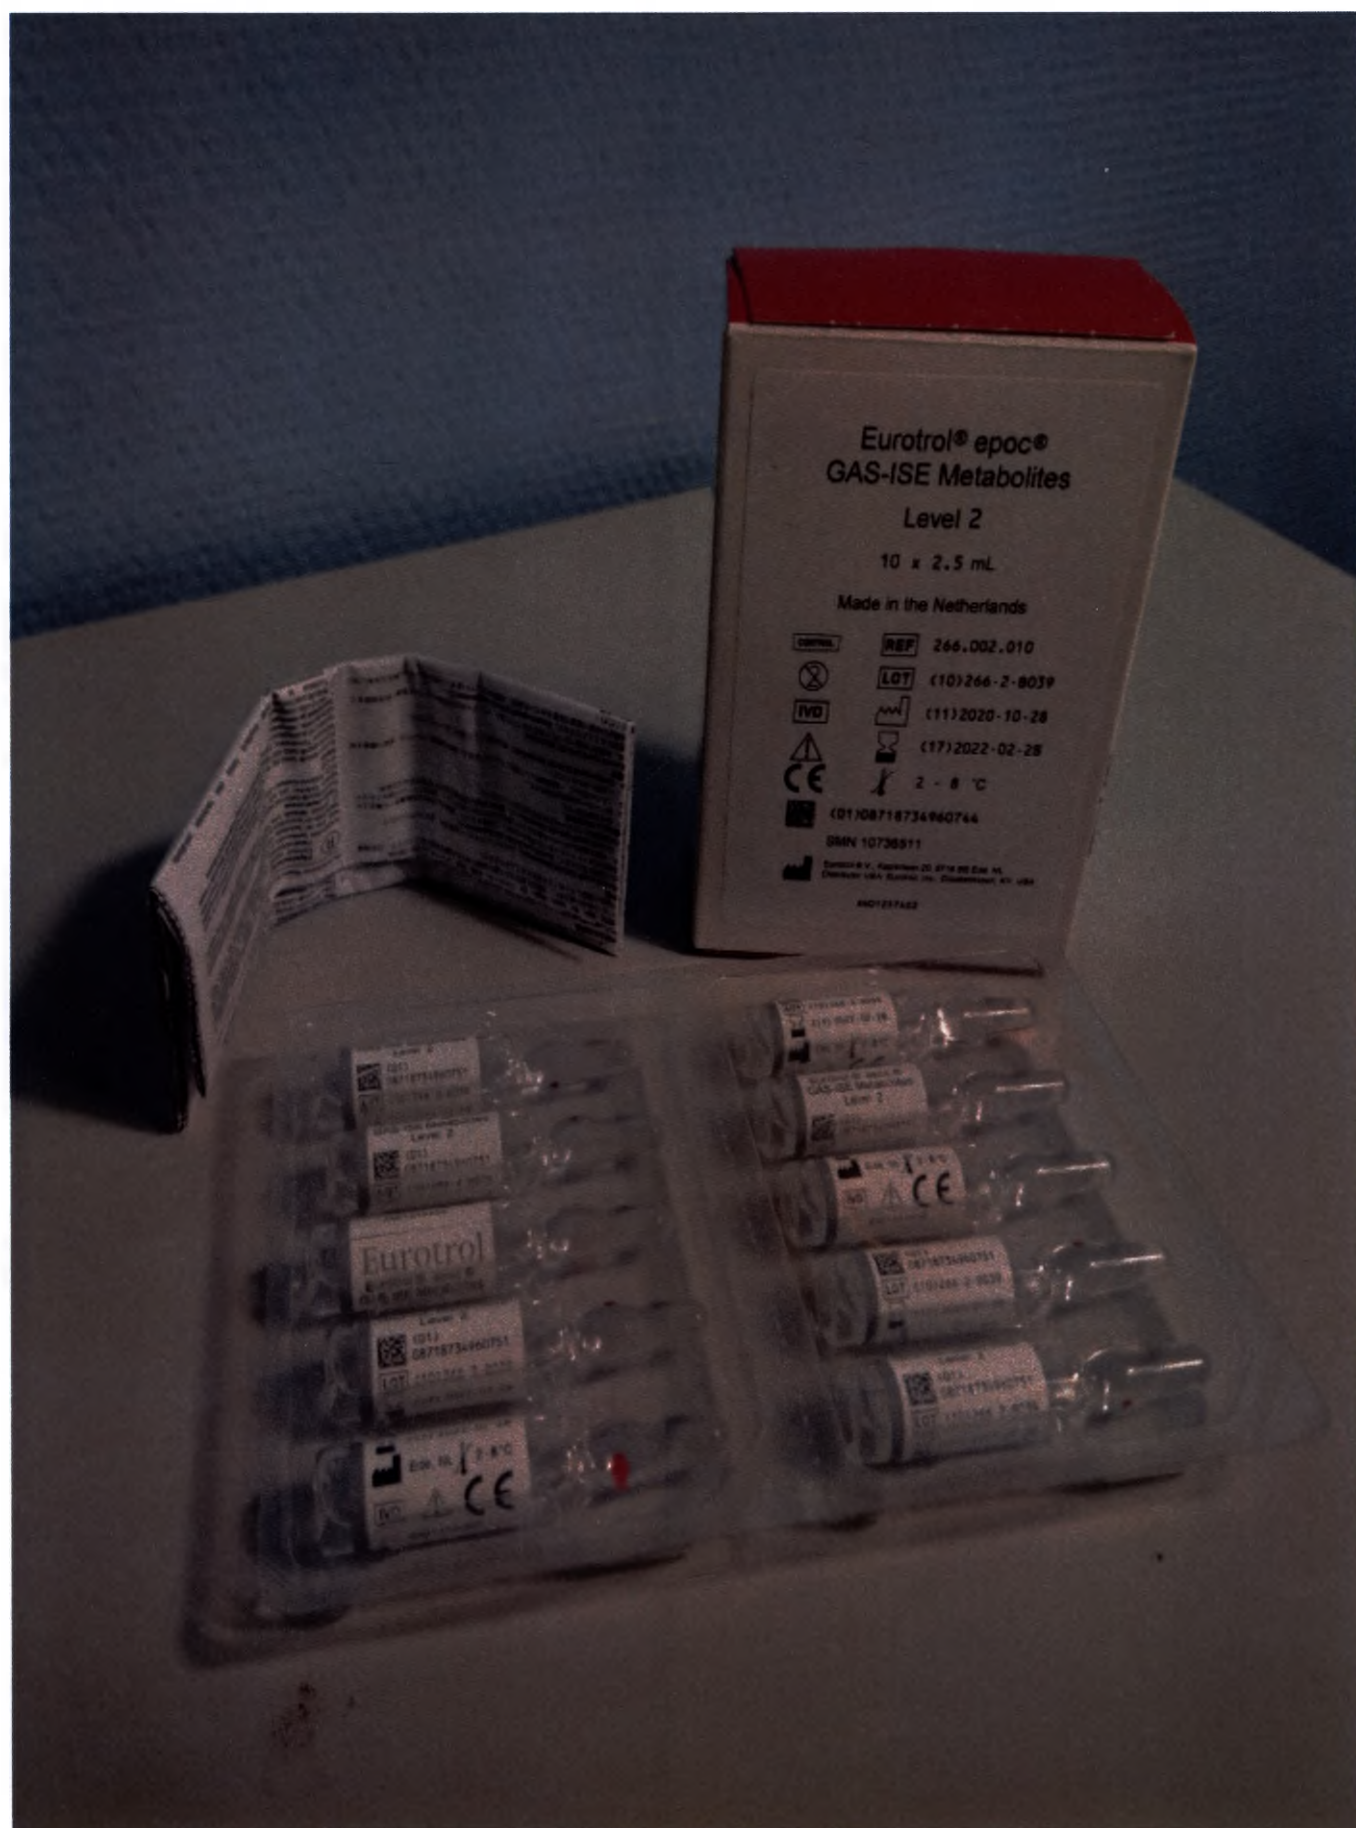


Рисунок 2 Вариант исполнения 2:

- Материал контрольный газов крови, электролитов и метаболитов Eurotrol (Eurotrol epoc GAS-ISE Metabolites) (уровень 2) – 10 ампул по 2, 5 мл.
- Инструкция по применению

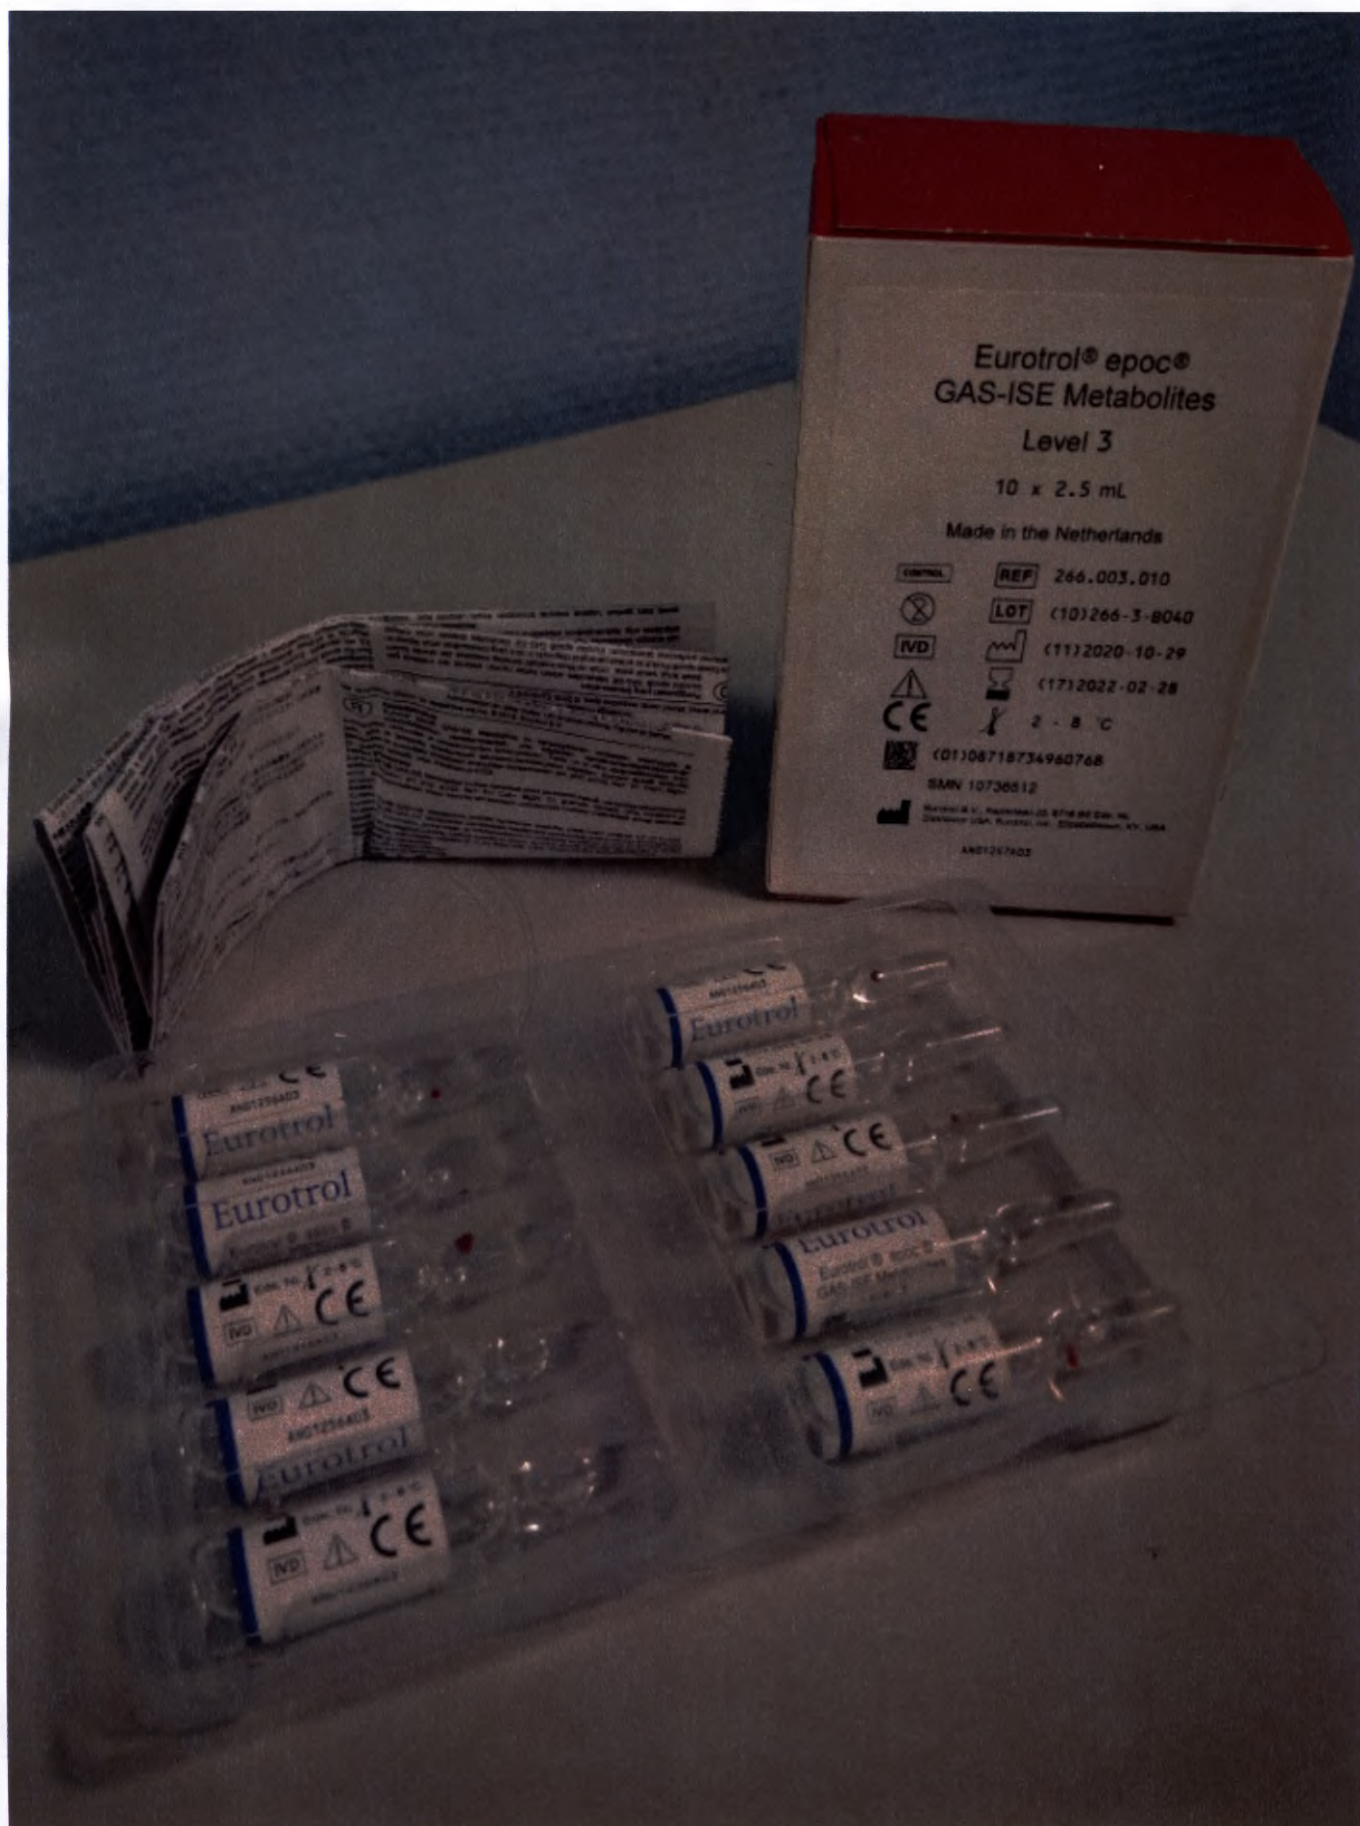


Рисунок 3 Вариант исполнения 3:

- Материал контрольный газов крови, электролитов и метаболитов Eurotrol (Eurotrol epoc GAS-ISE Metabolites) (уровень 3) – 10 ампул по 2, 5 мл.
- Инструкция по применению

Всего прошито и пронумеровано
4 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

