

Фотографические изображения

Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Лот: 59095401.


Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Лот: 59095401.



Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Лот: 59095401



Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Лот: 59095401

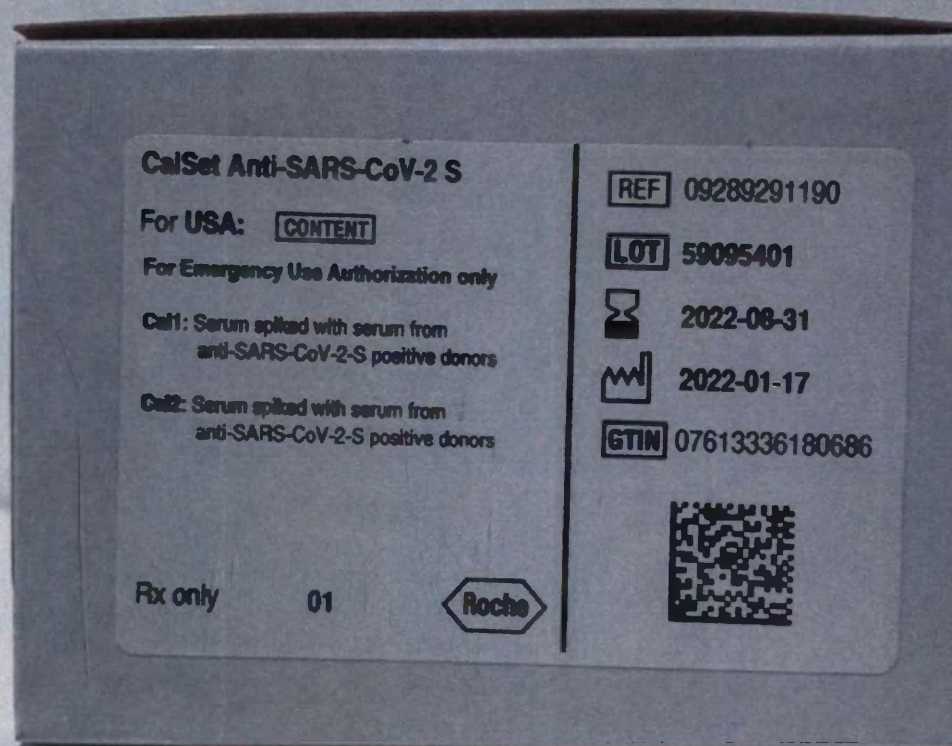

Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Лот: 59095401

Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Лот: 59095401, в составе:

1. Калибратор 1 (ACOV2S Cal1), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;
2. Калибратор 2 (ACOV2S Cal2), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;
3. Флаконы пустой – 4 шт.;
4. Карты со штрих-кодом – 1 шт.;
5. Этикетки для флаконов – 12 шт.;
6. Инструкция по применению.

Результаты анализа

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Антитела к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови

Содержимое набора SARS-CoV-2 антитела сыворотки крови, плазмы, для иммунохемилюминесцентного метода, было стандартизировано и проверено в течение 30 минут при 25 °C.

Производитель: Roche Diagnostics GmbH ("Рох Диагностикс ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Использование только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рох Диагностикс Рус» (ООО «Рох Диагностикс Рус»), 107031, Москва, Трудовая площадь, д.2. Тел: +7 495 229-02-00, факс: +7 495 229-02-64. E-mail: info@roche.ru

Кат. номер 09209201190


Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Лот: 59095401

1. Калибратор 1 (ACOV2S Cal1), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;




Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Лот: 59095401

2. Калибратор 2 (ACOV2S Cal2), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;

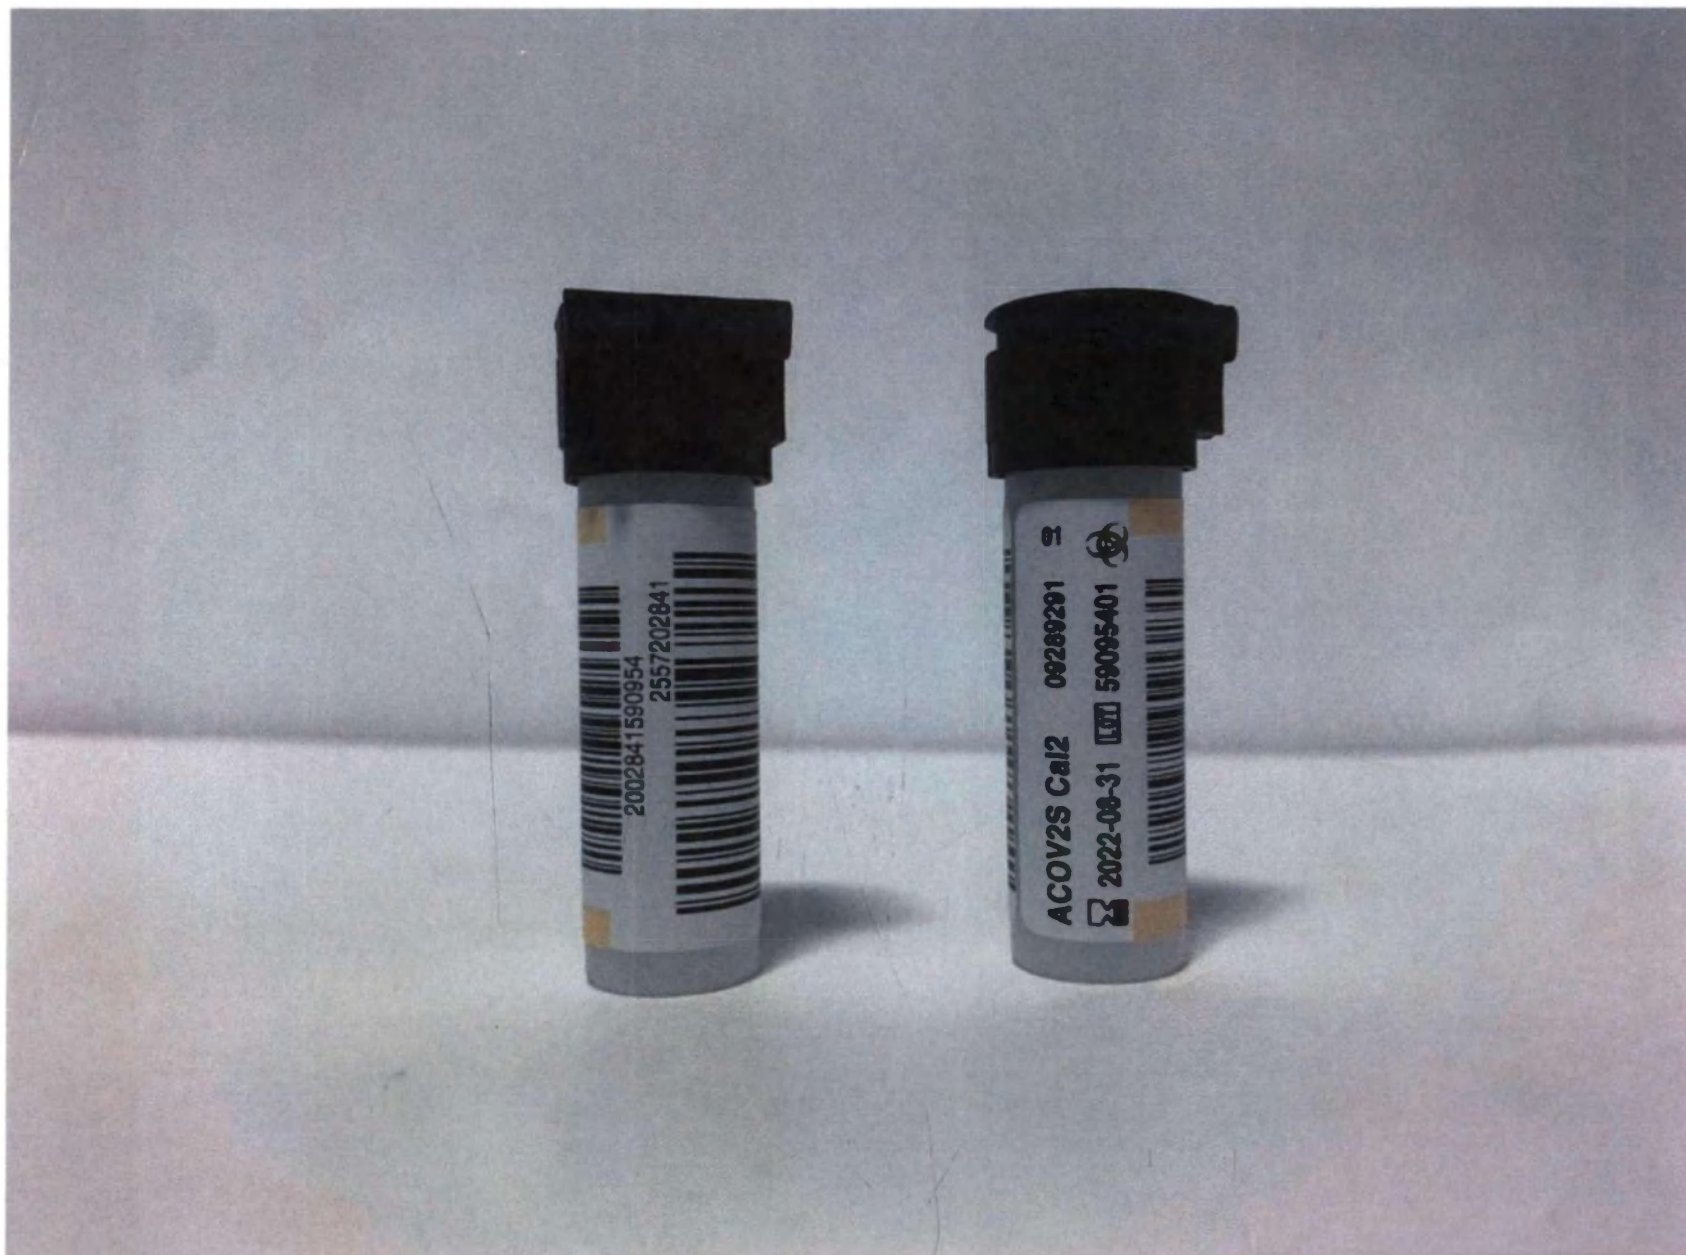

Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Лот: 59095401

3. Флакон пустой – 4 шт.;

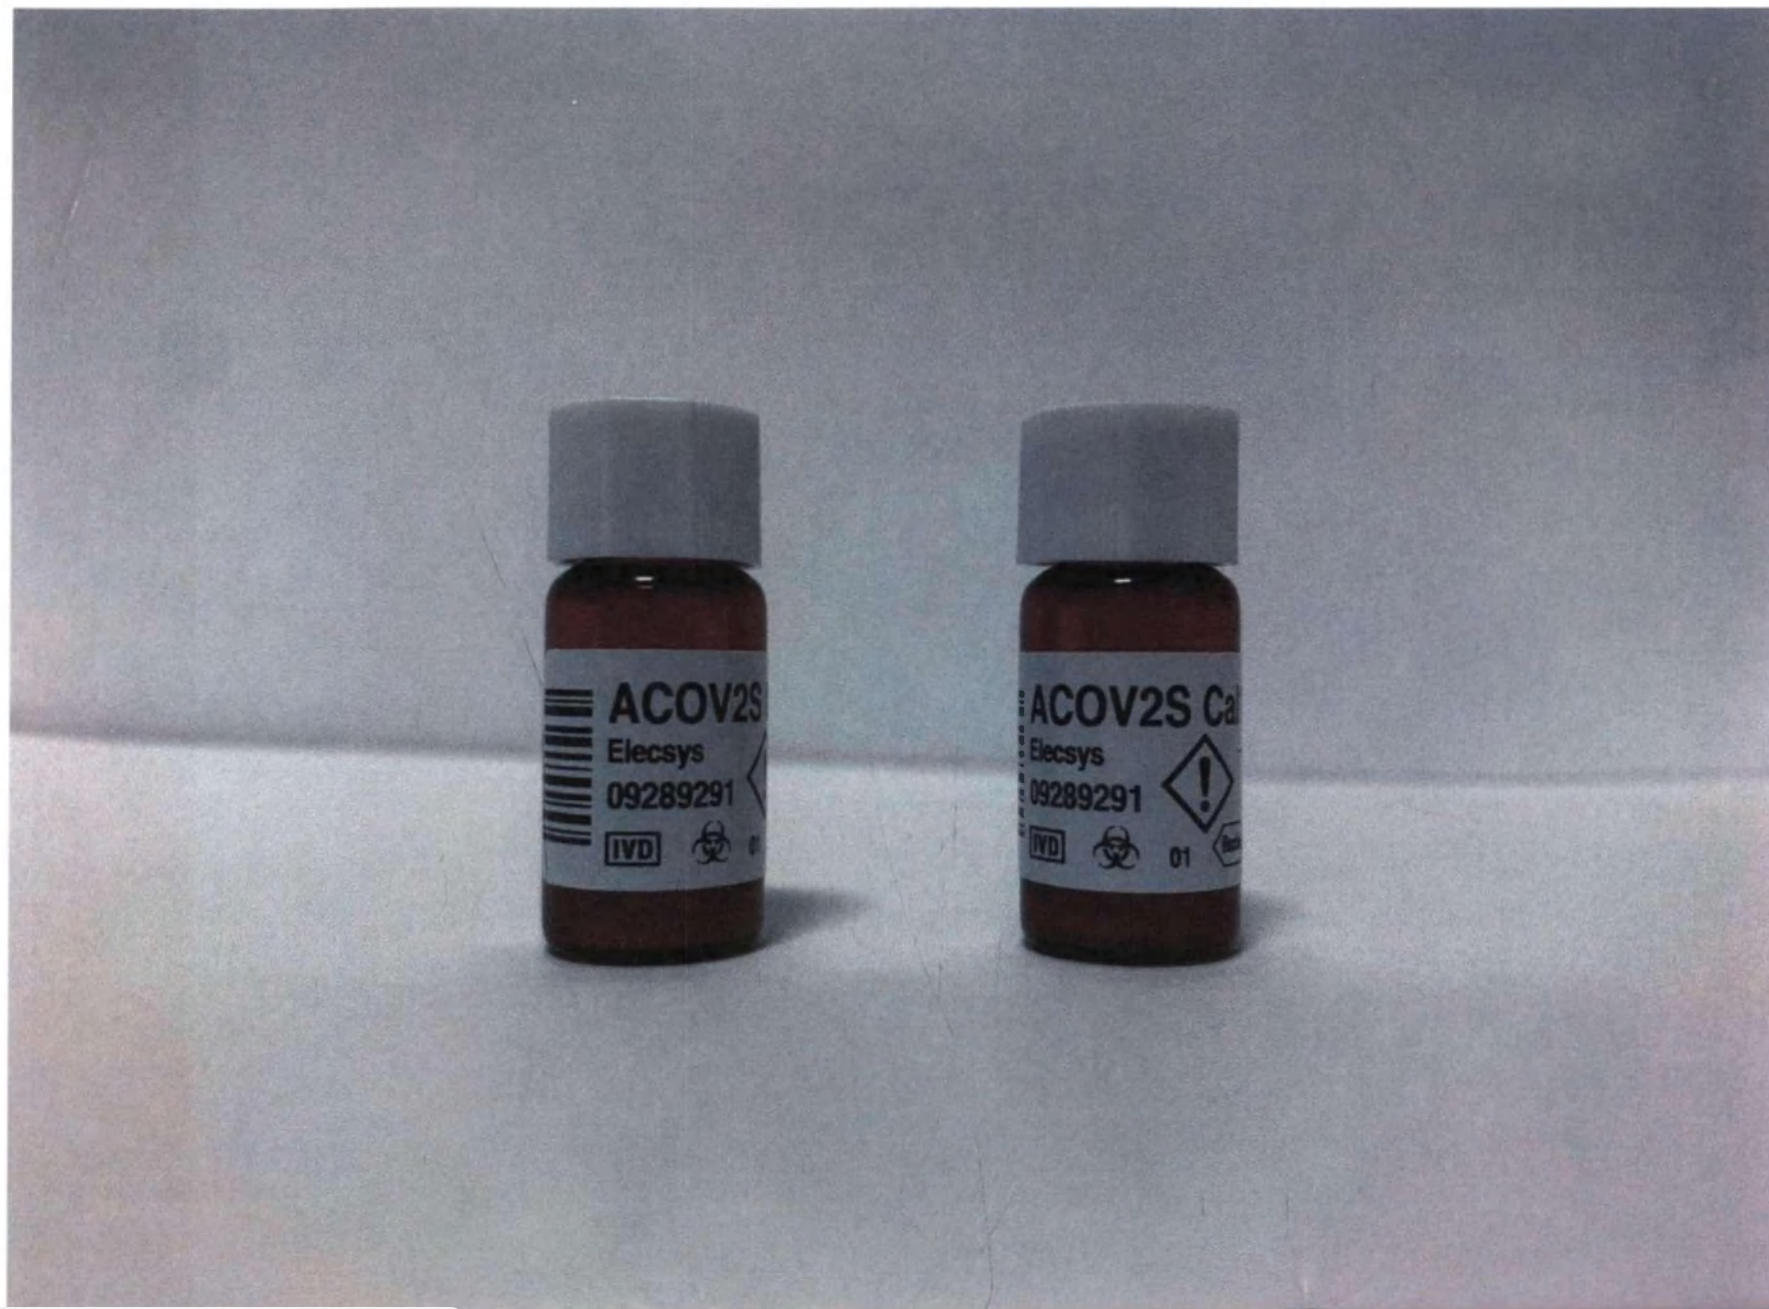


Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Лот: 59095401

3. Флакон пустой – 4 шт.;



Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Лот: 59095401

4. Карта со штрих-кодом – 1 шт.;

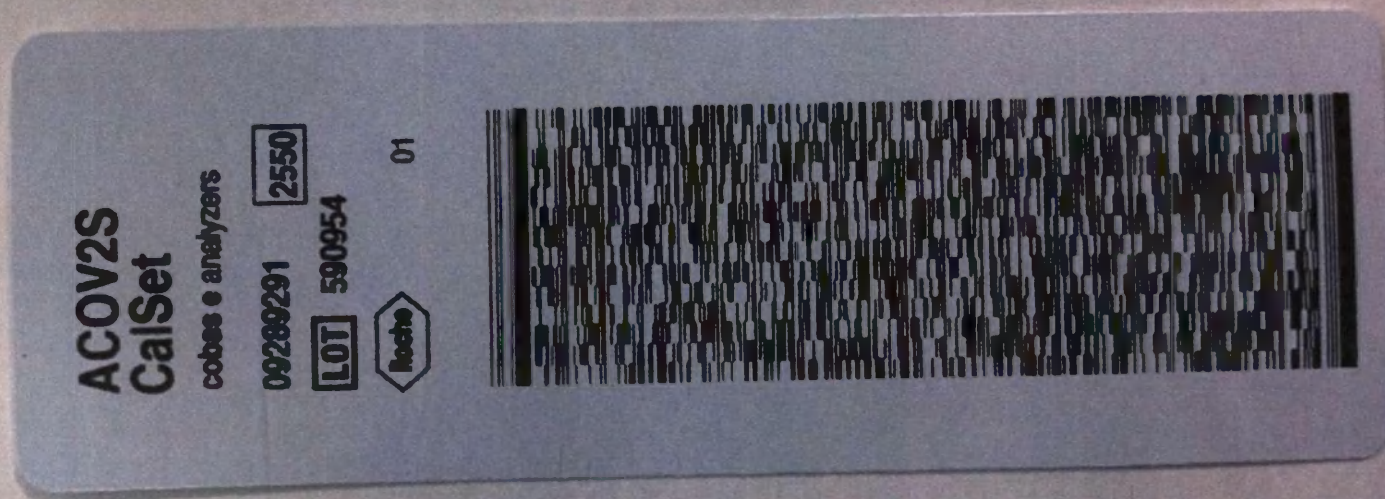

Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Lot: 59095401

5. Этикетки для флаконов – 12 шт.;



Набор калибраторов для количественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (CalSet Anti-SARS-CoV-2 S cobas e analyzers). Лот: 59095401

6. Инструкция по применению.

CalSet Anti-SARS-CoV-2 S

cobas

(EU) 0000091190

4 x 16 ml

Примечание

Набор калибраторов CalSet Anti-SARS-CoV-2 S предназначен для определения концентрации антител к SARS-CoV-2 S на иммунохемилюминесцентном анализаторе cobas e.

Таблица назначения калибраторов

CalSet Anti-SARS-CoV-2 S предназначен для калибровки модуля Cobas e для определения концентрации антител к SARS-CoV-2 S в сыворотке и плазме крови. Калибраторы имеют вид, соответствующий таблице ниже.

Реактивы — растворы

- ACQ/60 S1: 2 флакона, для приготовления 1,0 мл калибратора 1
- ACQ/60 S2: 2 флакона, для приготовления 1,0 мл калибратора 2

Оборудование

Анализатор cobas e 811. Для калибровки калибраторов для определения концентрации антител к SARS-CoV-2 S в сыворотке и плазме крови необходимо использовать модуль Cobas e для определения концентрации антител к SARS-CoV-2 S в сыворотке и плазме крови.

Состав

Поставляется: Test Basic Anti-SARS-CoV-2 S. Этот стандартный реактивный набор предназначен для определения концентрации антител к SARS-CoV-2 S в сыворотке и плазме крови. Набор состоит из 2 флаконов: 1 флакон — для приготовления 1,0 мл калибратора 1, 2 флакона — для приготовления 1,0 мл калибратора 2.

Важные замечания

Этот набор калибраторов предназначен для использования на анализаторе cobas e. Не используйте этот набор калибраторов на других анализаторах. Не используйте этот набор калибраторов для других целей.



Этот набор калибраторов предназначен для использования на анализаторе cobas e. Не используйте этот набор калибраторов на других анализаторах. Не используйте этот набор калибраторов для других целей.

Подготовка

H017 Калибровка калибраторов должна быть выполнена.

Важные замечания

P261 Избегайте вдыхания пыли / газа / пара / тумана / аэрозоля / дыма.

P272 Запрещается прикасаться к лицу, рту, глазам, носу, волосам и одежде.

P280 Носить защитную одежду.

Очистка

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

2020-08 V1.0 Russian

1/2

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

Важные замечания

P261 Избегайте вдыхания пыли / газа / пара / тумана / аэрозоля / дыма.

P272 Запрещается прикасаться к лицу, рту, глазам, носу, волосам и одежде.

P280 Носить защитную одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

P203 + P213 При попадании реактива на кожу или одежду: Очистите пораженный участок / одежду.

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
листа (ов)

12



Королева Г. А.
по доверенности
от 11.02.2022