

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

2022 г.






ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАЙЛО Р. В.

Фотографические изображения изделия:


**Набор реагентов для количественного определения альфа-фетопротеина
электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики *in vitro*
(Alpha-Fetoprotein (eCLIA) / AFP)**


**Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.
(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай**

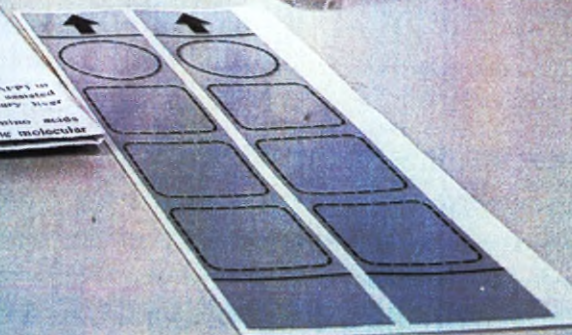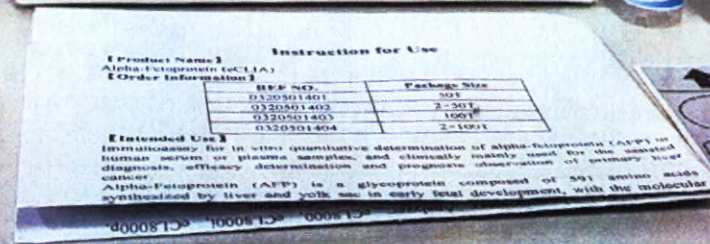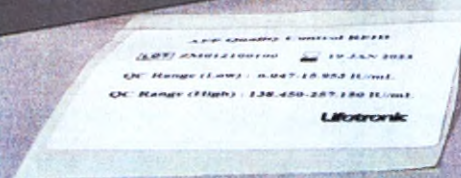




Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения альфа-фетопroteина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Alpha-Fetoprotein (eCLIA) / AFP))

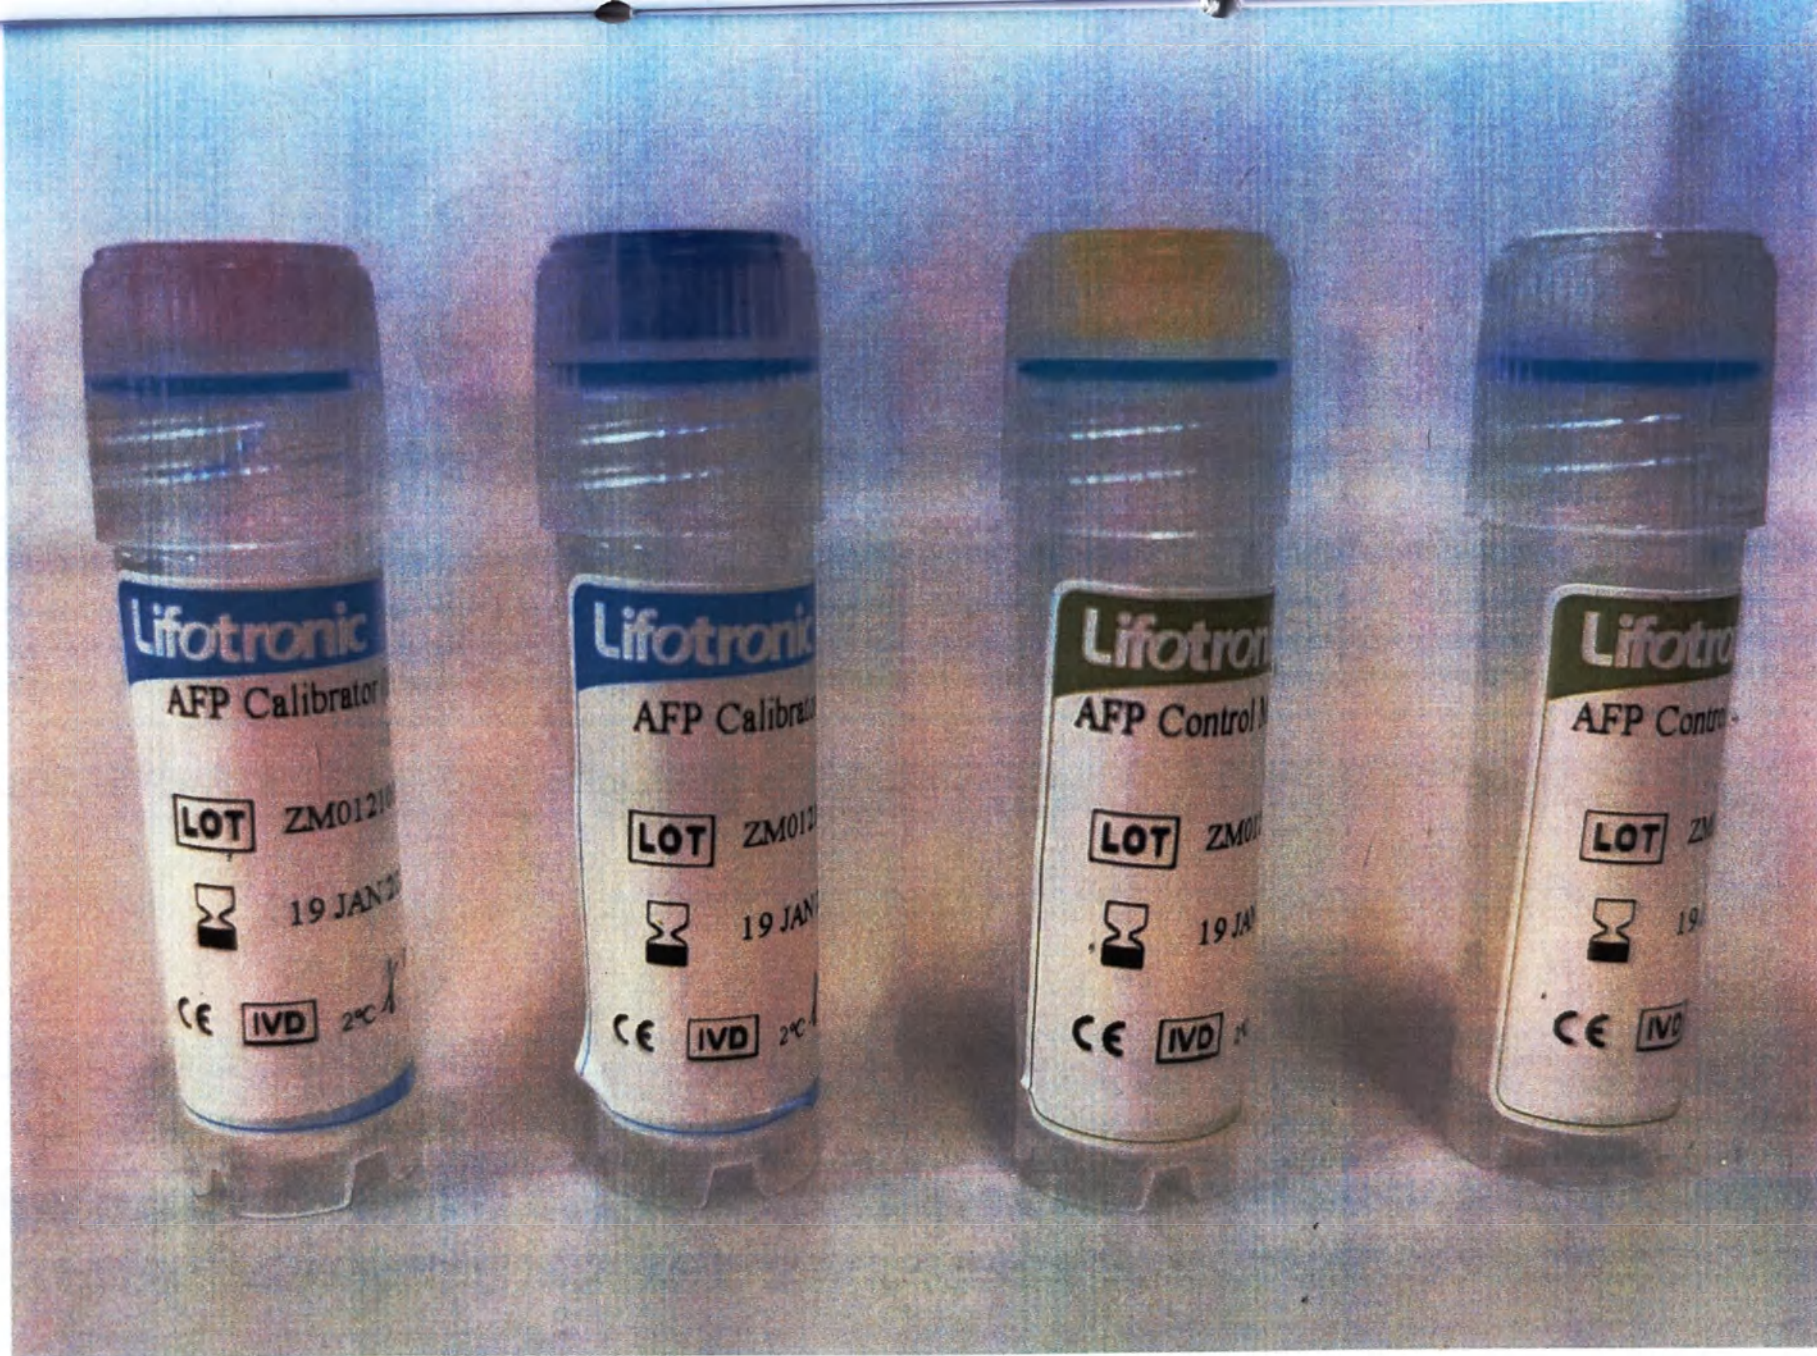

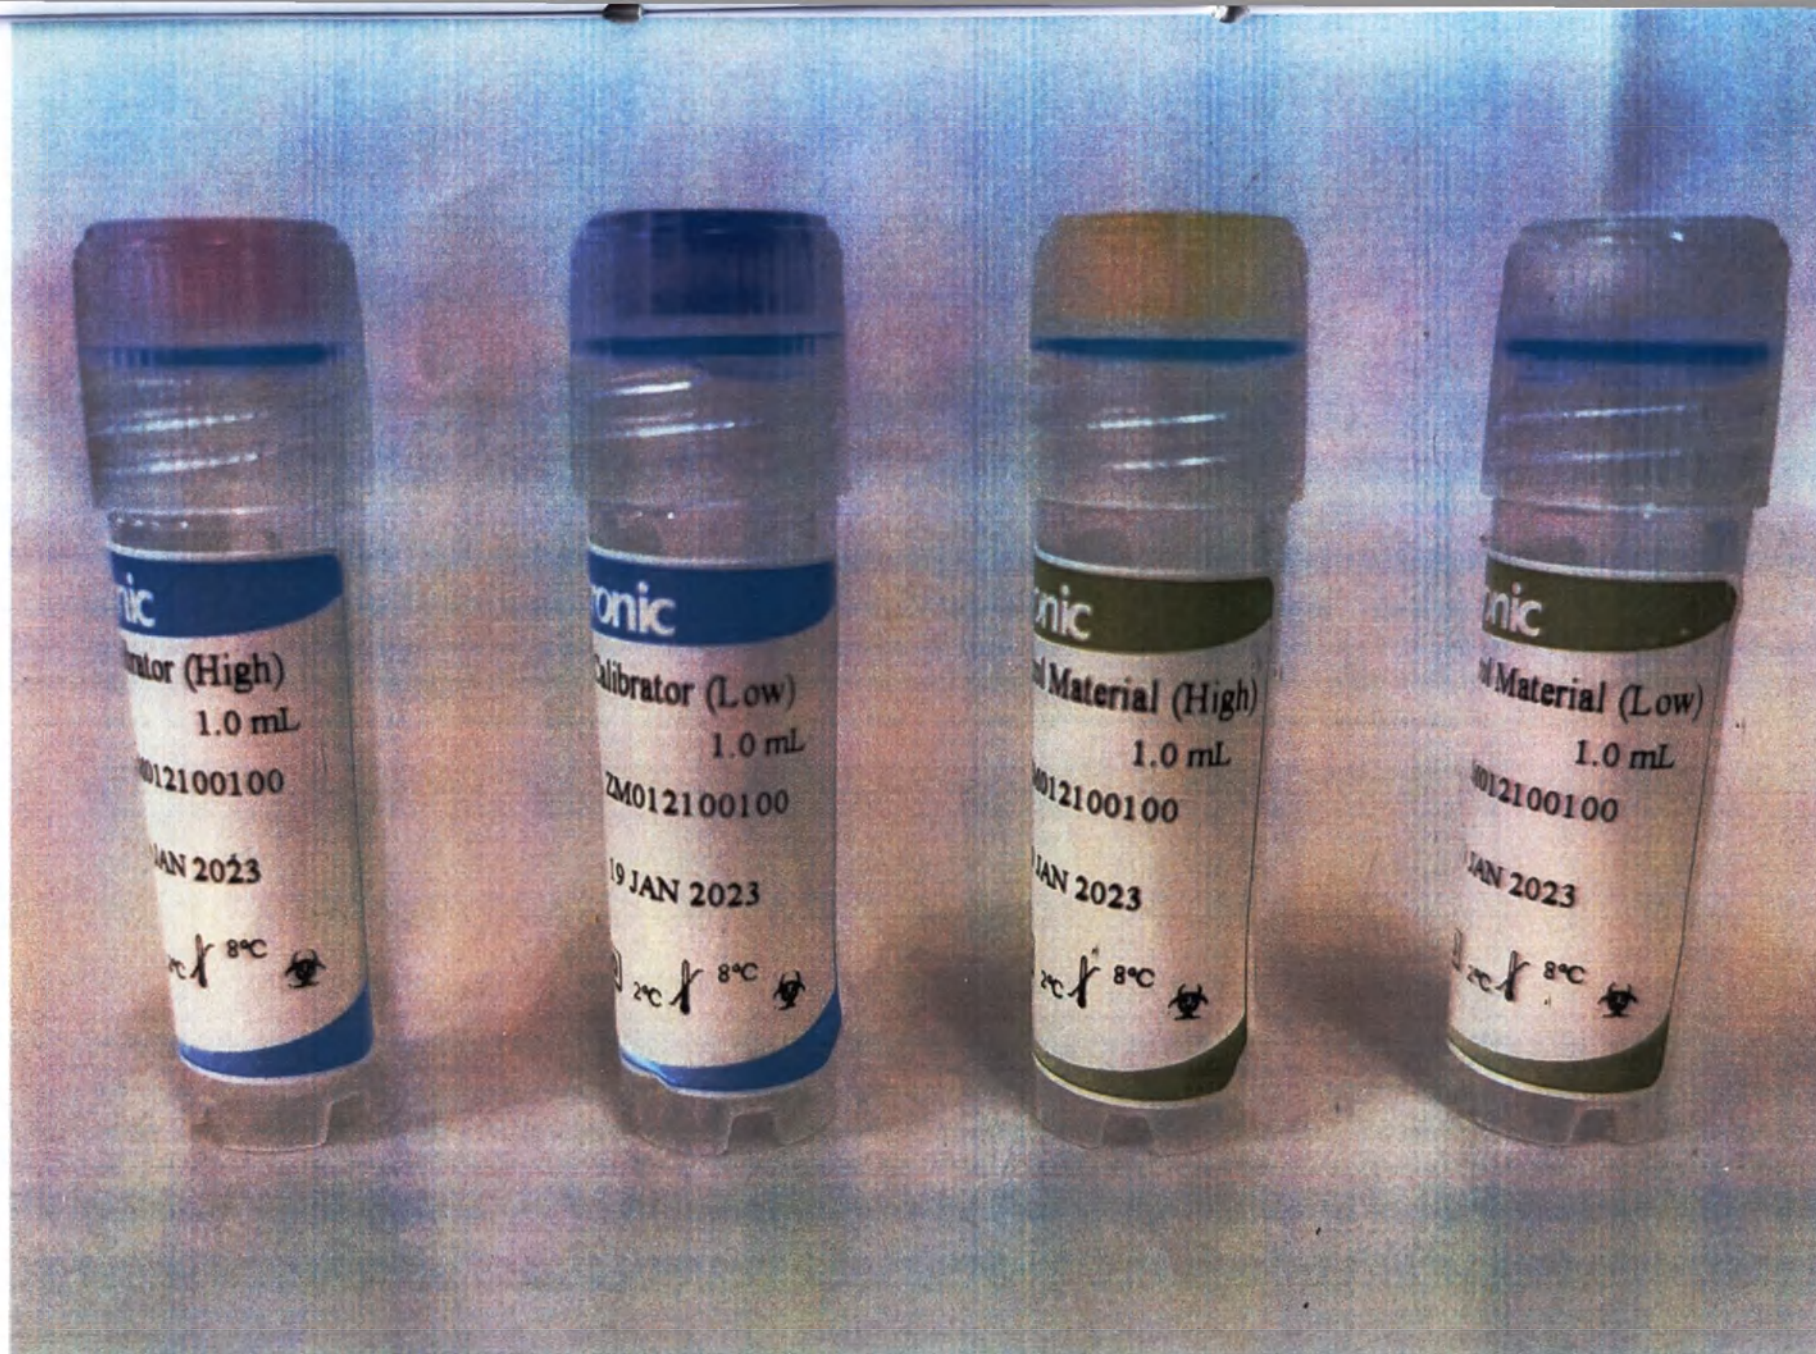

Калибратор (низкий и высокий уровень), Материал контрольный (низкий и высокий уровень) (Набор реагентов для количественного определения альфа-фетопротеина

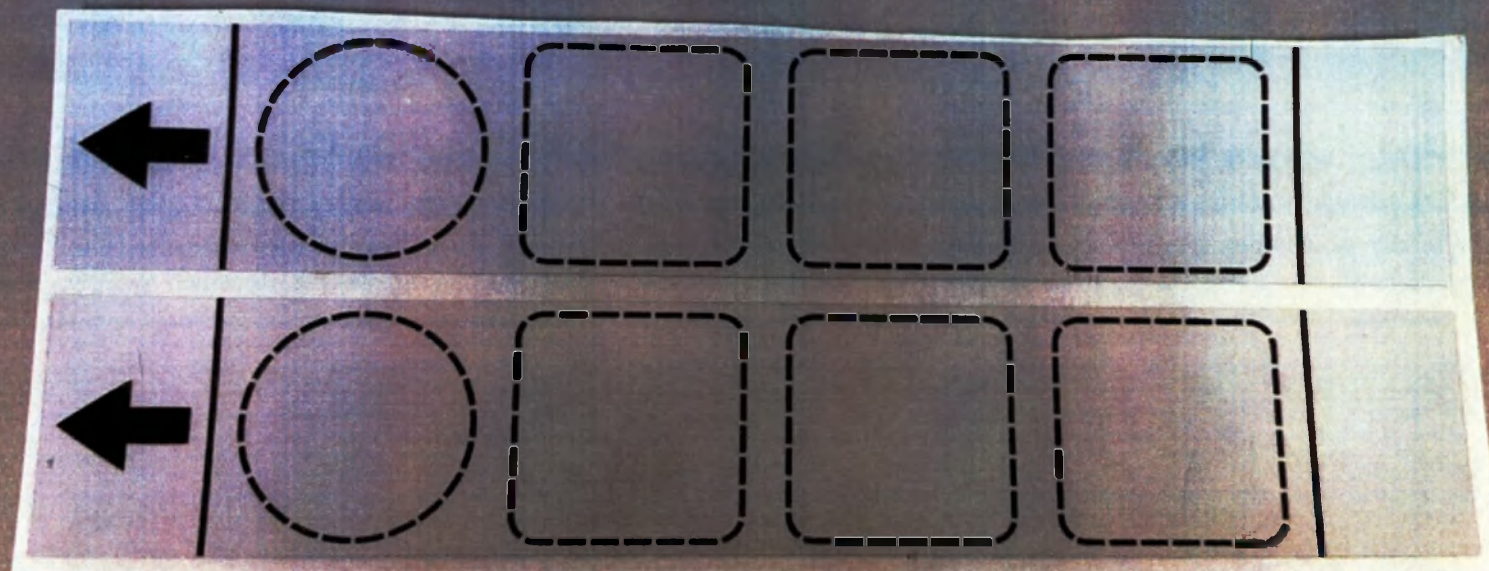

Этикетки для запечатывания флаконов (Набор реагентов для количественного определения альфа-фетопротеина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Alpha-Fetoprotein (eCLIA) / AFP))

AFP Quality Control RFID

LOT ZM012100100  19 JAN 2023

QC Range (Low) : 6.047-15.953 IU/mL

QC Range (High) : 138.450-257.150 IU/mL

Lifotronic

Этикетка результатов значений материалов контрольных (Набор реагентов для количественного определения альфа-фетопротеина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Alpha-Fetoprotein (eCLIA) / AFP))



Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения альфа-фетопротейна электрохемилуминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Alpha-Fetoprotein (eCLIA) / AFP))

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 8 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А.
М.П.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАЙЛО Р.В.

