

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест-Балтика»

Боднар И.С.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:


Раствор окрашивающий для Анализатора автоматического клеточного состава мочи Uscanner (E)



**24 мл. Раствор окрашивающий для Анализатора автоматического клеточного состава мочи
Uscanner (E)**

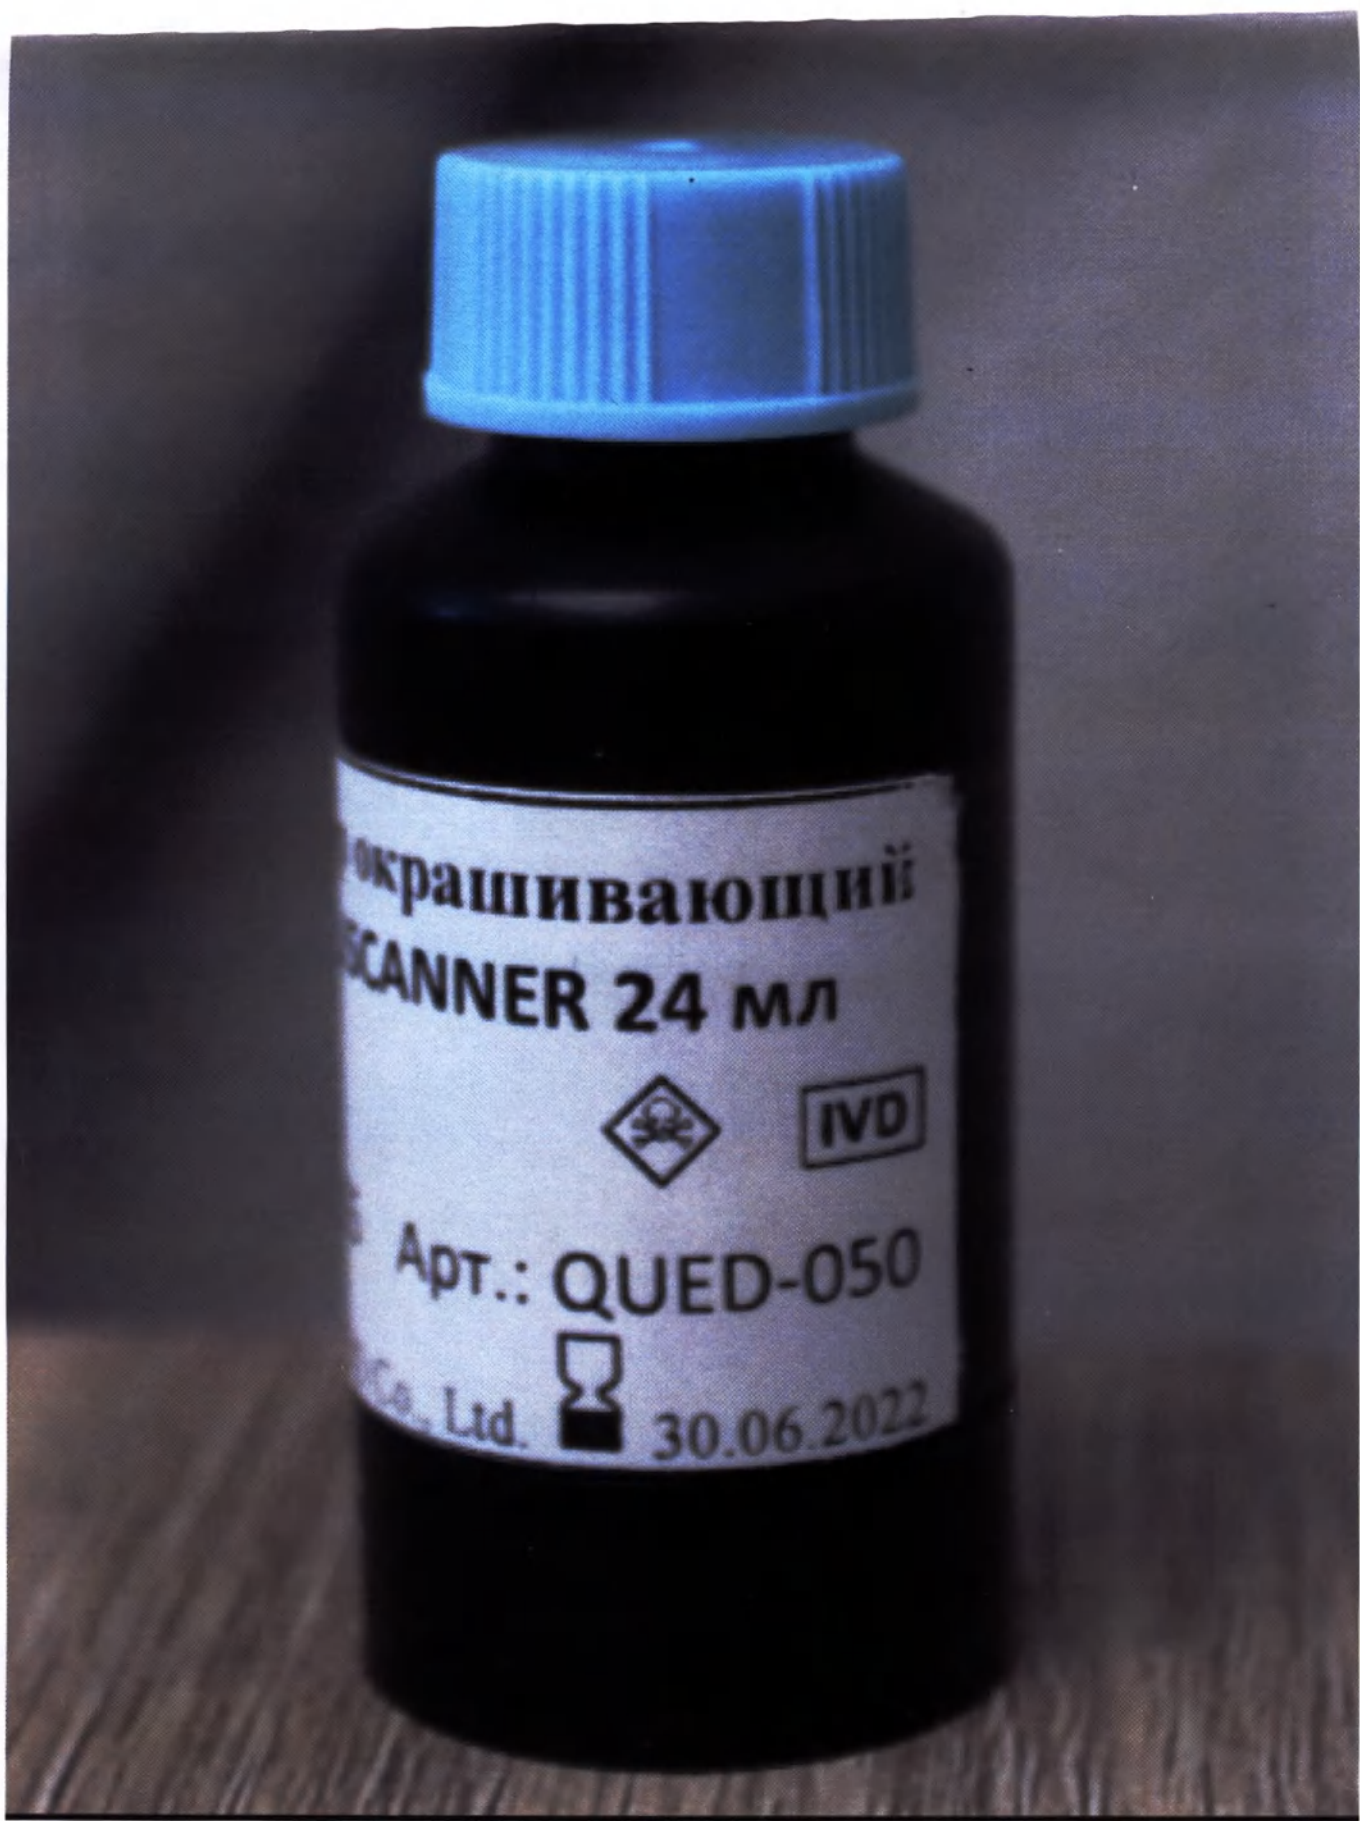

Флакон 24 мл. Раствор окрашивающий для Анализатора автоматического клеточного состава мочи Uscanner (E)

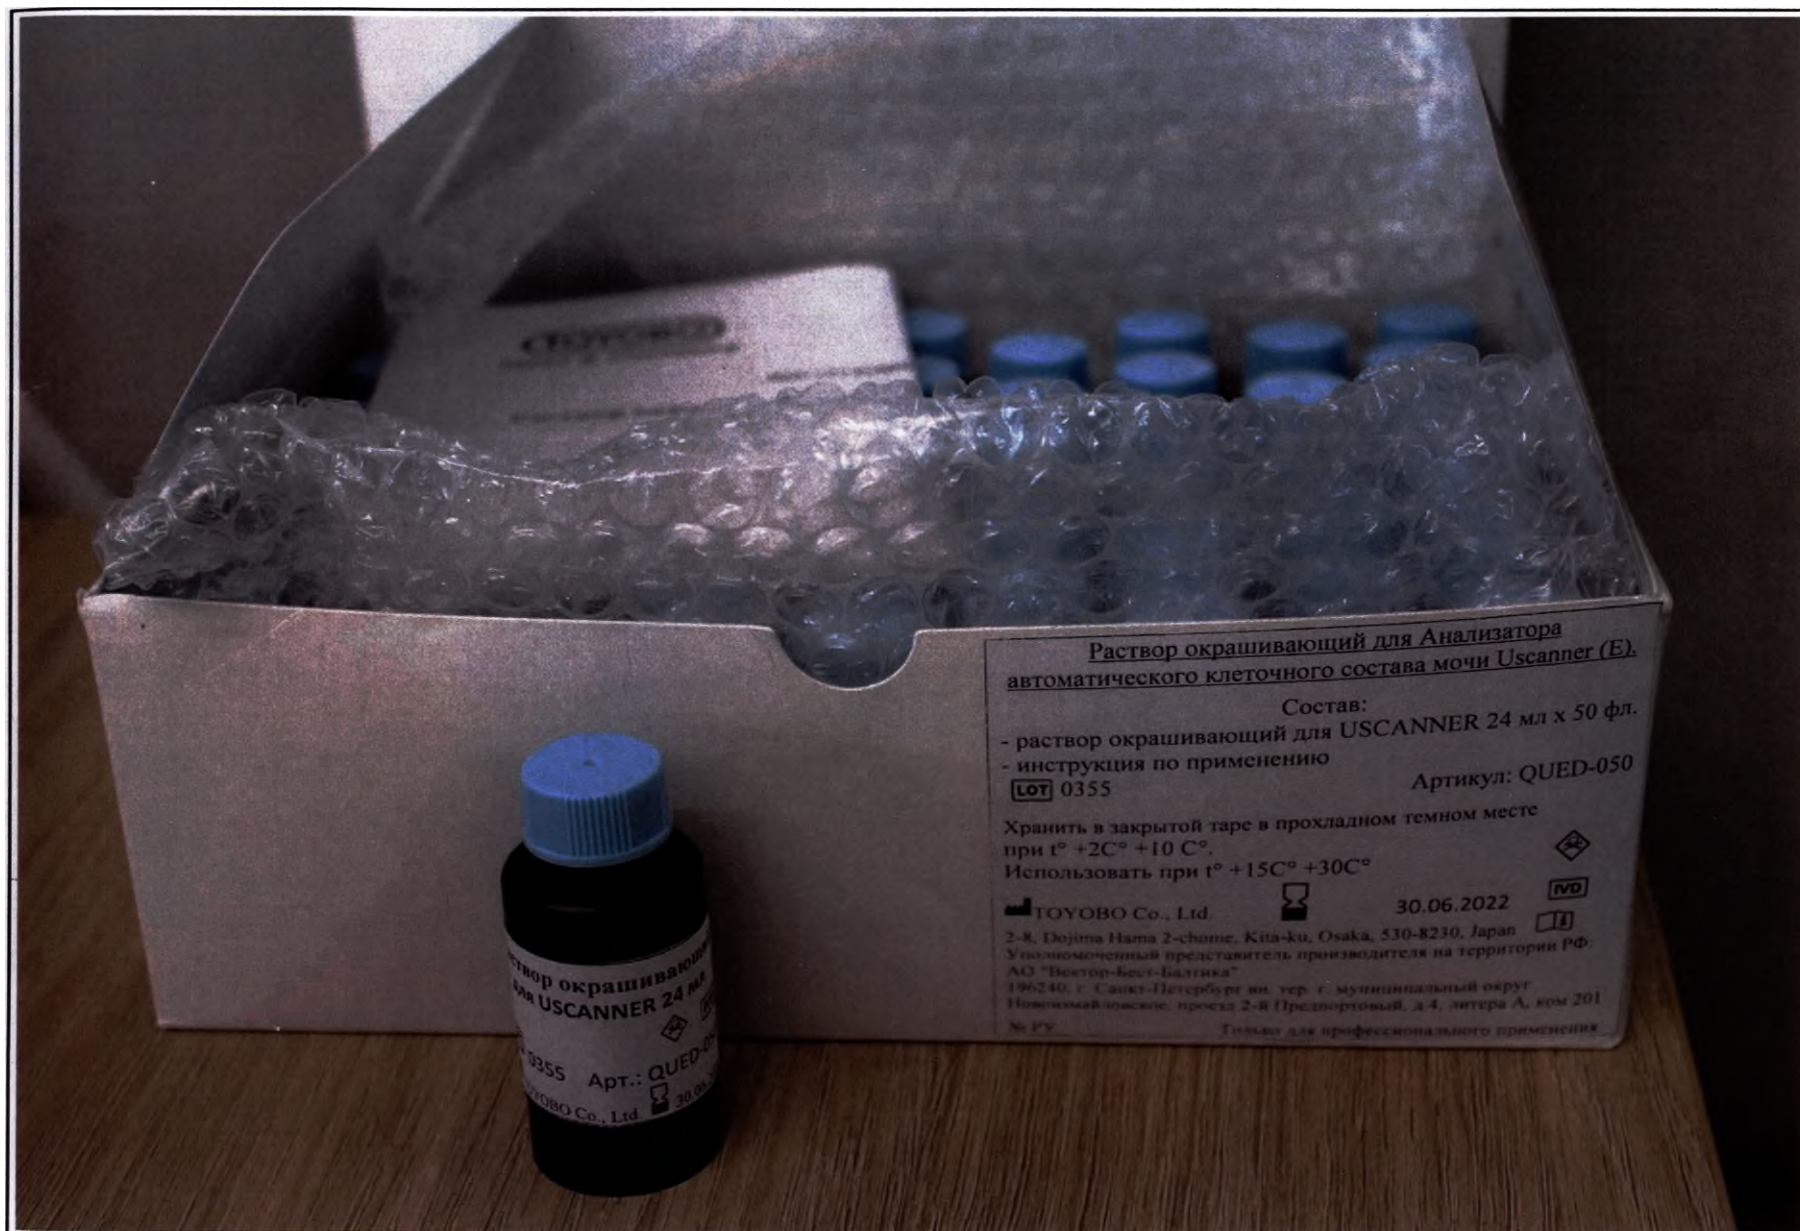

**Раствор окрашивающий для Анализатора
автоматического клеточного состава мочи Usscanner (E).**

Состав:

- раствор окрашивающий для USscanner 24 мл x 50 фл.
- инструкция по применению

LOT 0355

Артикул: QUED-050

Хранить в закрытой таре в прохладном темном месте
при $t^{\circ} +2C^{\circ} +10 C^{\circ}$.
Использовать при $t^{\circ} +15C^{\circ} +30C^{\circ}$

TOYOBO Co., Ltd.

30.06.2022

2-8, Dojima Naha 2-chome, Kita-ku, Osaka, 530-8230, Japan
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
АО "Вектор-Бест-Балтика"
196240, г. Санкт-Петербург, ил. тер. г. муниципальный округ
Новоизмайловское, проезд 2-й Предпортовый, д. 4, литера А, ком 201
№ Р/У

Только для профессионального применения

Раствор окрашивающий для Анализатора
автоматического клеточного состава мочи Uscanner (E).

Состав:

- раствор окрашивающий для USCANNER 24 мл x 50 фл.
- инструкция по применению

LOT 0355

Артикул: QUED-050

Хранить в закрытой таре в прохладном темном месте
при $t^{\circ} +2C^{\circ} +10 C^{\circ}$.

Использовать при $t^{\circ} +15C^{\circ} +30C^{\circ}$

 TOYOBO Co., Ltd.



30.06.2022



2-8, Dojima Naha 2-chome, Kita-ku, Osaka, 530-8230, Japan
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
АО "Вектор-Бест-Балтика"

196240, г. Санкт-Петербург вн. тер. г. муниципальный округ
Новоизмайловское, проезд 2-й Предпортовый, д.4, литера А, ком 201

№ РУ

Только для профессионального применения

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на

5

листах

