

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ТестГен»
А. Н. Тороповский
«15» октября 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ

Набор реагентов для определения статуса мутаций
гена *NRAS* методом мультиплексной ПЦР-РВ с
детекцией кривых плавления в
пробе геномной ДНК человека из образцов
фиксированной ткани
«Тест-*NRAS*-ткань-мульти»

ТУ 21.20.23-036-97638376-2020

Версия 2 от 15.10.2021.



ООО «ТестГен»

Паспорт качества № 250


Набор реагентов для определения
статуса мутаций гена *NRAS* методом
мультиплексной ПЦР-РВ с
детекцией кривых плавления в
пробе геномной ДНК человека из
образцов фиксированной ткани
«Тест-*NRAS*-ткань-мульти»



ТУ 21.20.23-036-97638376-2020

Номер серии (лот)	202110-250
Количество наборов в серии	2
Дата изготовления	2021-10
Срок годности	2022-10

ТестГен

Генетика нового поколения

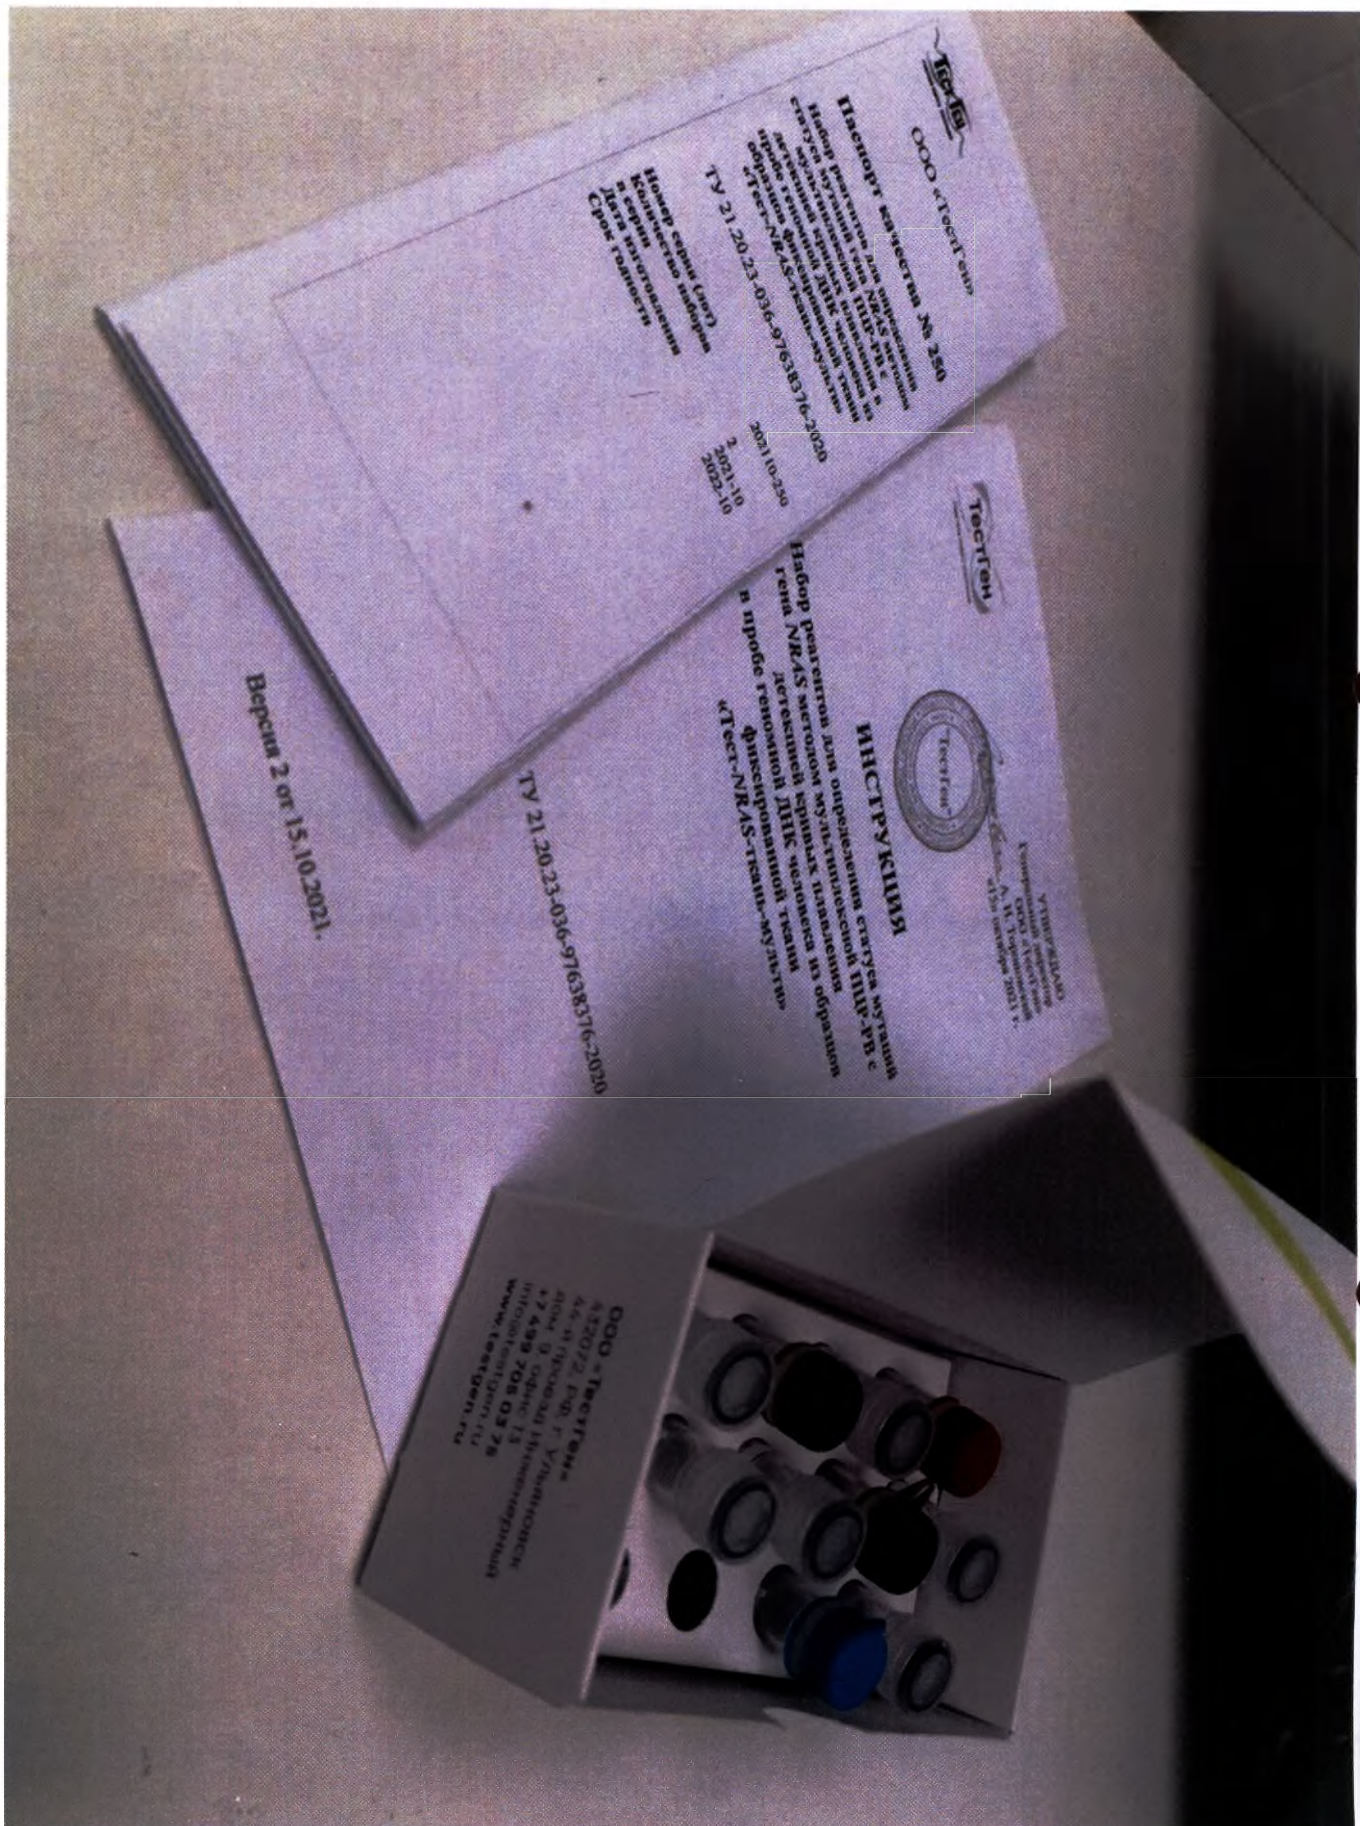




УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ТестГен»
А. Н. Тороповский
«15» октября 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ

Набор реагентов для определения статуса мутаций
гена *NRAS* методом мультиплексной ПЦР-РВ с
детекцией кривых плавления
в пробе геномной ДНК человека из образцов
фиксированной ткани
«Тест-*NRAS*-ткань-мульти»

TU 21.20.23-036-97638376-2020

Версия 2 от 15.10.2021.



ООО «ТестГен»

Паспорт качества № 250

Набор реагентов для определения
статуса мутаций гена *NRAS* методом
мультиплексной ПЦР-РВ с
детекцией кривых плавления в
пробе геномной ДНК человека из
образцов фиксированной ткани
«Тест-*NRAS*-ткань-мульти»


TU 21.20.23-036-97638376-2020

Номер серии (лот)	202110-250
Количество наборов в серии	2
Дата изготовления	2021-10
Срок годности	2022-10

Набор реагентов для определения статуса мутаций гена *NRAS*
методом мультиплексной ПЦР-РВ с детекцией кривых плавления в
пробе геномной ДНК человека из образцов фиксированной ткани
«Тест-*NRAS*-ткань-мульти»


TU 21.20.23-036-97638376-2020

Состав набора	
ПЦР-бульон	2 пробирки по 500 мкл
Праймер-микс 12	1 пробирка, 112 мкл
Праймер-микс 53	1 пробирка, 112 мкл
Праймер-микс 58	1 пробирка, 112 мкл
Праймер-микс 53	1 пробирка, 112 мкл
Праймер-микс 117	1 пробирка, 112 мкл
Праймер-микс 146	1 пробирка, 112 мкл
ПНД	4 пробирки, 324 мкл
ОНД	3 пробирки, 324 мкл



ТУ

Информация для использования
набора для профессионального применения



История проведения для оборудования класса точности 1 класс (100.05)
 на основании сертификата ГИЛ-08 с датировкой нулевым показанием в
 работе (гидрометр ГИЛ) внесено в образовательный фонд метрологической службы

с точностью 100.05 класс точности

TV 21.20.23.036-97631376-2020

[ND]

Состав изделий:

тип флуор	2 пробирки по 340 мкл
Пробирка-милл 12	1 пробирка, 112 мкл
Пробирка-милл 13	1 пробирка, 112 мкл
Пробирка-милл 59	1 пробирка, 112 мкл
Пробирка-милл 61	1 пробирка, 112 мкл
Пробирка-милл 117	1 пробирка, 112 мкл
Пробирка-милл 146	1 пробирка, 112 мкл
ГМО	1 пробирка, 324 мкл
ОМО	1 пробирка, 324 мкл



24 °C

-16 °C



2022-10



2021-10





202110-750

ру
 История для вкл. в кл. о дате истечения
 История для профессионального применения



Нанесение маркировки на пробирки с помощью этикеток из белой полимерной пленки с печатной надписью черного цвета

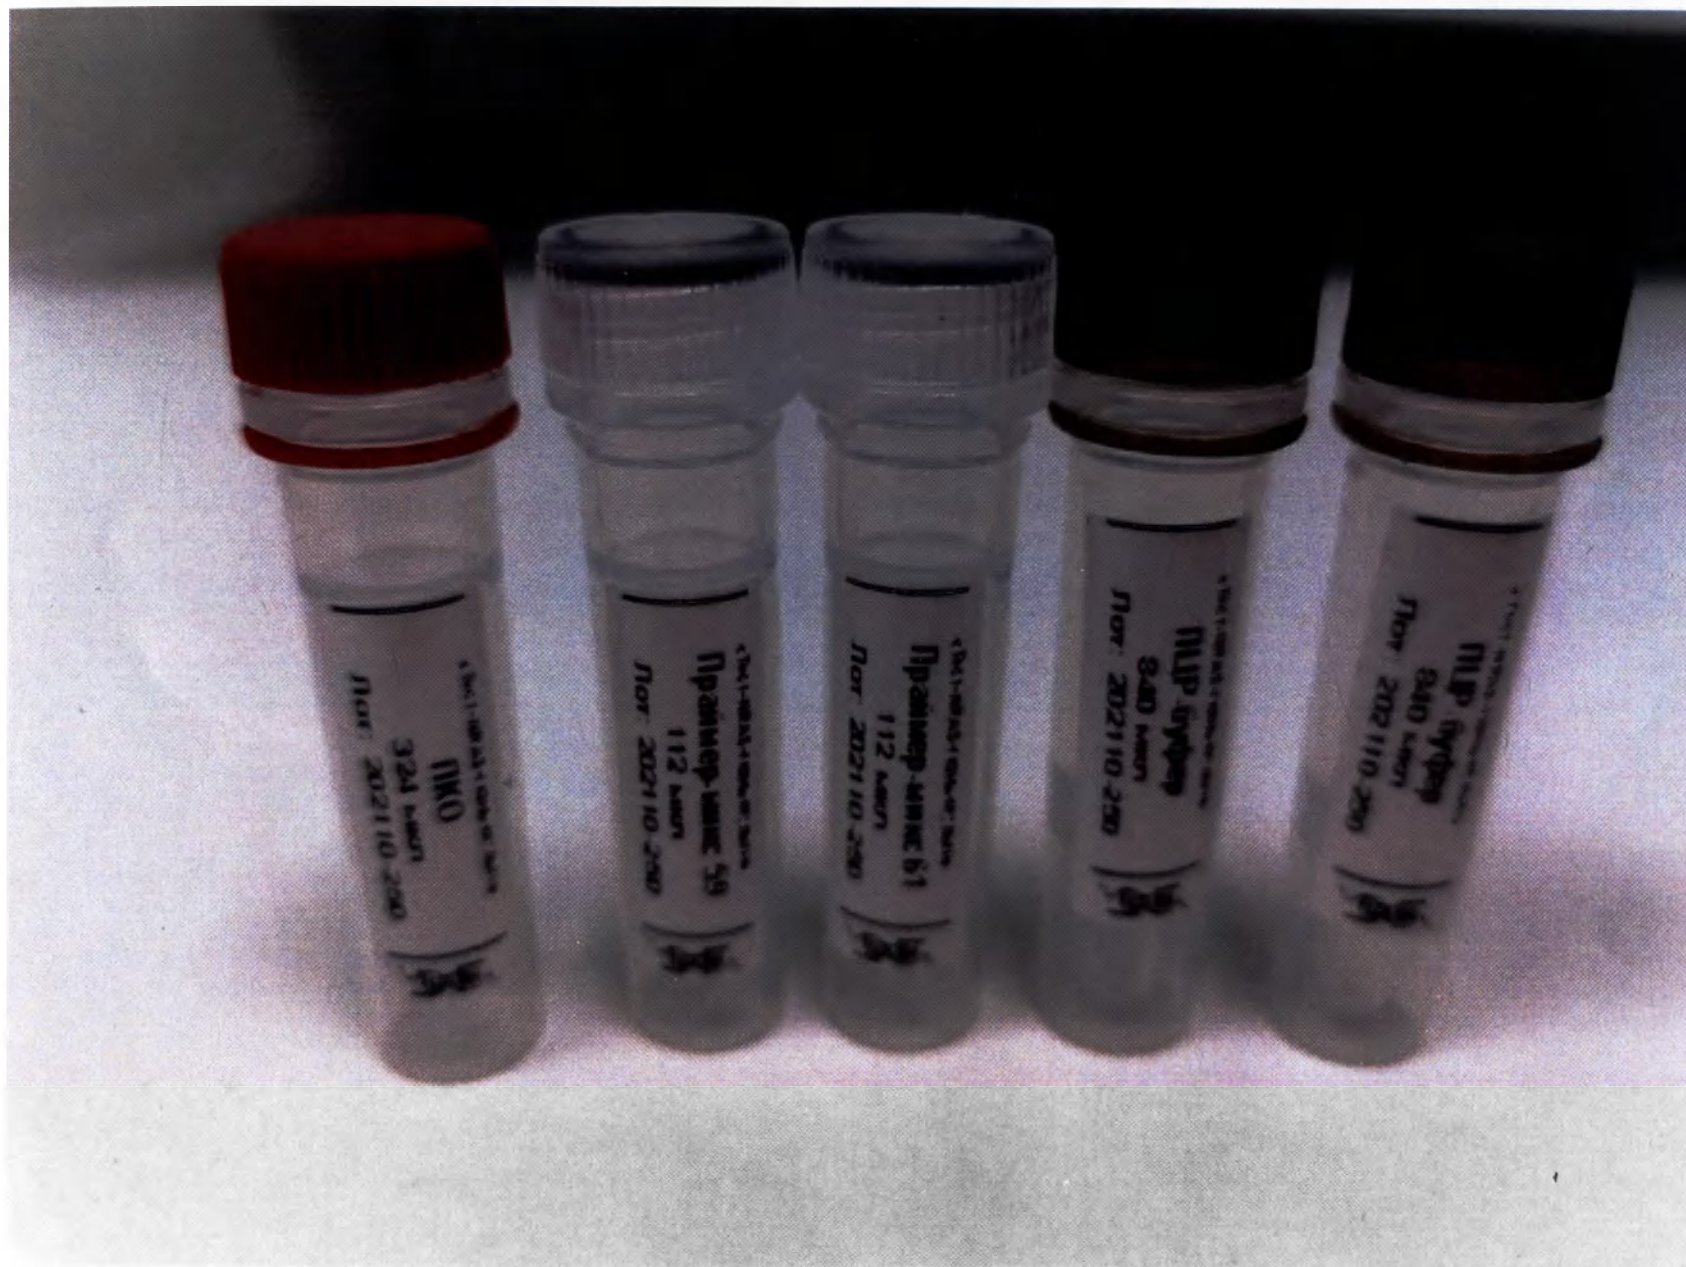

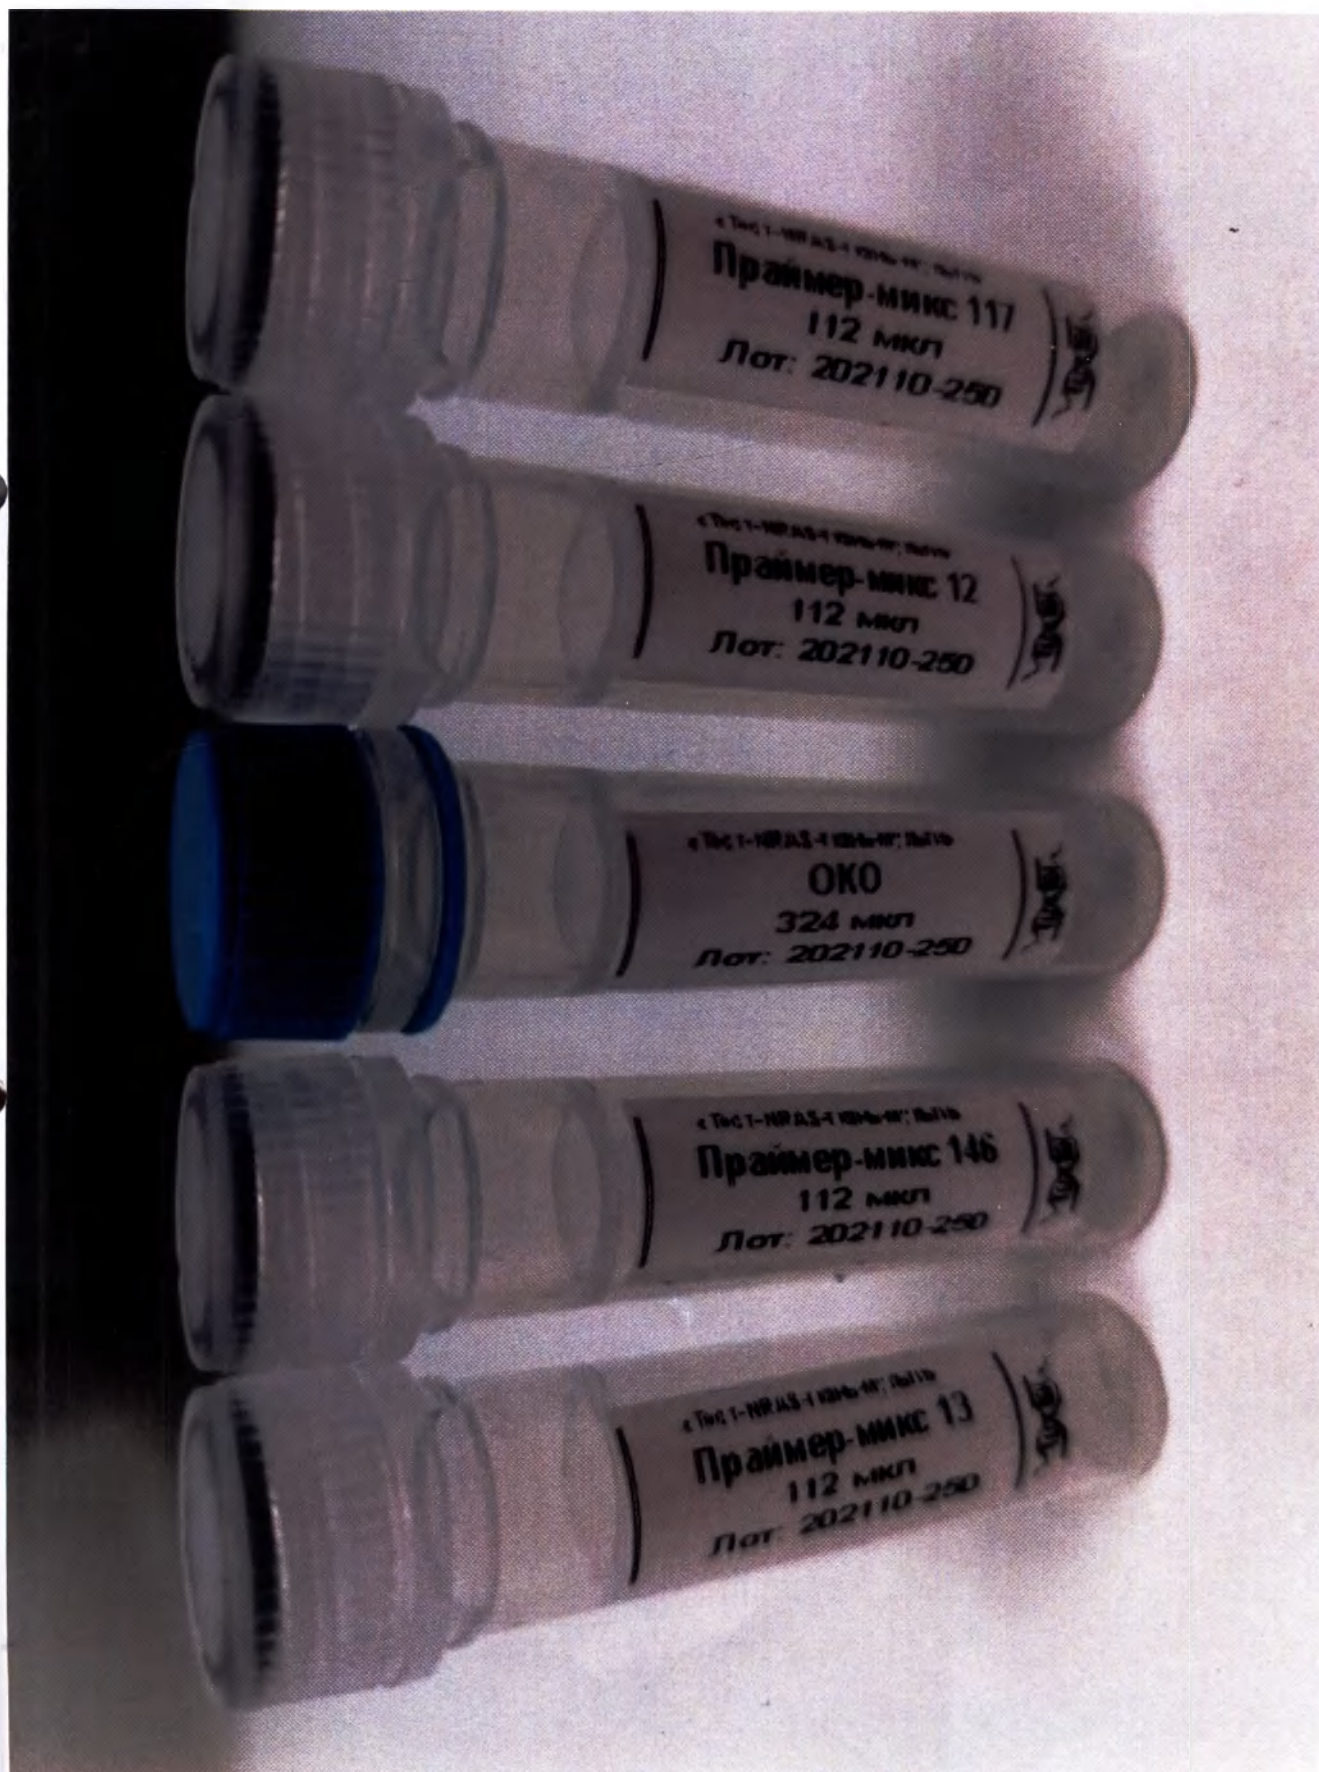

Нанесение маркировки на пробирки с помощью этикеток из прозрачной полимерной пленки с печатной надписью черного цвета



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

4 (Слеса) листов

Должность: ген. директор

Тороповский А.Н.

