

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

« 10 » *нояб* 2022 г.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАЙЛО Р. В.

Фотографические изображения изделия:

**Набор реагентов для количественного определения тиреоглобулина
электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro
(Thyroglobulin (Electrochemiluminescence Immunoassay) / Tg)**

Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.
(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай



Tg Quality Control

1062100000 14 MAY 2022
 QC Sample Label : 14-201-01181 ng/mL
 QC Sample Weight : 125.000 ± 0.1 mg

Galent


Instruction For Use


[Product Name]
 Thyroglobulin (Electrochemiluminescence Immunoassay)
[Order Information]

Part No.	Package Size
6900330	50T
6900334	2+50T
6900335	100T
6900339	2+100T

[Extended Uses]
 Intended for the in vitro quantitative determination of Thyroglobulin in human serum and plasma. Calibration of Tg is used as an aid in interpreting assay clinical results.


[Summary]

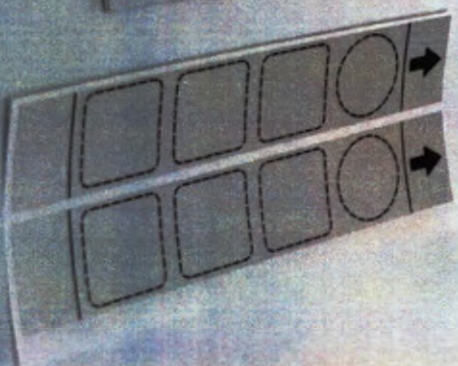

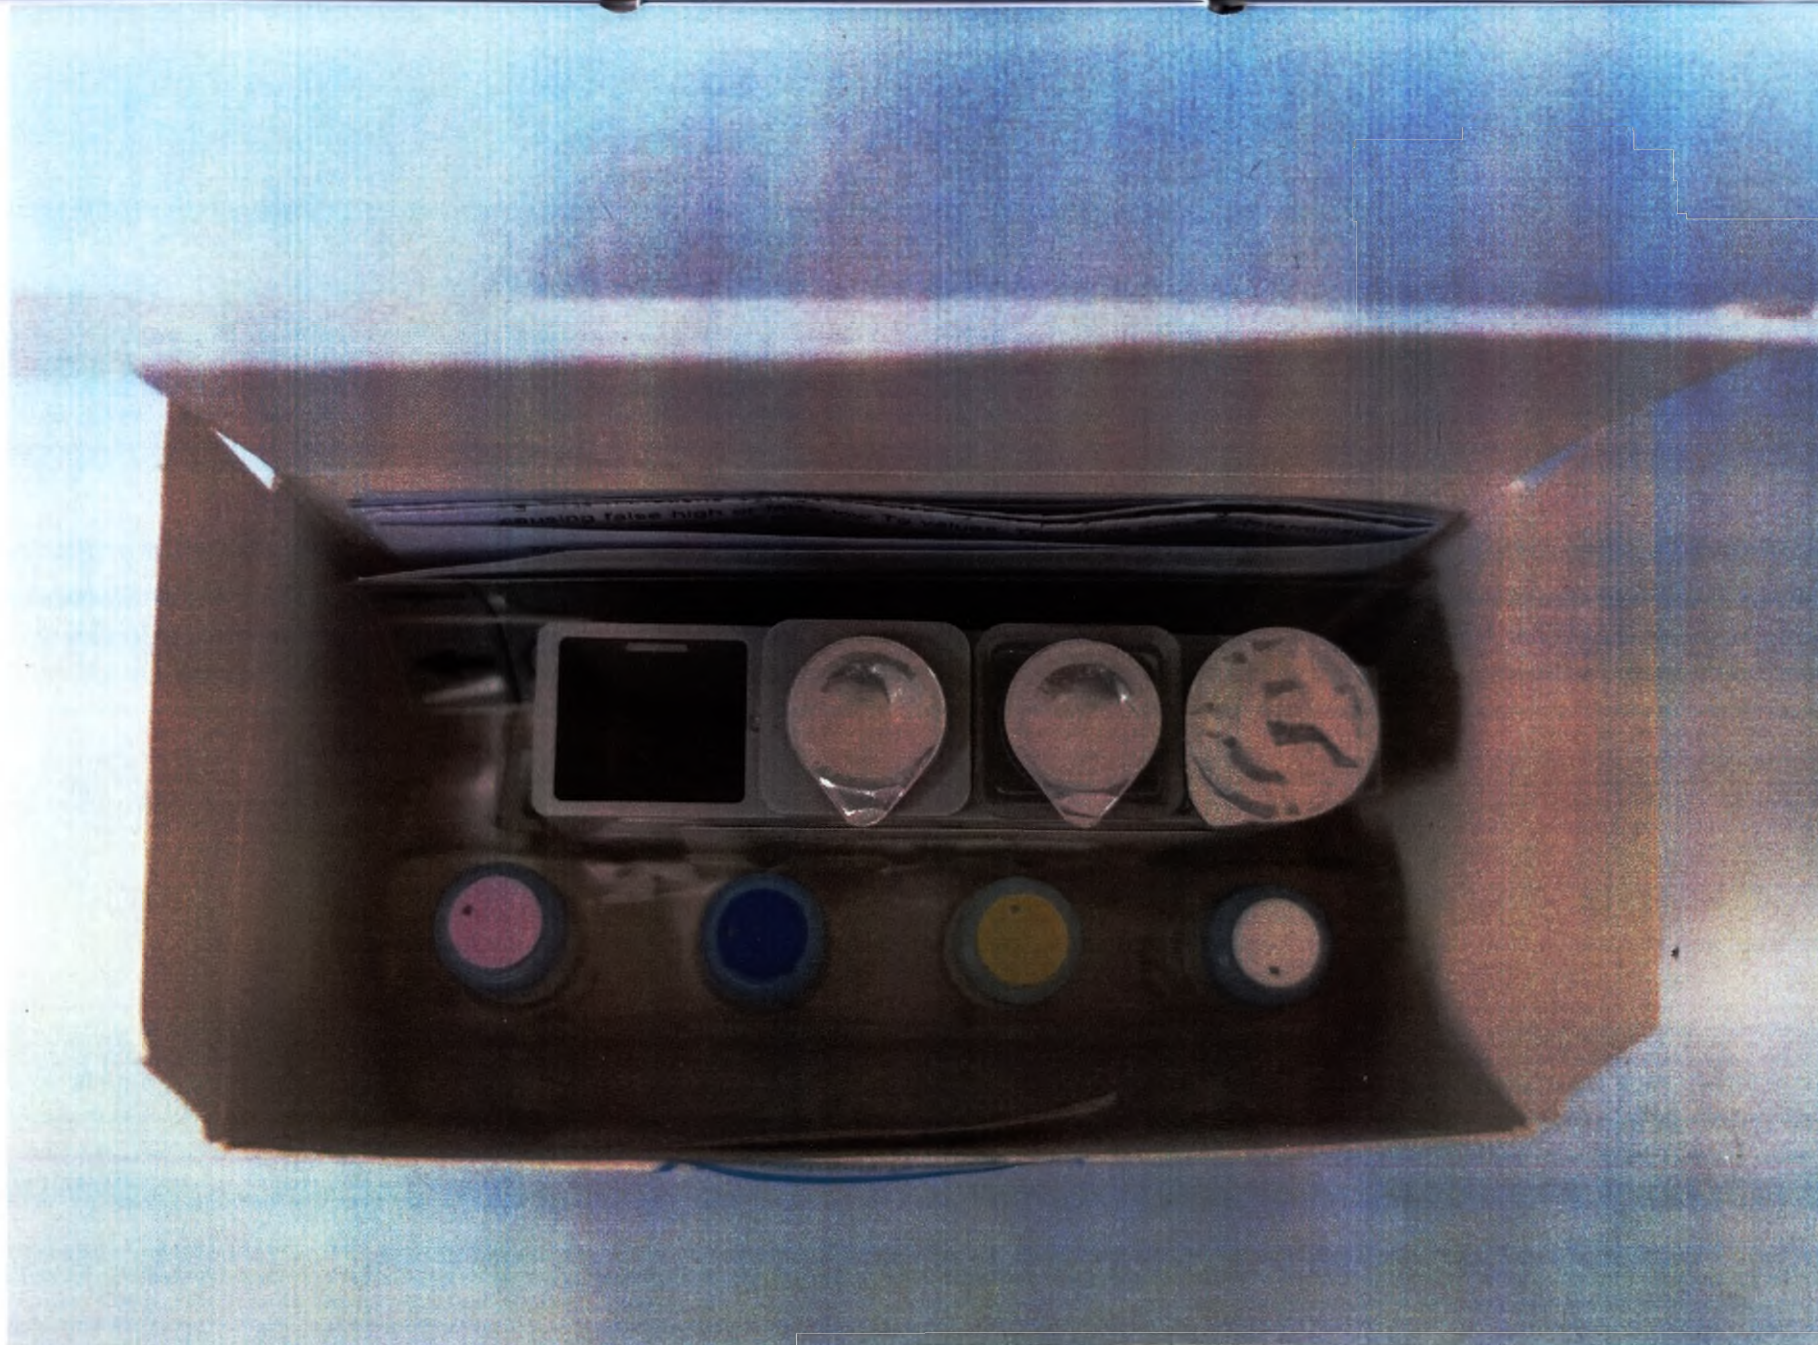


Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения тиреоглобулина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Thyroglobulin (Electrochemiluminescence Immunoassay) / Tg))



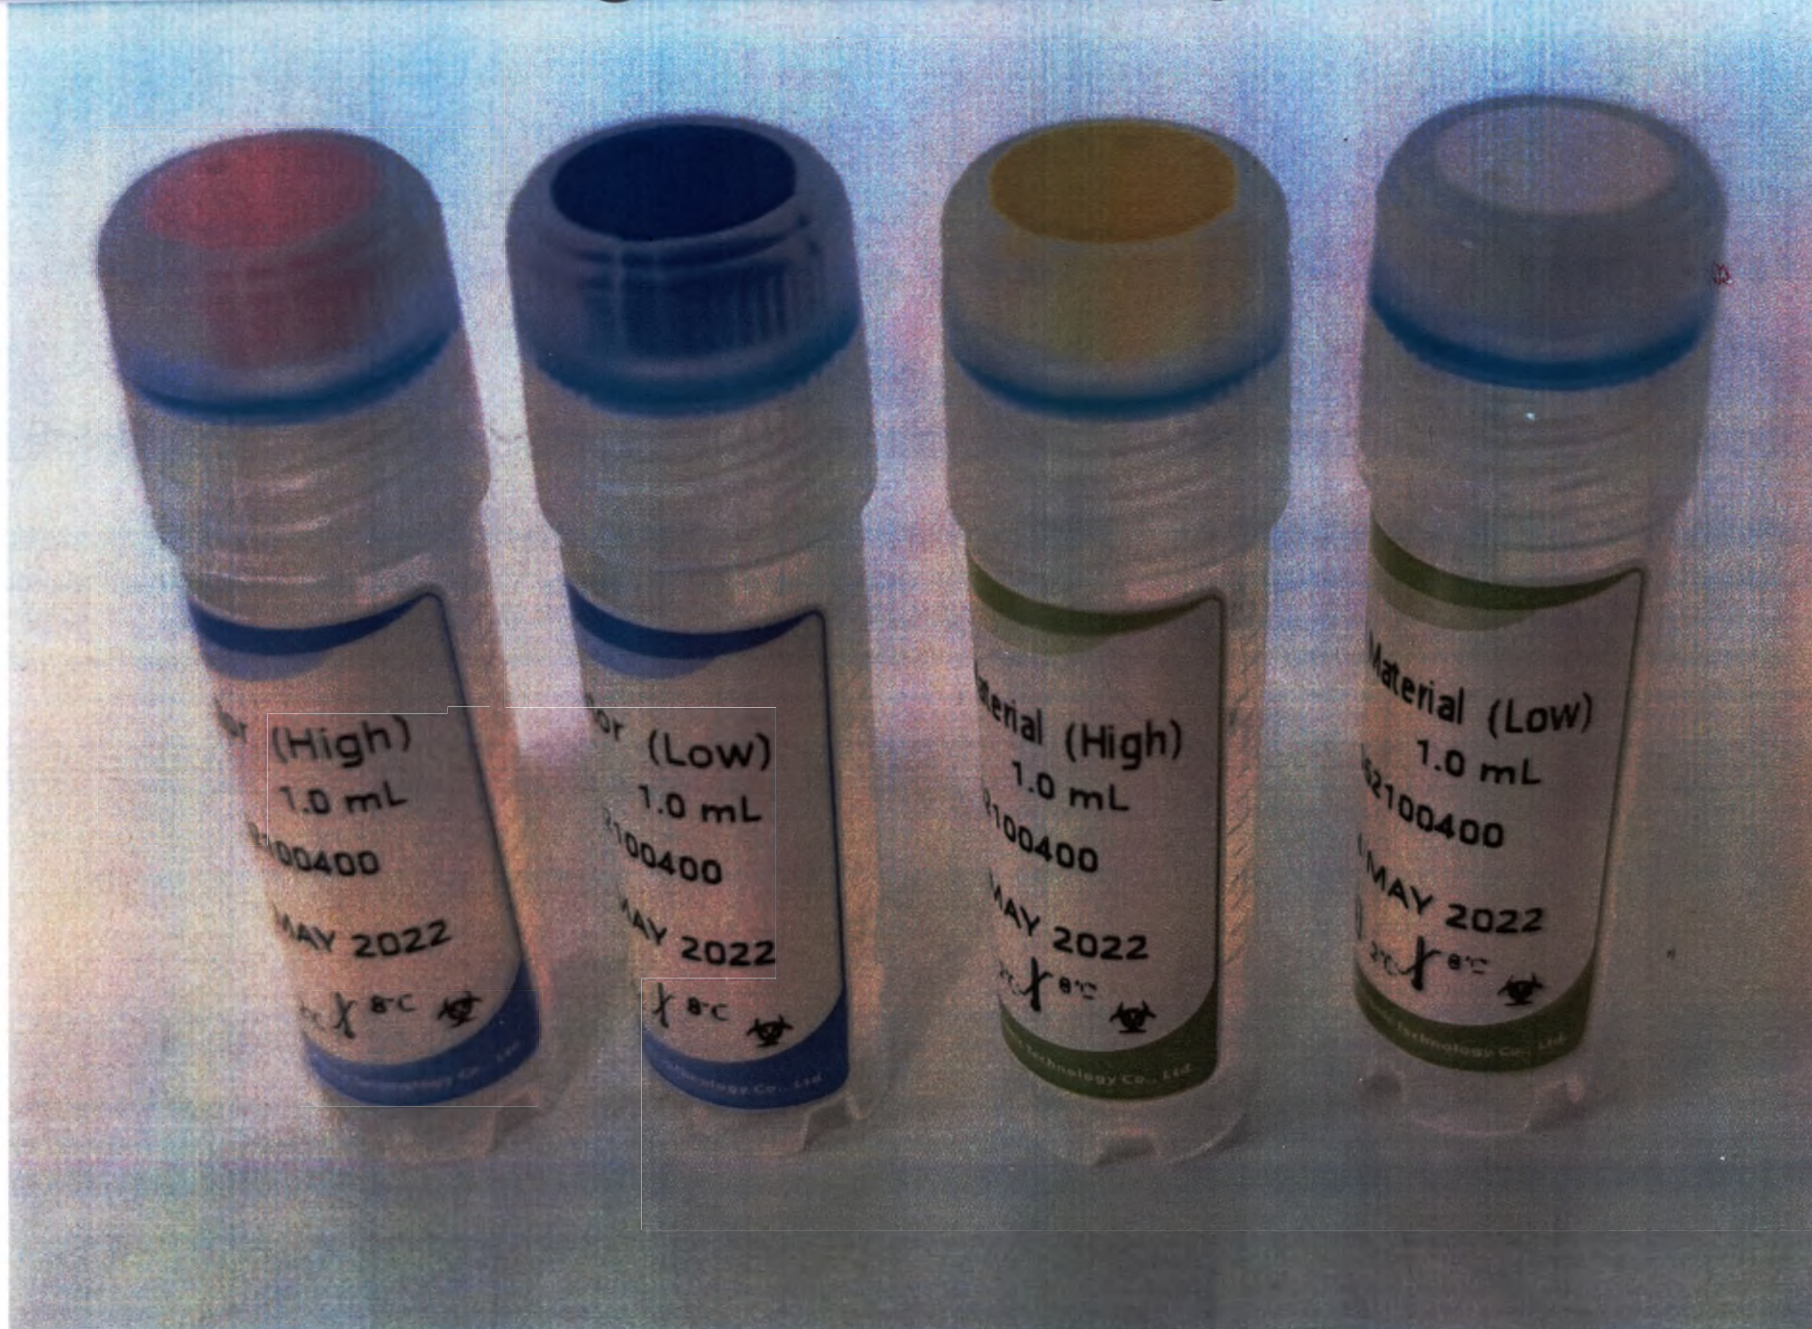

Калибратор (низкий и высокий уровень), Материал контрольный (низкий и высокий уровень) (Набор реагентов для количественного определения тиреоглобулина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Thyroglobulin (Electrochemiluminescence Immunoassay) / Tg))

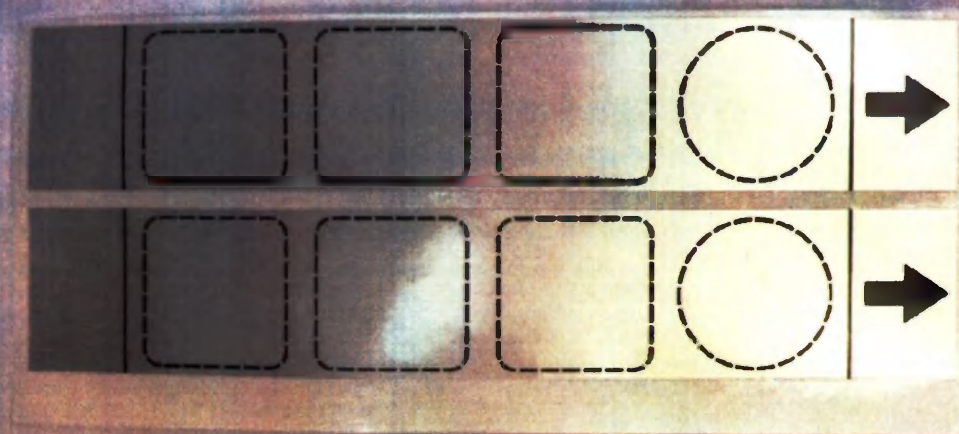


Этикетки для запечатывания флаконов (Набор реагентов для количественного определения тиреоглобулина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Thyroglobulin (Electrochemiluminescence Immunoassay) / Tg))

Tg Quality Control


LOT T062100400  14 MAY 2022

QC Range (Low) : 14.221-33.181 ng/mL

QC Range (High) : 135.936-317.184 ng/mL



Этикетка результатов значений материалов контрольных (Набор реагентов для количественного определения тиреоглобулина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Thyroglobulin (Electrochemiluminescence Immunoassay) / Tg))

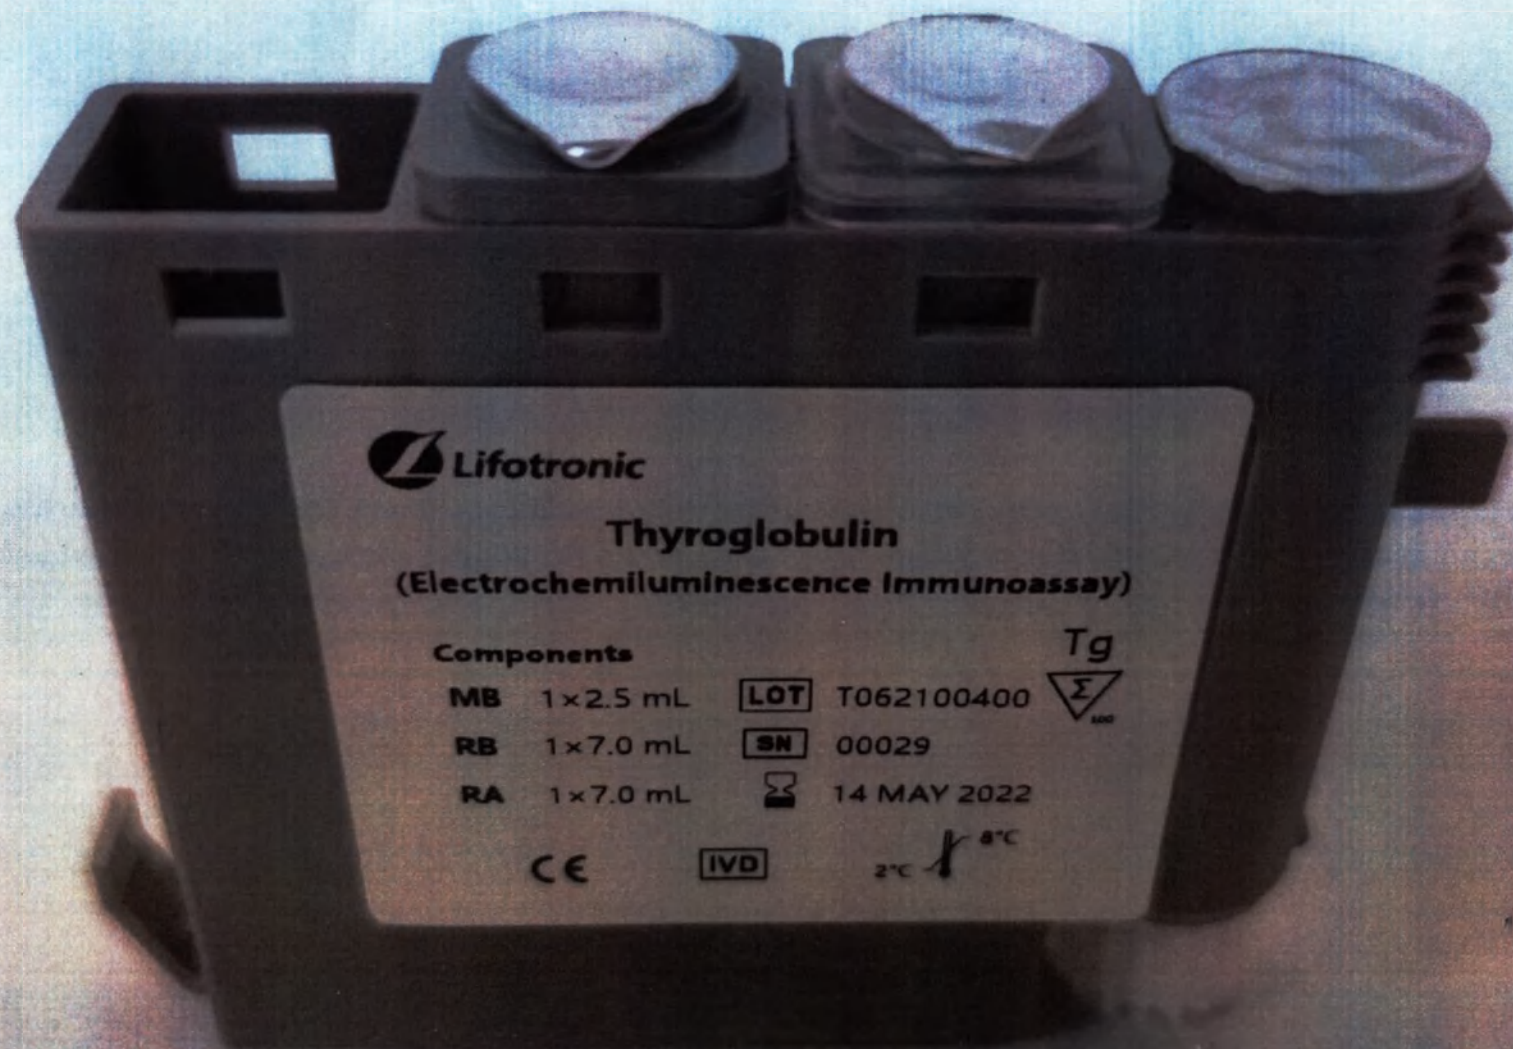

Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения тиреоглобулина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Thyroglobulin (Electrochemiluminescence Immunoassay) / Tg))

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 7 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А.
М.П.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789

КУСАЙЛО Р. В.