

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «ХИЛЛ-РОМ РУС»

Королева Е.А.

13.05. 2022 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Матрас терапевтический Accella™ с постоянным и переменным режимами низкого давления, в вариантах исполнения

2022 г.



Фото 3 - Верхнее покрытие

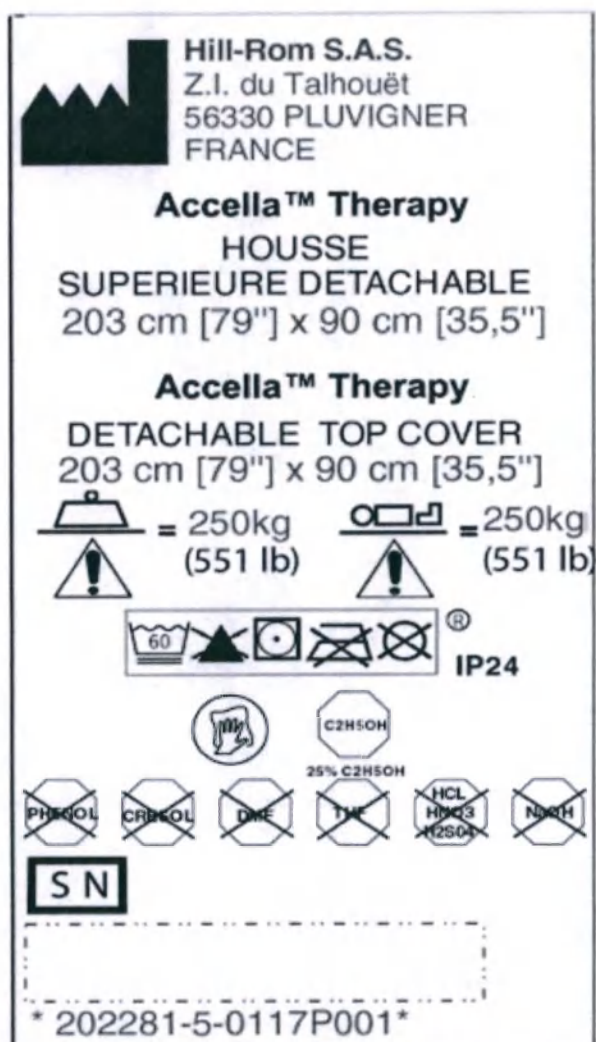


Фото 4 - Верхнее покрытие (маркировка)



Фото 5 - Нижнее покрытие с ремнями крепления матраса к кровати (в изголовье и в ножной секции)



Фото 6 - Встроенный компрессор



Фото 7- Датчик давления I-mersion



Фото 8 - Пульт навесной, модель AD313A



Фото 9 - Воздушный фильтр



Фото 10 - Отсек для рентгеновских кассет

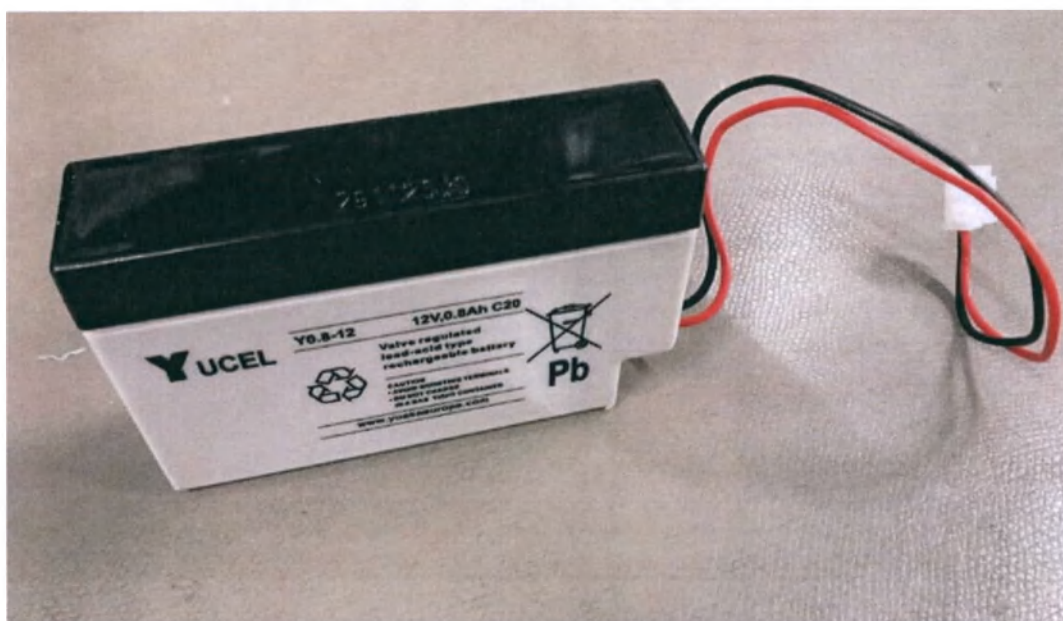


Фото 11 - Аккумулятор встроенный



Фото 12 - Сумка для транспортировки



Фото 13- Кабель питания



Фото 14- Инструкция по применению



Фото 15 - Матрас Accella™ Therapy, модель P006788A



Фото 16 - Матрас Accella™ Therapy, модель P006788A (маркировка)



Фото 19- Нижнее покрытие с ремнями крепления матраса к кровати (в изголовье и в ножной секции)



Фото 20 - Встроенный компрессор.



Фото 21- Датчик давления I-mmersion



Фото 22- Пульт навесной, модель AD293A



Фото 23 - Воздушный фильтр



Фото 24 - Отсек для рентгеновских кассет



Фото 25 - Аккумулятор встроенный



Фото 26 - Сумка для транспортировки

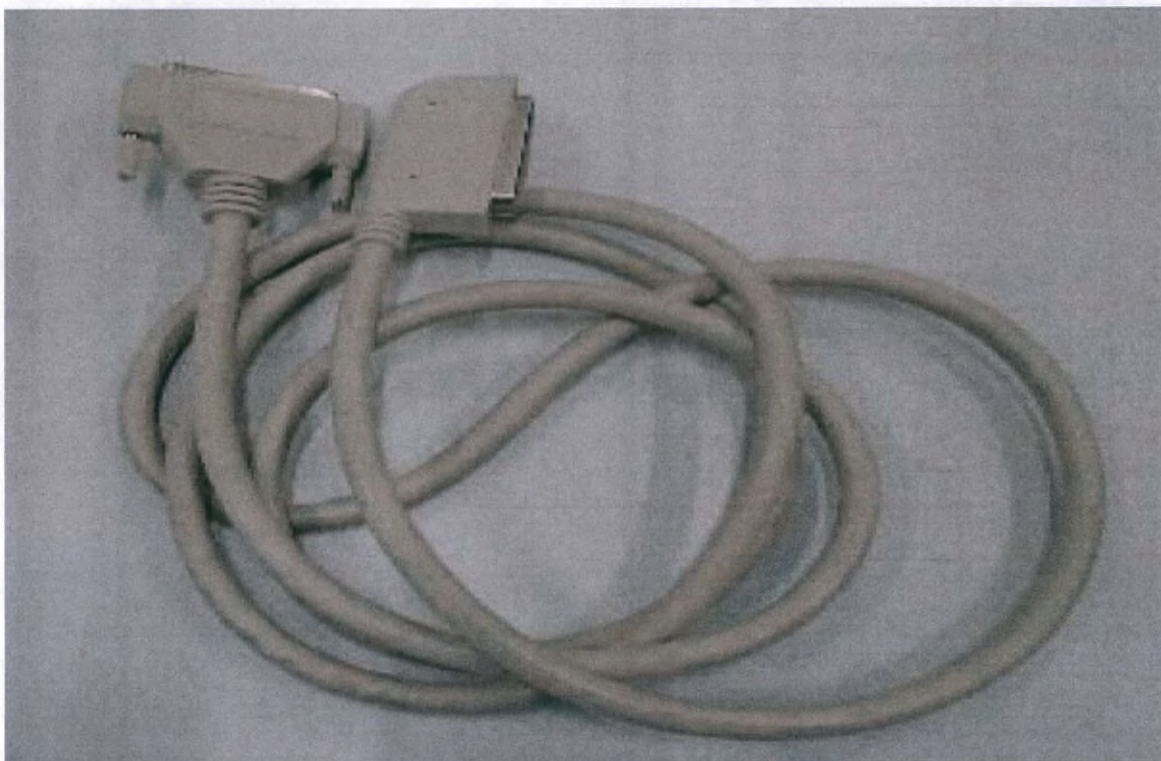



Фото 27- Кабель питания.



Фото 28 - Инструкция по применению



Фото 29 - Матрас Accella™ Therapy, модель P006789A

HILL-ROM S.A.S.
Z.I. du Talhouet
56330 PLUVIGNER - FRANCE
YYYY-MMM-DD

MD

C

E

199709-3

0459

Accella™ Therapy

REF

P006789A

SN

HRPM0000000



(01) 00887761997127
 (11) YYMMDD
 (01) HRPM000000000

220-240V ~50 Hz 40VA - IP24

Фото 30 - Матрас Accella Therapy, модель P006789A(маркировка)



Фото 33 - Нижнее покрытие с ремнями крепления матраса к кровати (в изголовье и в ножной секции)



Фото 34 - Встроенный компрессор



Фото 35 - Датчик давления I-mmersion



Фото 36 - Пульт навесной, модель AD293A

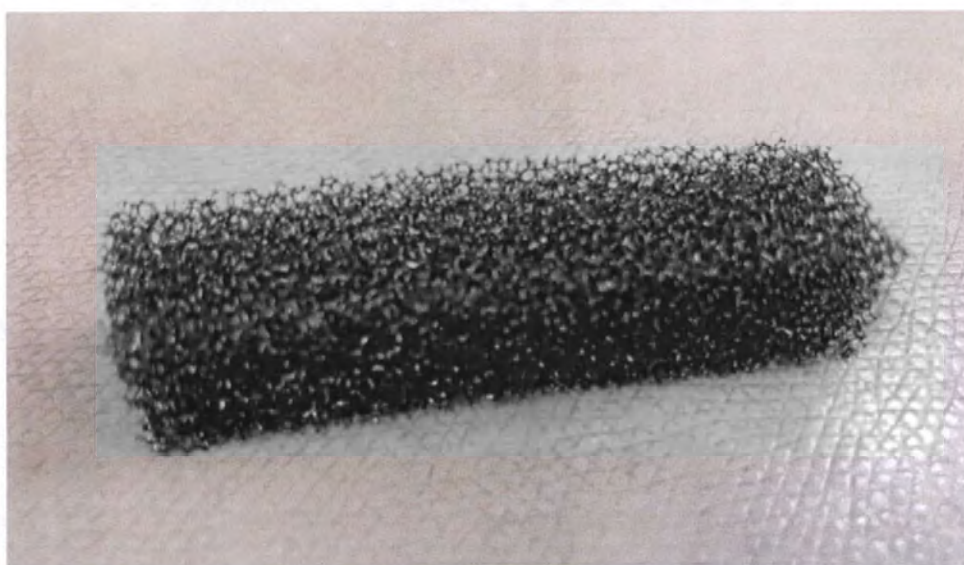


Фото 37 – Воздушный фильтр

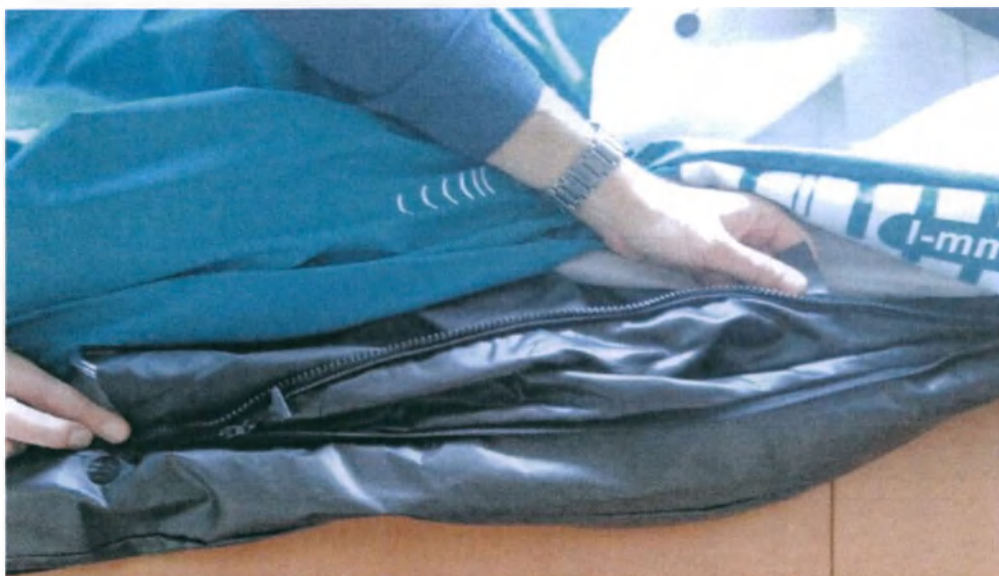


Фото 38 – Отсек для рентгеновских кассет



Фото 39 – Аккумулятор встроенный



Фото 40 - Сумка для транспортировки




Фото 41 – Кабель питания.



Фото 42 – Инструкция по применению



Фото 43 – Матрас Accella™ Therapy, модель P006794A

HILL-ROM S.A.S.
Z.I. du Talhouet
56330 PLUVIGNER - FRANCE
YYYY-MMM-DD

MD

CE

0459

199709-3

Accella™ Therapy

REF

P006794A

SN

HRPM0000000



(01) 00687761997127

(11) YYMMDD

(01) HRPM000000000

220-240V ~50 Hz 40VA - IP24

Фото 44 – Матрас Accella™ Therapy, модель P006794A (маркировка)



Фото 45 – Верхнее покрытие

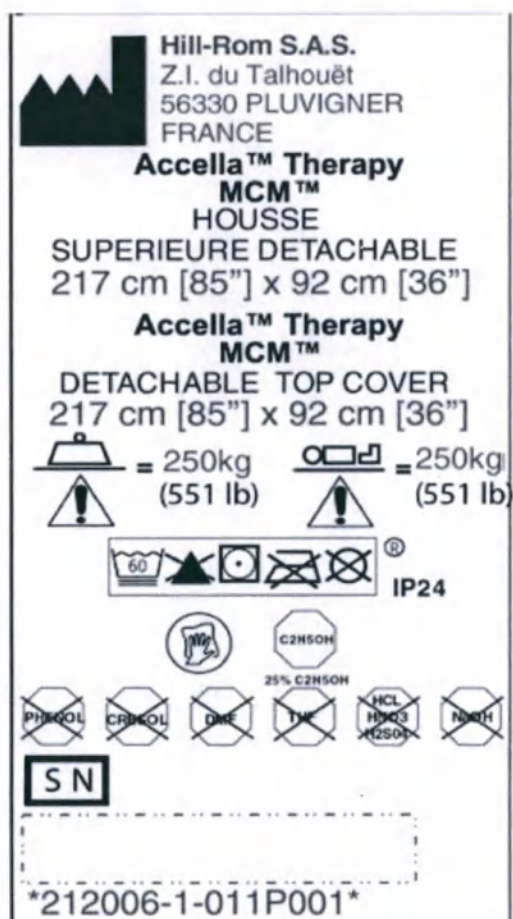


Фото 46 – Верхнее покрытие (маркировка)



Фото 47 – Нижнее покрытие с ремнями крепления матраса к кровати (в изголовье и в ножной секции)



Фото 48 – Встроенный компрессор



Фото 49 – Датчик давления I-mmerision



Фото 50 - Пульт навесной, модель AD293A



Фото 51 – Воздушный фильтр



Фото 52 – Отсек для рентгеновских кассет



Фото 53 – Аккумулятор встроенный



Фото 54 – Сумка для транспортировки



Фото 55– Кабель питания



Фото 56- Инструкция по применению



Фото 57 – Упаковка (общий вид)

REF P006783A			
QUANTITY : 1 (Q1)		Transport and Storage Requirements:	
CE 0459		 	
Accella™ Therapy			
Hill-Rom		220-240V -50 Hz 40VA - IP24	
SN H RPM00000000		COUNTRY OF ORIGIN : MADE IN FRANCE	
		 HILL-ROM S.A.S. Z.I. du Talhouet 56330 PLUVIGNER FRANCE	

Фото 58 – Маркировка упаковки (общий вид)

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 26

двадцати шест листах

