

Утверждаю

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»
Т.А. Носова

«18» февраля 2022 г.
М.П.




ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАЙЛО Р.В.


Фотографические изображения

Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носа или носоглотки для диагностики in vitro (Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test). Партии COV1080132, COV1080133, COV1090058, COV1090059

« ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.»
(«ЭЙКОН Биотех Ханчжоу Ко., Лтд.»), Китай

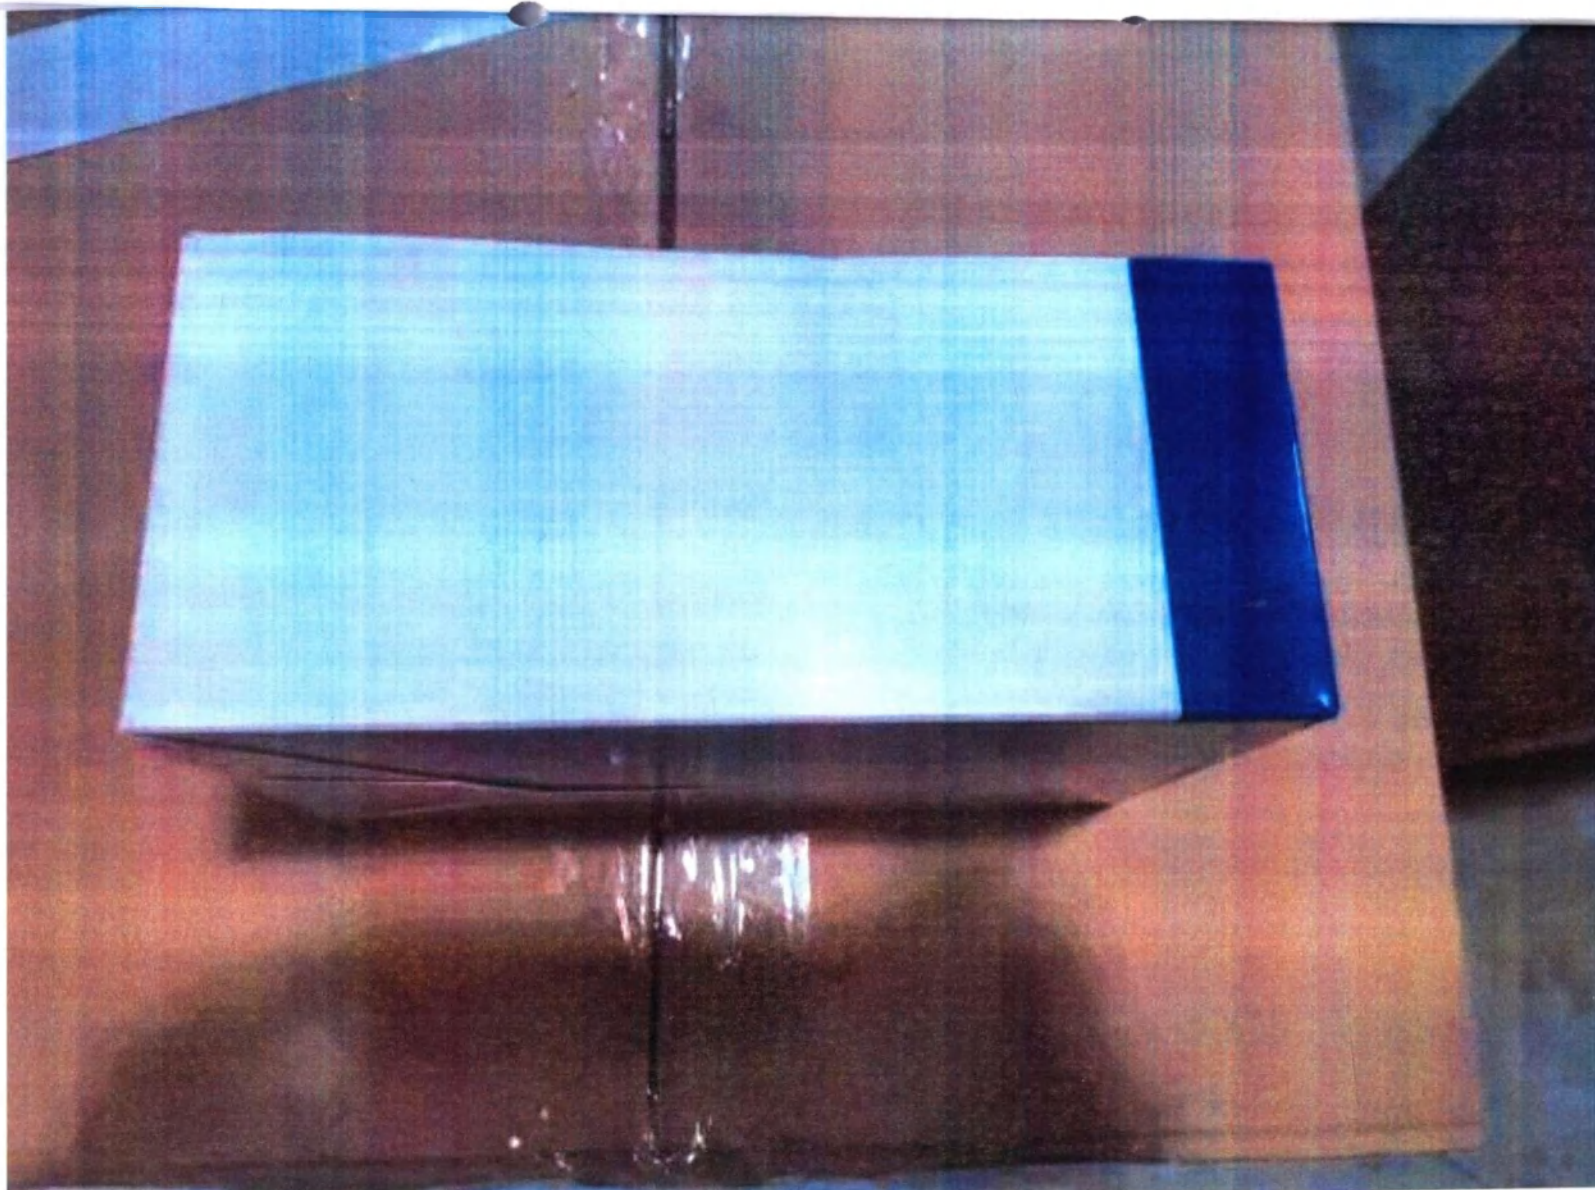

Потребительская упаковка в варианте исполнения 25 шт./уп. (вид спереди) МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носа или носоглотки для диагностики in vitro (Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test). Партии COV1080132, COV1080133, COV1090058, COV1090059»

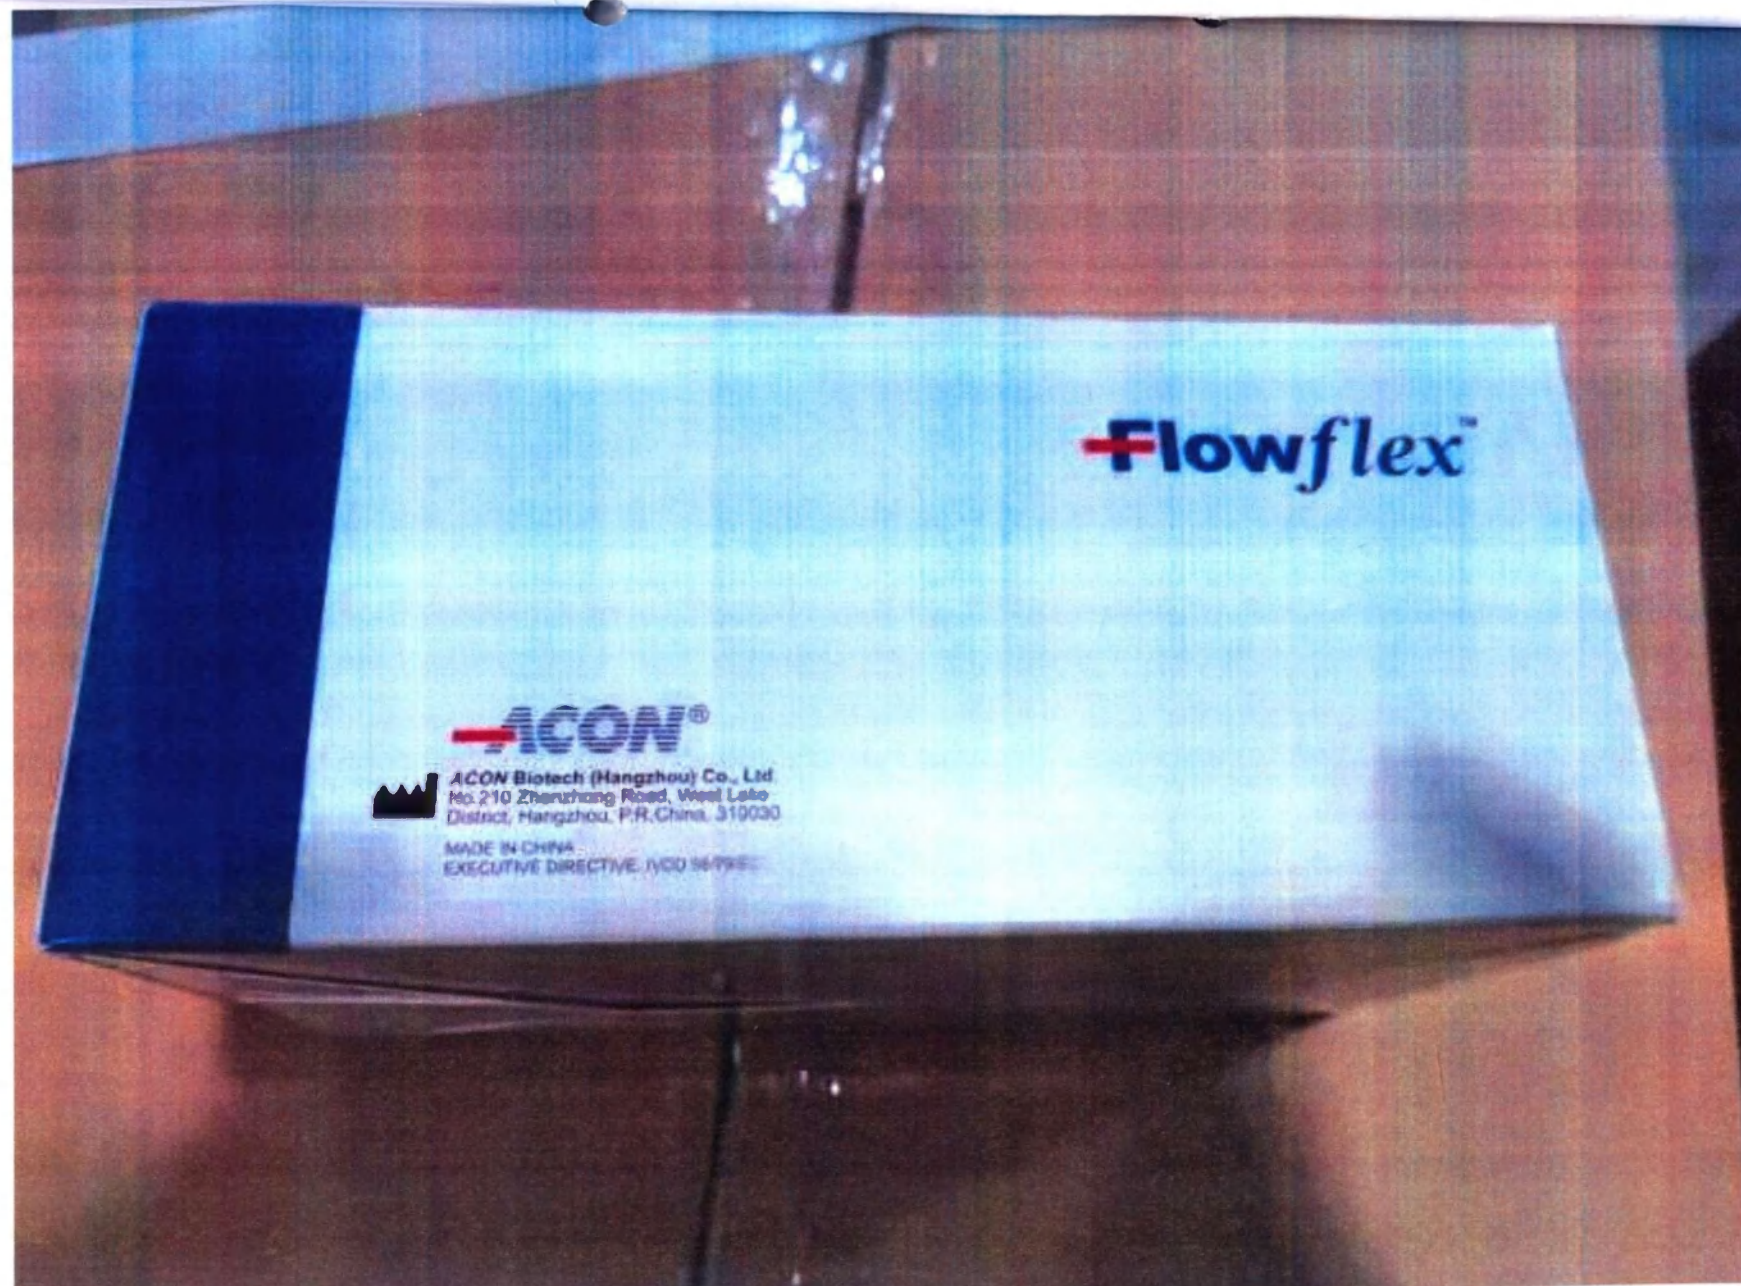

Потребительская упаковка в варианте исполнения 25 шт./уп. (вид спереди) МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носа или носоглотки для диагностики in vitro (Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test). Партии COV1080132, COV1080133, COV1090058, COV1090059»



Потребительская упаковка в варианте исполнения 25 шт./уп. (вид сверху) МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носа или носоглотки для диагностики in vitro (Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test). Партии COV1080132, COV1080133, COV1090058, COV1090059»

Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

REF L031-11816

A rapid test for the qualitative detection of SARS-CoV-2 nucleocapsid antigens in nasal and nasopharyngeal swab specimens.

For professional *in vitro* diagnostic use only.

Contents:

25 Test Cassettes

1 Positive Control Swab

Package Insert

25 Extraction Buffer Tubes

1 Negative Control Swab

Specimen Collection Guide

LOT COV1080132

 2023-04-22

 25 LCA10395-01

MD



Потребительская упаковка в варианте исполнения 25 шт./уп. (левая сторона) Партия COV1080132 МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носа или носоглотки для диагностики *in vitro* (Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test). Партии COV1080132, COV1080133, COV1090058, COV1090059»

Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

REF L031-11815

A rapid test for the qualitative detection of SARS-CoV-2 nucleocapsid antigens in nasal and nasopharyngeal swab specimens.

For professional *in vitro* diagnostic use only.

Contents:

25 Test Cassettes

1 Positive Control Swab

Package Insert

25 Extraction Buffer Tubes

1 Negative Control Swab

Specimen Collection Guide


LOT COV1080133

2023-04-22

Σ 25

LCA10395-01

IVD



Потребительская упаковка в варианте исполнения 25 шт./уп. (левая сторона) Партия COV1080133 МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носа или носоглотки для диагностики *in vitro* (Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test). Партии COV1080132, COV1080133, COV1090058, COV1090059»

ACON®



ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
No.210 Zhenzhong Road, West Lake District
Hangzhou, P.R.China, 310030


Made in China

Executive Directive:



LCA10394-01

Потребительская упаковка в варианте исполнения 25 шт./уп. (правая сторона) МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носа или носоглотки для диагностики in vitro (Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test). Партии COV1080132, COV1080133, COV1090058, COV1090059»

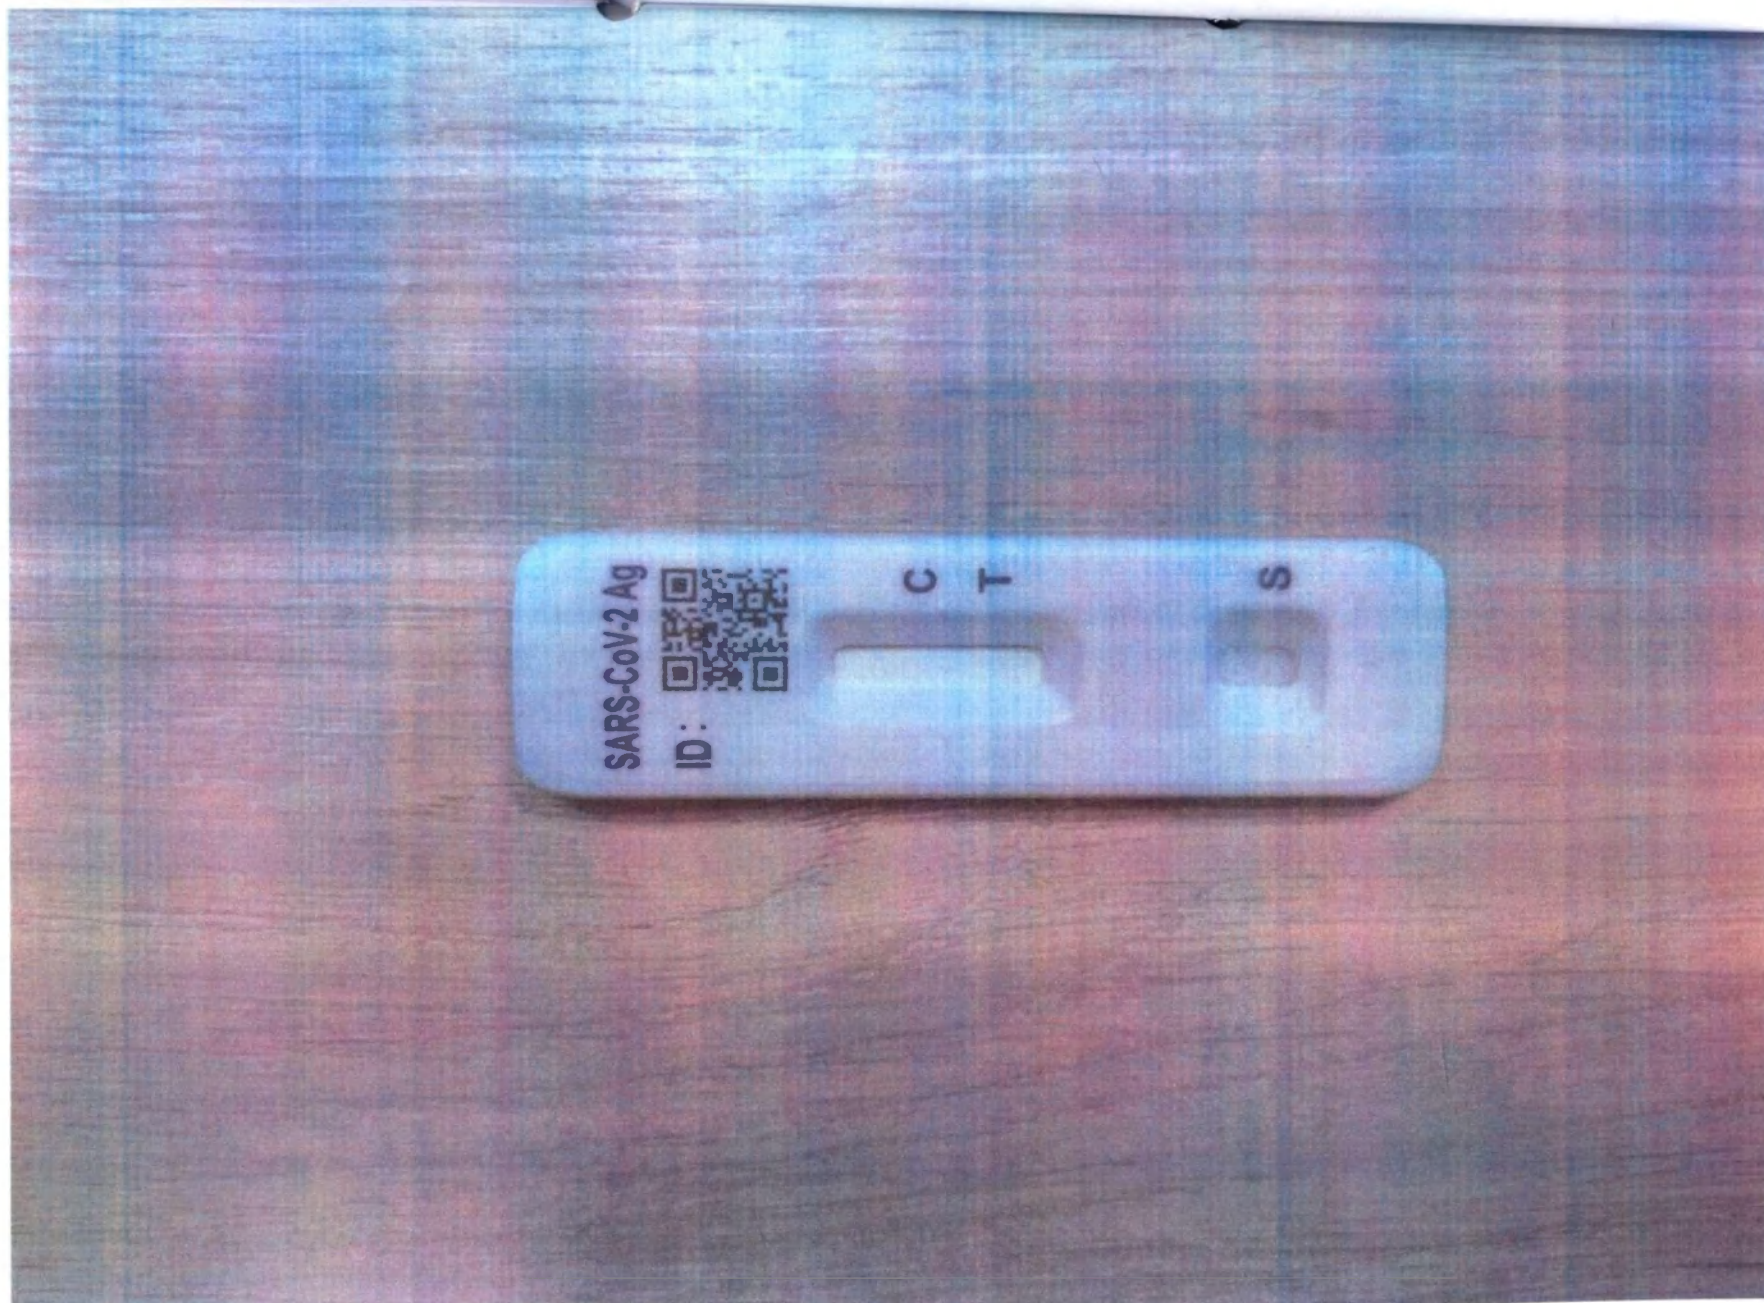

Тест-кассета МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носа или носоглотки для диагностики in vitro (Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test). Партии COV1080132, COV1080133, COV1090058, COV1090059»



 **ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.**
No.210 Zhenzhong Road, West Lake District, Hangzhou, P.R.China, 310030

FLOWFLEX SARS-COV-2 ANTIGEN RAPID TEST

 **COV1080132**  **2023-04-22**  **2021-04-23**

Индивидуальная упаковка тест-кассеты Партия COV1080132 МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носа или носоглотки для диагностики in vitro (Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test). Партии COV1080132, COV1080133, COV1090058, COV1090059»



 **ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.**
No.210 Zhengzhong Road, West Lake District, Hangzhou, P.R.China, 310030

FLOWFLEX SARS-COV-2 ANTIGEN RAPID TEST

 **COV1080133**  **2023-04-22**  **2021-04-23**

Индивидуальная упаковка тест-кассеты Партия COV1080133 МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носа или носоглотки для диагностики in vitro (Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test). Партии COV1080132, COV1080133, COV1090058, COV1090059»



ACOW Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
No.210 Zhenzhong Road, West Lake District, Hangzhou, P.R.China, 310030

FLOWFLEX SARS-COV-2 ANTIGEN RAPID TEST

LOT COV1090058  2023-04-22  2021-04-23

Индивидуальная упаковка тест-кассеты Партия COV1090058 МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носа или носоглотки для диагностики in vitro (Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test). Партии COV1080132, COV1080133, COV1090058, COV1090059»




 **ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.**
No.210 Zhengzhong Road, West Lake District, Hangzhou, P.R.China, 310030


FLOWFLEX SARS-COV-2 ANTIGEN RAPID TEST

LOT COV1090059  **2023-04-22**  **2021-04-23**


Индивидуальная упаковка тест-кассеты Партия COV1090059 МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носа или носоглотки для диагностики in vitro (Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test). Партии COV1080132, COV1080133, COV1090058, COV1090059»

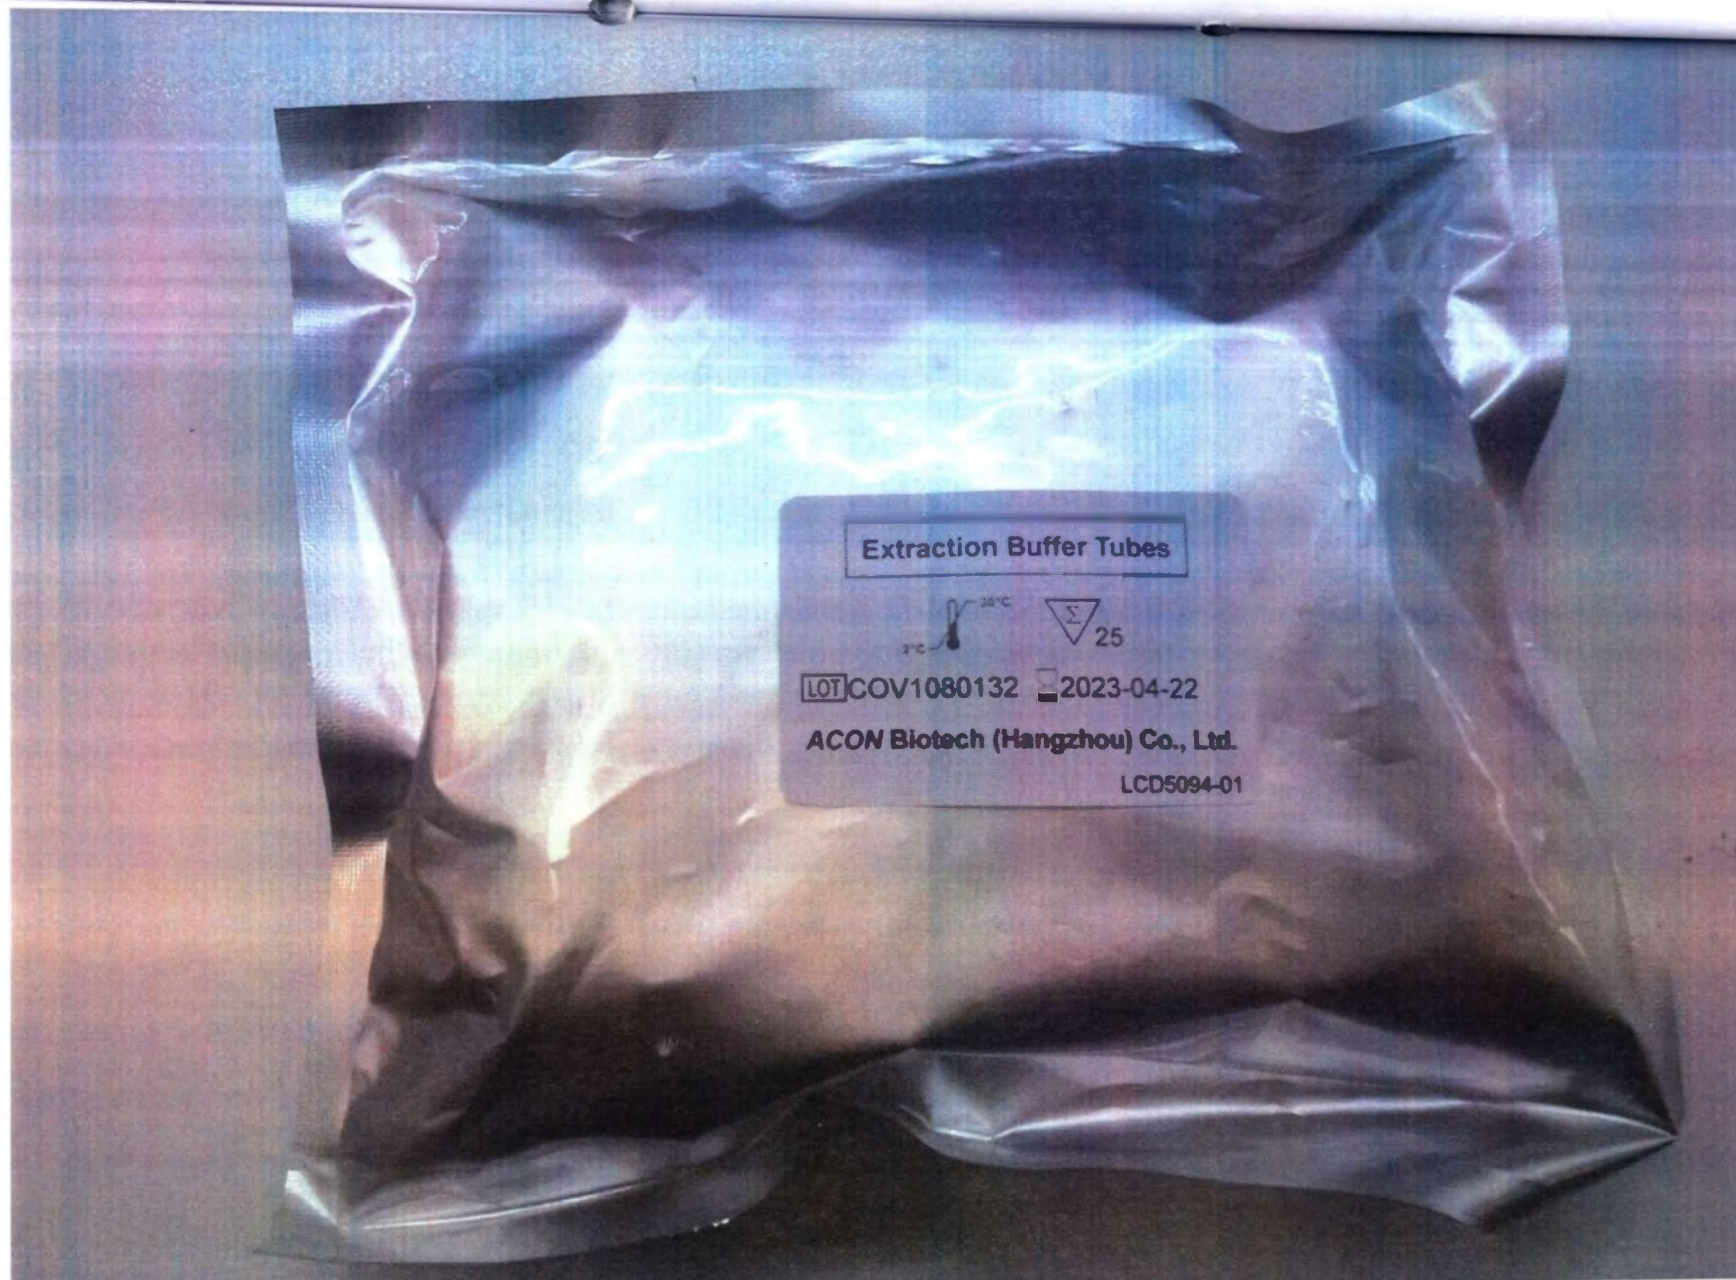


Упаковка Буфера для экстрагирования в варианте исполнения 25 шт./уп. Партия COV1080132 МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носа или носоглотки для диагностики in vitro (Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test). Партии COV1080132, COV1080133, COV1090058, COV1090059»

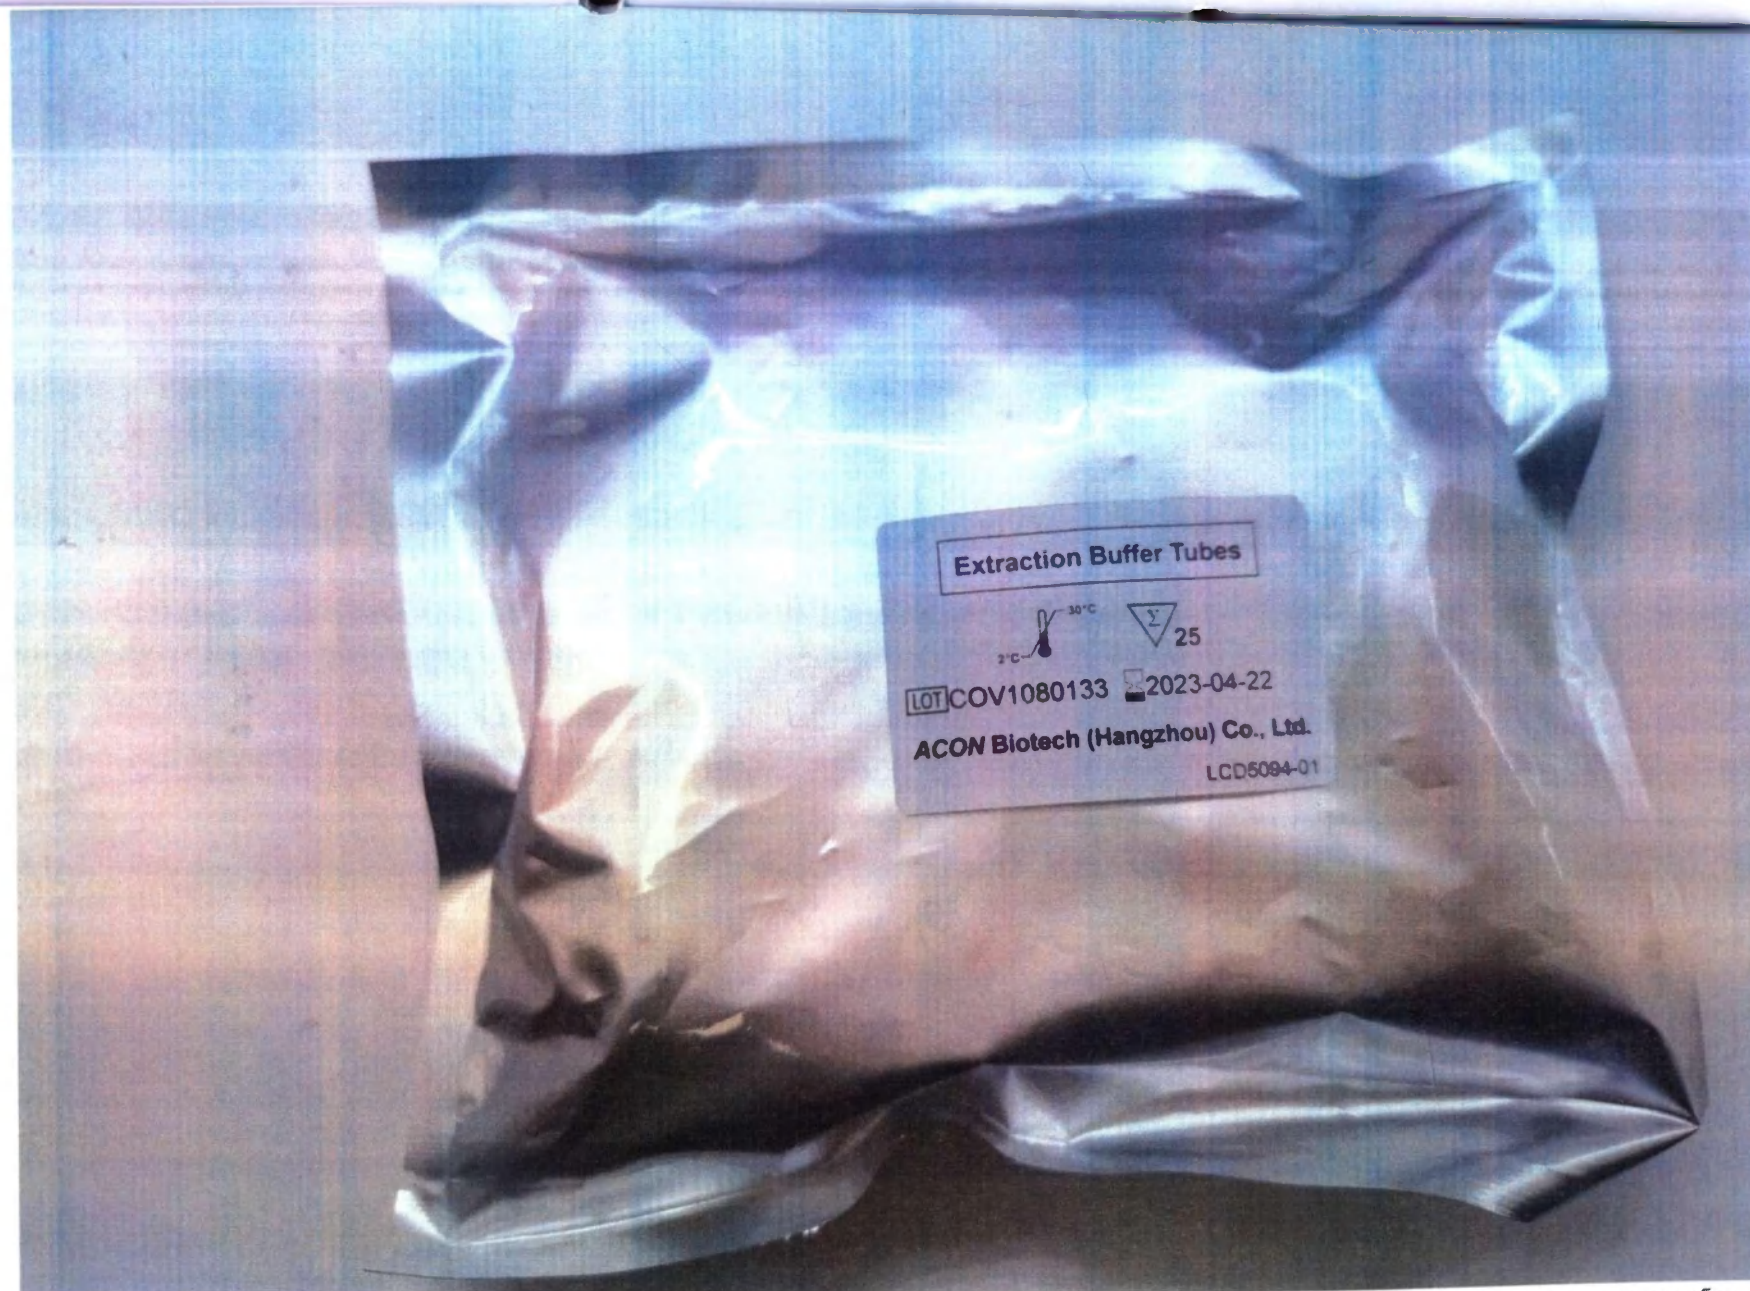


Упаковка Буфера для экстрагирования в варианте исполнения 25 шт./уп. Партия COV1080133 МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носа или носоглотки для диагностики in vitro (Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test). Партии COV1080132, COV1080133, COV1090058, COV1090059»

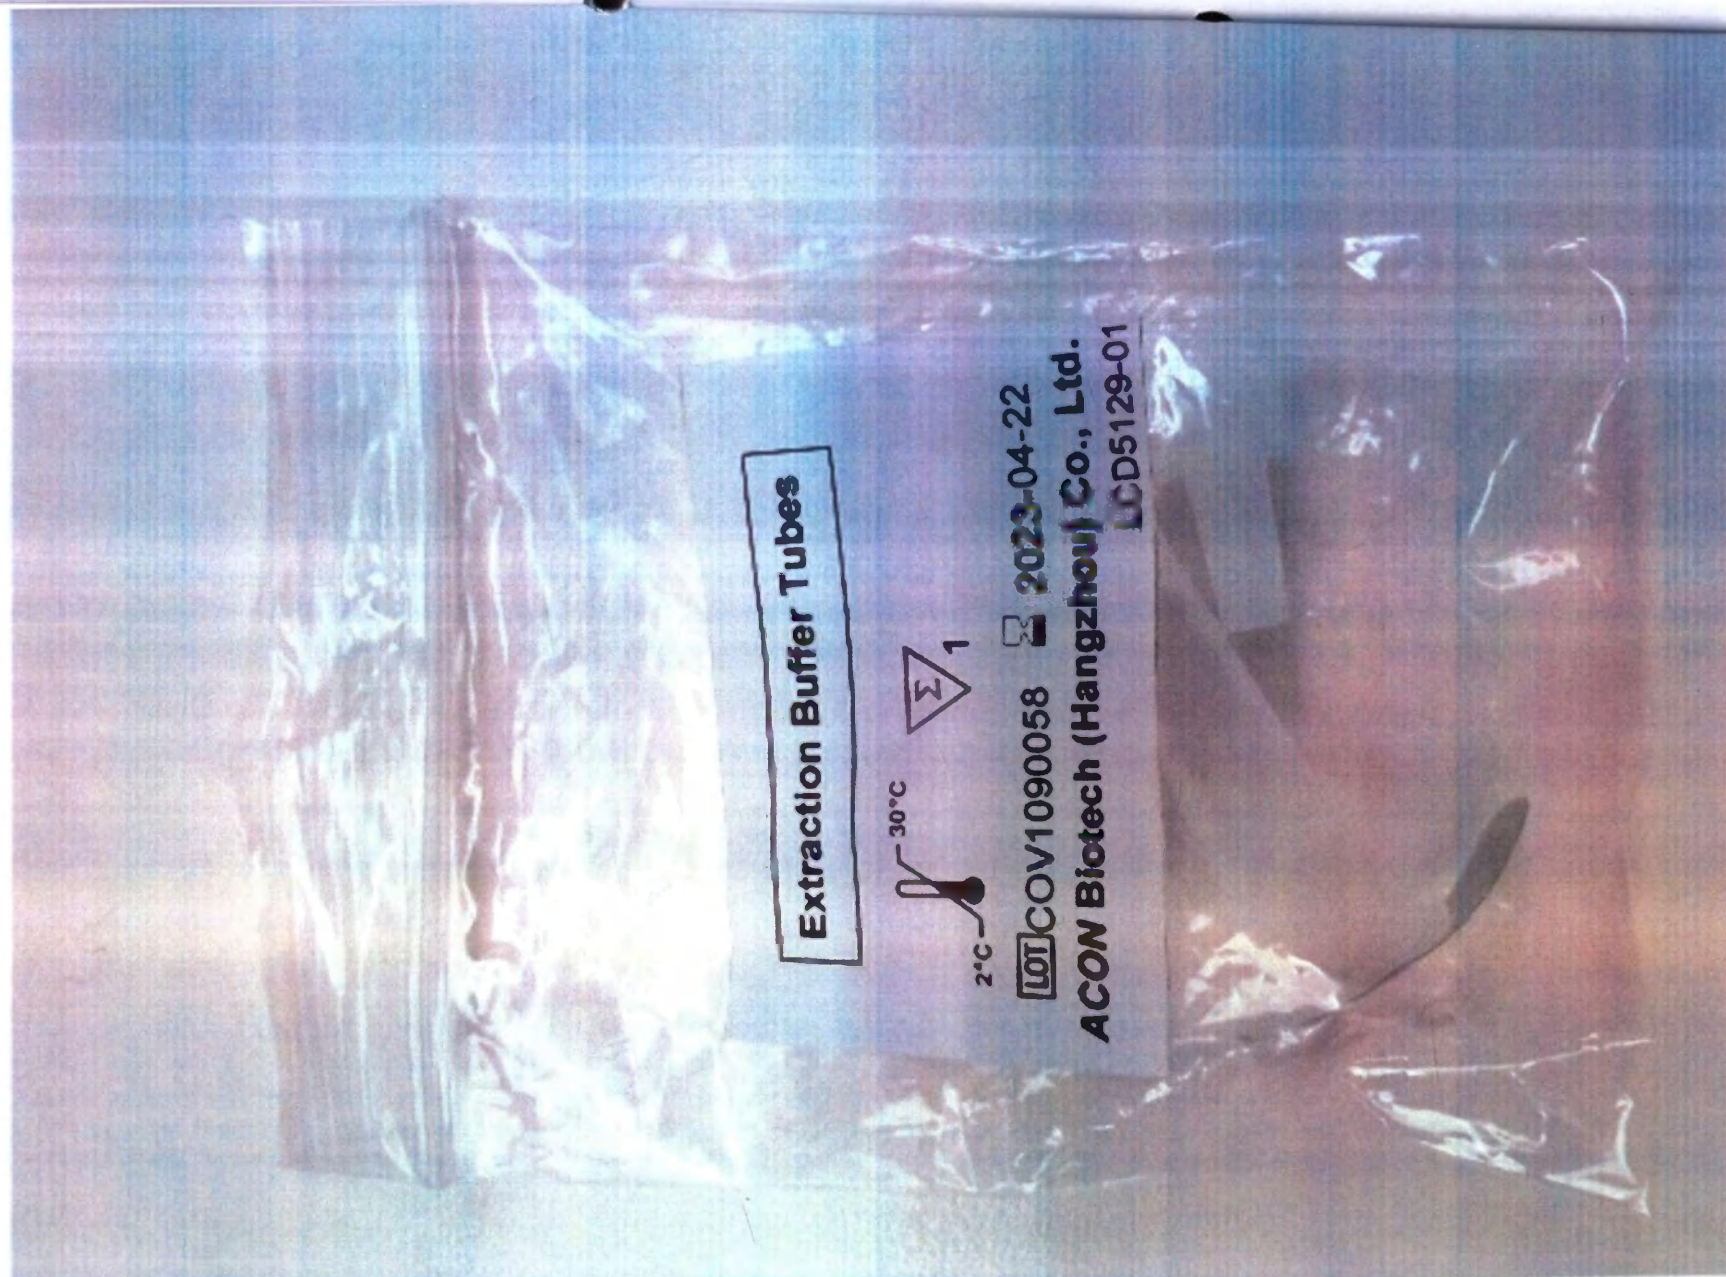


Упаковка Буфера для экстрагирования в варианте исполнения 1 шт./уп. Партия COV1090058 МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носа или носоглотки для диагностики in vitro (Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test). Партии COV1080132, COV1080133, COV1090058, COV1090059»

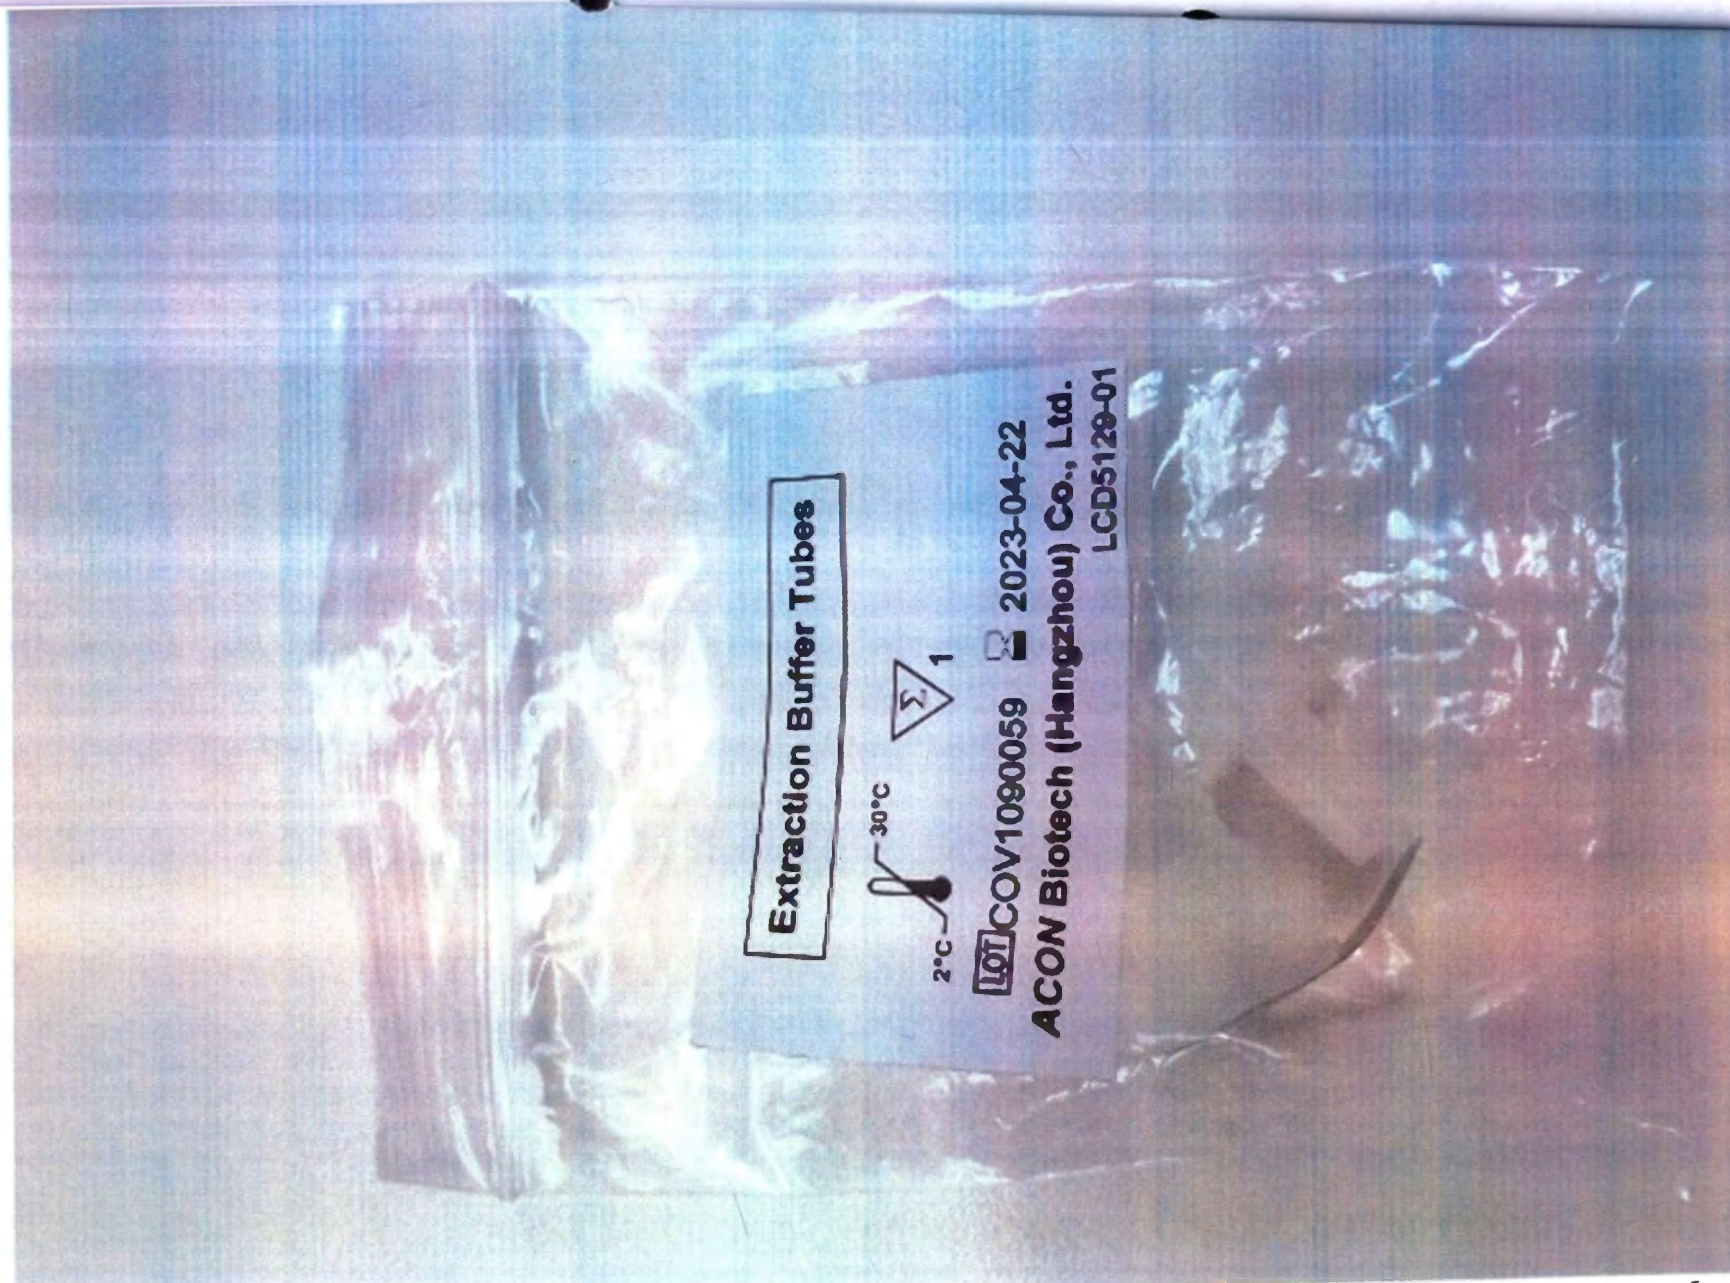

Упаковка Буфера для экстрагирования в варианте исполнения 1 шт./уп. Партия COV1090059 МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носа или носоглотки для диагностики in vitro (Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test). Партии COV1080132, COV1080133, COV1090058, COV1090059»

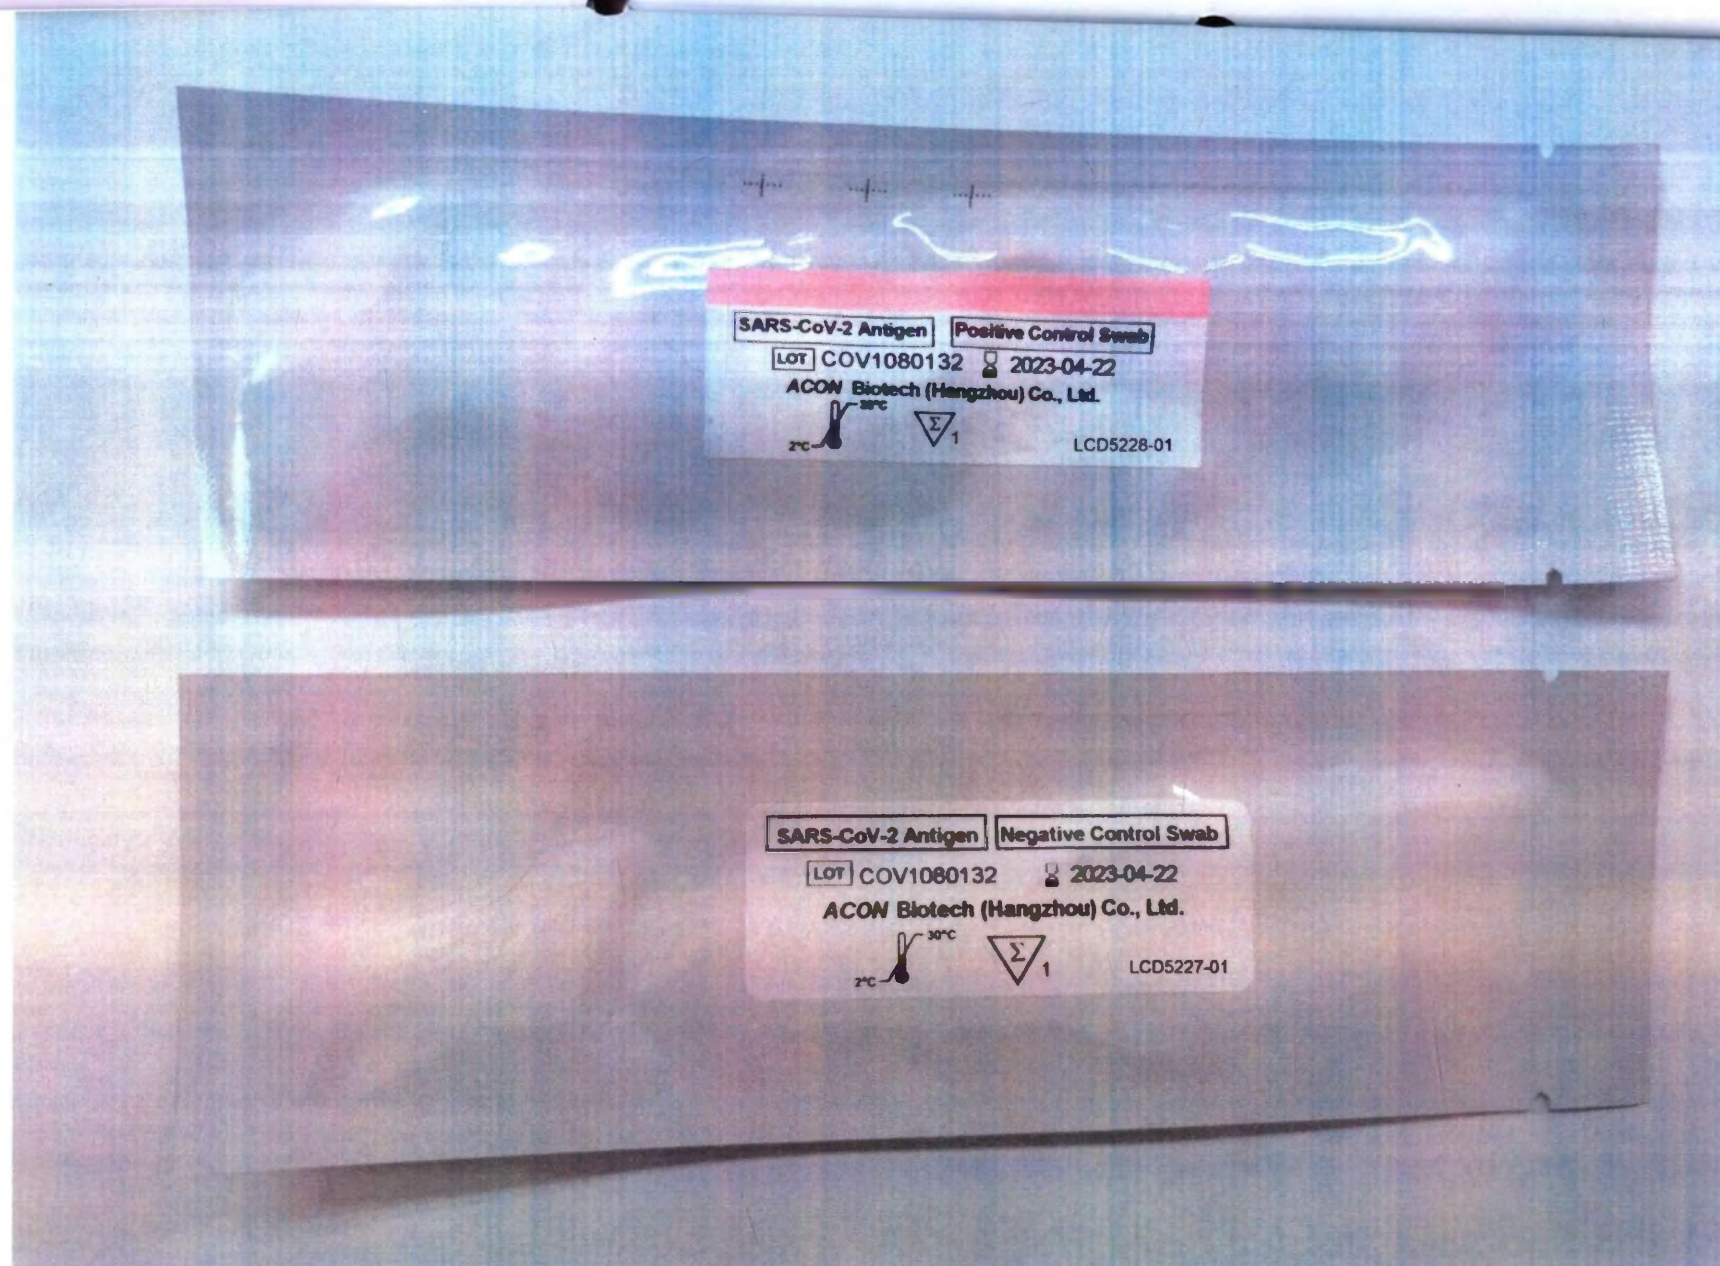

Зонды контрольные в варианте исполнения 25 шт./уп. Партия COV1080132 МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носа или носоглотки для диагностики in vitro (Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test). Партии COV1080132, COV1080133, COV1090058, COV1090059»

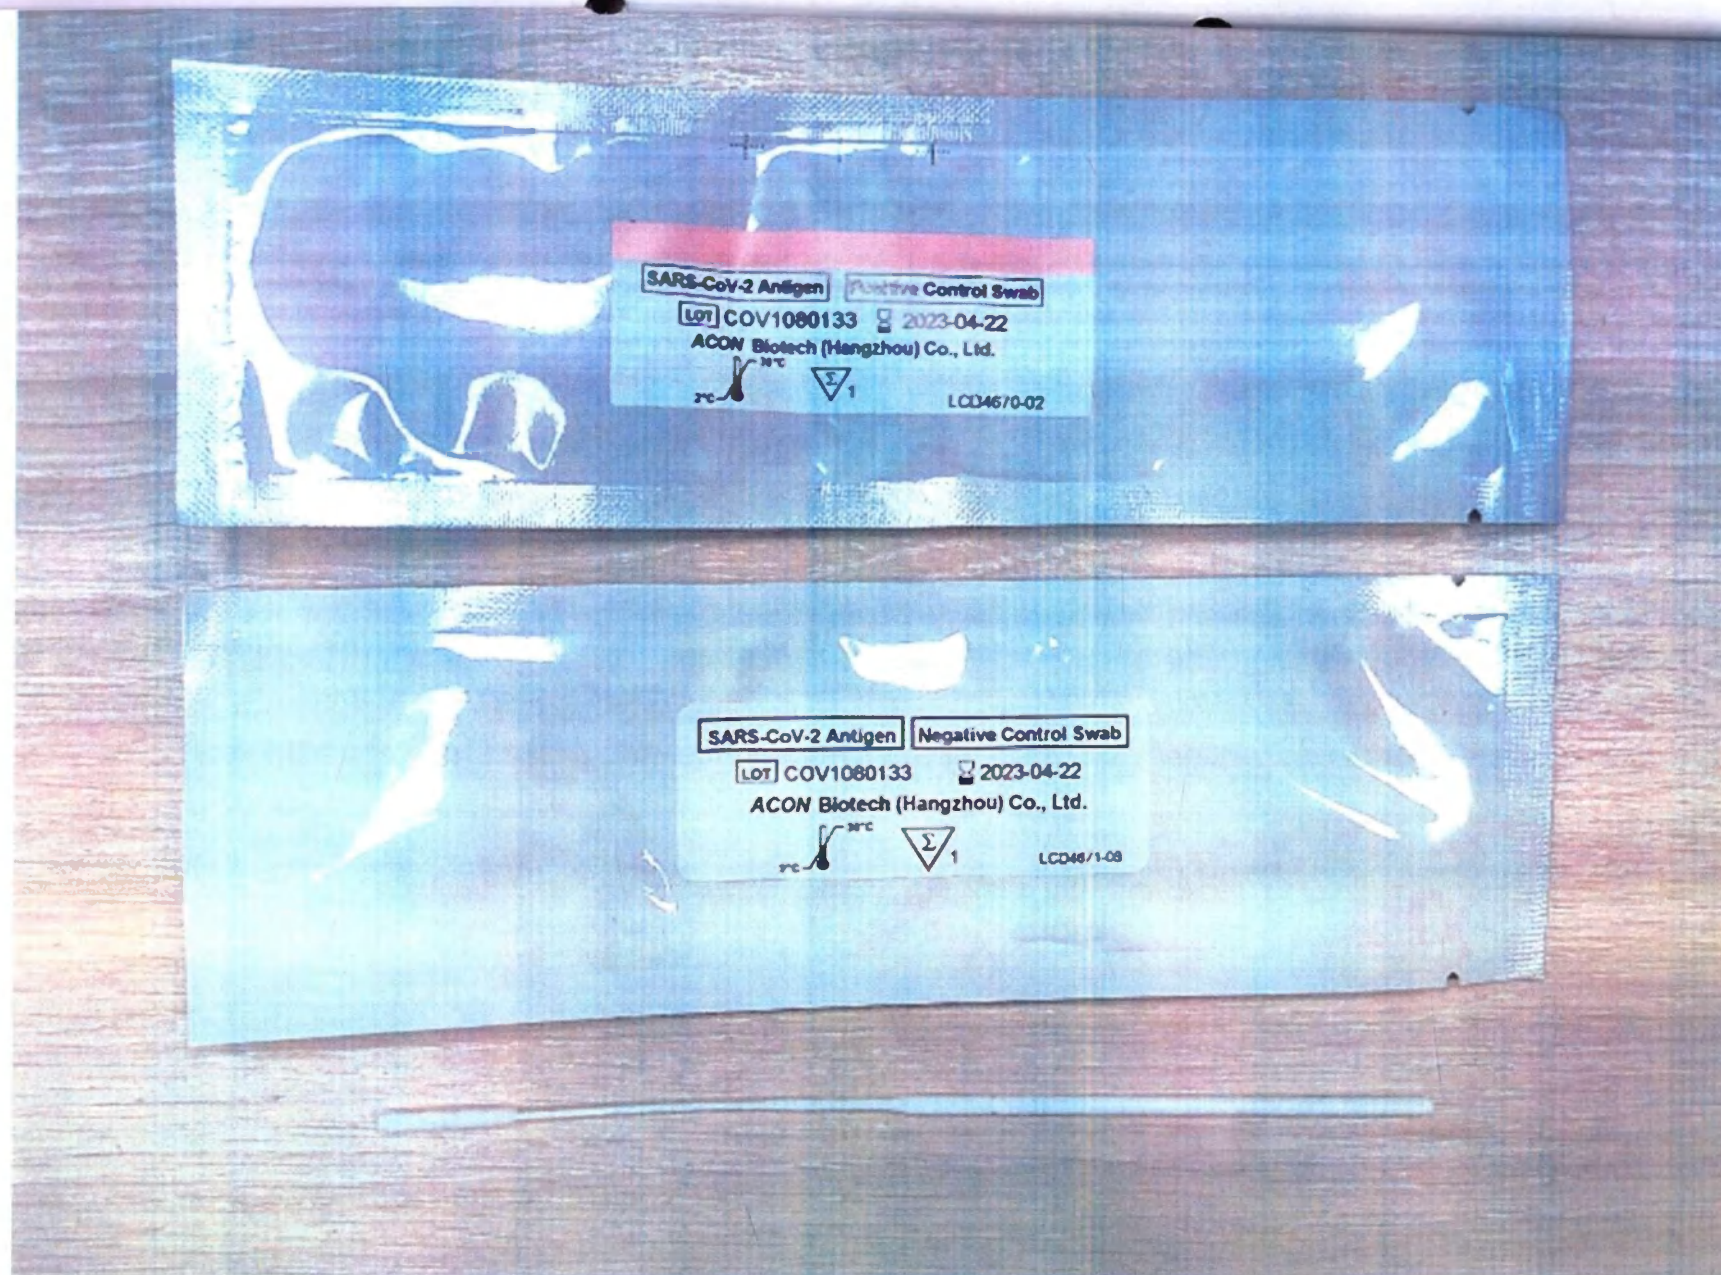

Зонды контрольные в варианте исполнения 25 шт./уп. Партия COV1080133 МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носа или носоглотки для диагностики in vitro (Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test). Партии COV1080132, COV1080133, COV1090058, COV1090059»



ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
No. 210 Zhongyuan Road, West Lake District, Hangzhou, P.R. China, 310030



Общий вид МИ в варианте исполнения 1 шт./уп. «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носа или носоглотки для диагностики in vitro (Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test). Партии COV1080132, COV1080133, COV1090058, COV1090059»



Потребительская упаковка в варианте исполнения 1 шт./уп. (вид спереди) МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носа или носоглотки для диагностики in vitro (Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test). Партии COV1080132, COV1080133, COV1090058, COV1090059»

FlowflexTM

REF L031-11845

1 Test

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test

Contents:

- 1 Test Cassette
- 1 Extraction Buffer Tube
- Package Insert


COVID-19 Test

A rapid test for the qualitative detection of SARS-CoV-2 nucleocapsid antigens in nasal and nasopharyngeal swab specimens.

For professional *in vitro* diagnostic use only.



Потребительская упаковка в варианте исполнения 1 шт./уп. (вид сверху) МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носа или носоглотки для диагностики *in vitro* (Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test). Партии COV1080132, COV1080133, COV1090058, COV1090059»

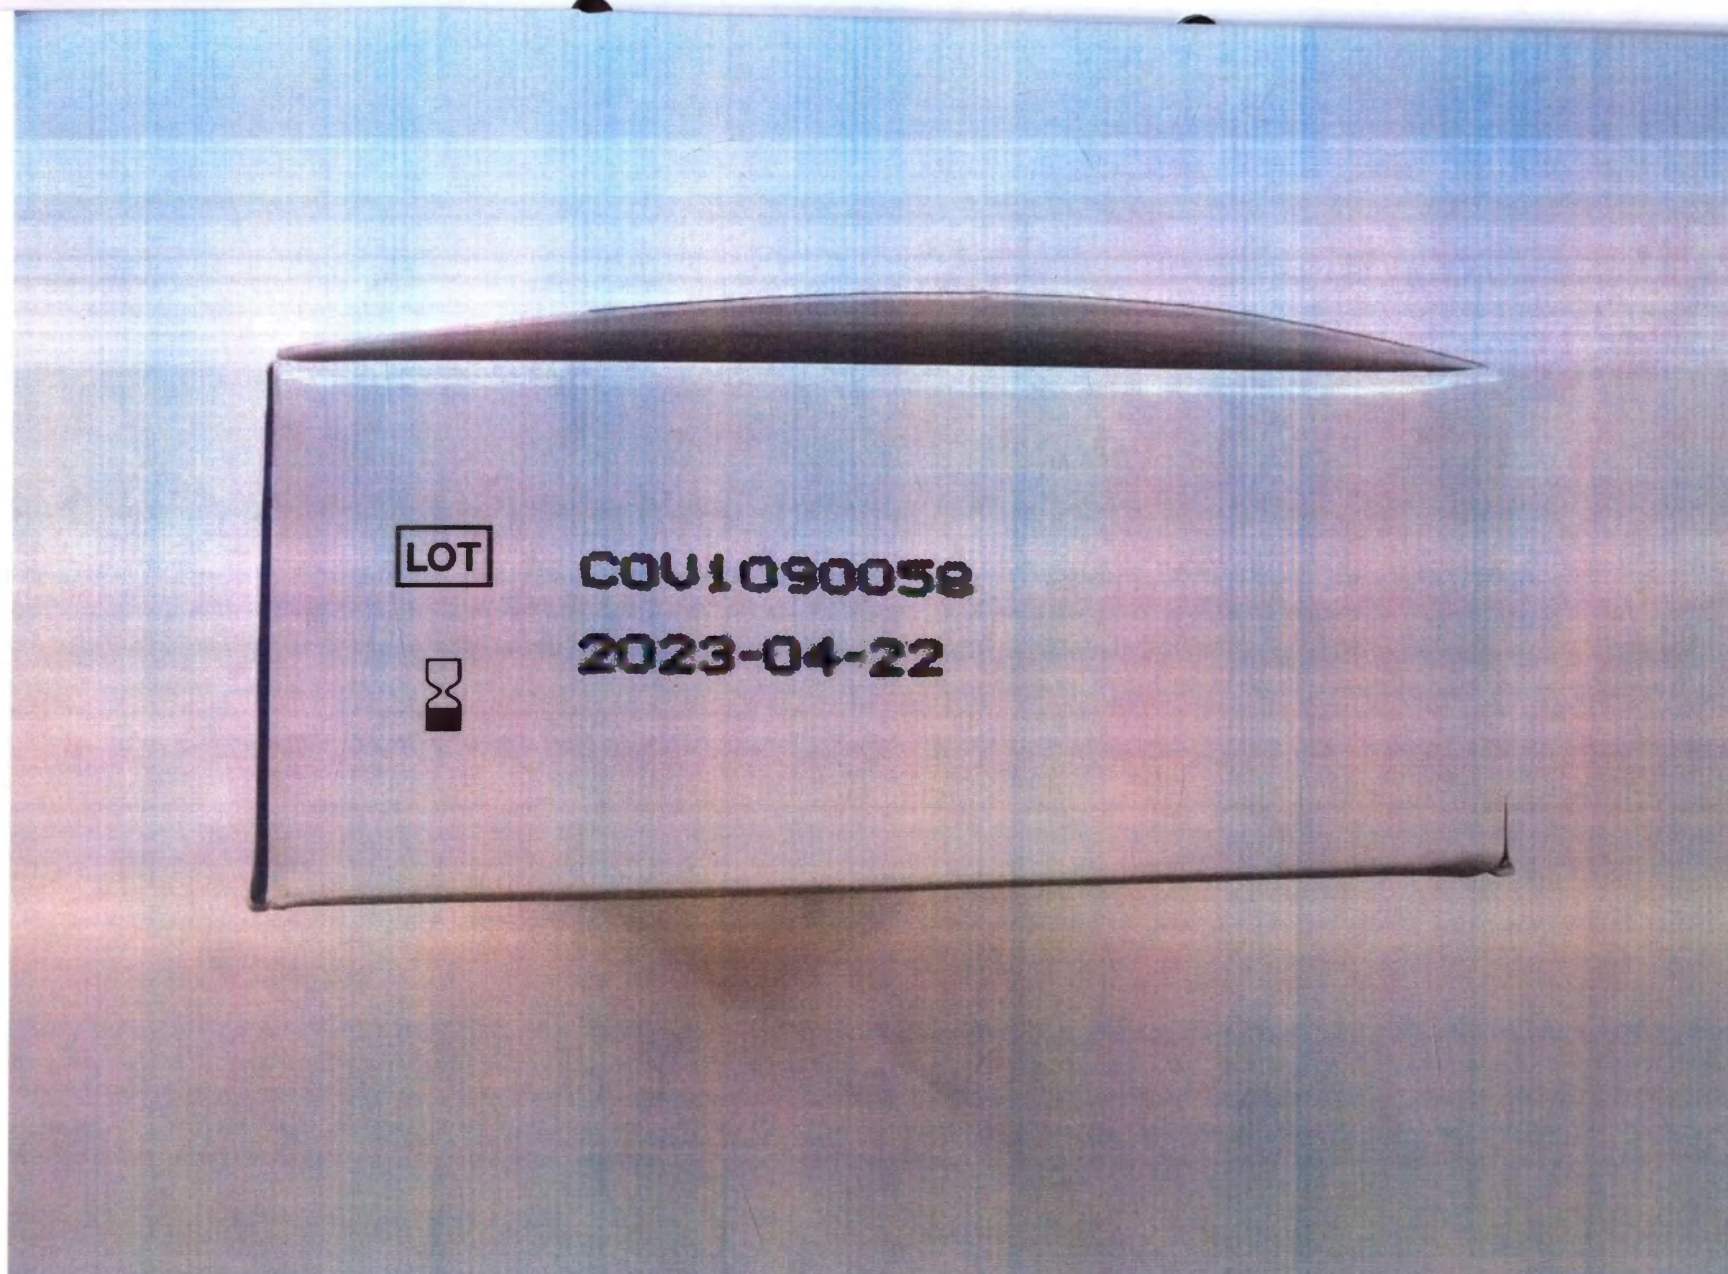

Потребительская упаковка в варианте исполнения 1 шт./уп. (правая сторона) Партия COV1090058 МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носа или носоглотки для диагностики in vitro (Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test). Партии COV1080132, COV1080133, COV1090058, COV1090059»


LOT

COV1090059



2023-04-22

Потребительская упаковка в варианте исполнения 1 шт./уп. (правая сторона)) Партия COV1090059 МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носа или носоглотки для диагностики in vitro (Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test). Партии COV1080132, COV1080133, COV1090058, COV1090059»

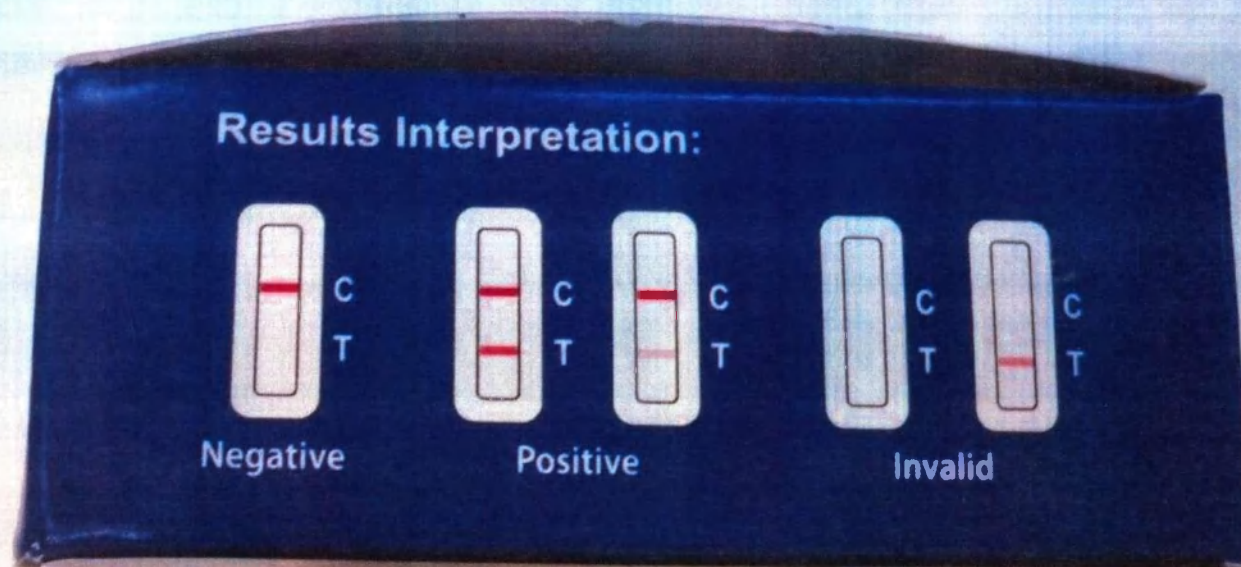

Потребительская упаковка в варианте исполнения 1 шт./уп. (левая сторона) МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из носа или носоглотки для диагностики in vitro (Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test). Партии COV1080132, COV1080133, COV1090058, COV1090059»

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 24 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А.
М.П.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789

КУСАЙЛО Р.В.