





Общий вид медицинского изделия во внешней (потребительской) упаковке



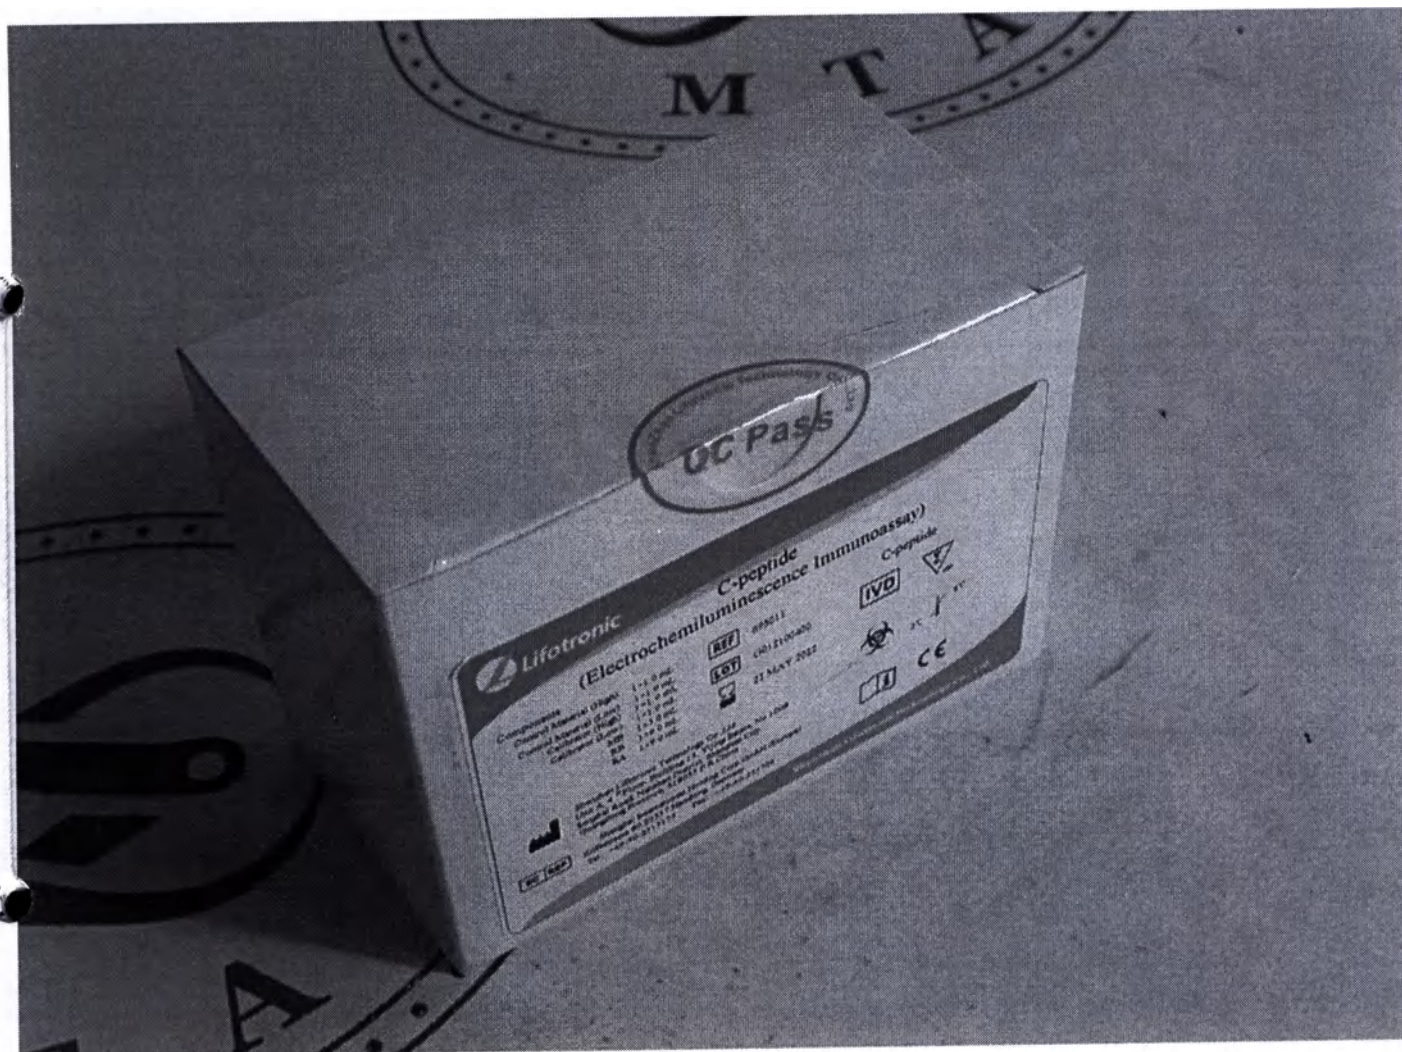


Открытая потребительская упаковка с медицинским изделием.

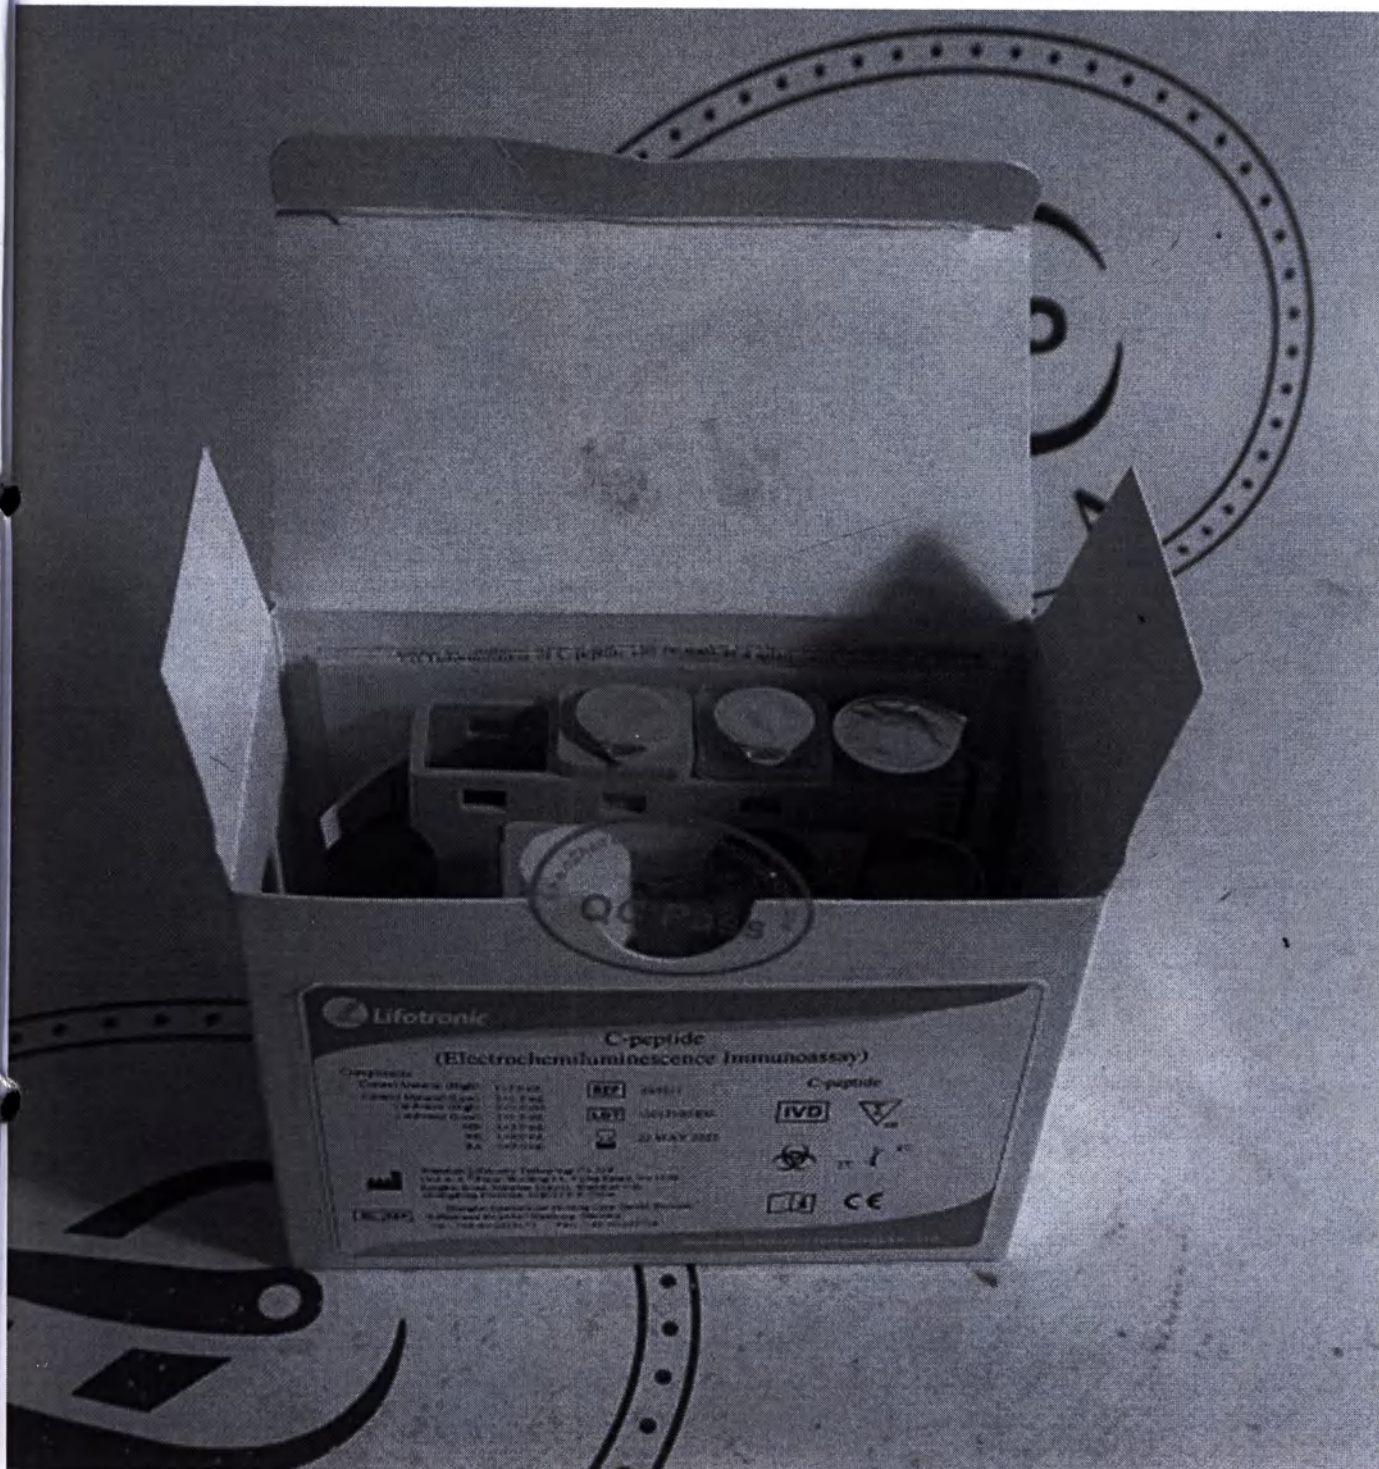




Компоненты медицинского изделия

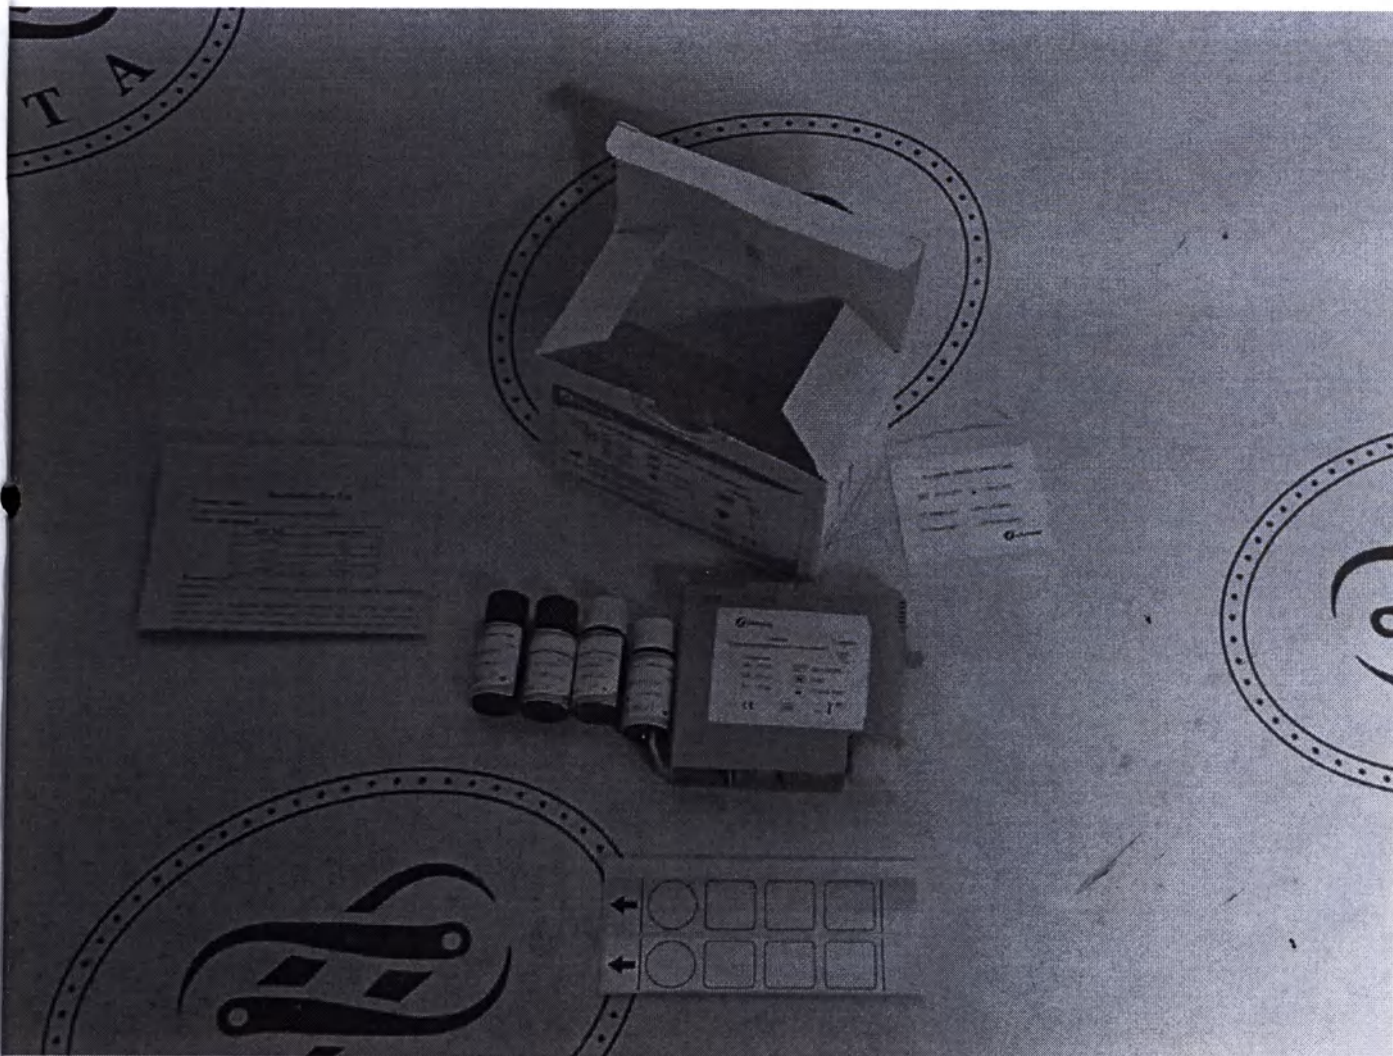



Кассета с реагентами

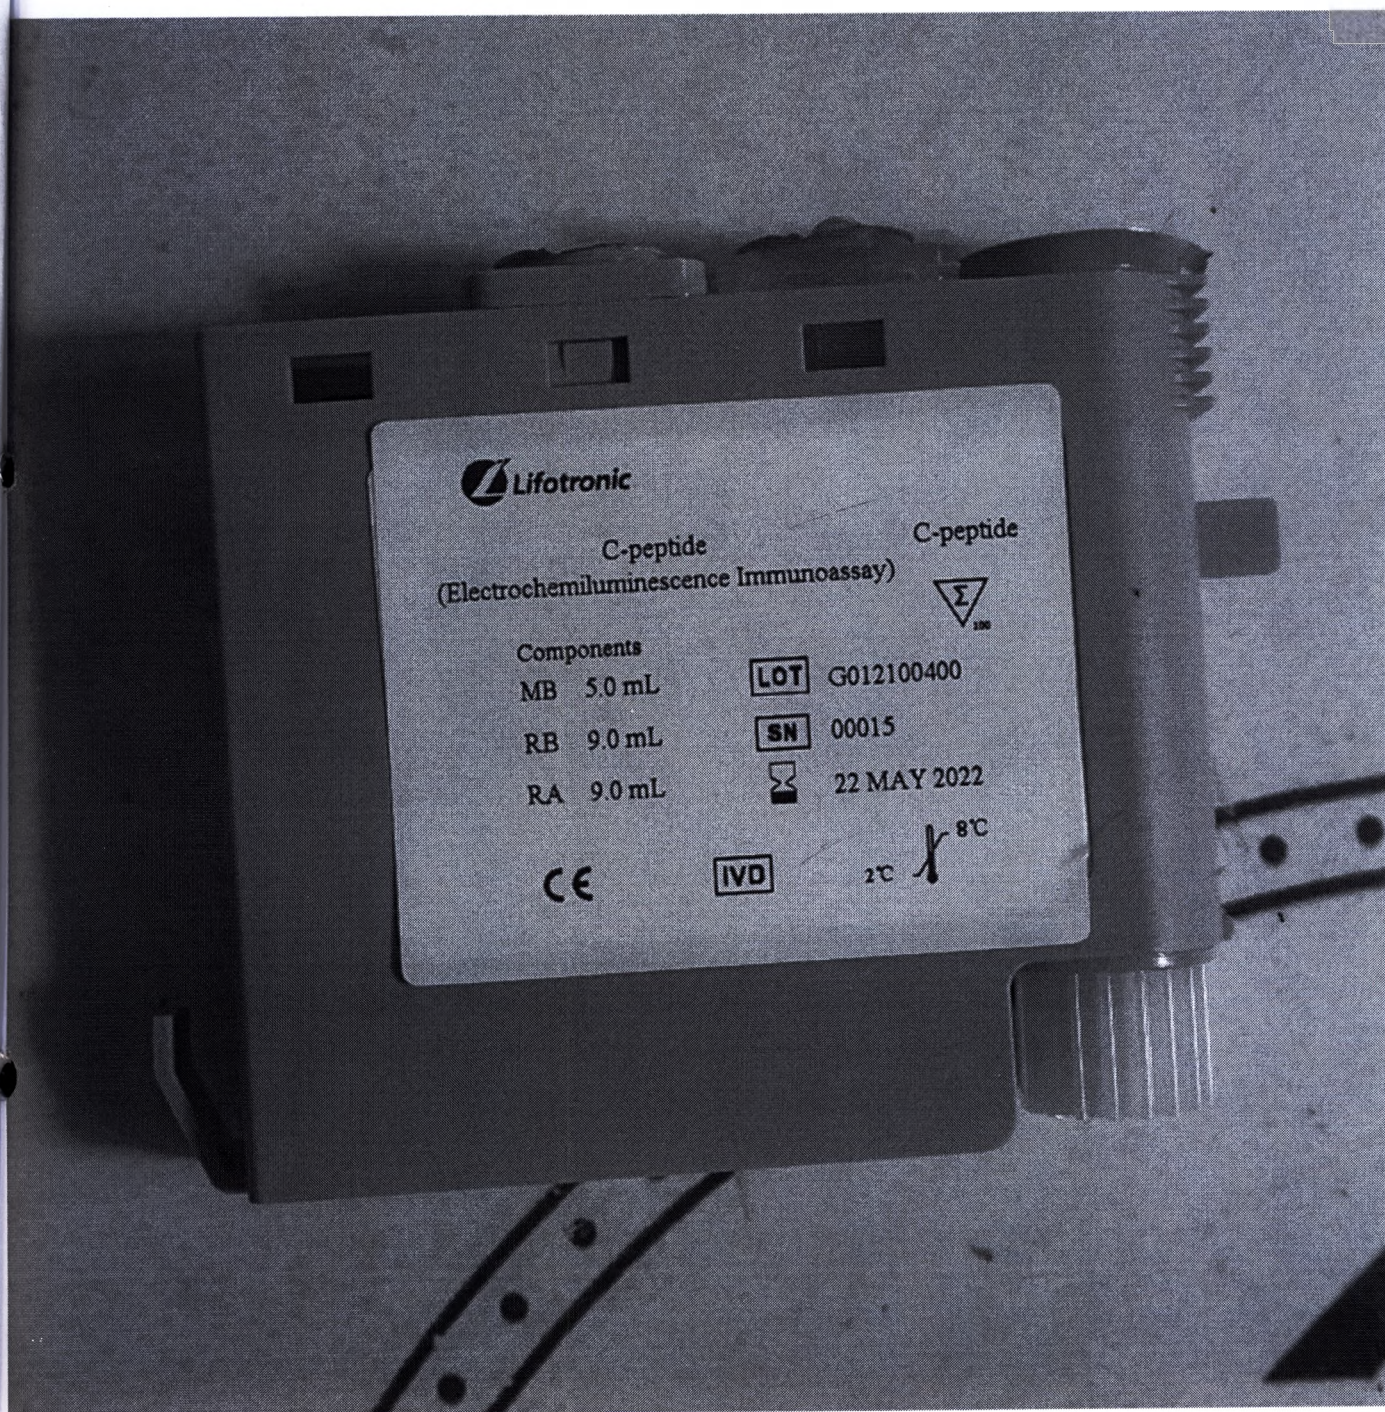




Калибратор (низкий уровень). Маркировка.





Калибратор (низкий уровень). Маркировка.

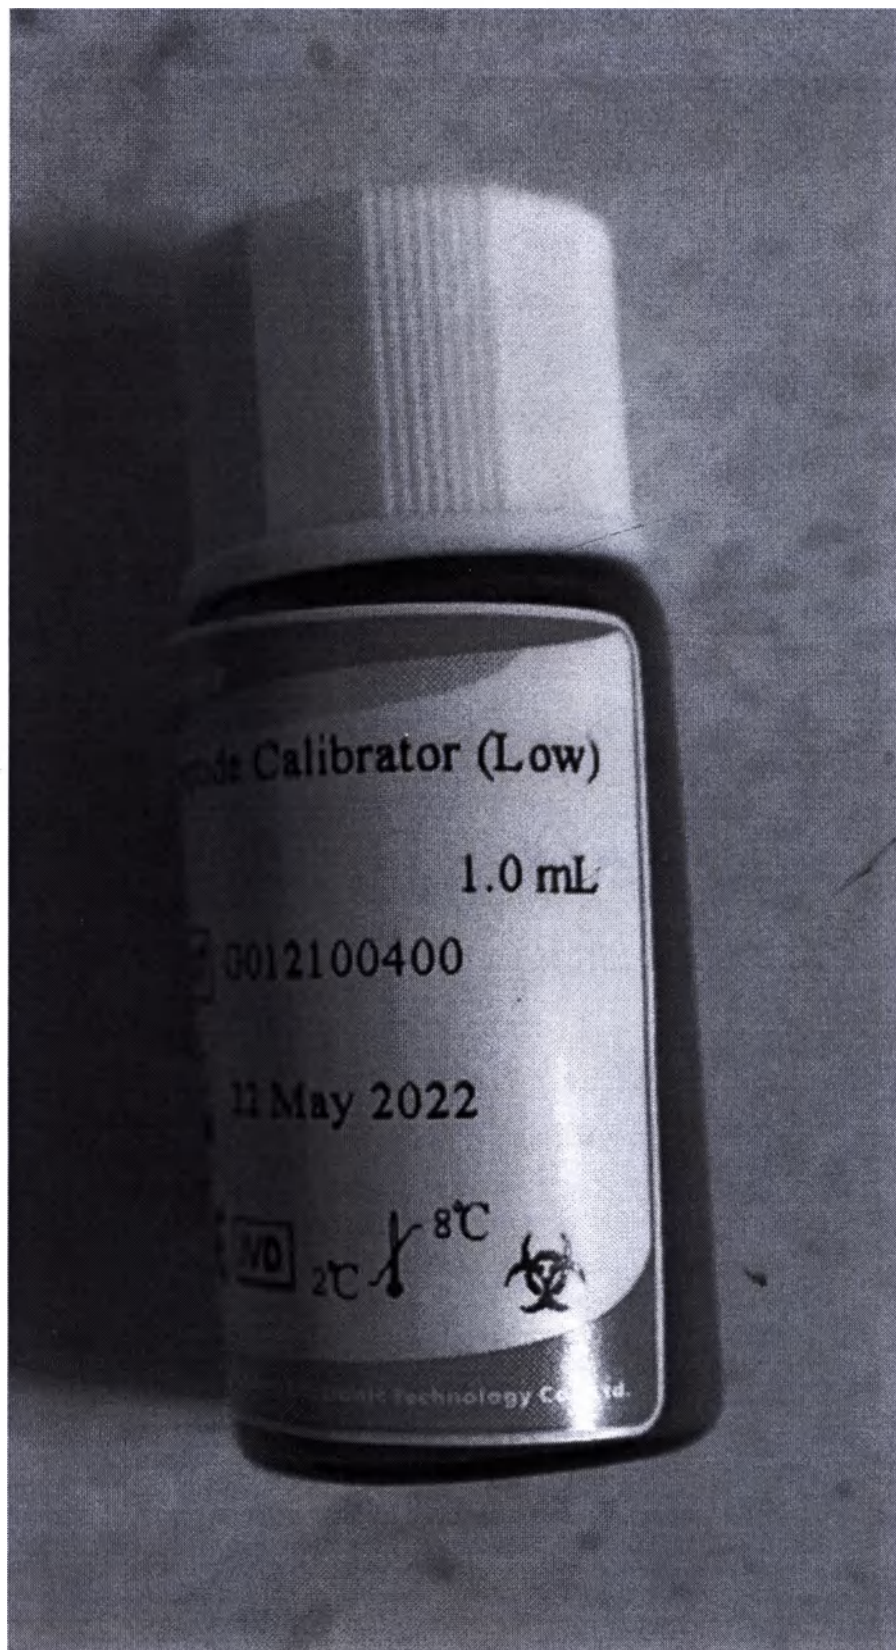




Калибратор (высокий уровень). Маркировка.





Калибратор (высокий уровень). Маркировка.

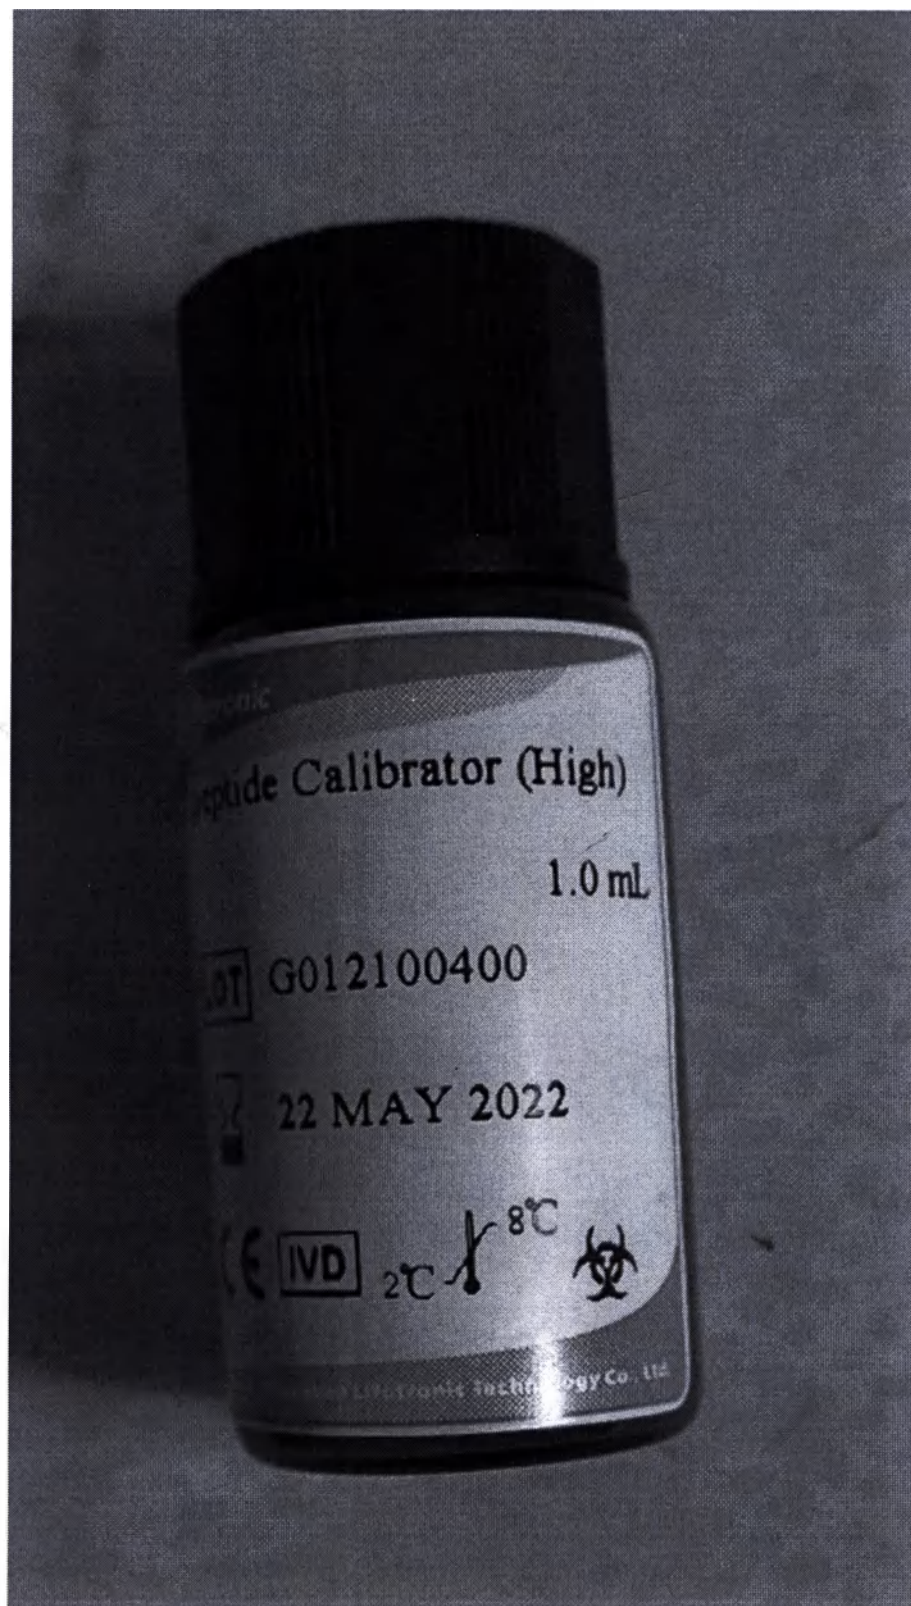



Материал контрольный (высокий уровень). Маркировка.






Материал контрольный (высокий уровень). Маркировка.






Материал контрольный (низкий уровень). Маркировка.

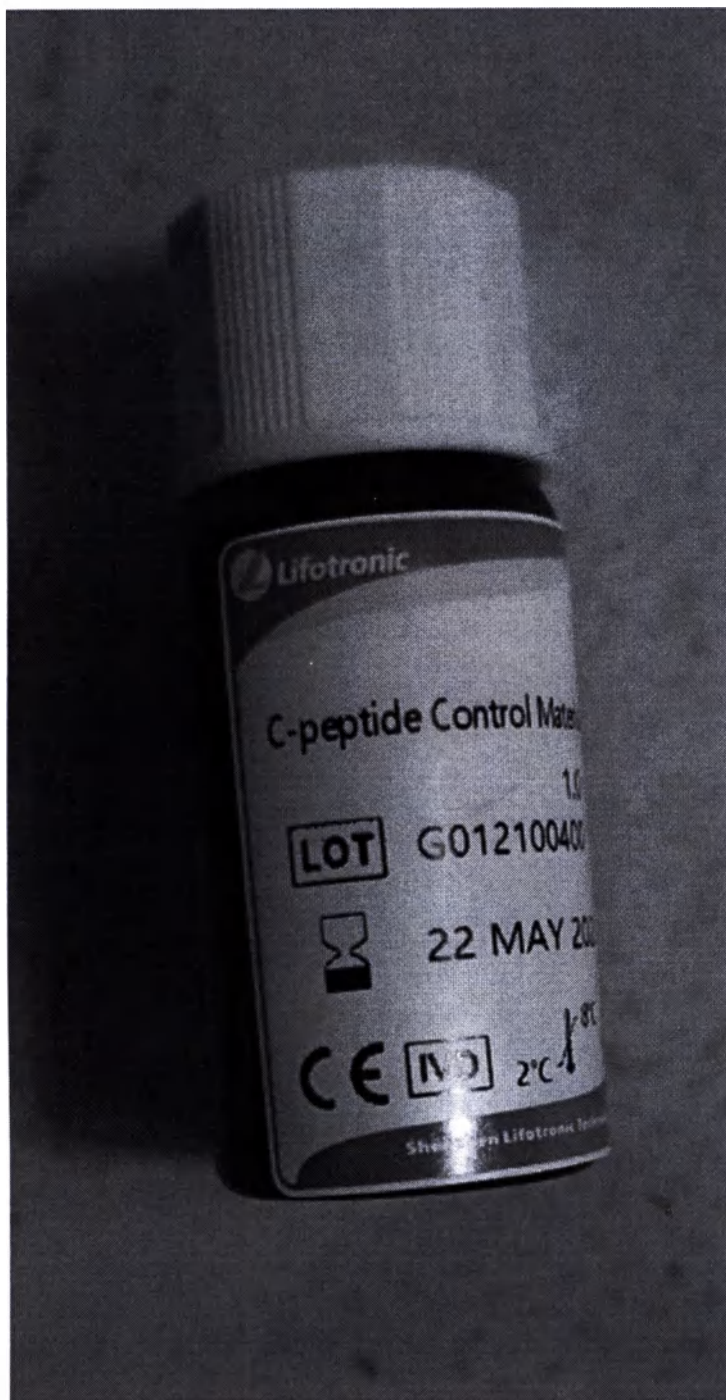




Материал контрольный (низкий уровень). Маркировка.

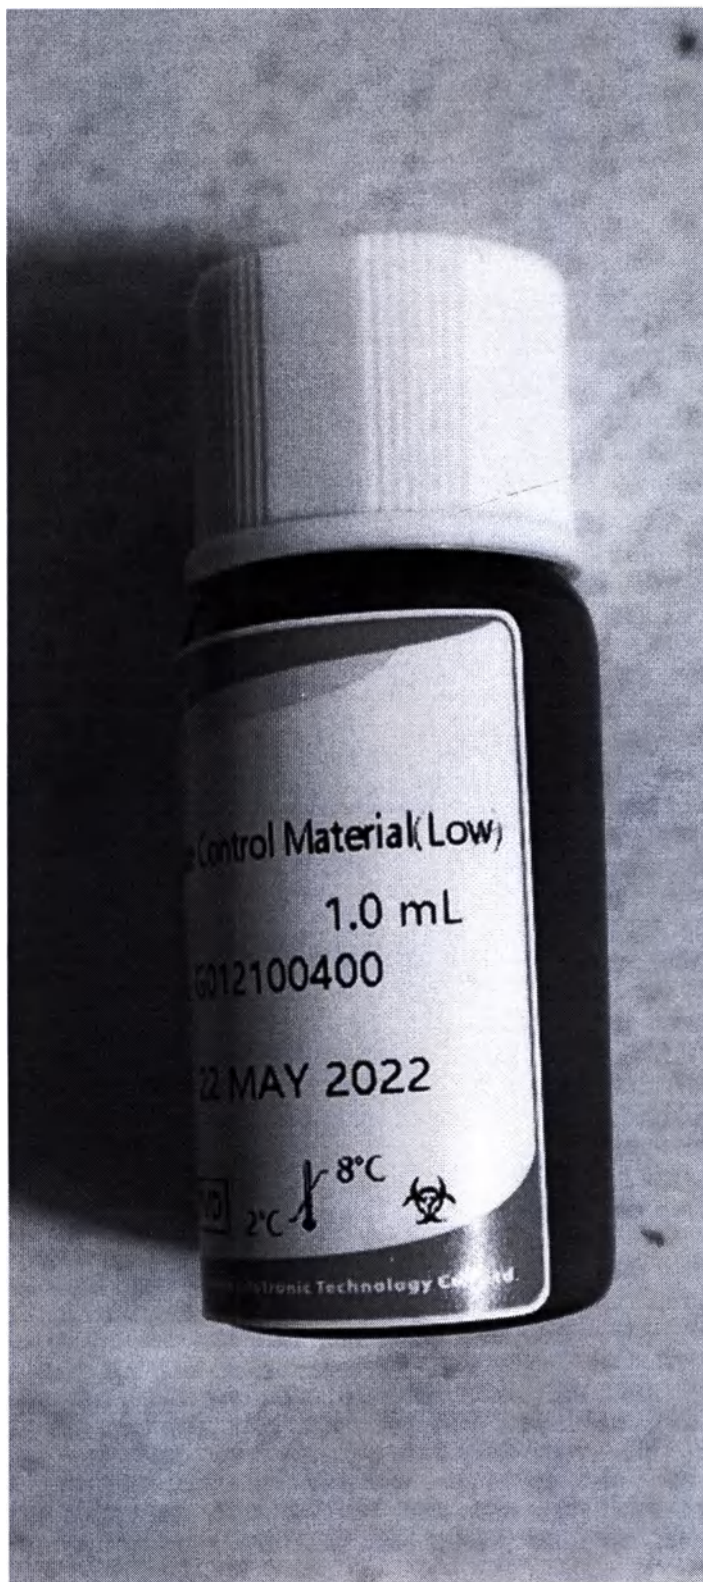




Этикетки для запечатывания флаконов

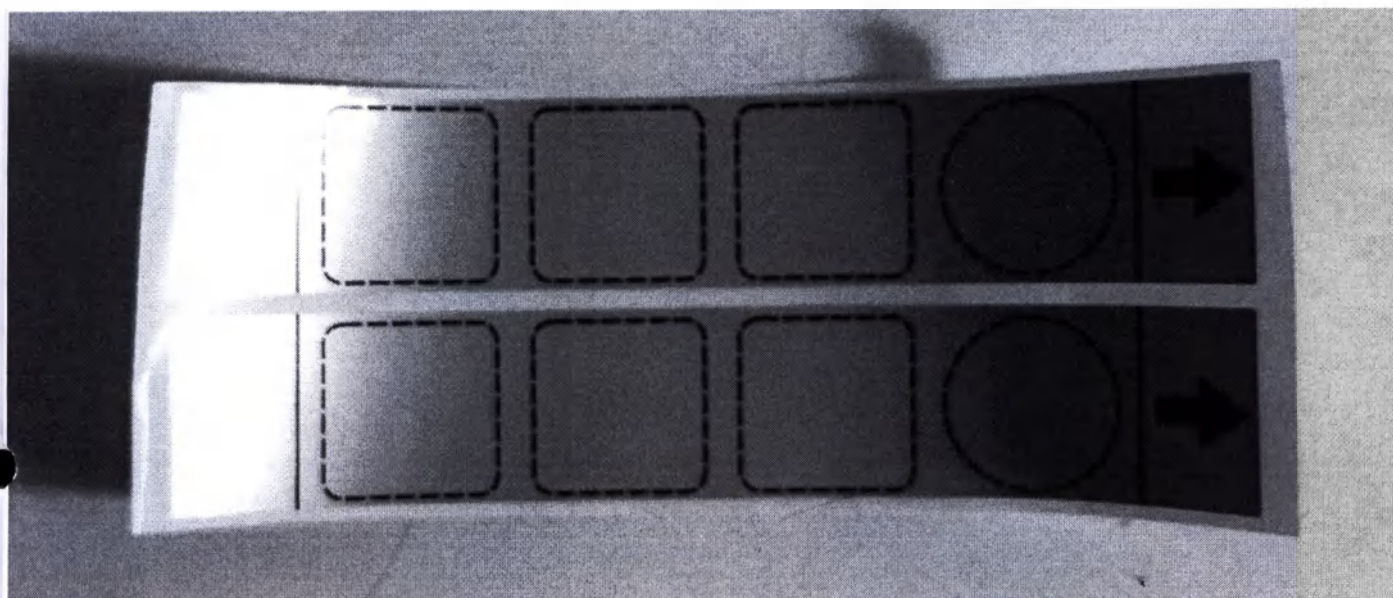



Этикетка результатов значений материалов контрольных

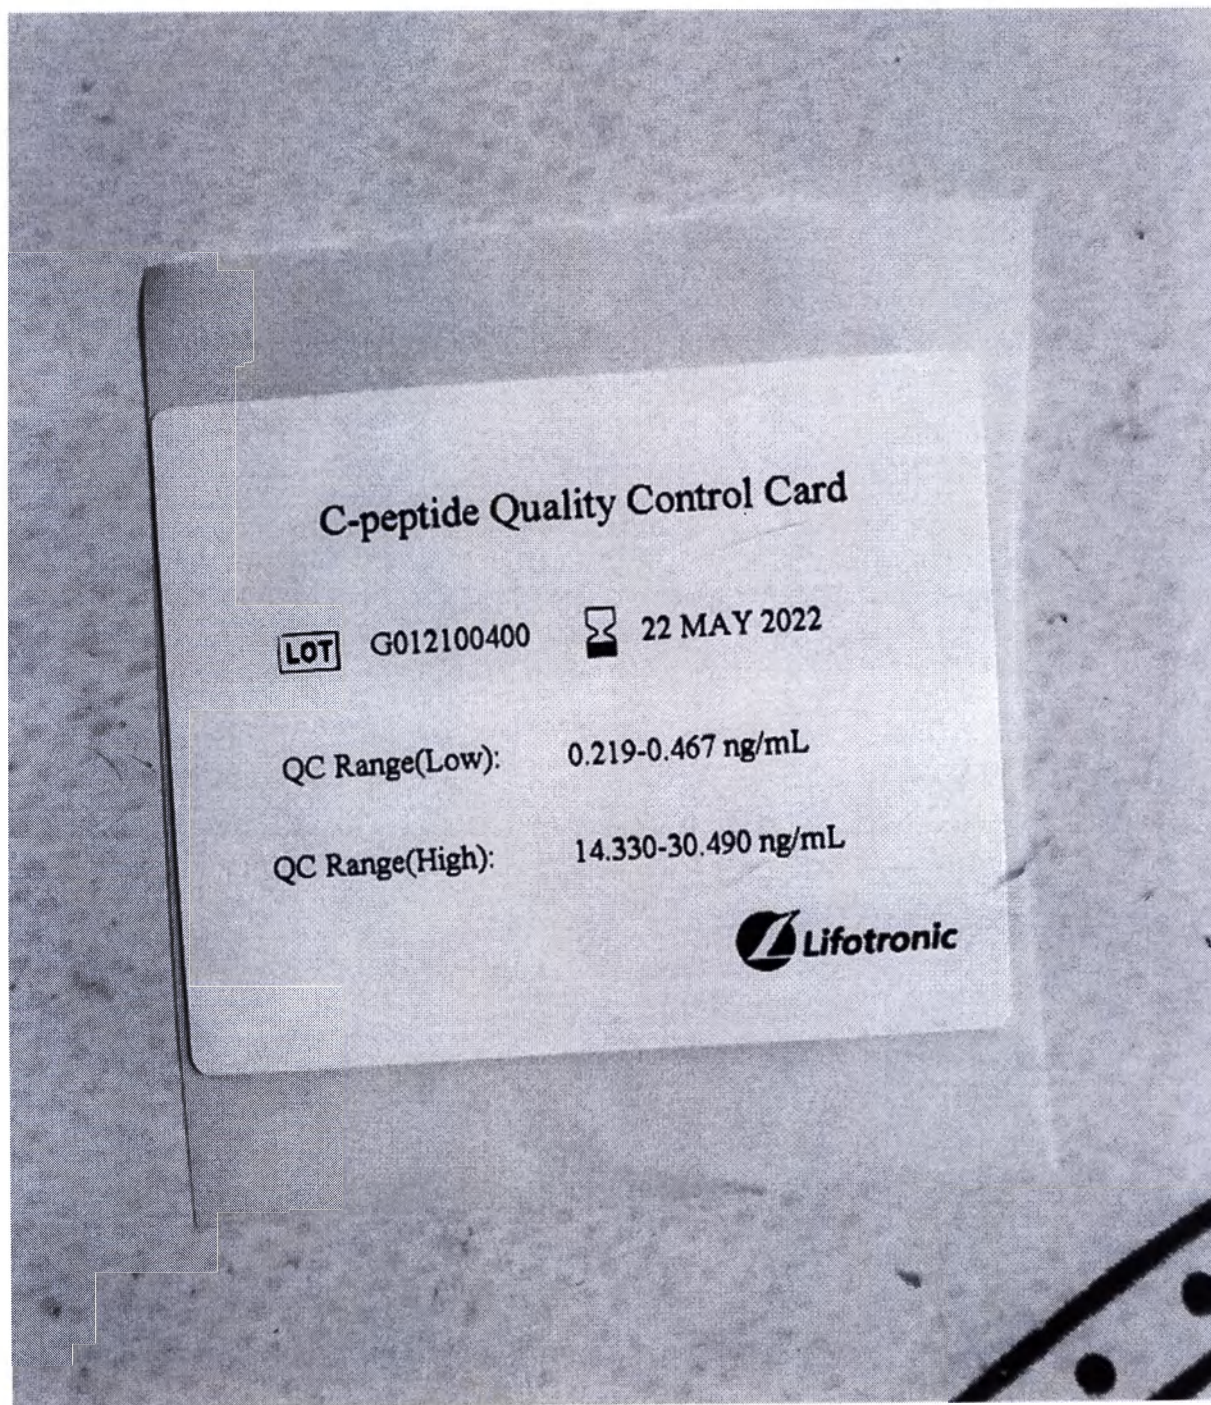

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 15

Менеджер) листов



Менеджер ООО «МТА»

С.В. Страшко

С.В. Страшко




УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

«27» декабря 2021 г.


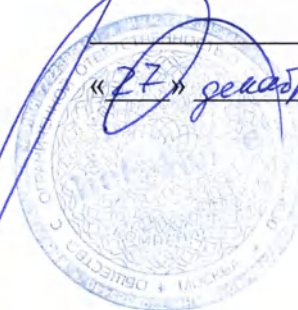


ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАЙЛО Р.В.


Фотографические изображения изделия:


**Набор реагентов для количественного определения С-пептида
электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (C-
peptide (Electrochemiluminescence Immunoassay) / C-peptide)**

**Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.
(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай**

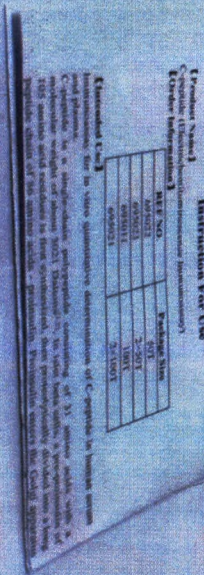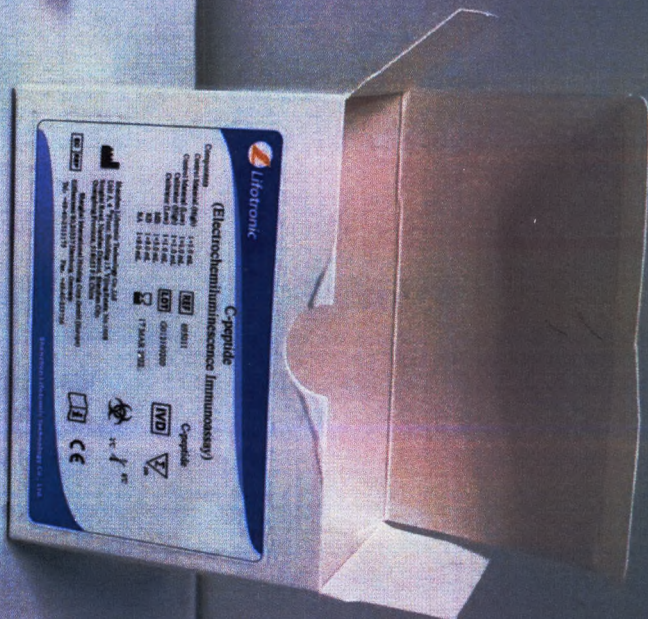

Extraction For Use	
Lot No.	Expiry Date
0000001	31.12.2023
0000002	31.12.2023
0000003	31.12.2023
0000004	31.12.2023
0000005	31.12.2023
0000006	31.12.2023
0000007	31.12.2023
0000008	31.12.2023
0000009	31.12.2023
0000010	31.12.2023

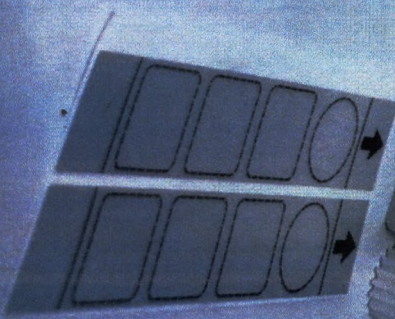

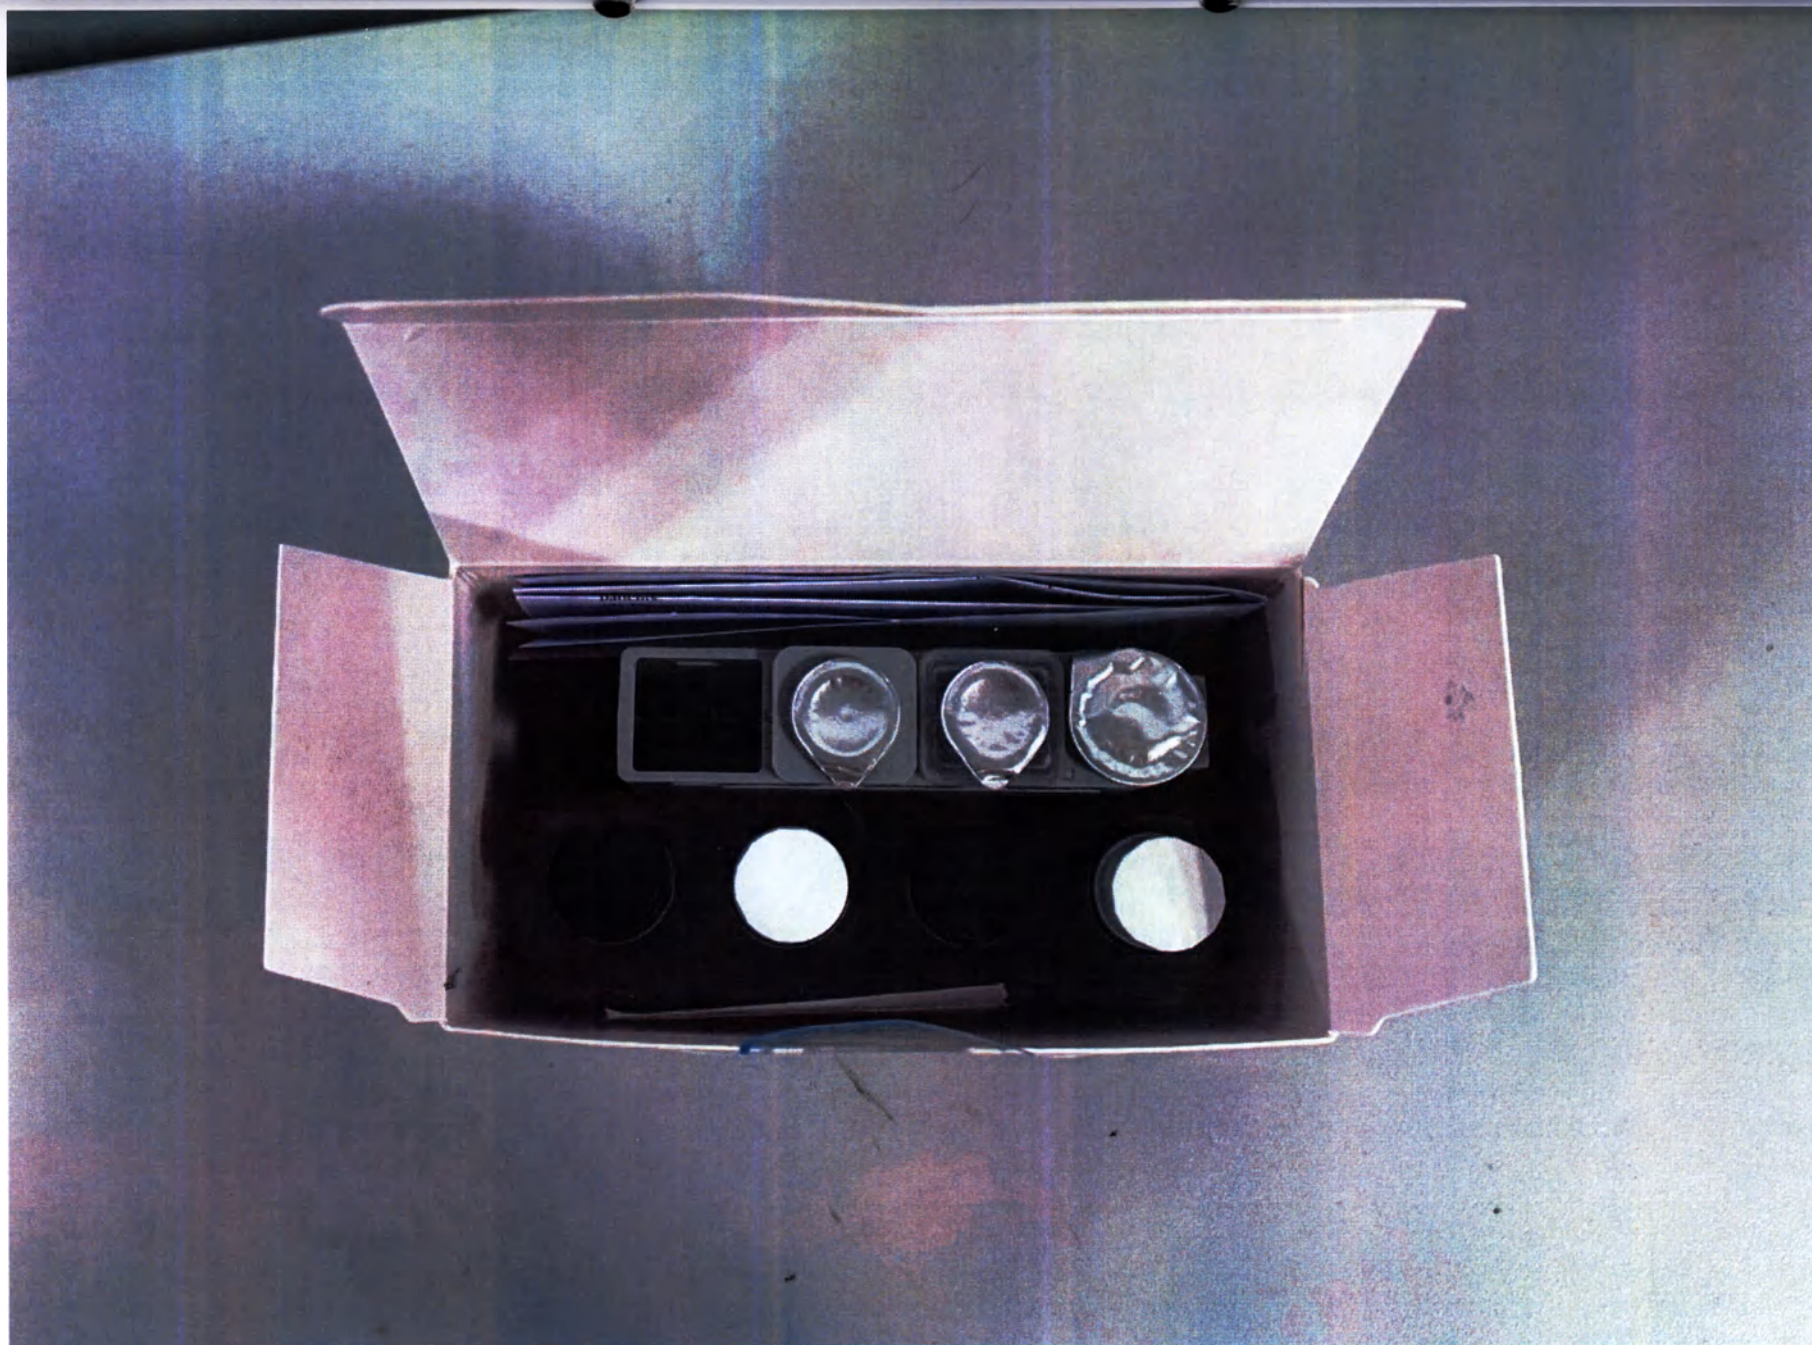


Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения С-пептида электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in





Калибратор (низкий и высокий уровень), Материал контрольный (низкий и высокий уровень) (Набор реагентов для количественного определения С-пептида электрохемилюминесцентным

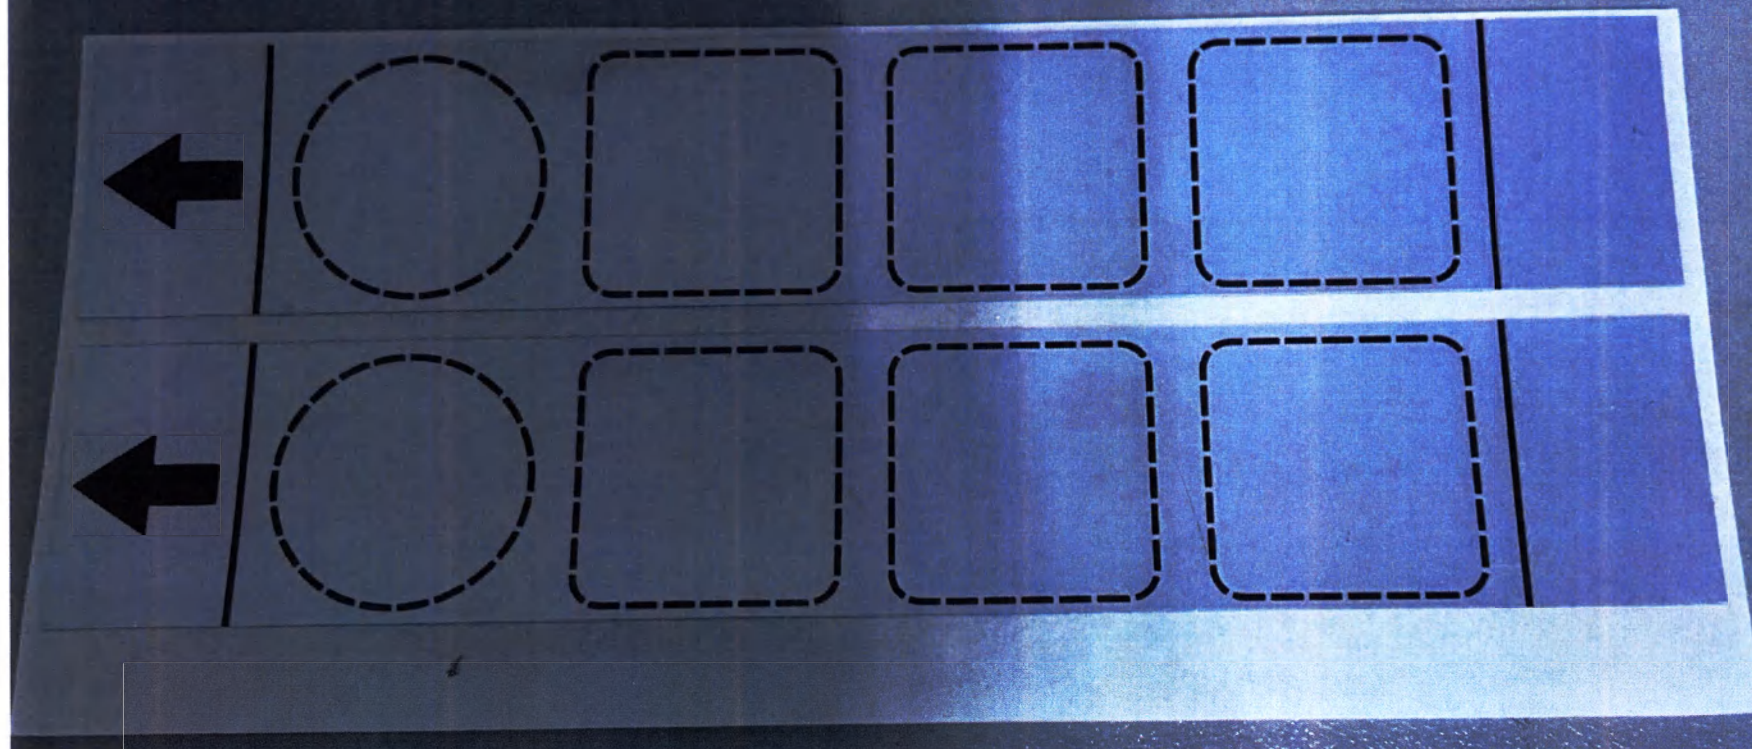

C-peptide Quality Control Card

[LOT] G012100200  17 MAR 2022


QC Range(Low): 0.249-0.525 ng/mL

QC Range(High): 17.255-36.665 ng/mL





Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения С-пептида электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (C-peptide

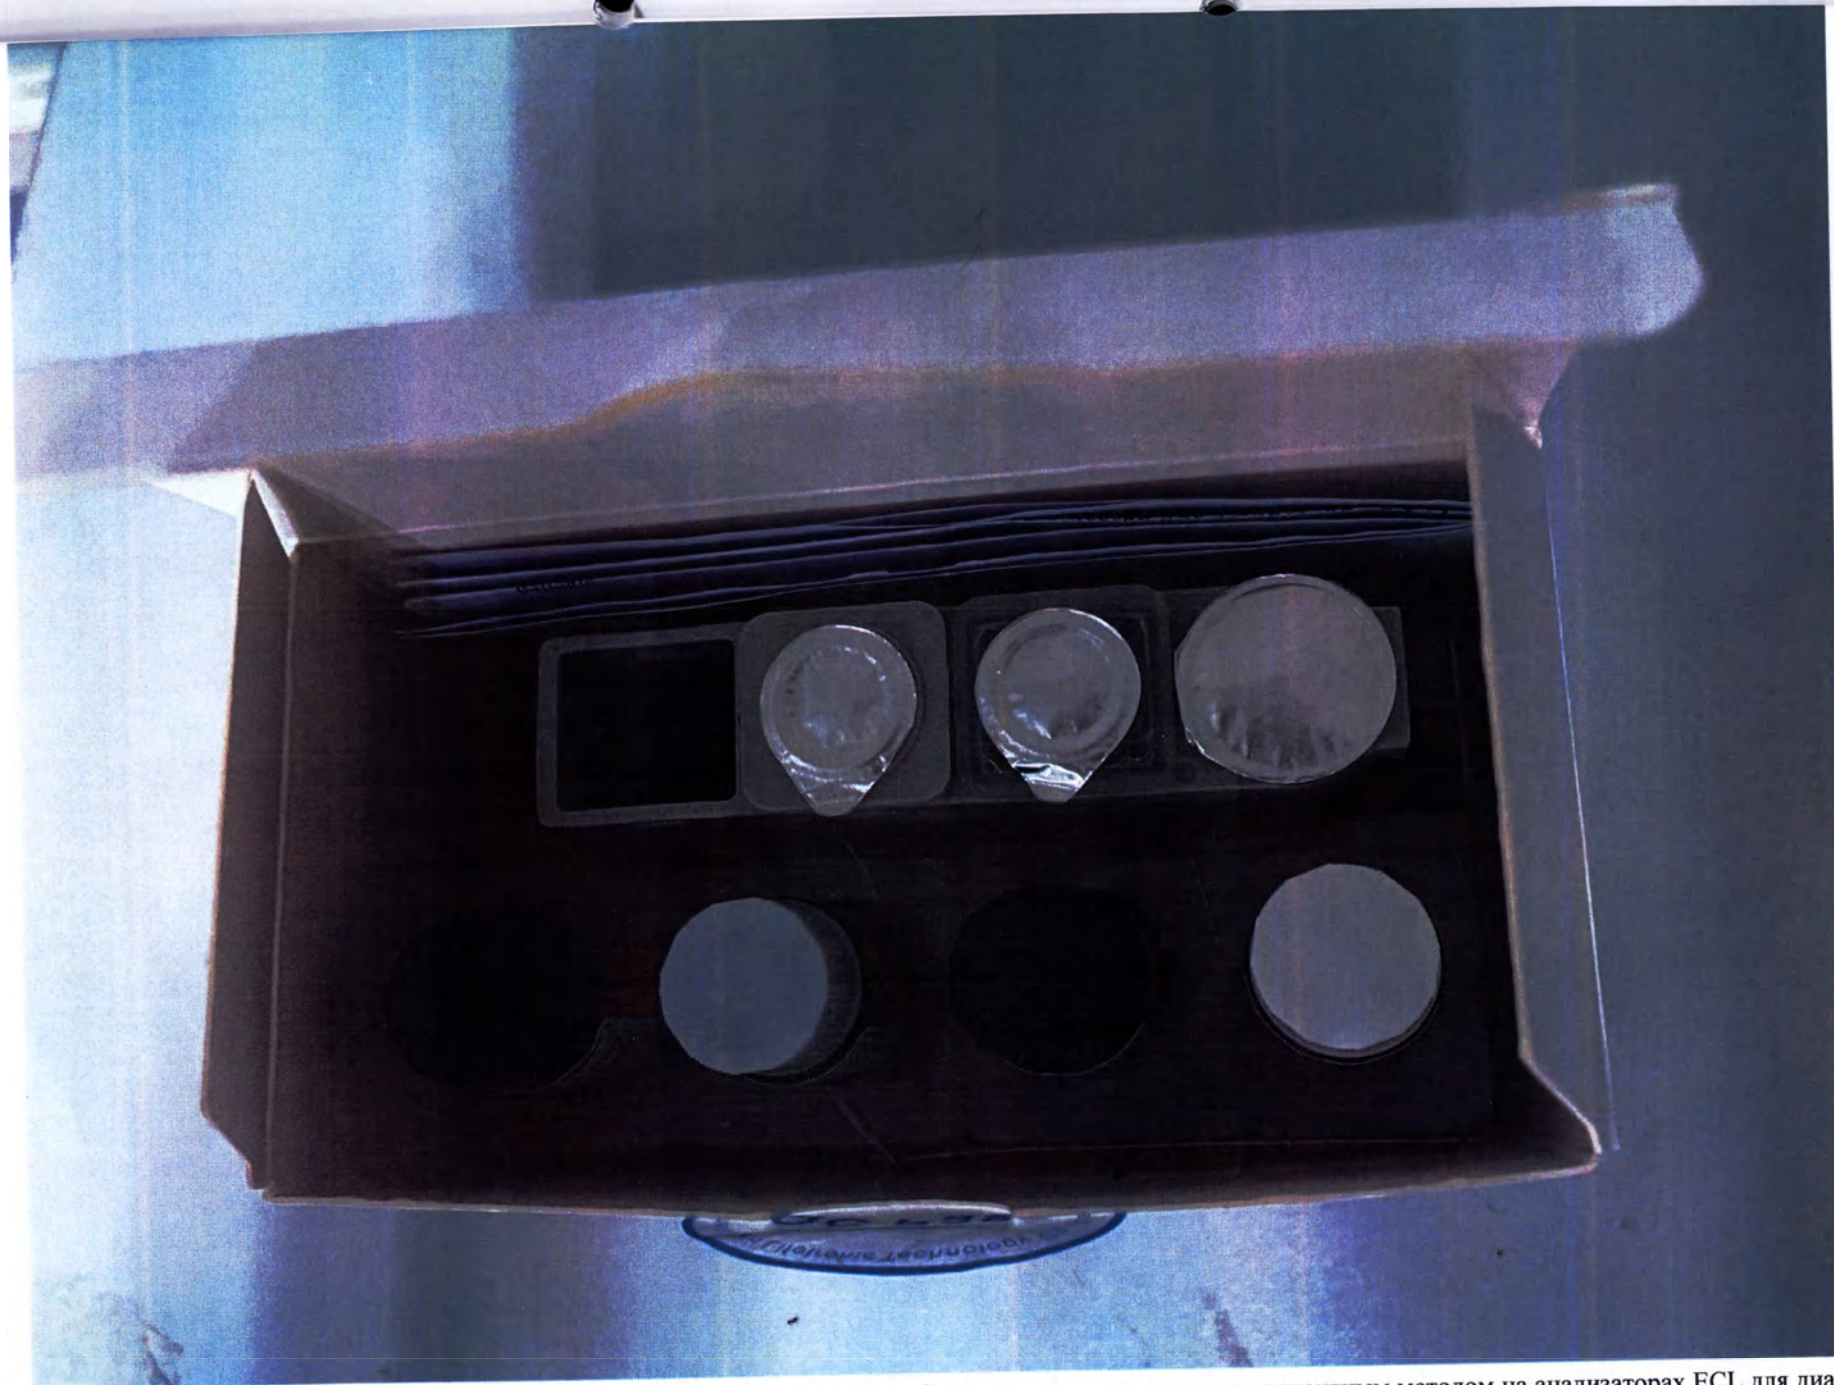


Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения С-пептида электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (C-peptide (Electrochemiluminescence Immunoassay) / C-peptide), в варианте исполнения 50 тестов)





Калибратор (низкий и высокий уровень), Материал контрольный (низкий и высокий уровень) (Набор реагентов для количественного определения С-пептида

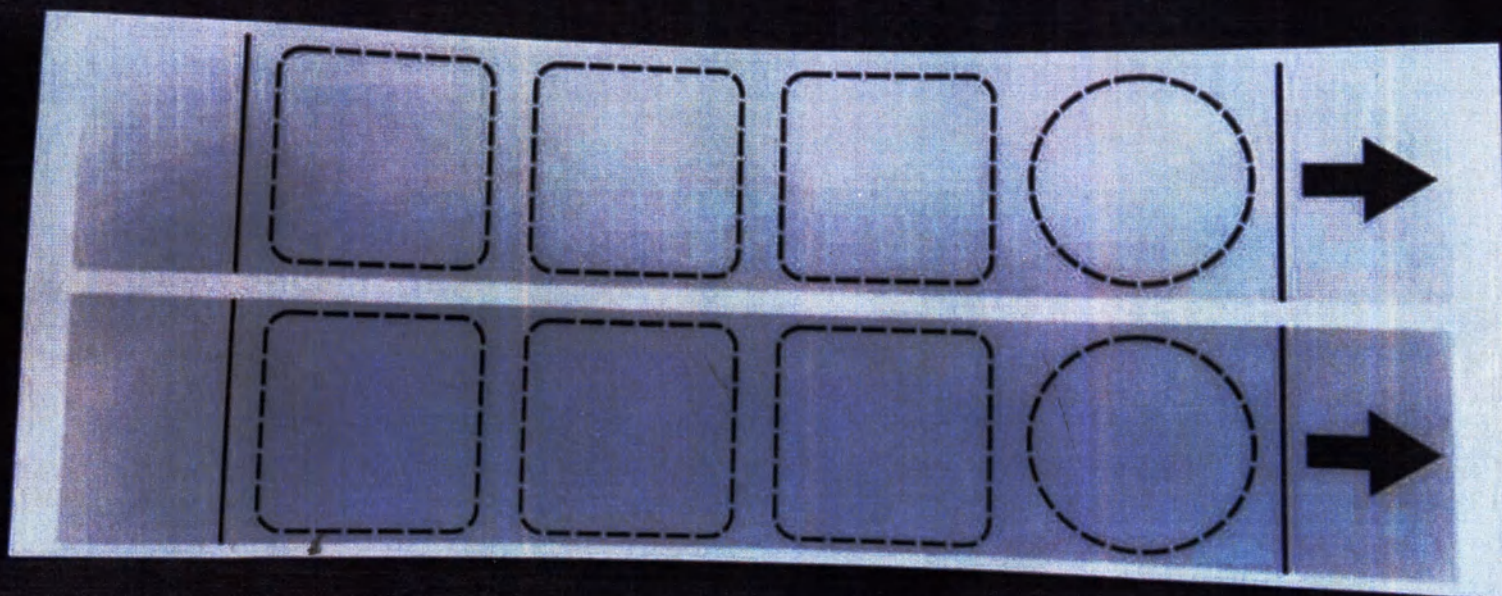

Этикетки для запечатывания флаконов (Набор реагентов для количественного определения С-пептида электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики

ООО ЦРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU (C-peptide (Electrochemiluminescence Immunoassay) / C-peptide), в варианте исполнения 50 тестов)

C-peptide Quality Control Card

LOT


G012100600




22 JUN 2022

QC Range(Low): 0.249-0.525 ng/mL

QC Range(High): 17.26-36.67 ng/mL



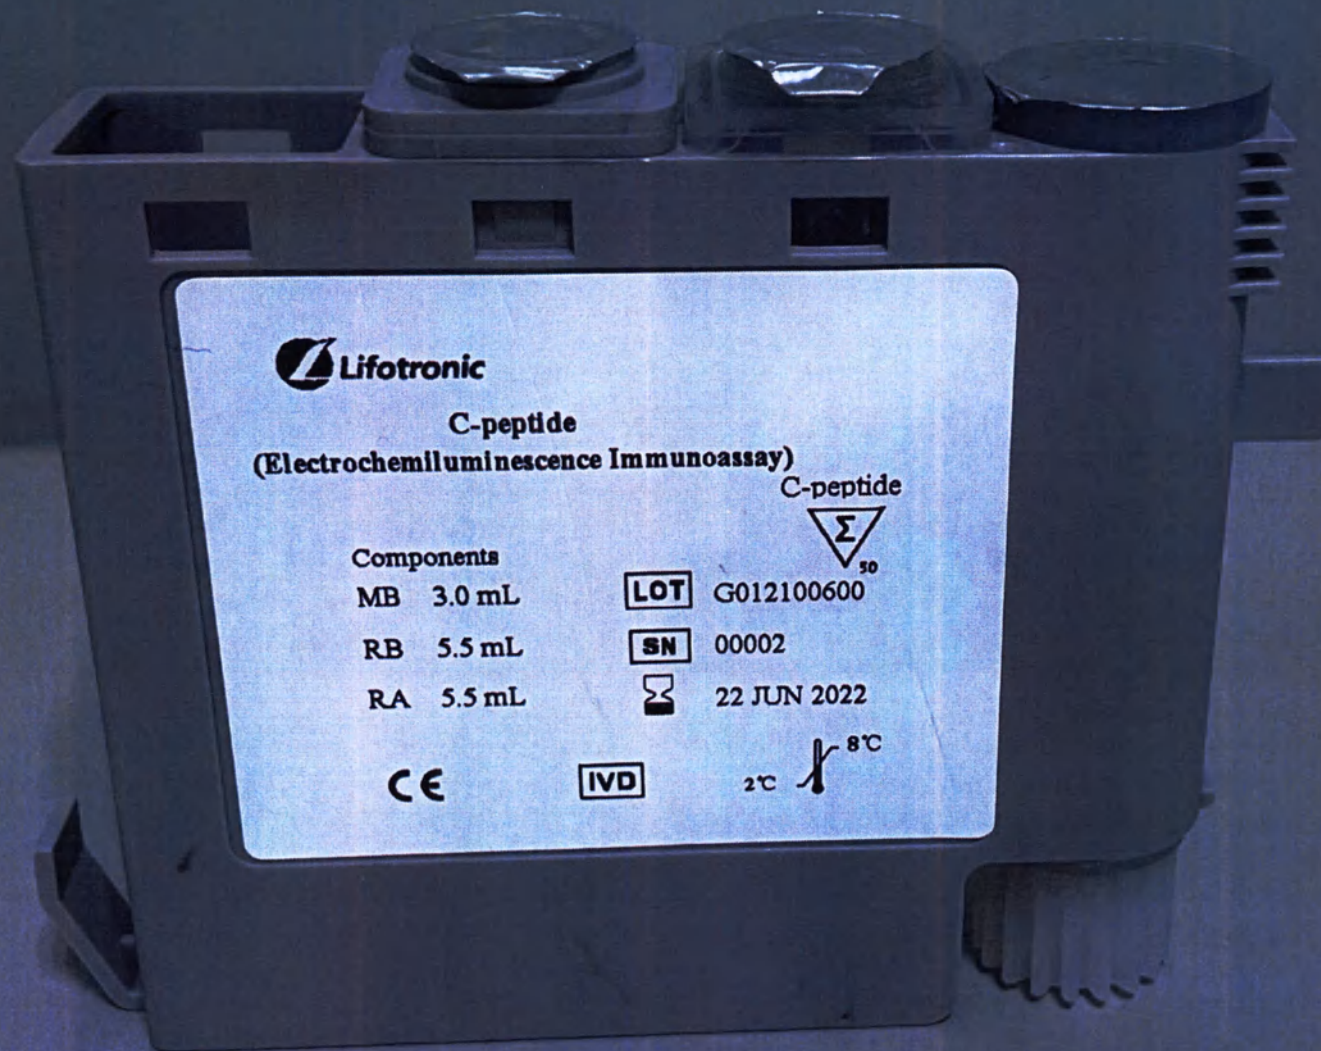

Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения С-пептида электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (C-peptide (Electrochemiluminescence Immunoassay) / C-peptide), в варианте исполнения 50 тестов)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 15 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А.
М.П.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАЙЛО Р.В.