

1  
/

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

А.Г.Плехов

2021 г.



## **МАКЕТ МАРКИРОВКИ ГРУППОВОЙ ТАРЫ**

**Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения  
иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке (плазме) крови человека  
«Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)»  
ТУ 21.20.23-114-94568735-2021**

**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения**  
**иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в**  
**сыворотке (плазме) крови человека**  
**ТУ 21.20.23-114-94568735-2021**

**LOT** Серия XXXX

 Годен до YYYY-XX

**Наборов в коробке: XX шт.**

**Масса нетто набора: XX г.**

**Масса нетто: XX г.**

**Масса брутто: XX г.**

 **АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», 194356, Санкт-Петербург,**  
**Дорога в Каменку, дом 56, литера А**

 **+2-8°C**



**Прошито, пронумеровано,  
и скреплено печатью**

Всего 2 листа(ов)

Генеральный директор

Плехов А.Г.



# **IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ) REF ВИ 12-36.1**

РУ №  
ТУ 21.20.23-114-94568735-2021

Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения  
иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу  
SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке (плазме) крови человека  
«Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)»  
**Состав набора (комплект 1):**

только для in vitro диагностики

**LOT серия:**  
**008.1**

**Дата выпуска:**  
**2021-09**

**Годен до:**  
**2022-07**

АО "Витал Девелопмент  
Корпорэйшн", Россия  
194356 Санкт-Петербург,  
Дорога в Каменку,  
д.56, лит А  
тел: (812) 550-55-10

- 1 Микропланшет
- 2 Калибровочные пробы
- 3 Контрольная сыворотка
- 4 Конъюгат
- 5 Буфер А
- 6 Буфер Р
- 7 Буфер П
- 8 Раствор ТМБ
- 9 Стоп-реагент
- 10 Пакет закрывающийся
- 11 Пленка для заклеивания микропланшета
- 12 Ванночки для внесения реагентов
- 13 Одноразовые наконечники для дозаторов
- 14 Разборный полистирольный планшет для предварительного разведения исследуемых образцов

- 1 упак
- 6 фл(1,0мл)
- 1 фл(1,0мл)
- 1 фл(14мл)
- 1 фл(14мл)
- 1 фл(24мл)
- 1 фл(50мл)
- 1 фл(14мл)
- 1 фл(14мл)
- 1 шт
- 2 шт
- 2 шт
- 16 шт
- 2 шт

Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют



**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Микропланшет**  
**с иммобилизованным**  
**SARS-CoV-2**  
Готов к использованию  
**LOT 008.1**  
Годен до: 2022-07

**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Буфер А**  
**14 мл**  
Готов к использованию  
**LOT 008.1**  
Годен до: 2022-07

**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Калибровочная проба №1**  
**0 ВАУ/мл**  
**LOT 008.1 1,0 мл**  
Годен до: 2022-07 Готов к использованию  
Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Буфер Р**  
**24 мл**  
Готов к использованию  
**LOT 008.1**  
Годен до: 2022-07

**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Калибровочная проба №2**  
**10 ВАУ/мл**  
**LOT 008.1 1,0 мл**  
Годен до: 2022-07 Готов к использованию  
Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Буфер П**  
**50 мл**  
Буфер для промывки(20X)  
Развести в 20 раз  
Готов к использованию  
**LOT 008.1**  
Годен до: 2022-07

**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Калибровочная проба №3**  
**50 ВАУ/мл**  
**LOT 008.1 1,0 мл**  
Годен до: 2022-07 Готов к использованию  
Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Калибровочная проба №4**  
**200 ВАУ/мл**  
**LOT 008.1 1,0 мл**  
Годен до: 2022-07 Готов к использованию  
Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Раствор ТМБ**  
**14 мл**  
Готов к использованию  
**LOT 008.1**  
Годен до: 2022-07

**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Калибровочная проба №5**  
**600 ВАУ/мл**  
**LOT 008.1 1,0 мл**  
Годен до: 2022-07 Готов к использованию  
Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Стоп-реагент**  
**14 мл**  
Готов к использованию  
**LOT 008.1**  
Годен до: 2022-07

**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Калибровочная проба №6**  
**1200 ВАУ/мл**  
**LOT 008.1 1,0 мл**  
Годен до: 2022-07 Готов к использованию  
Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Контрольная сыворотка**  
**49 - 74 ВАУ/мл**  
**LOT 008.1 1,0 мл**  
Годен до: 2022-07 Готов к использованию  
Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Конъюгат**  
**14 мл**  
Готов к использованию  
**LOT 008.1**  
Годен до: 2022-07



# **IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ) REF BI 12-36.2**

RU №  
ТУ 21.20.23-114-94568735-2021 Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения

иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2(COVID-19) в сыворотке (плазме) крови человека «Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)»

**Состав набора(комплект 2):**

только для in vitro диагностики

**LOT серия:**  
**008.2**

**Дата выпуска:**  
**2021-09**

**Годен до:**  
**2022-07**

АО "Витал Девелопмент  
Корпорация", Россия  
194356 Санкт-Петербург,  
Дорога в Каменку,  
д.56, лит А  
тел: (812) 250-55-10

- |                                                                                          |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Микропланшет                                                                           | 5 упак                  |
| 2 Калибровочные пробы                                                                    | 5 комп (6 фл по 1,0 мл) |
| 3 Контрольная сыворотка                                                                  | 5 фл(1,0 мл)            |
| 4 Конъюгат                                                                               | 5 фл(14 мл)             |
| 5 Буфер А                                                                                | 5 фл(14 мл)             |
| 6 Буфер Р                                                                                | 5 фл(24 мл)             |
| 7 Буфер П                                                                                | 5 фл(50 мл)             |
| 8 Раствор ТМБ                                                                            | 5 фл(14 мл)             |
| 9 Стоп-реагент                                                                           | 5 фл(14 мл)             |
| 10 Пакет закрывающийся                                                                   | 5 шт                    |
| 11 Пленка для заклеивания микропланшета                                                  | 10 шт                   |
| 12 Ванночки для внесения реагентов                                                       | 10 шт                   |
| 13 Одноразовые наконечники для дозаторов                                                 | 80 шт                   |
| 14 Разборный полистирольный планшет для предварительного разведения исследуемых образцов | 10 шт                   |

Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют



**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Микропланшет**  
**с иммобилизованным**  
**SARS-CoV-2**  
Готов к использованию  
**LOT 008.2**  
Годен до: 2022-07

**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Буфер А**  
**14 мл**  
Готов к использованию  
**LOT 008.2**  
Годен до: 2022-07

**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Калибровочная проба №1**  
**0 ВАУ/мл**  
**LOT 008.2 1,0 мл**  
Годен до: 2022-07 Готов к использованию  
Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Буфер Р**  
**24 мл**  
Готов к использованию  
**LOT 008.2**  
Годен до: 2022-07

**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Калибровочная проба №2**  
**10 ВАУ/мл**  
**LOT 008.2 1,0 мл**  
Годен до: 2022-07 Готов к использованию  
Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Буфер П**  
**50 мл**  
Буфер для промывки(20X)  
Развести в 20 раз  
**LOT 008.2**  
Годен до: 2022-07

**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Калибровочная проба №3**  
**50 ВАУ/мл**  
**LOT 008.2 1,0 мл**  
Годен до: 2022-07 Готов к использованию  
Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Калибровочная проба №4**  
**200 ВАУ/мл**  
**LOT 008.2 1,0 мл**  
Годен до: 2022-07 Готов к использованию  
Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Раствор ТМБ**  
**14 мл**  
Готов к использованию  
**LOT 008.2**  
Годен до: 2022-07

**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Калибровочная проба №5**  
**600 ВАУ/мл**  
**LOT 008.2 1,0 мл**  
Годен до: 2022-07 Готов к использованию  
Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Стоп-реагент**  
**14 мл**  
Готов к использованию  
**LOT 008.2**  
Годен до: 2022-07

**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Калибровочная проба №6**  
**1200 ВАУ/мл**  
**LOT 008.2 1,0 мл**  
Годен до: 2022-07 Готов к использованию  
Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Контрольная сыворотка**  
**LOT 003.2 49 - 74 ВАУ/мл**  
**1,0 мл**  
Годен до: 2022-07 Готов к использованию  
Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

**Количественный IgG-SARS-CoV-2-Имаксиз (IMAXYZ)**  
**Конъюгат**  
**14 мл**  
Готов к использованию  
**LOT 008.2**

Прошито, пронумеровано,  
и скреплено печатью

Всего 2 листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.

# **IgG-SARS-CoV-2-Иммуноиз (IMAXYZ) REF ВИ 12-36.1**

РУ №  
ТУ 21.30.33-1 (4-84888738-2021)

Набор реагентов для количественного иммуноферментного  
определения  
иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу  
SARS-CoV-2 (COVID-19) в сыворотке (плазме) крови человека  
«Количественный IgG-SARS-CoV-2-Иммуноиз (IMAXYZ)»  
**Состав набора (комплект 1):**

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНЕШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**LOT** серия:  
**010**

**Дата выпуска:**  
2021-11


**Годен до:**  
2022-09

АО «Витал Девелопмент  
«Корпорейшн», Россия  
184364 Санкт-Петербург,  
Дорога в Колпино,  
д.56, лит А  
тел. (812) 250-66-10

- |                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Микропланшет                                                                           | 1 упак      |
| 2. Калибровочные пробы                                                                    | 6 фл(1.0мл) |
| 3. Контрольная сыворотка                                                                  | 1 фл(1.0мл) |
| 4. Конъюгат                                                                               | 1 фл(14мл)  |
| 5. Буфер А                                                                                | 1 фл(14мл)  |
| 6. Буфер Р                                                                                | 1 фл(24мл)  |
| 7. Буфер П                                                                                | 1 фл(50мл)  |
| 8. Реагент ТМБ                                                                            | 1 фл(14мл)  |
| 9. Стоп-реагент                                                                           | 1 фл(14мл)  |
| 10. Плат для окисления                                                                    | 1 шт        |
| 11. Пленка для захвата микропланшета                                                      | 2 шт        |
| 12. Ванночки для элиминации реагентов                                                     | 2 шт        |
| 13. Одноразовые ватонечки для дозаторов                                                   | 10 шт       |
| 14. Разборный полистирольный планшет для предварительного разведения исследуемых образцов | 2 шт        |

Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют



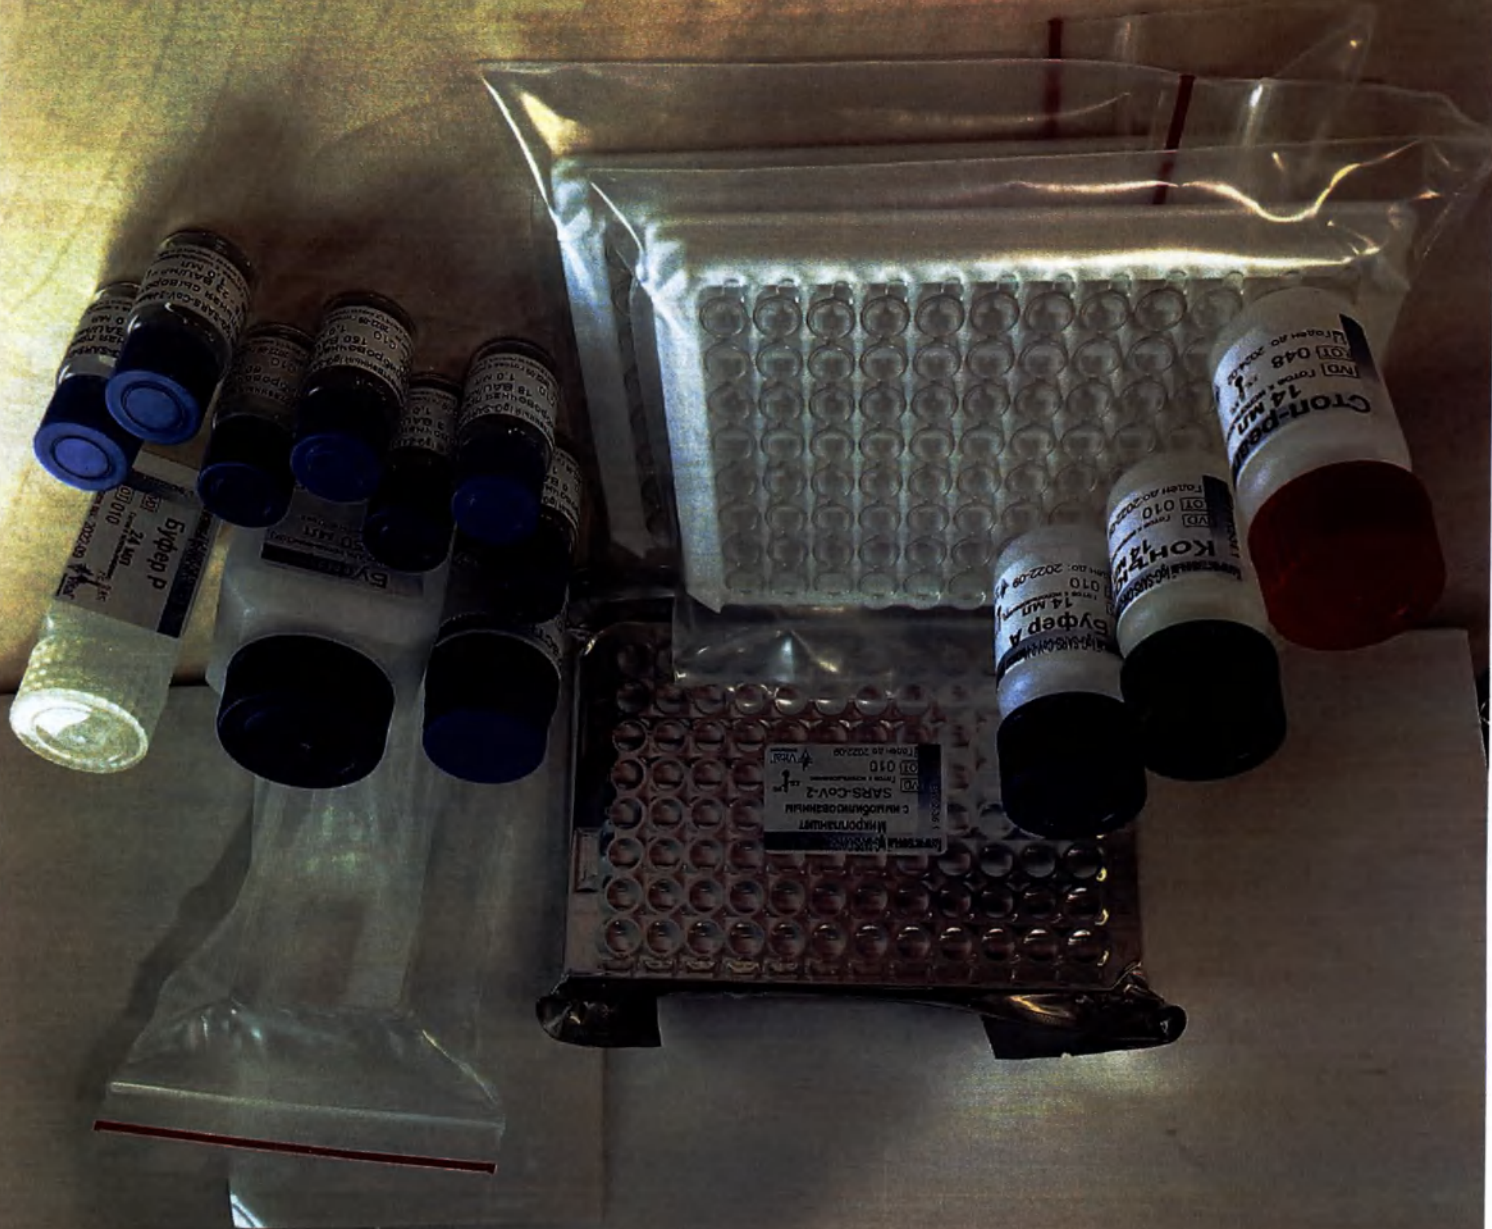

Saint-Petersburg  
+7 (812) 702-1086  
sale@vital-spb.ru  
www.vital-spb.ru



Saint-Petersburg  
+7 (812) 702-1086  
sale@vital-spb.ru  
www.vital-spb.ru



ИГО-SARS-CoV-2-ИМАХИЗ (IMAXYZ) REF: ВИ 12-36.2

Р/И № 12-36.2-11-0000070-2021

Набор реактивов для количественного иммуноферментного определения  
вирусной нагрузки (вирус SARS-CoV-2) в сыворотке (плазме) крови человека  
«Комплексный ИГО-SARS-CoV-2-ИМАХИЗ»


Состав набора (компонент 21):


|                                                                                             |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Микроплазмат                                                                             | 5 шт.                          |
| 2. Калибровочные пробы                                                                      | 5 шт. (5 шт. по 1 шт. в 1 шт.) |
| 3. Контрольная сыворотка                                                                    | 5 шт. (1 шт.)                  |
| 4. Конъюгат                                                                                 | 5 шт. (1 шт.)                  |
| 5. Буфер А                                                                                  | 5 шт. (1 шт.)                  |
| 6. Буфер В                                                                                  | 5 шт. (1 шт.)                  |
| 7. Буфер П                                                                                  | 5 шт. (1 шт.)                  |
| 8. Раствор ТМБ                                                                              | 5 шт. (1 шт.)                  |
| 9. Стоп-реактив                                                                             | 5 шт. (1 шт.)                  |
| 10. Платформы для заливки                                                                   | 5 шт.                          |
| 11. Платформы для заливки микроплазмат                                                      | 10 шт.                         |
| 12. Ватные диски для впитывания реактивов                                                   | 10 шт.                         |
| 13. Стерильные микротрубки для дозаторов                                                    | 90 шт.                         |
| 14. Рабочий поликарбонатный планшет для<br>предварительного разведения исследуемых образцов | 10 шт.                         |

Адрес: АО "Витал Девелопмент"  
"Комплексный ИГО-SARS-CoV-2-ИМАХИЗ"  
184388 Санкт-Петербург,  
А.М.Д.А.  
тел (812) 702-1086


Аттестован к ВИЧ 1.2. вступу в силу сертификата С.И. ИМАХИЗ от 01.01.2021 г.



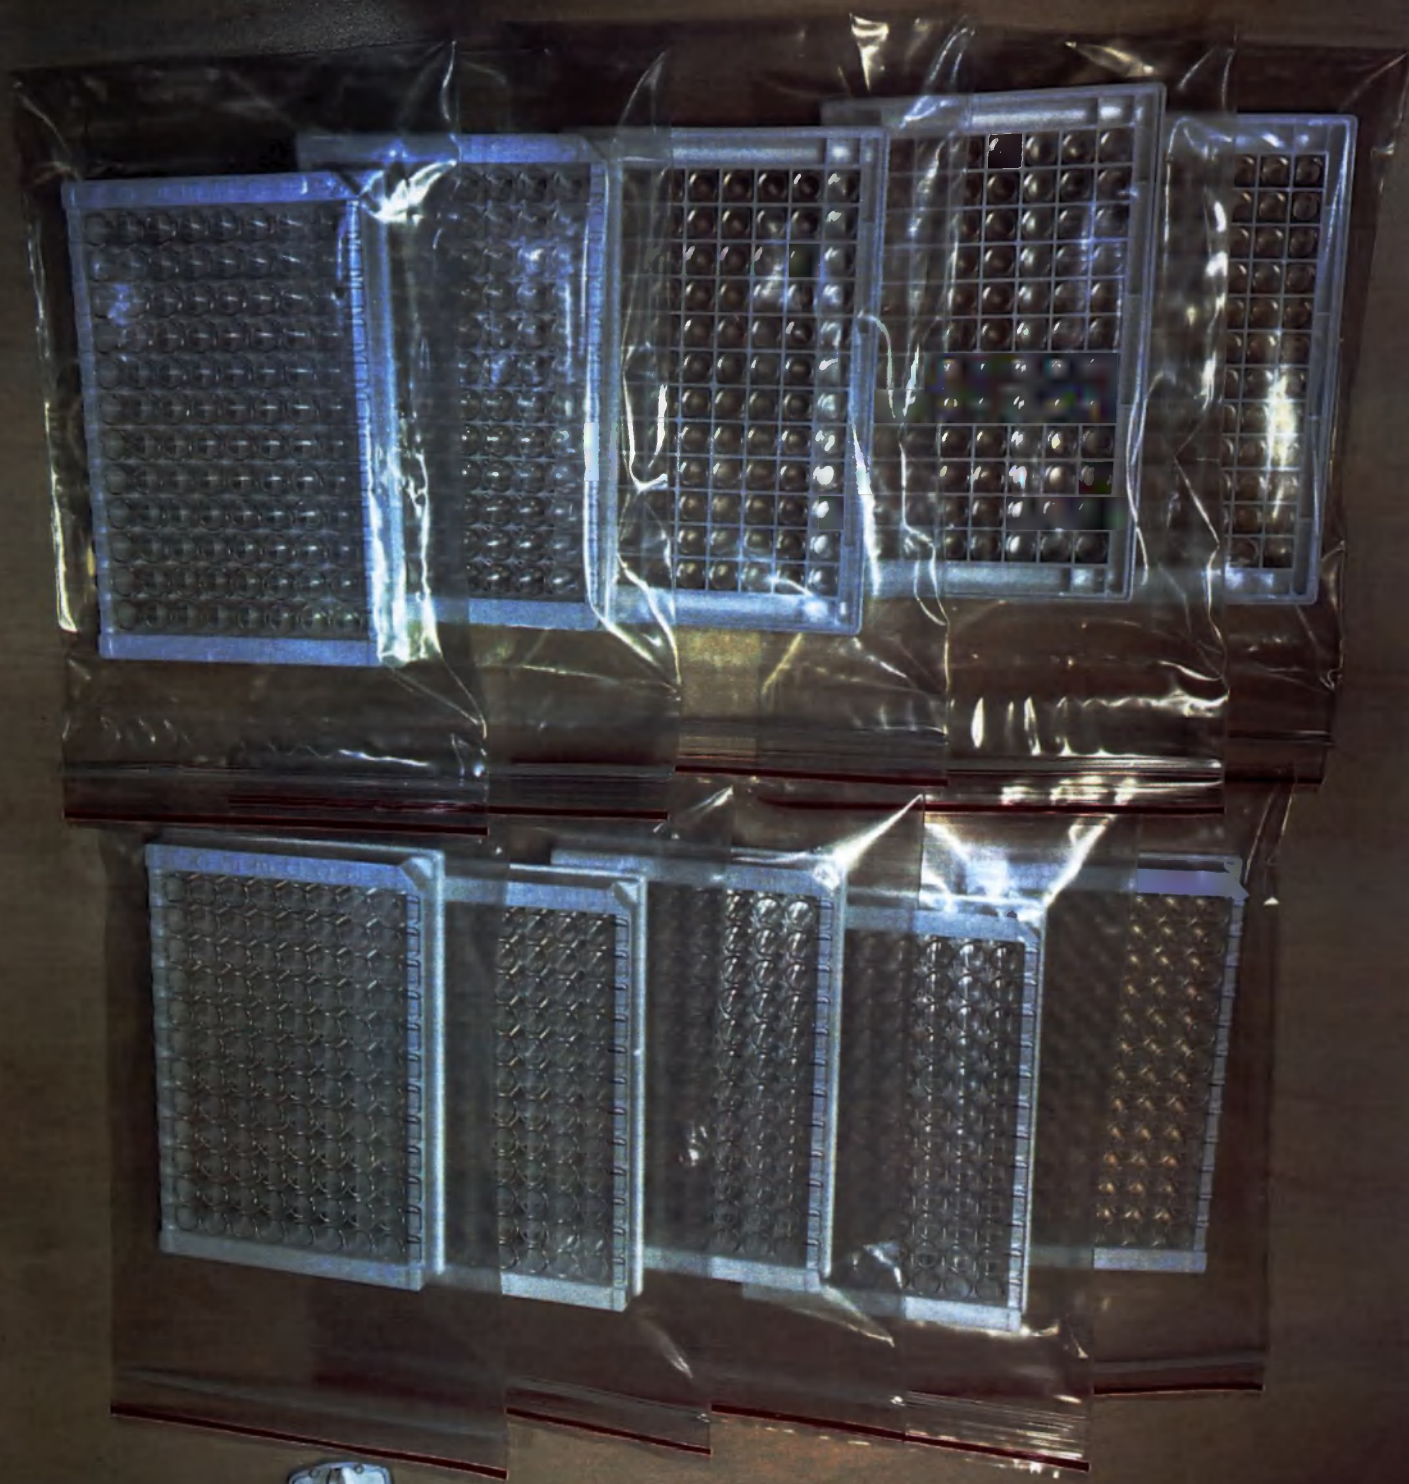

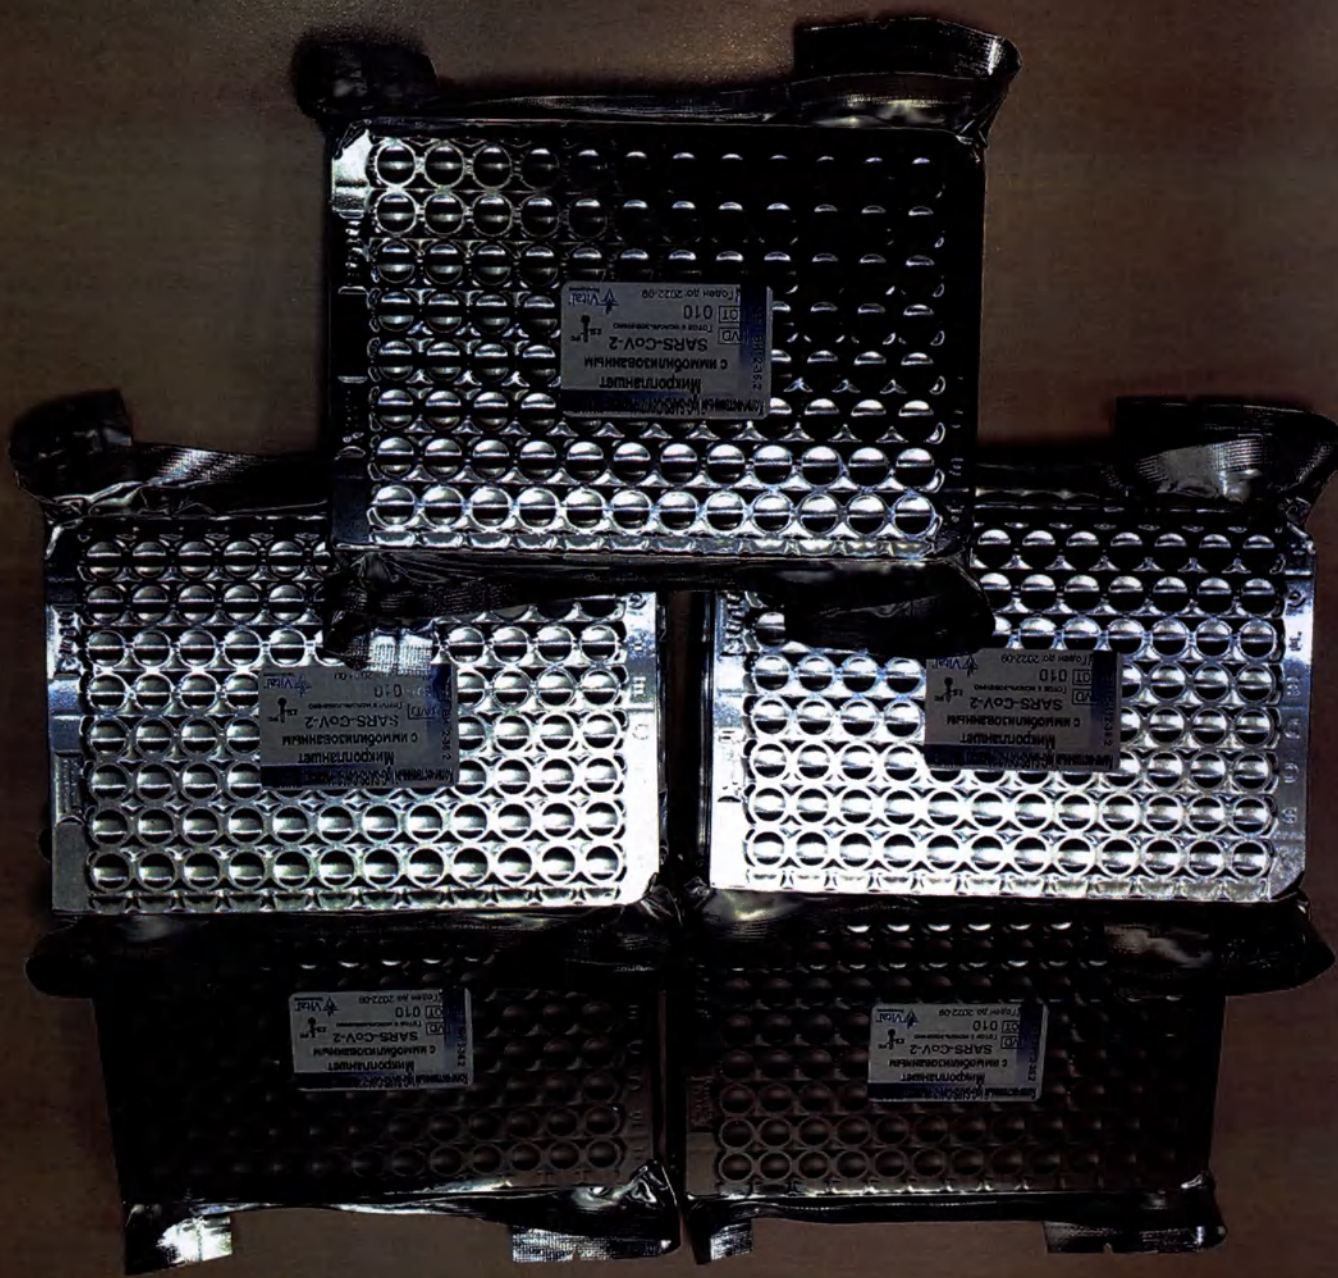

7

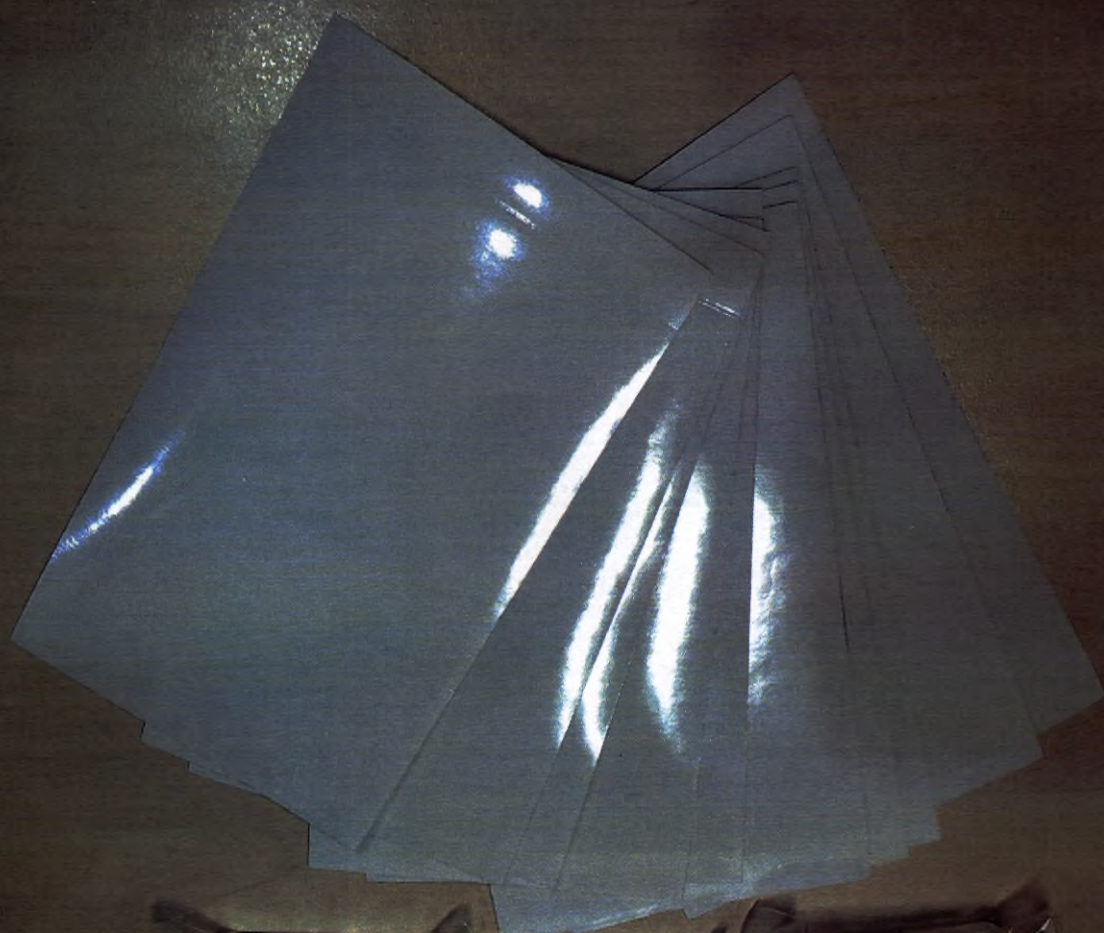

**Прошито, пронумеровано,  
и скреплено печатью**

Всего

7

листа(ов)



Ген. директор

Плехов А.Г.