

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

«18» сентября 2022 г.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАЙЛО Р. В.


Фотографические изображения изделия:

**Набор реагентов для количественного определения креатинкиназы-MB
электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro
(Creatine Kinase MB STAT eCLIA / CK-MB STAT)**


Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.

(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай



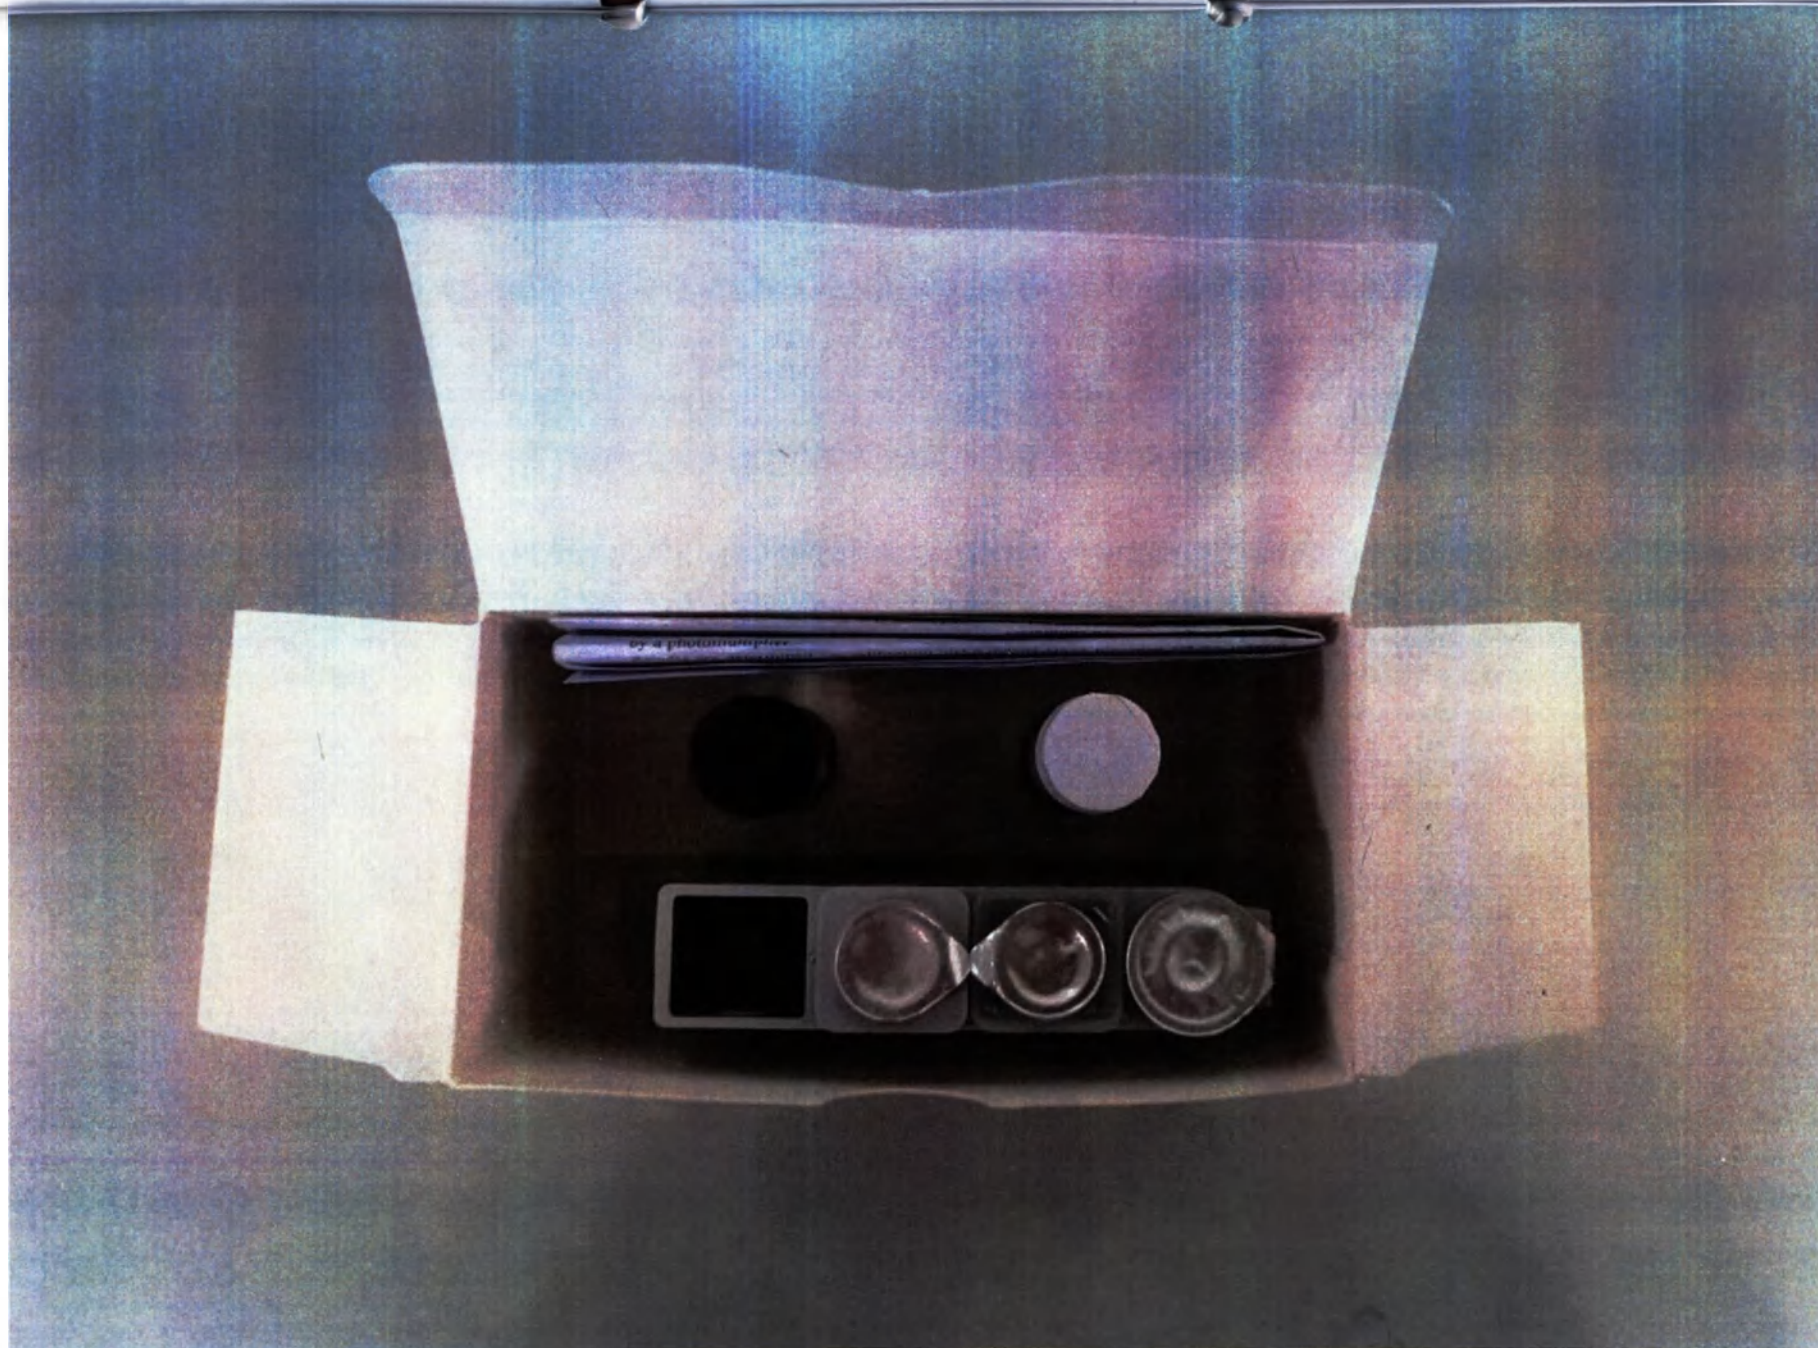


Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения креатинкиназы-MB электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Creatine Kinase MB STAT eCLIA / CK-MB STAT), в варианте исполнения 100 тестов)

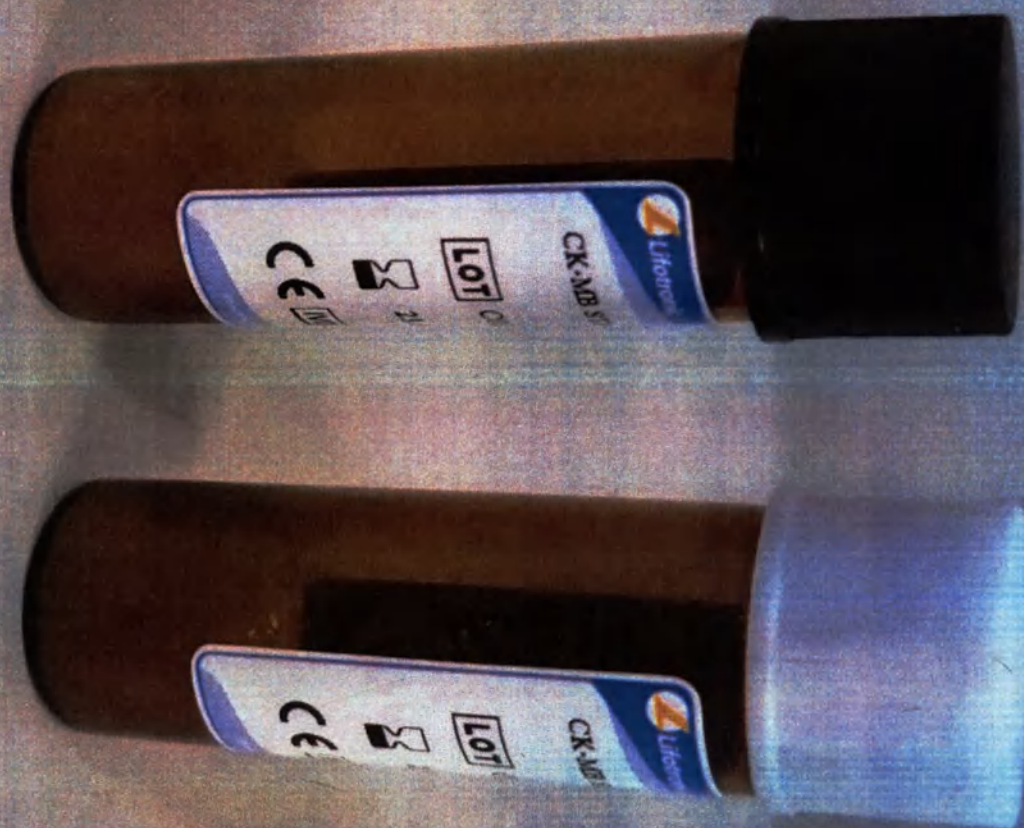




Калибратор (низкий и высокий уровень) (Набор реагентов для количественного определения креатинкиназы-MB электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Creatine Kinase MB STAT eCLIA / CK-MB STAT), в варианте исполнения 100 тестов)

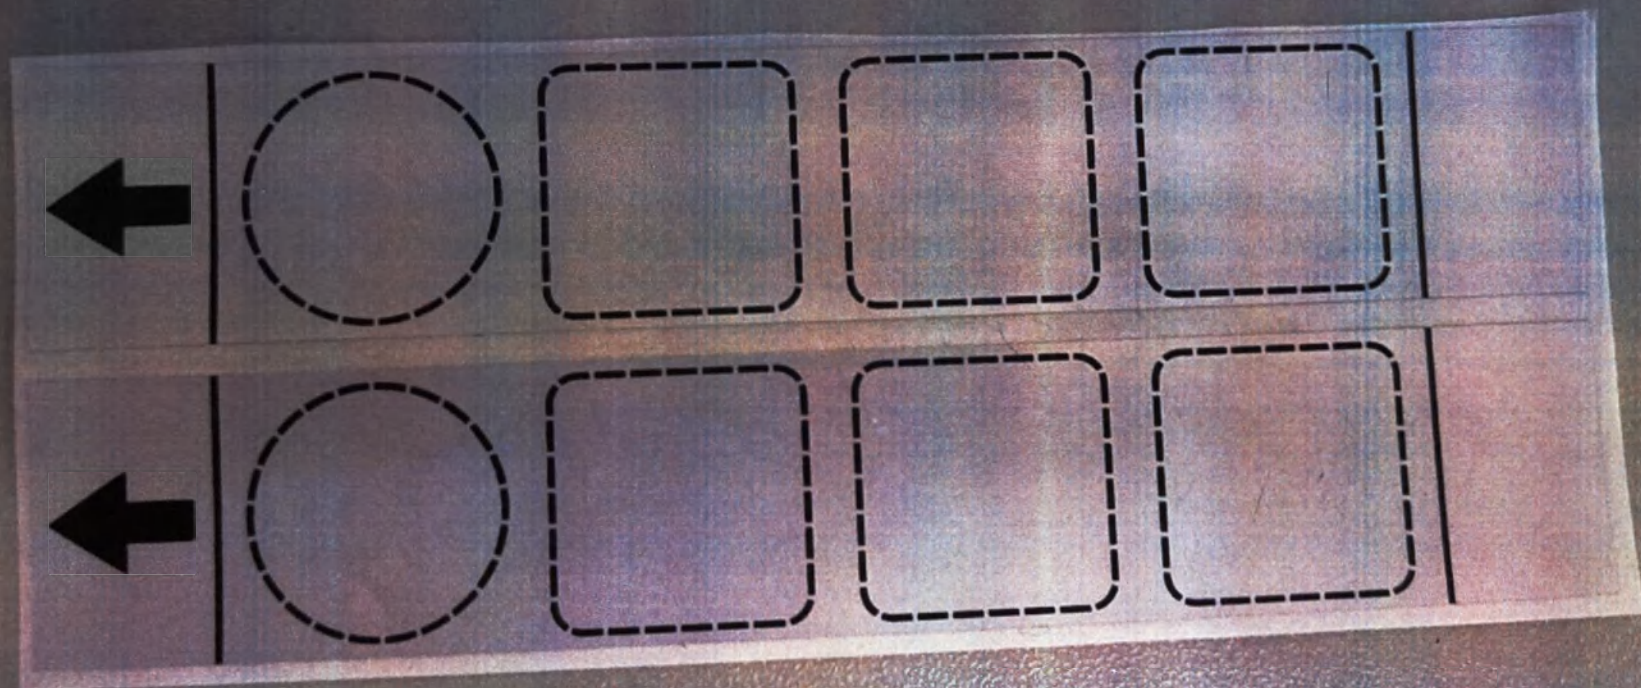

Этикетки для запечатывания флаконов (Набор реагентов для количественного определения креатинкиназы-MB электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для
этикетки in vitro (Creatine Kinase MB STAT eCLIA / CK-MB STAT), в варианте исполнения 100 тестов)



Creatine Kinase MB STAT eCLIA

CK-MB STAT

Components

MB 3.5 mL

RB 7.5 mL

RA 7.5 mL

LOT

C012100500

SN

00003



23 APR 2022


CE

IVD


2°C 8°C

Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения креатинкиназы-MB электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Creatine Kinase MB STAT eCLIA / CK-MB STAT), в варианте исполнения 100 тестов)



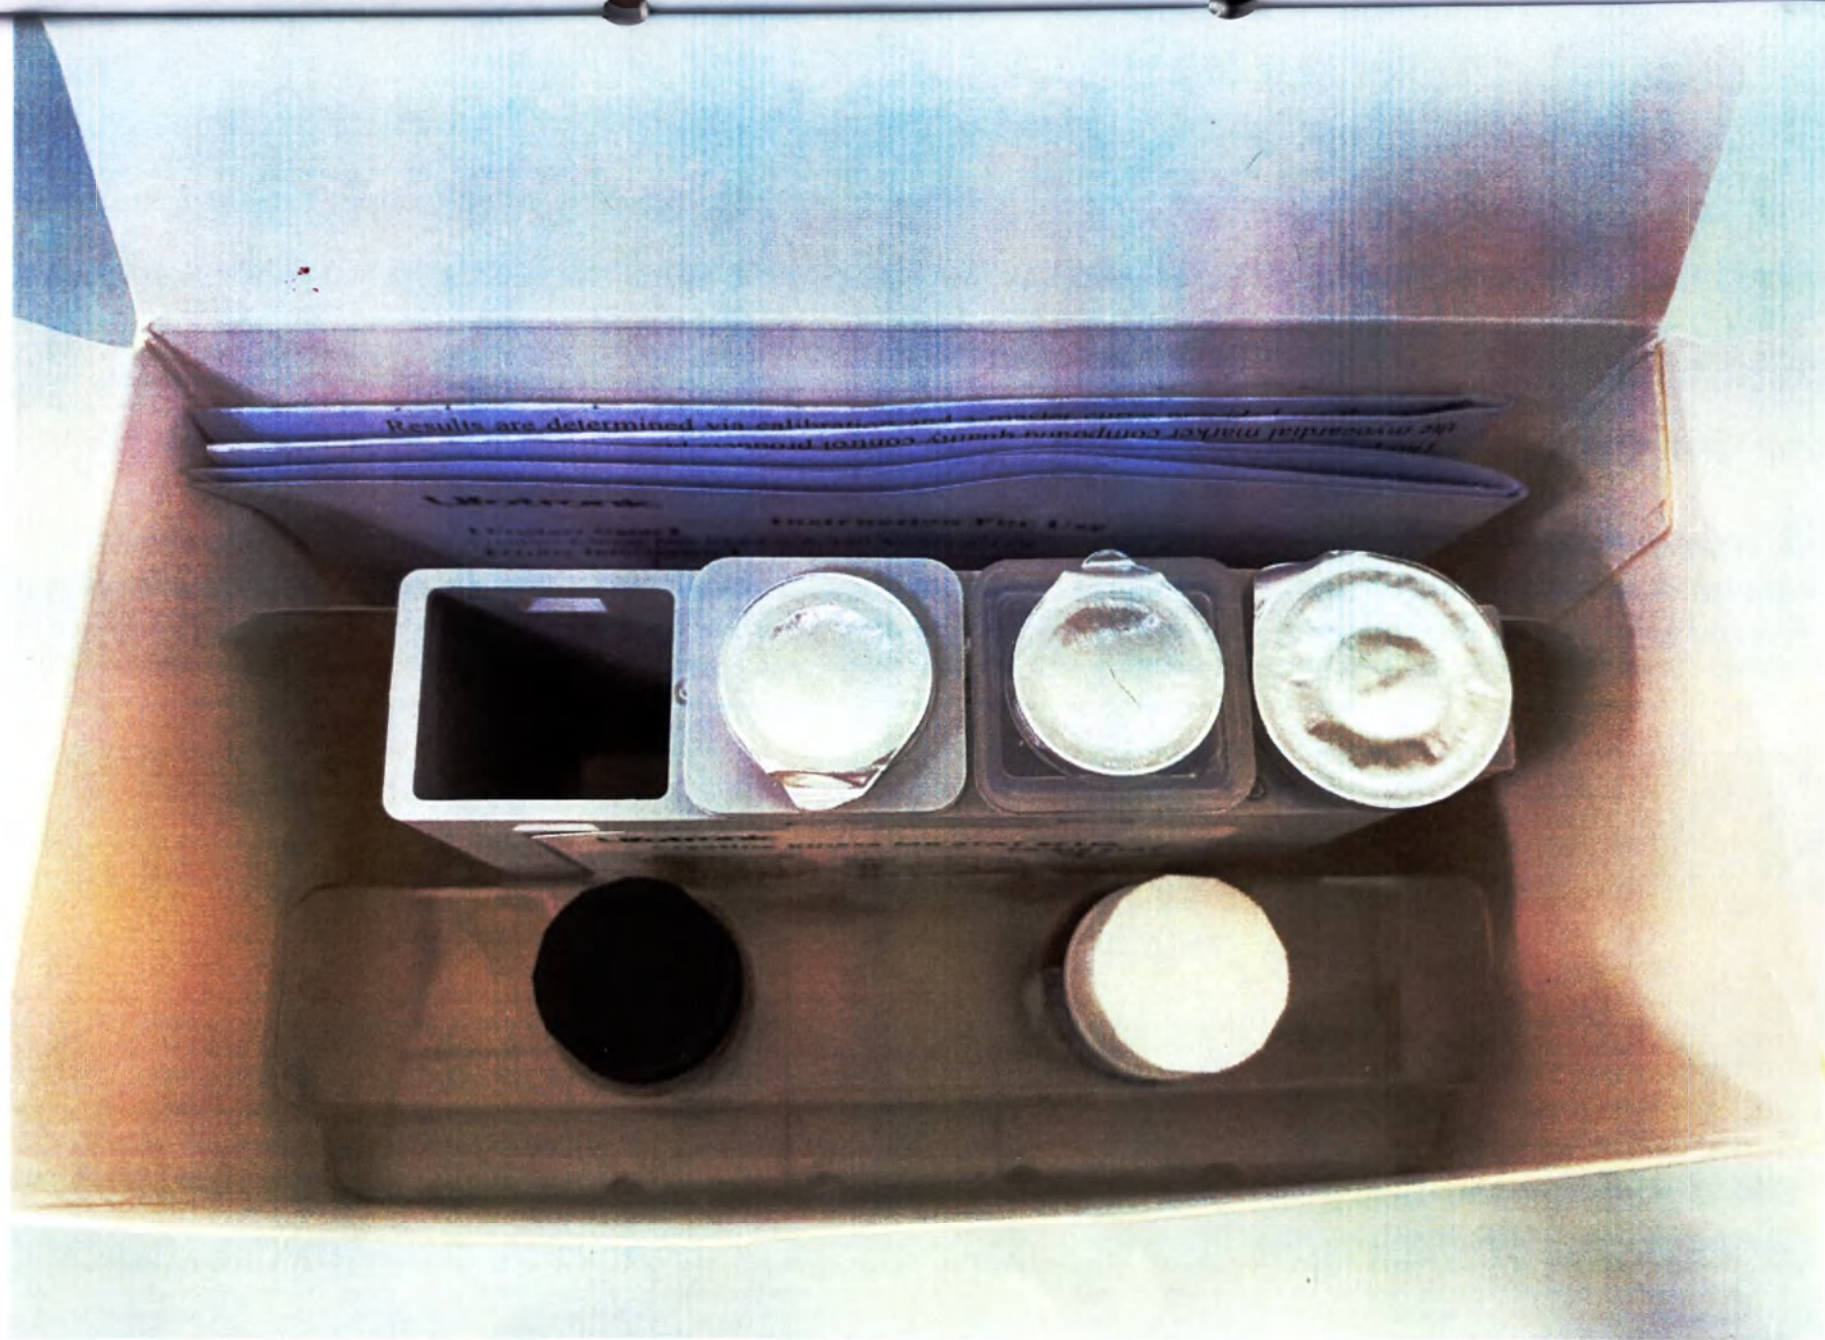



Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения креатинкиназы-MB электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для стики in vitro (Creatine Kinase MB STAT eCLIA / CK-MB STAT), в варианте исполнения 50 тестов)

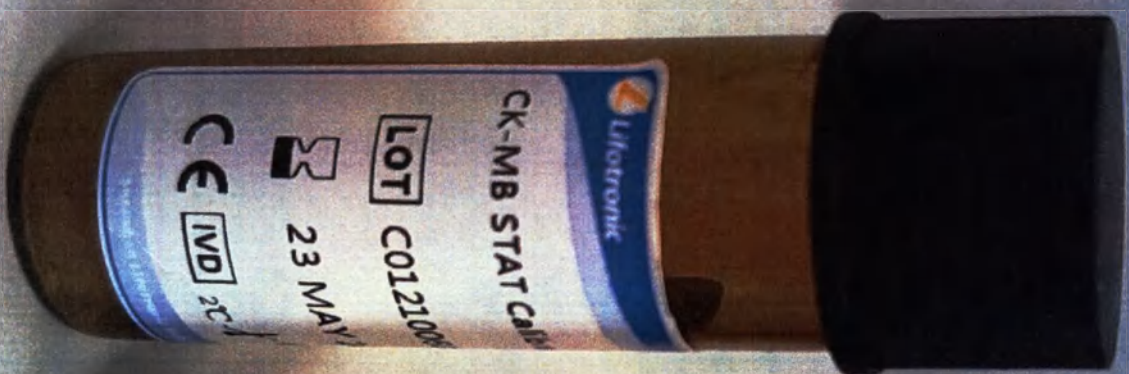



Калибратор (низкий и высокий уровень) (Набор реагентов для количественного определения креатинкиназы-MB электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для тестов in vitro (Creatine Kinase MB STAT eCLIA / CK-MB STAT), в варианте исполнения 50 тестов)

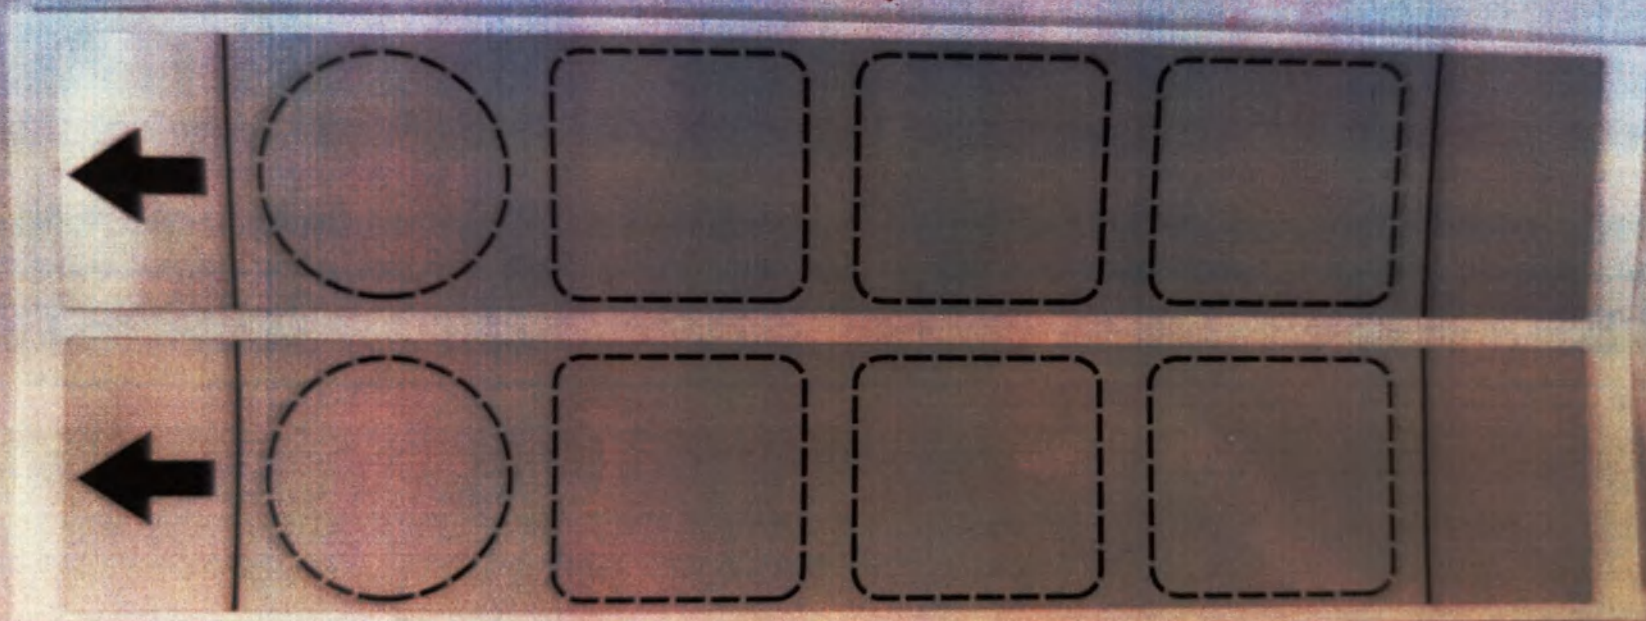



Creatine Kinase MB STAT eCLIA

CK-MB STAT

Components

MB 1.8 mL

RB 3.8 mL

RA 3.8 mL

LOT

C012100600

SN

00002



23 MAY 2022



CE

IVD

2°C 8°C

Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения креатинкиназы-MB электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Creatine Kinase MB STAT eCLIA / CK-MB STAT), в варианте исполнения 50 тестов)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 13 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А.
М.П.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАЙЛО Р. В.