

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»»

Носова Т.А.

«27» *сентября* 2022 г.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАЙЛО Р.В.

Фотографические изображения изделия:

**Набор реагентов для количественного определения интерлейкина-6
электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на
анализаторах ECL для диагностики in vitro (Interleukin-6 (Electrochemiluminescence
Immunoassay)/IL-6)**

Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.
(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай



IL-6 Control Material REFID
 REF: 1002100000 2022-04-28
 QC Range (Low): 31.00-59.24 pg/mL
 QC Range (High): 158.9-291.5 pg/mL
Lifotronic




Lifotronic
Instruction For Use
[Product Name]
 Interleukin-6 (Electrochemiluminescence Immunoassay)
[Order Information]

REF NO.	Package Size
689073	50T
689024	2x50T
689017	10T
689018	2x100T

[Intended Use]
 Immunoassay for in vitro quantitative determination of Interleukin-6 (IL-6) in human serum and plasma. This assay can be used to aid in the management of critically ill patients as an early indicator for acute inflammation.

[Summary]

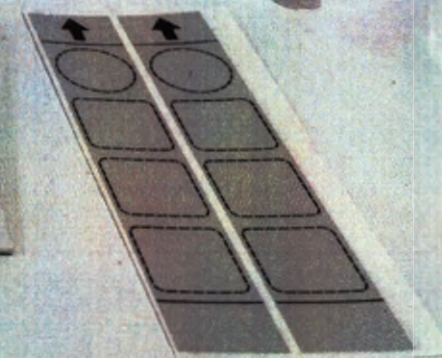

Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения интерлейкина-6 электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или




Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения интерлейкина-6 электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или




Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения интерлейкина-6 электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови




Калибратор (высокий уровень), Калибратор (низкий уровень), Материал контрольный (высокий уровень), Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU интерлейкина-6 электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Interleukin-6 (Electrochemiluminescence Immunoassay)/IL-6)

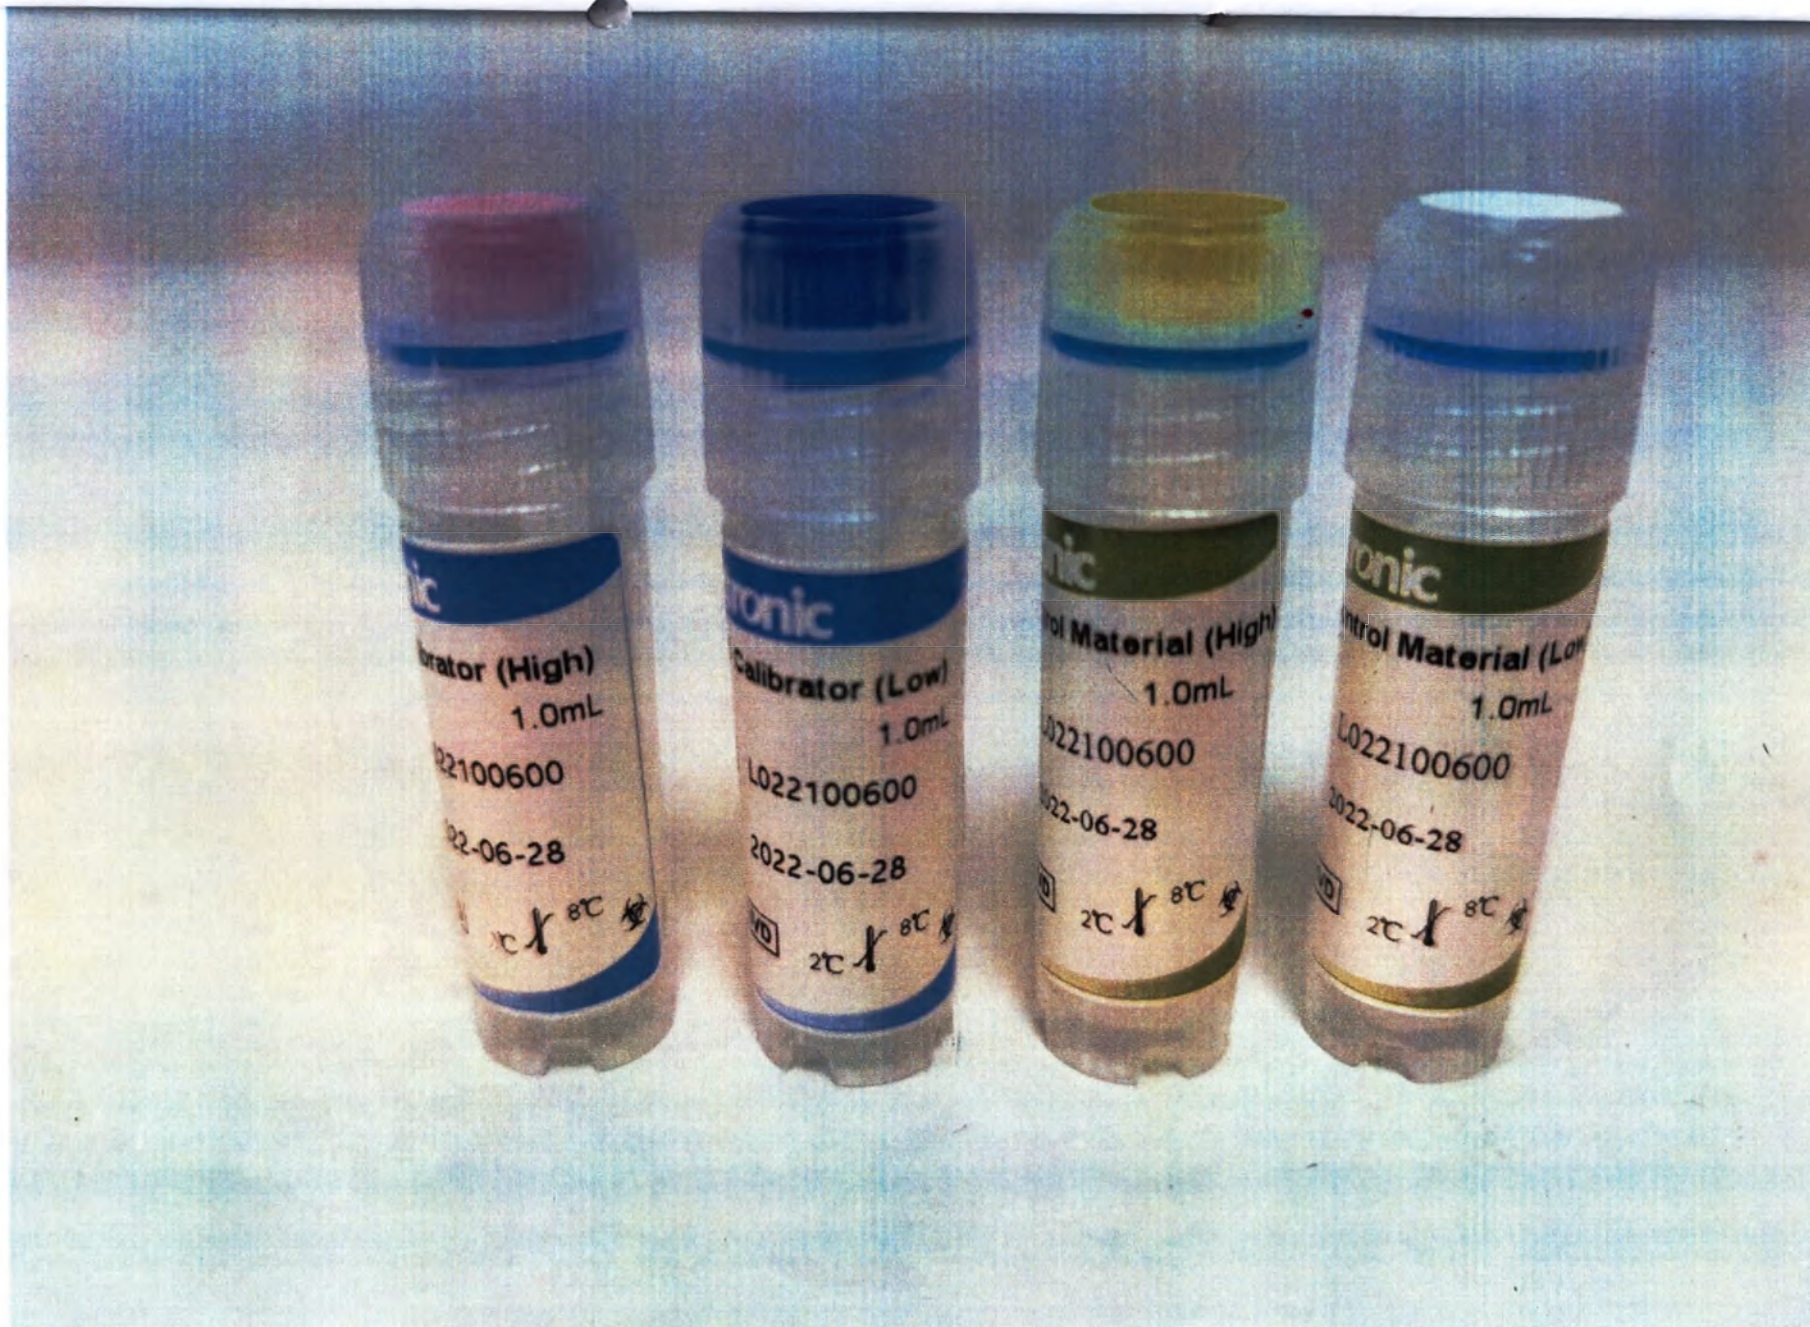

Калибратор (высокий уровень), Калибратор (низкий уровень), Материал контрольный (высокий уровень), Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов
ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU интерлейкина-6 электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для
диагностики in vitro (Interleukin-6 (Electrochemiluminescence Immunoassay)/IL-6)

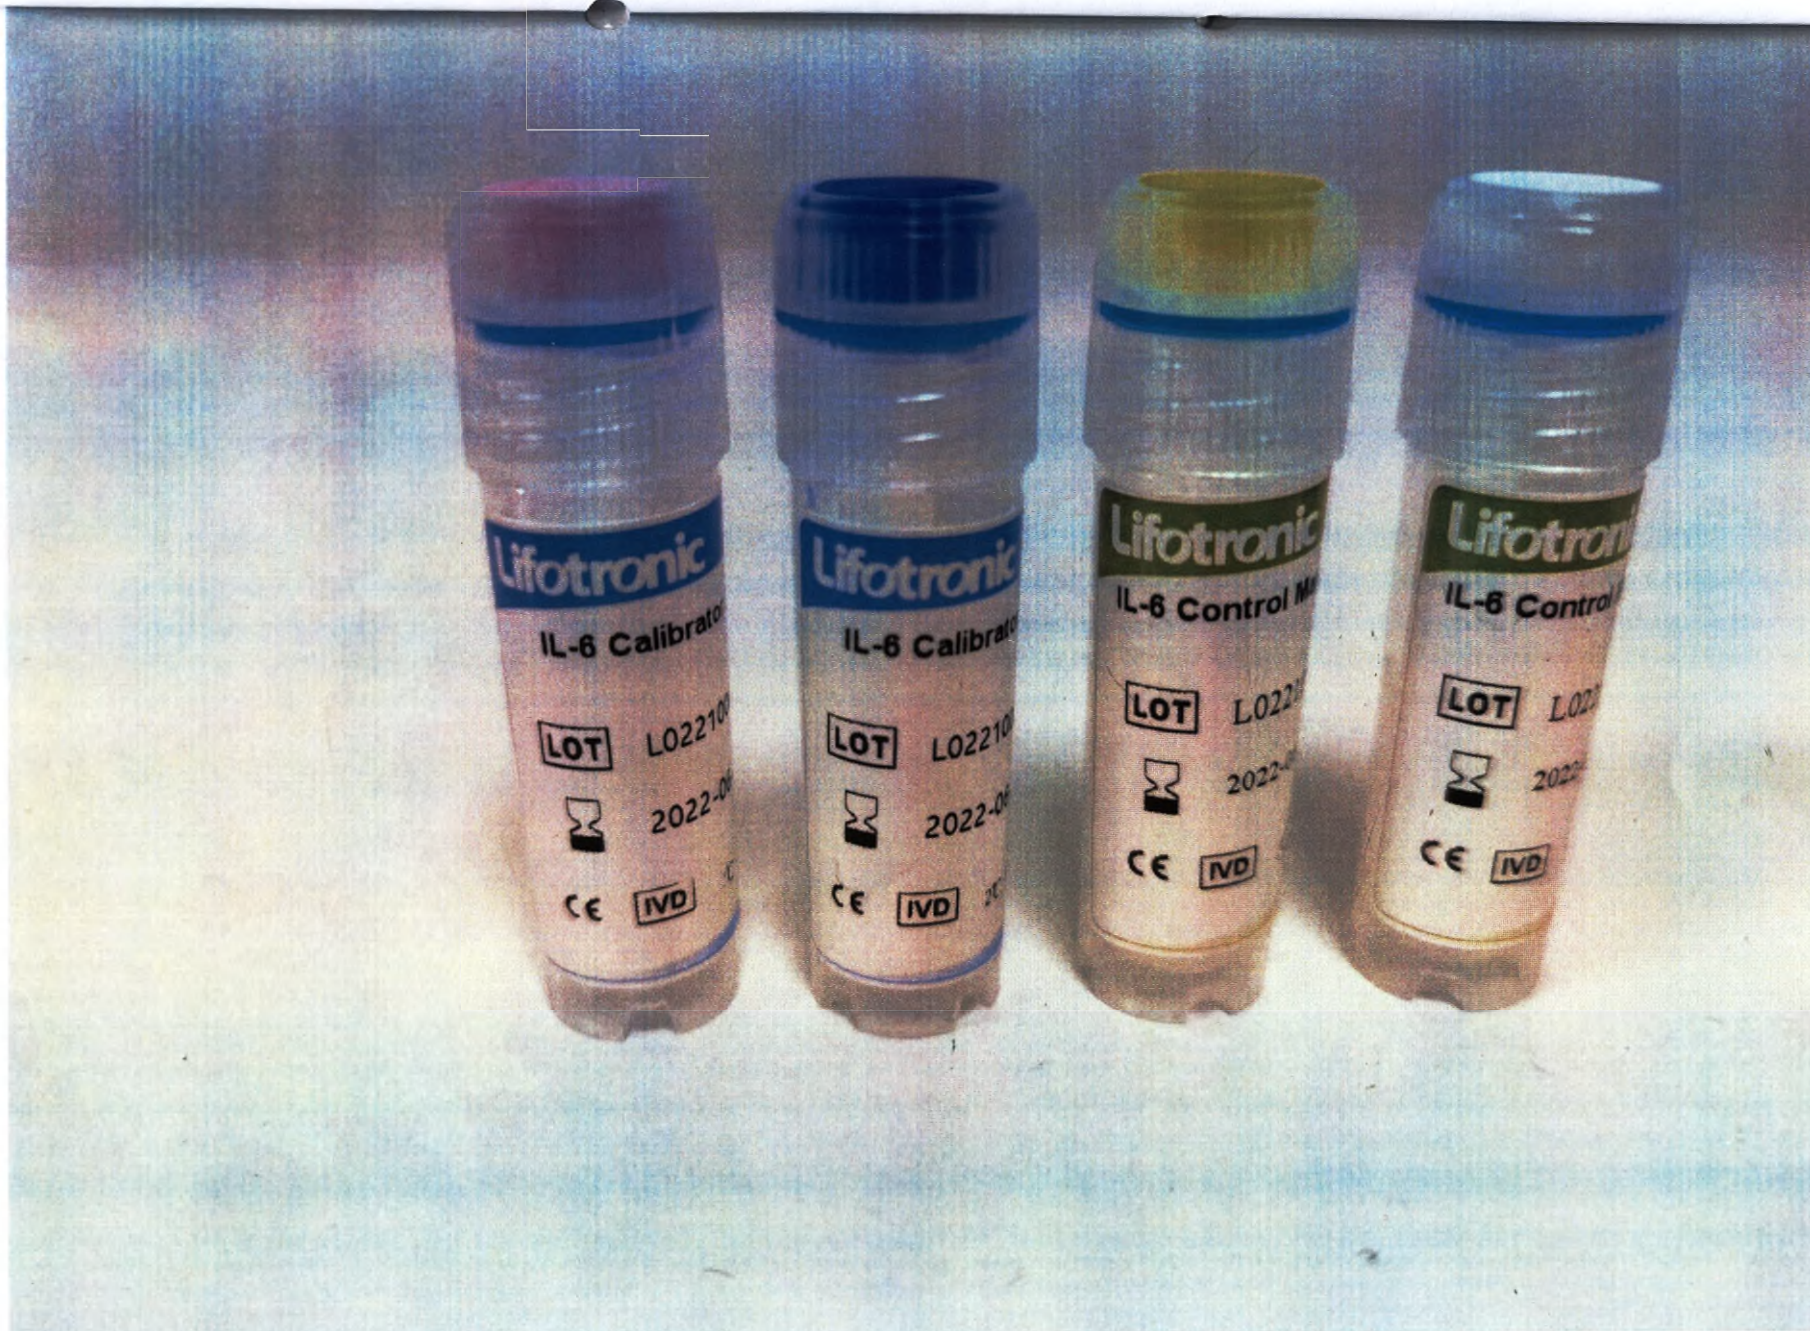

Калибратор (высокий уровень), Калибратор (низкий уровень), Материал контрольный (высокий уровень), Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU интерлейкина-6 электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Interleukin-6 (Electrochemiluminescence Immunoassay)/IL-6)

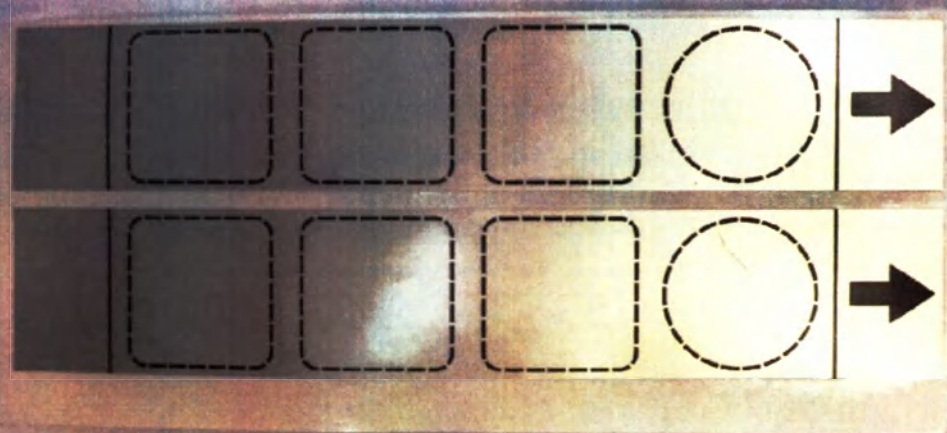

Этикетки для запечатывания флаконов (Набор реагентов для количественного определения интерлейкина-6 электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или
ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru а на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Interleukin-6 (Electrochemiluminescence Immunoassay)/IL-6)

IL-6 Control Material RFID

LOT L022100600  2022-06-28

QC Range (Low): 31.90-59.24 pg/mL

QC Range (High): 156.9-291.5 pg/mL

Lifotronic

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 2 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.



КУСАЙЛО Р.Б.