



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО "РадаМед"

Балуева И. Г.

«25» февраля 2022 г.
м.п.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

«Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375

Производства: ООО "РадаМед", Россия

SORBUS

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ

с коллоидным золотом

«Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS»
с коллоидным золотом для качественного иммунохромато-
графического выявления антигена вируса SARS-CoV-2
в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека»
Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375

мазок из носо-
и ротоглотки


Вторичная упаковка медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест

SORBUS

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ

с коллоидным золотом

Интерпретация результатов

Отрицательный результат	Положительный результат	Недействительный результат
		

мазок из носоглотки

Комплектация на 1 тест:

-
-
-
-

Вторичная упаковка медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест

«Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS»
с коллоидным золотом для качественного иммунохромато-
графического выявления антигена вируса SARS-CoV-2
в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека»
Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375
Для профессионального использования
Не замораживать

SORBUS
ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
с коллоидным золотом


Вторичная упаковка медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест

Получатель: ООО «Цирми»
 Медицинское изделие, предназначенное
 для использования в качестве экспресс-тестов
 для выявления антител к SARS-CoV-2 в
 слюне и мазках из носоглотки человека.
 Сер. 511220, 511000, 504318, 444331, 401375
 Код 511220, 511000, 504318, 444331, 401375




SORBUS
 Медицинское изделие, предназначенное
 для использования в качестве экспресс-тестов
 для выявления антител к SARS-CoV-2 в
 слюне и мазках из носоглотки человека.
 Сер. 511220, 511000, 504318, 444331, 401375
 Код 511220, 511000, 504318, 444331, 401375



Вторичная упаковка медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
 Серия №511220. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест

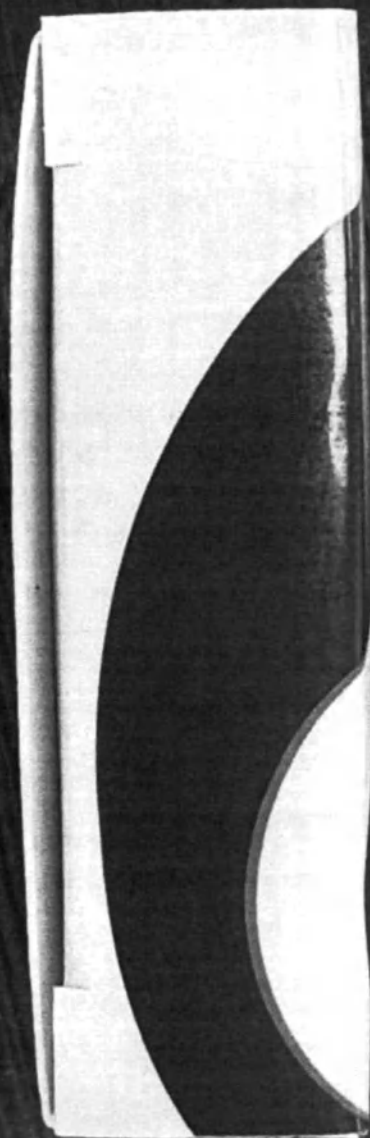

Вторичная упаковка медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест

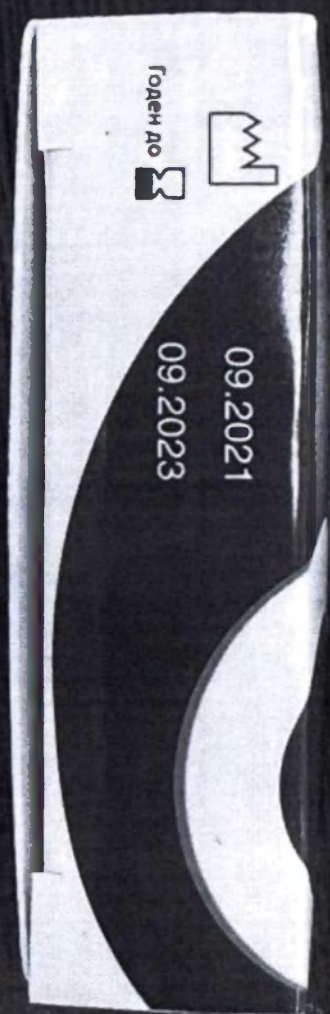

Вторичная упаковка медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-IHA SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест

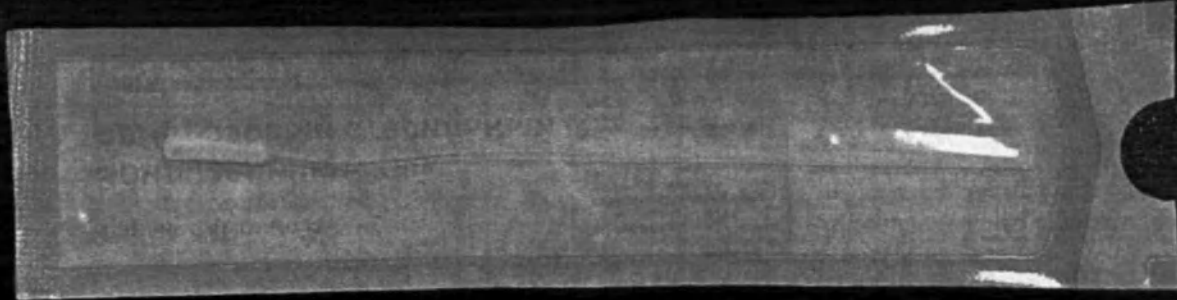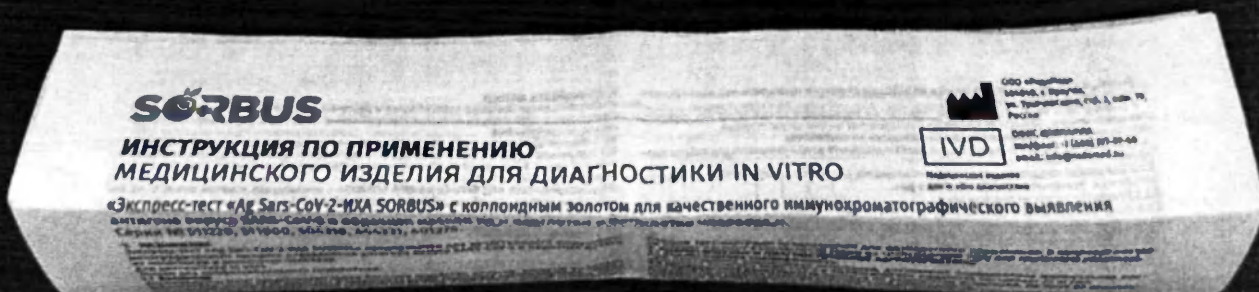

Вторичная упаковка и компоненты медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №511220. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест

ФармМедПолис

Зонд медицинский одноразовый стерильный

ТУ 32.50.13-002-28731857-2020

STERILE EO

Производитель:

ООО «ФАРММЕДПОЛИС РТ»
420017, Республика Татарстан,
Ленинский район, село Болдыня
Кабаны, Восточная улица, 1,
Кластер «В».

Номер и дата регистрации:


РЗН 2021/13989 от 12.04.2021

LOT 02/2021



04/2021

04/2026

гггг



Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Вариант исполнения Комплектация на 1 тест - Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020, РУ №РЗН 2021/13989.

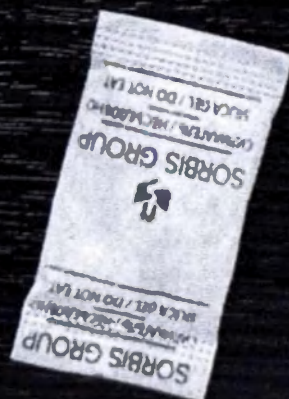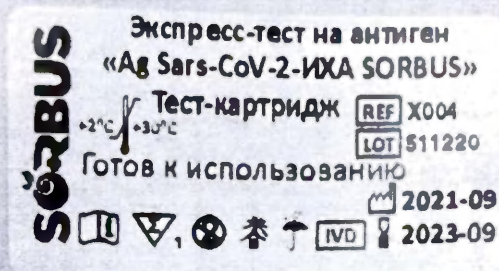

Тест-картридж и его первичная упаковка в медицинском изделии «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №511220. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест – тест-картридж.



Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №511220. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест – Буфер



Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-IHA SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №511220. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест – Буфер





SORBUS

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ

С КОЛЛОИДНЫМ ЗОЛОТОМ

COVID-19
НА АНТИГЕН
МАЗОК ИЗ НОСО-
И РОТОГЛОТКИ

«Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS»
с коллоидным золотом для качественного иммунохромато-
графического выявления антигена вируса SARS-CoV-2
в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека»
Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375

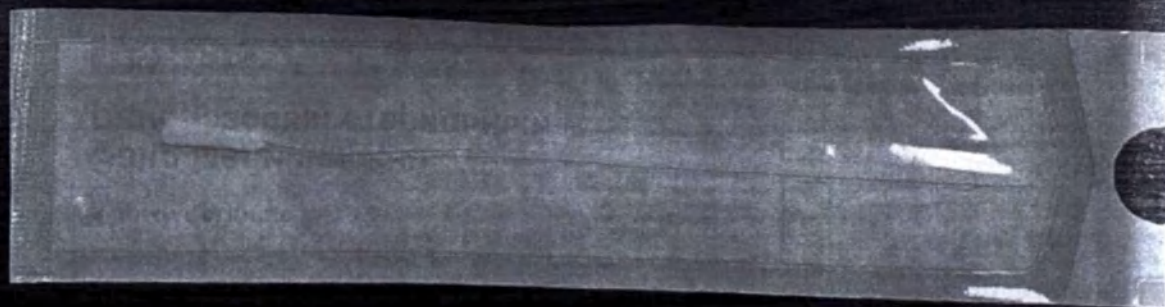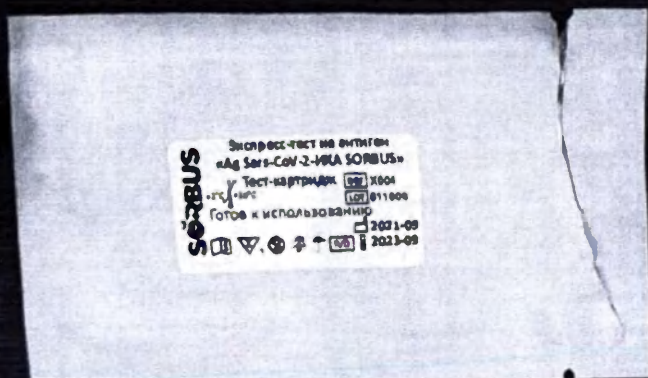

Исходная упаковка и компоненты медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №511000. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест

ФармМедПолис

Зонд медицинский одноразовый стерильный

Производитель:
ООО «ФАРММЕДПОЛИС РТ»,
420017, Республика Татарстан,
Ленинский район, село Большие
Камены, Выставочная улица, 1,
Клuster «В».

Номер и дата регистрационного
удостоверения:
РЗН 2021/13989 от 12.04.2021

LOT

02/2021

04/2021

04/2026

1^{го} пос

IVD



DO NOT USE AFTER EXPIRATION DATE - ДО НЕ ПОСЛЕ ДАТЫ ИСХОДА

TY 32.50.13-002-28731857-2020

STERILE EO

Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.


Вариант исполнения Комплектация на 1 тест – Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020, РУ №РЗН 2021/13989.

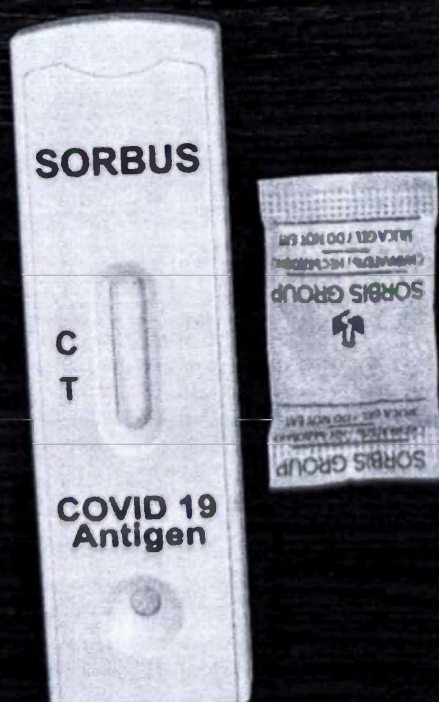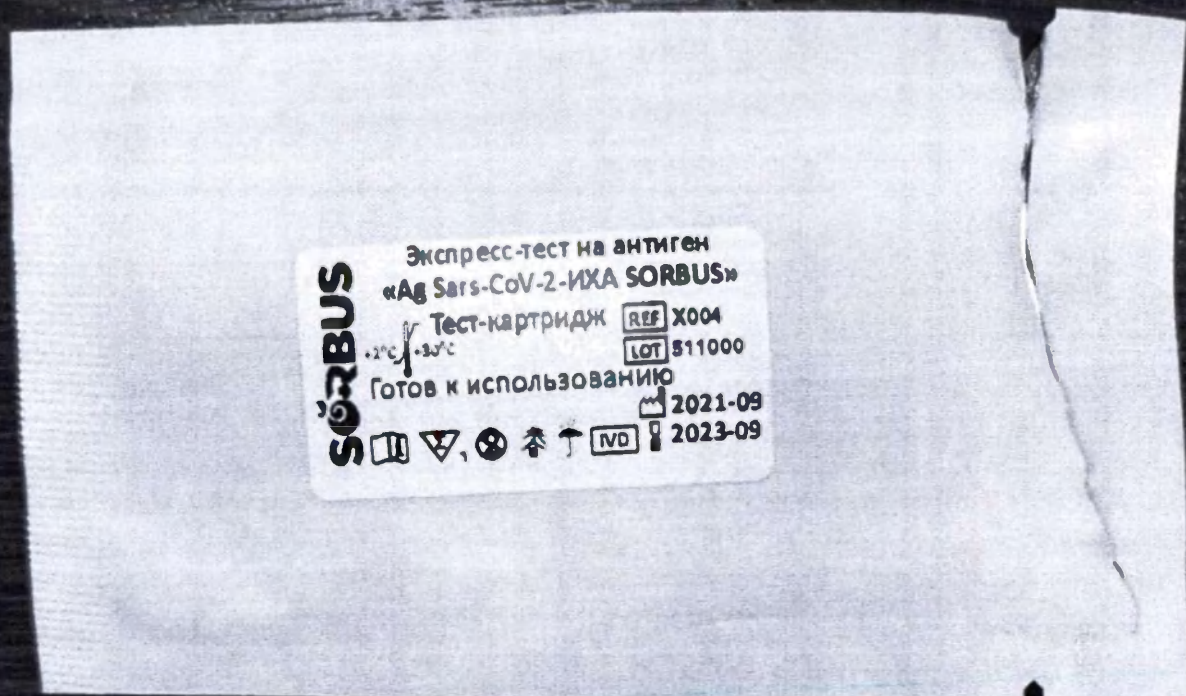




Тест-картридж и его первичная упаковка в медицинском изделии «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №511000. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест – тест-картридж.



Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №511000. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест – Буфер

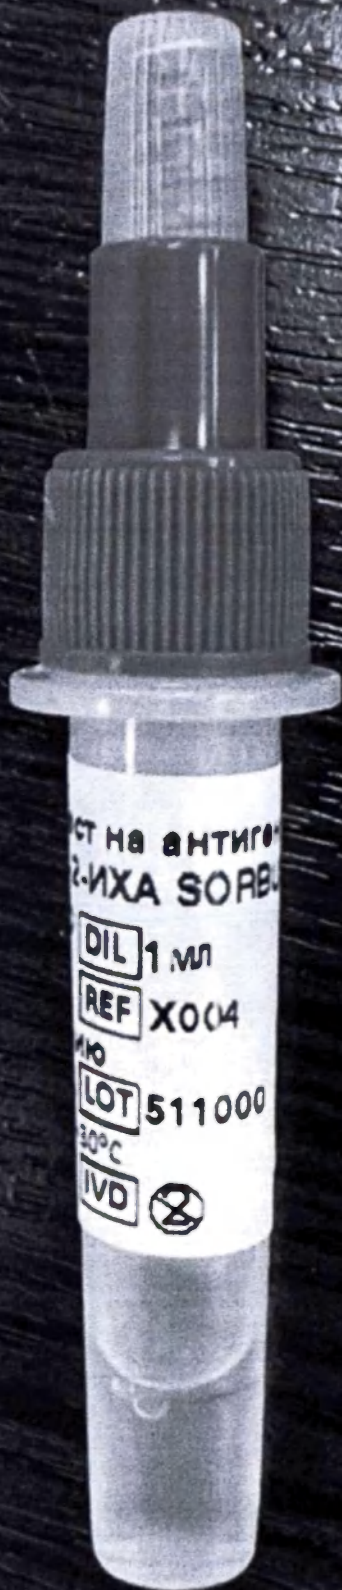

Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-IgA SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №511000. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест – Буфер

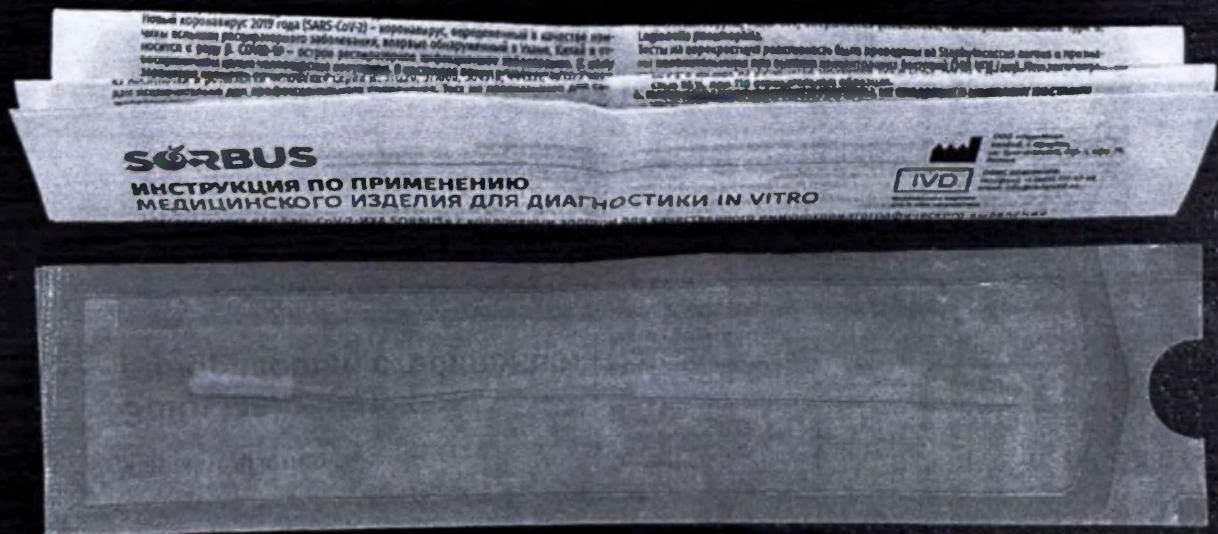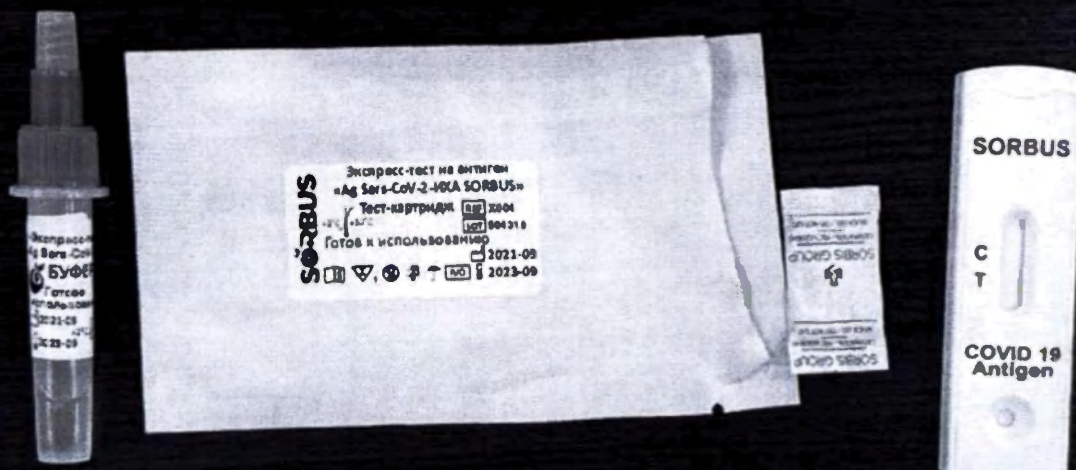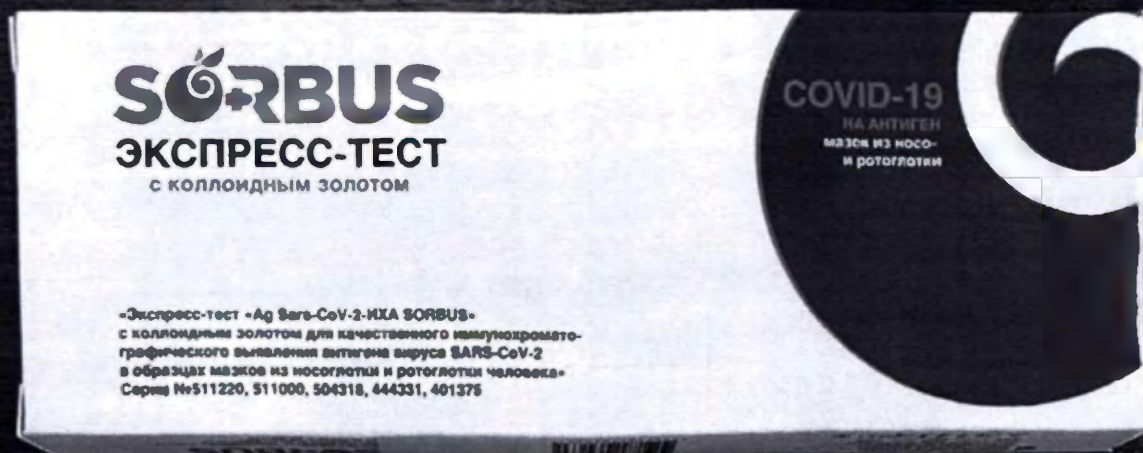

Вторичная упаковка и компоненты медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №504318. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест

ФармМедПолис

Зонд медицинский одноразовый стерильный

ТУ 32.50.13-002-28731857-2020

STERILE EO

Производитель:
ООО «ФАРММЕДПОЛИС РТ»
420017, Республика Татарстан,
Ленинский район, село Большие
Кабаны, Восточная улица, 1,
Кластер «В».

Номер и дата регистрационного
удостоверения:
РЗН 2021/13989 от 12.04.2021

LOT 02/2021
M 04/2021
S 04/2026





ИСКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

DO NOT USE AFTER EXPIRATION DATE • DO NOT USE AFTER USE


Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.

Вариант исполнения Комплектация на 1 тест – Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020, РУ №РЗН 2021/13989.


SORBUS Экспресс-тест на антиген
 «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS»
 Тест-картридж REF X004
 LOT 504318
 Готов к использованию
 2021-09
 2023-09

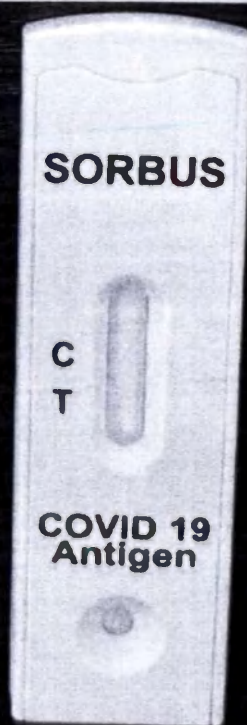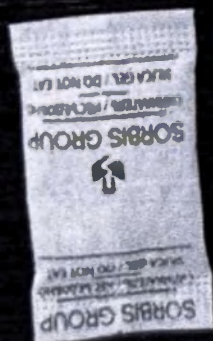

Тест-картридж и его первичная упаковка в медицинском изделии «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
 Серия №504318. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест – тест-картридж.

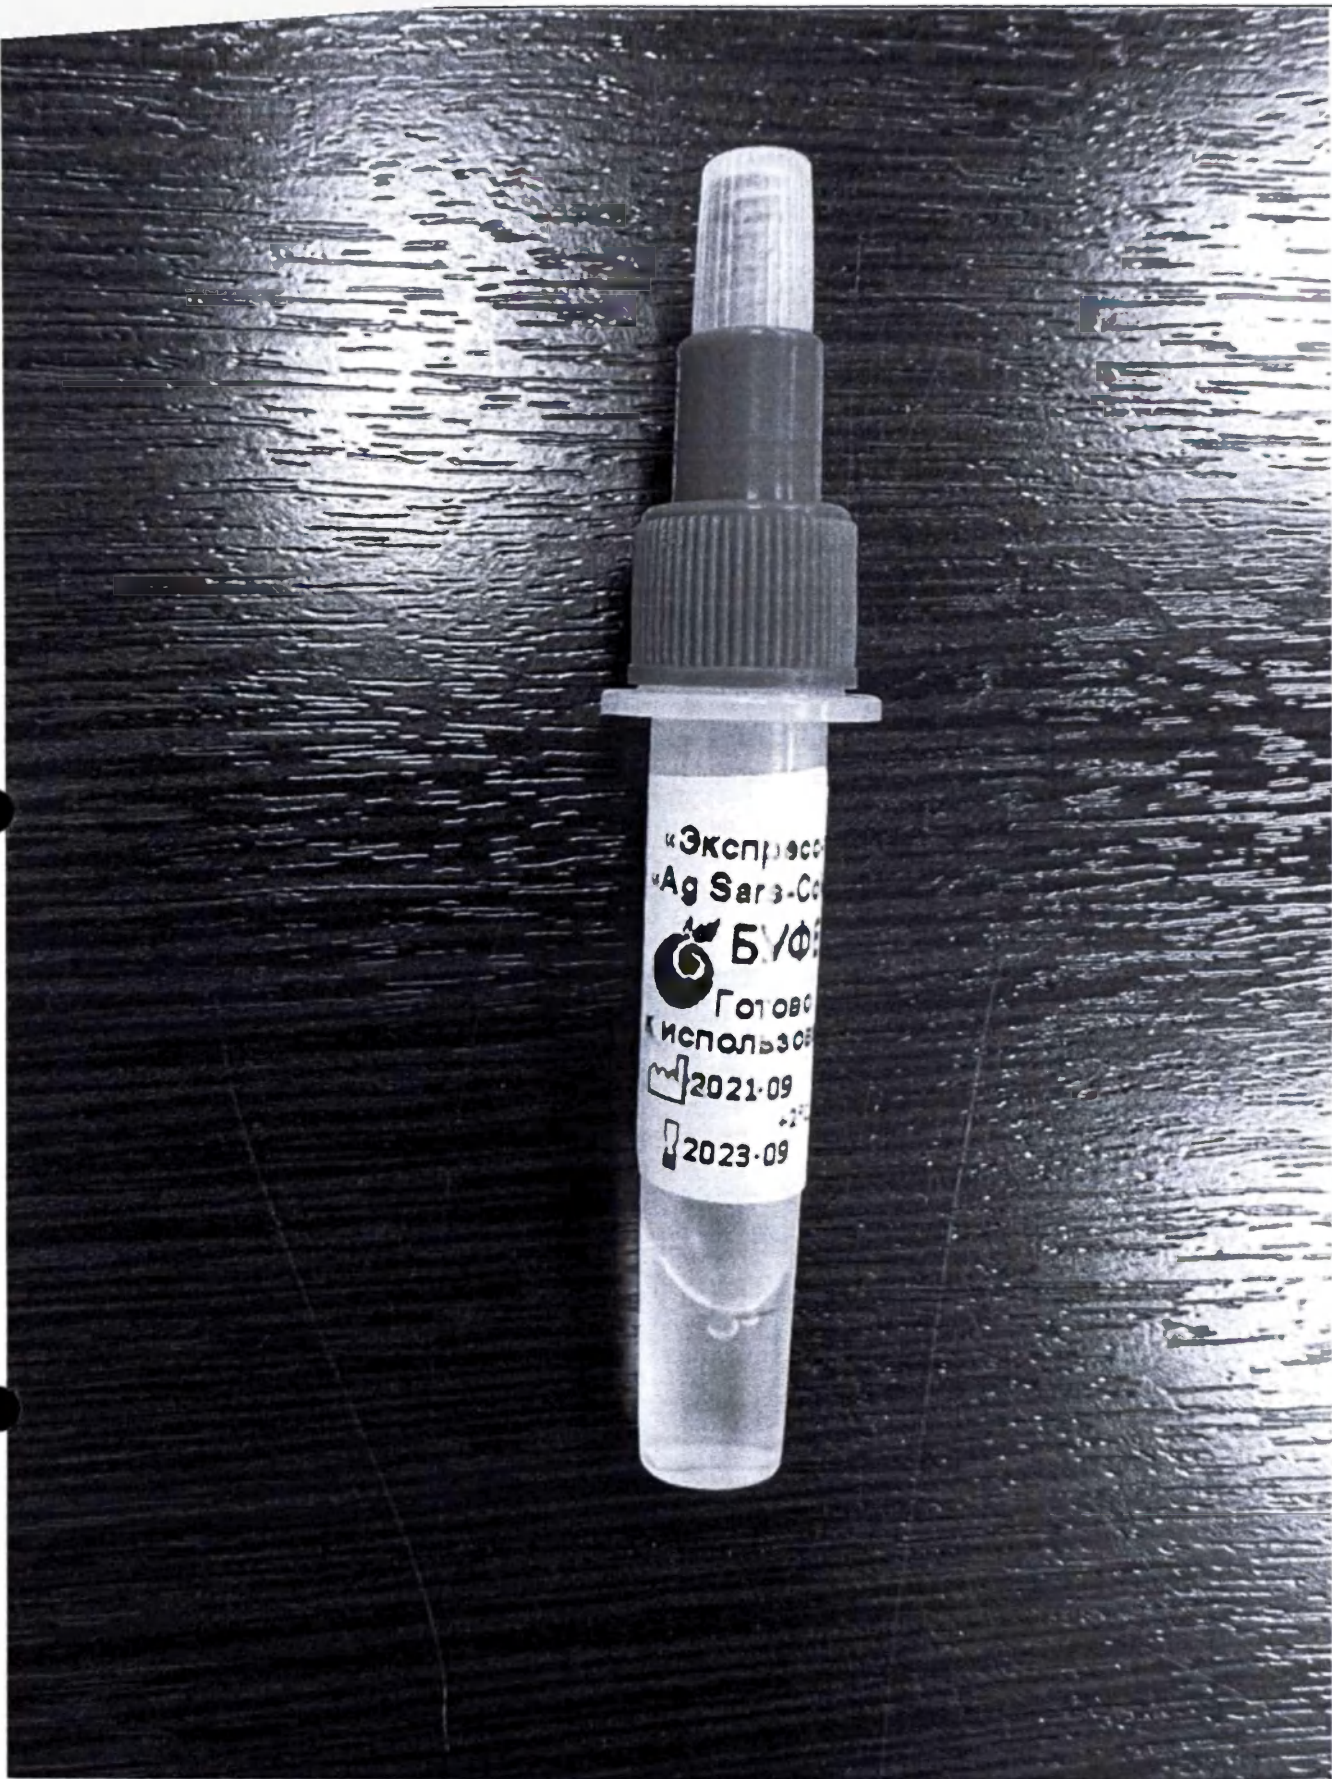

Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №504318. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест – Буфер

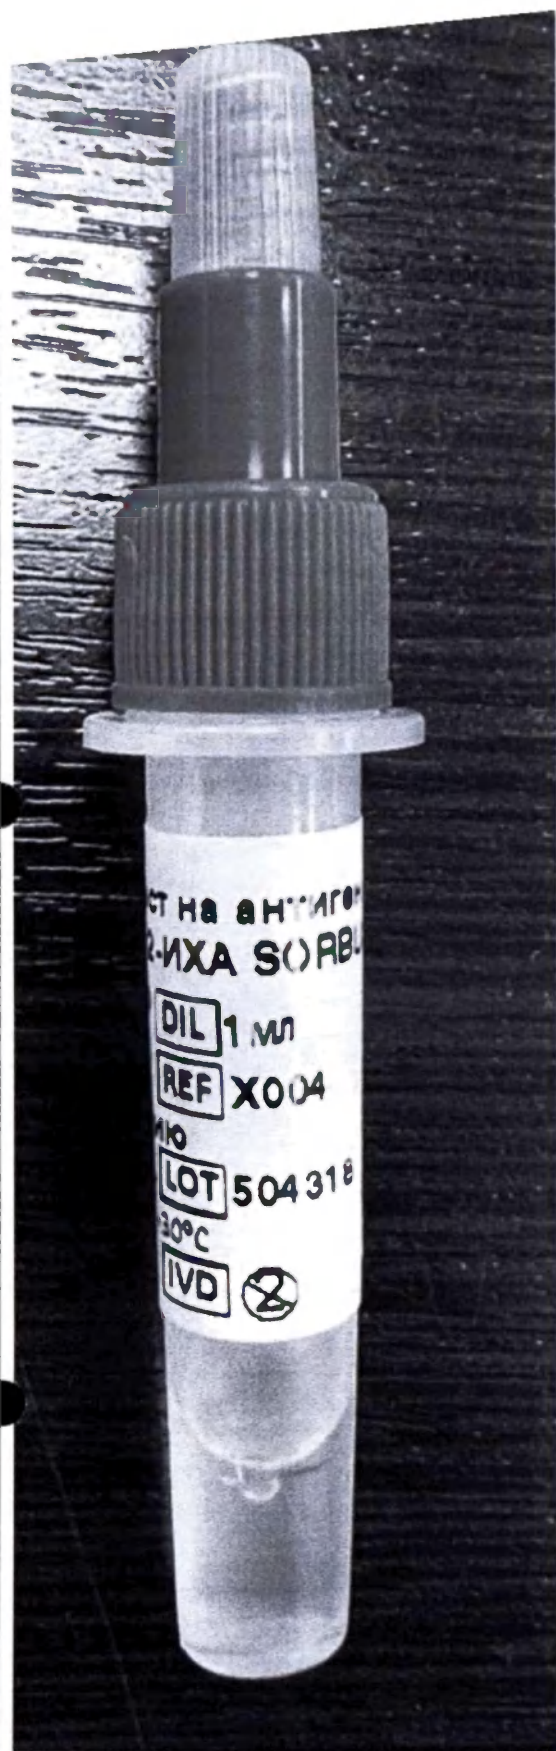

Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №504318. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест – Буфер




SORBUS

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ

с коллоидным золотом

COVID-19
НА АНТИГЕН
МАЗОК ИЗ НОСО-
И РОТОГЛОТКИ

«Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека»
Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375

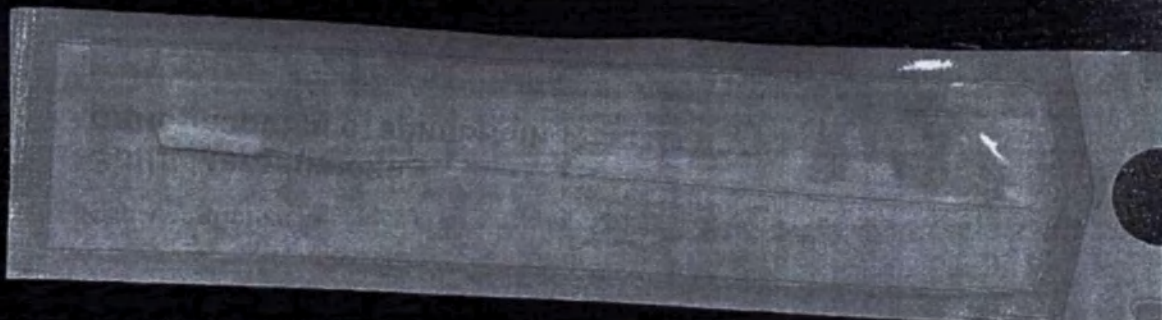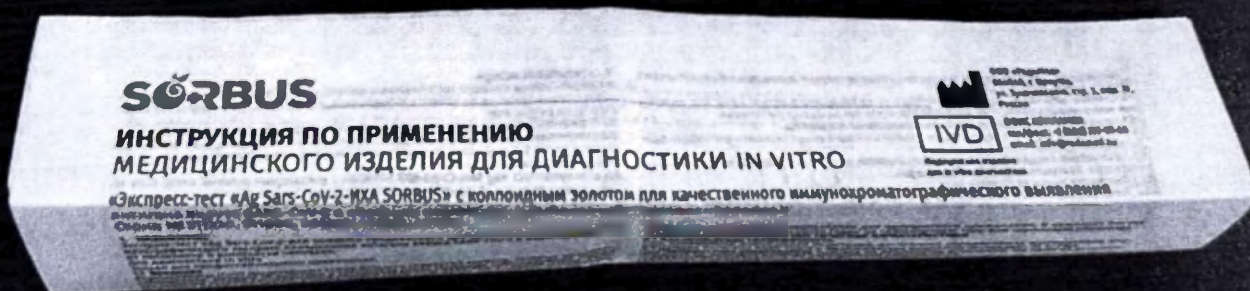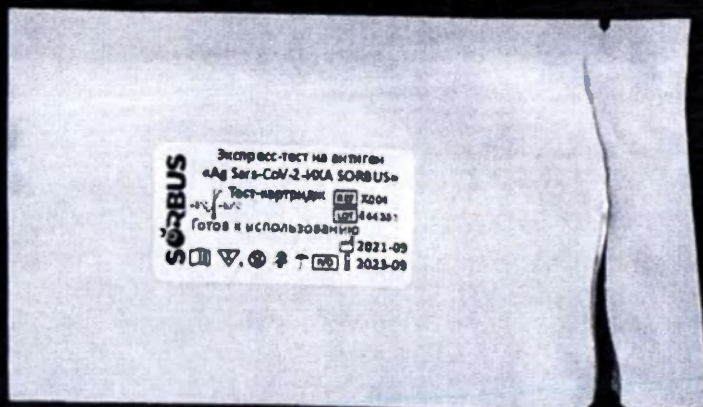

Вторичная упаковка и компоненты медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №444331. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест

ФармМедПолис

Зонд медицинский одноразовый стерильный

ТУ 32.50.13-002-28731857-2020

STERILE

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ • DO NOT USE AFTER EXPIRATION DATE • DISPOSE OF AFTER USE

Производитель:
ООО «ФАРММЕДПОЛИС РТ»
420017, Республика Татарстан,
Ленинский район, село Болыше
Кабаны, Выставочная улица, 1,
Кластер «В».


Номер и дата регистрационного
удостоверения:
РЗН 2021/13989 от 12.04.2021

LOT 02/2021

04/2021

04/2026

37°C



IVD

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



1

1


1

Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.


Вариант исполнения Комплектация на 1 тест – Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020, РУ №РЗН 2021/13989.

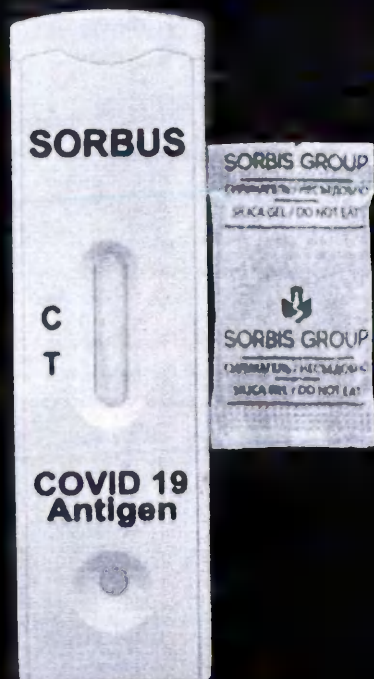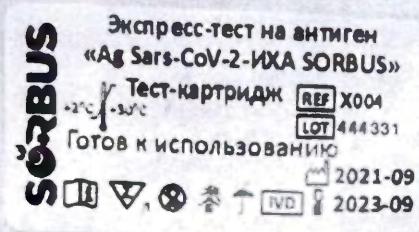

Тест-картридж и его первичная упаковка в медицинском изделии «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №444331. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест – тест-картридж.

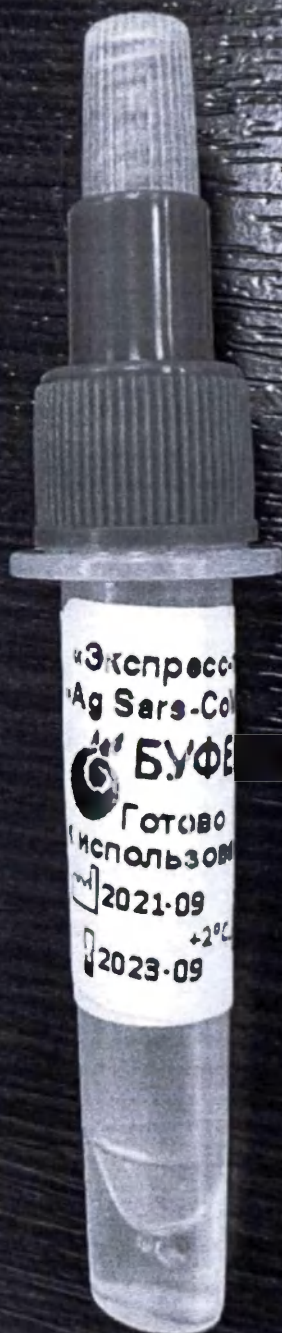

Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №444331. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест – Буфер

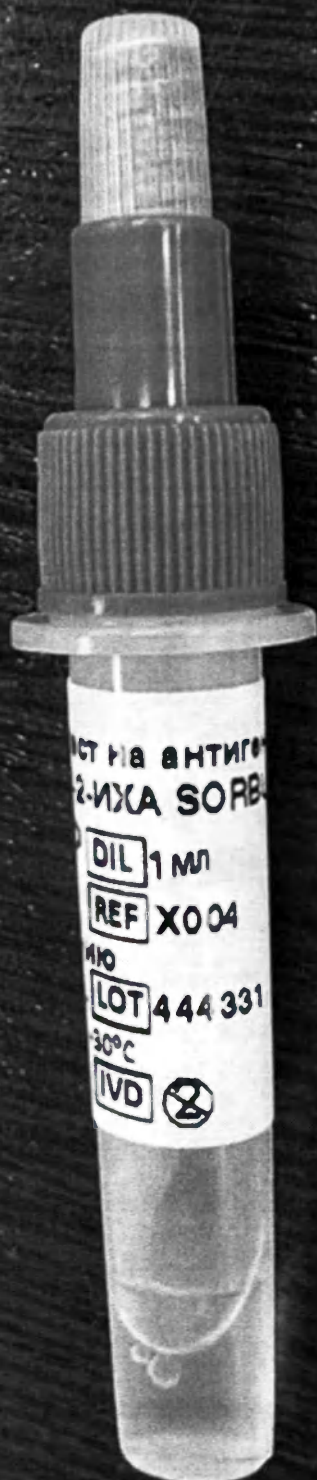

Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №444331. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест – Буфер

SORBUS

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ

с коллоидным золотом

COVID-19
НА АНТИГЕН
МАЗОК ИЗ НОСО-
И РОТОГЛОТКИ

«Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS»
с коллоидным золотом для качественного иммунохромато-
графического выявления антигена вируса SARS-CoV-2
в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека»
Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375




SORBUS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

«Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления

IVD

ООО «Цирми»
г. Иркутск, ул. Кирова, 1
ИНН 47-01-00001
ОГРН 1044701000011
Сайт: info@circmi.ru

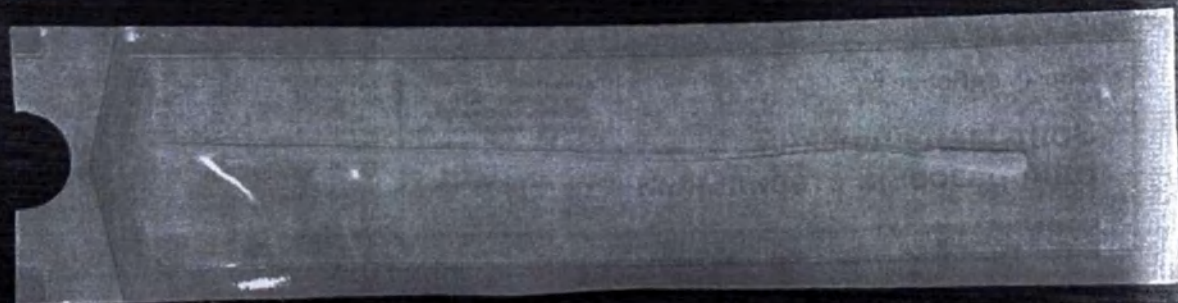

Внешняя упаковка и компоненты медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №401375. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест

ФармМедПолис

Зонд медицинский одноразовый стерильный

Производитель:
ООО «ФАРММЕДПОЛИС РТ»
420017, Республика Татарстан,
Ленинский район, село Большие
Казаны, Выставочная улица, 1,
Кластер «В».

Номер и дата регистрационного
удостоверения:
РЗН 2021/13989 от 12.04.2021

LOT 02/2021

04/2021

04/2026



IVD



НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ • УТИЛИЗИРОВАТЬ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ • DO NOT USE AFTER EXPIRATION DATE • DISPOSE OF AFTER USE

STERILE EO


ТУ 32.50.13-002-28731857-2020

Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Вариант исполнения Комплектация на 1 тест – Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020, РУ №РЗН 2021/13989.


SORBUS Экспресс-тест на антиген
 «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS»
 Тест-картридж REF X004
 -15°C -30°C LOT 401378
 Готов к использованию
 2021-09 2023-09







Тест-картридж и его первичная упаковка в медицинском изделии «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №401375. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест – тест-картридж.

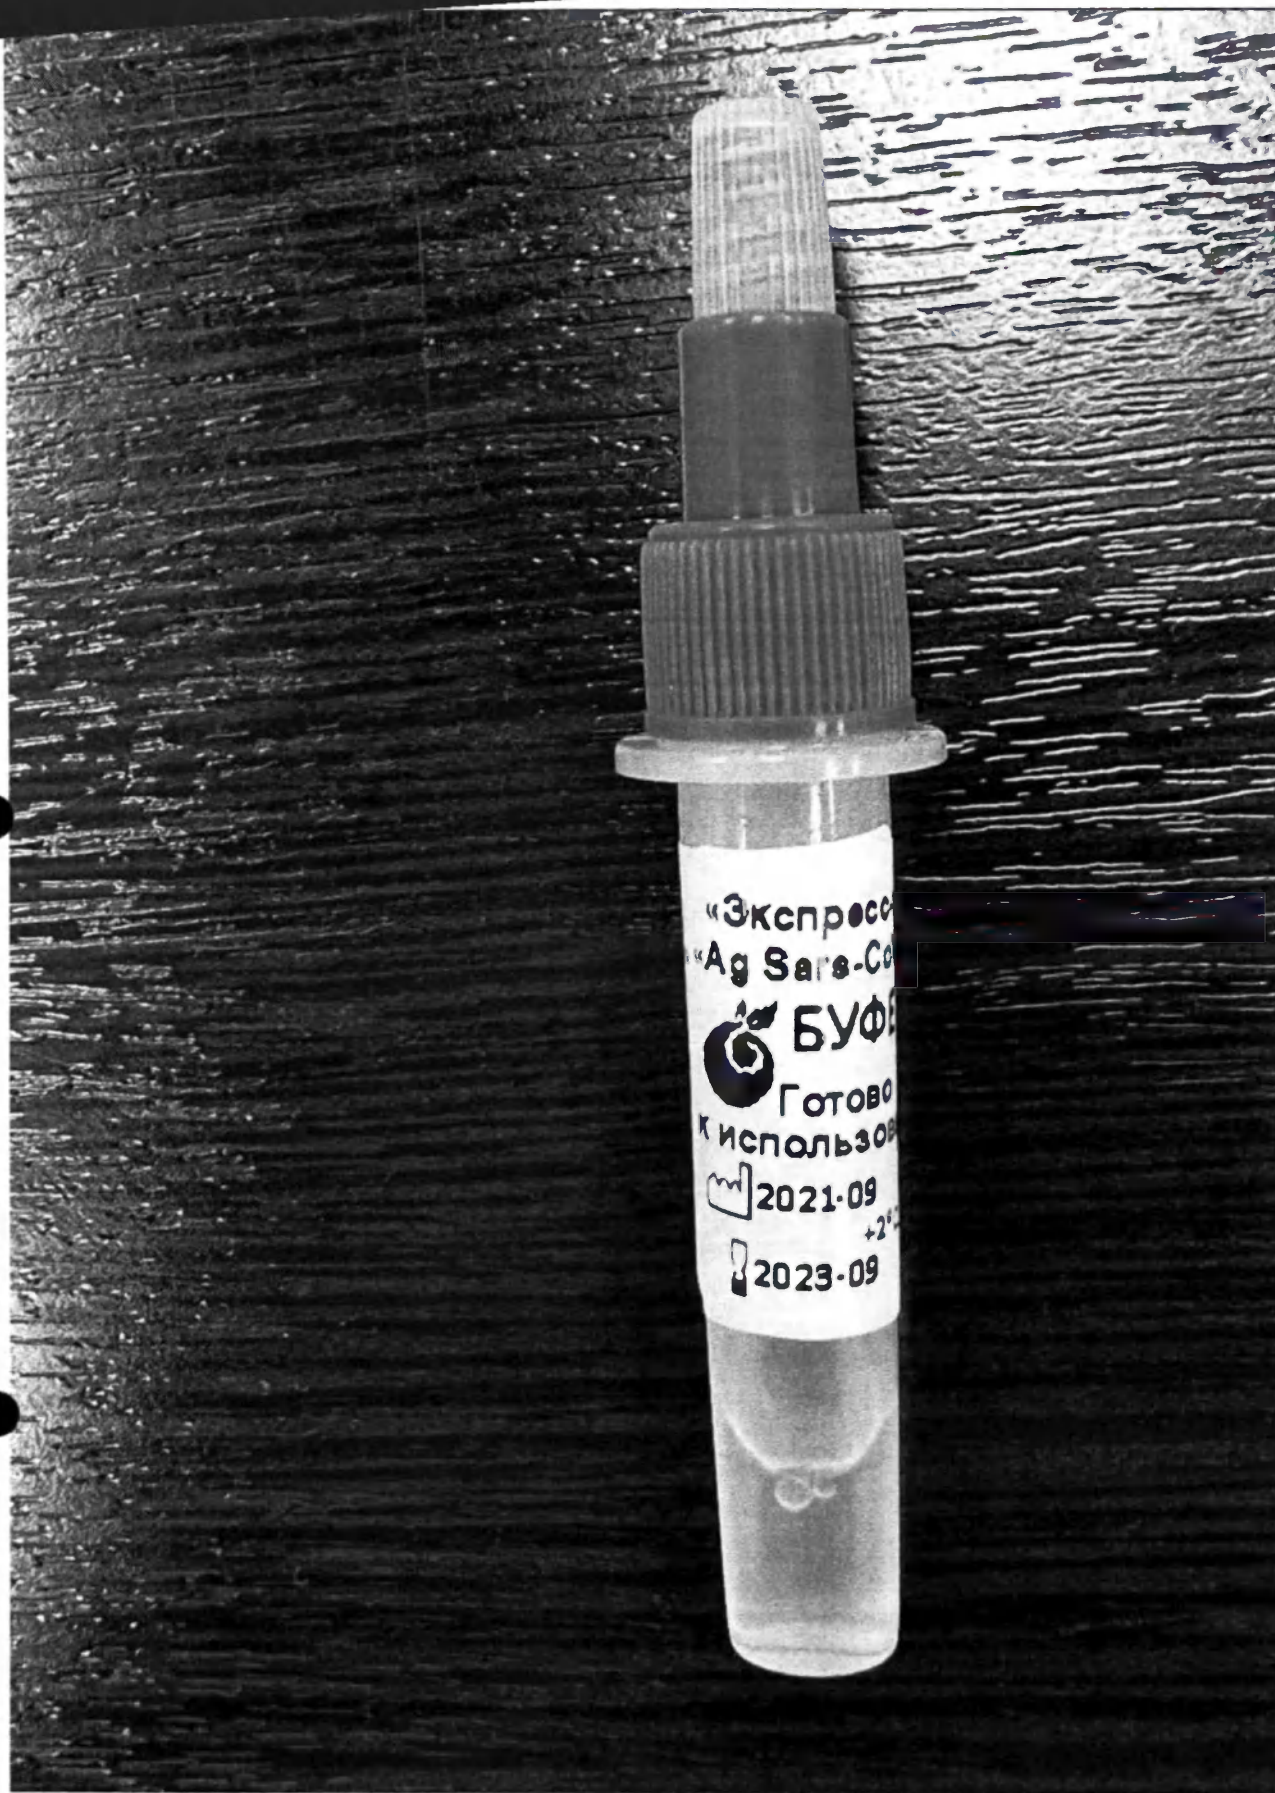

Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №401375. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест – Буфер

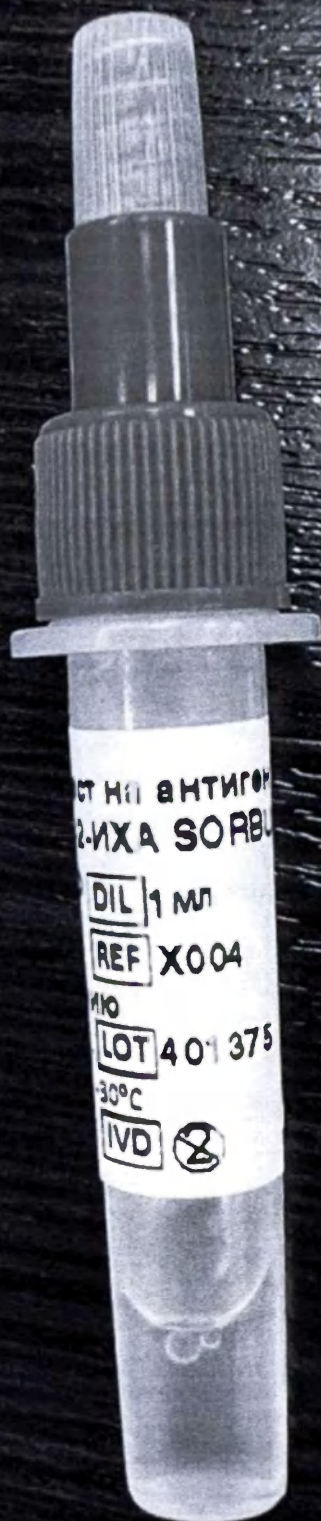

Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №401375. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест – Буфер

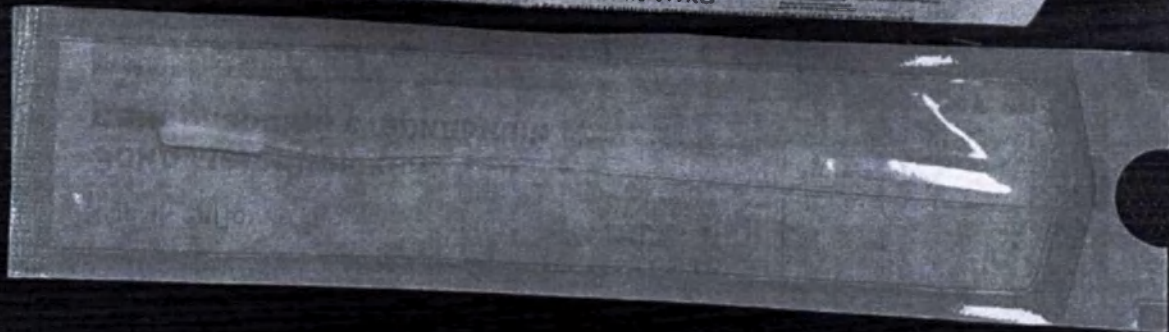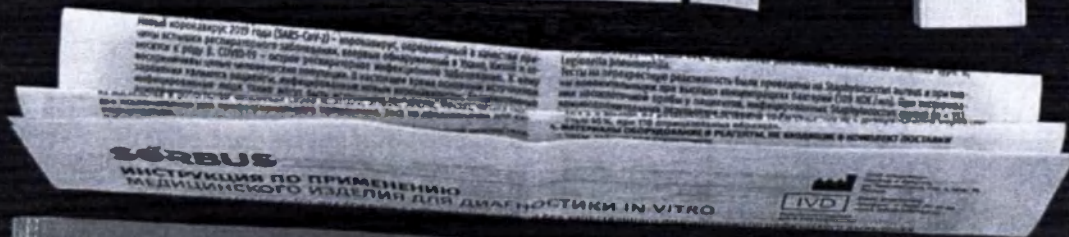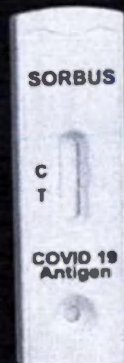

Вторичная упаковка и компоненты медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия № 511220. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест в фольгированном пакете

ФармМедПолис

Зонд медицинский одноразовый стерильный

Производитель:
ООО «ФАРММЕДПОЛИС РТ»
420017, Республика Татарстан,
Ленинский район, село Болыше
Кабыны, Выставочная улица, 1,
Кластер «В».

Номер и дата регистрационного
удостоверения:
РЗН 2021/13989 от 12.04.2021



LOT


02/2021

04/2021

04/2026

IVD

IVD




НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО истечении срока годности - УТИЛИЗОВАТЬ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - DO NOT USE AFTER EXPIRATION DATE - DISPOSE OF AFTER USE

ТУ 32.50.13-002-28731857-2020

STERILE

Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Вариант исполнения Комплектация на 1 тест в фольгированном пакете – Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020, РУ №РЗН 2021/13989.


SORBUS Экспресс-тест на антиген
 «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS»
 Тест-картридж REF X008
 LOT 511220
 Готов к использованию
 2021-09
 2023-09

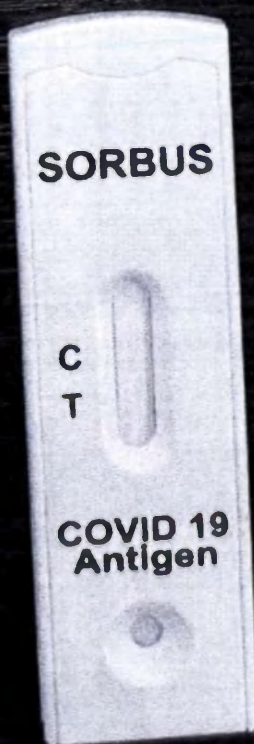

Тест-картридж и его первичная упаковка в медицинском изделии «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
 Серия № 511220. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест в фольгированном пакете – тест-картридж.






Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №511220. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест в фольгированном пакете – Буфер

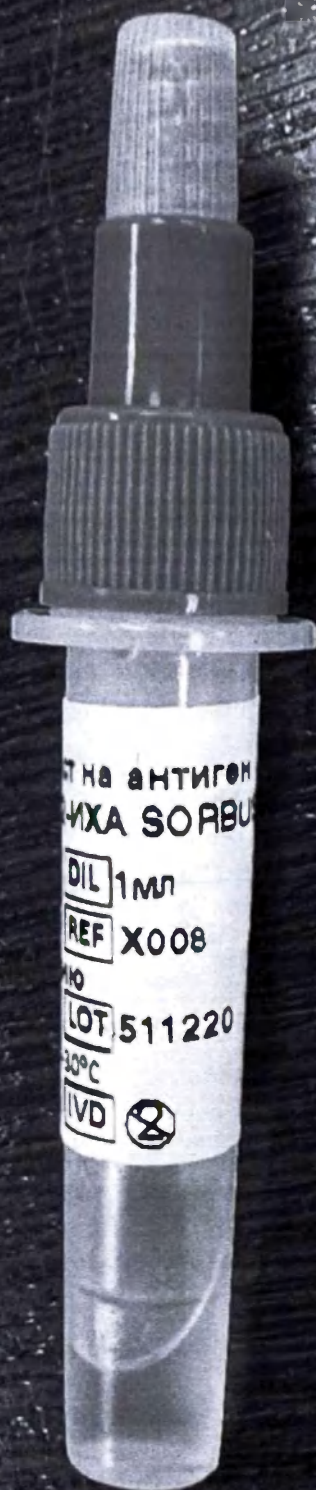

Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.

Серия №511220. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест в фольгированном пакете – Буфер

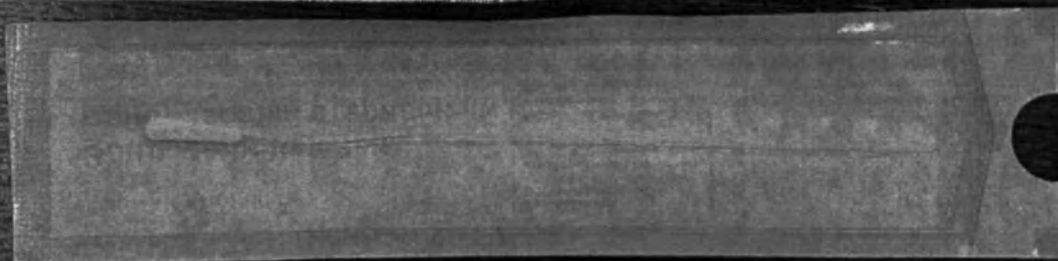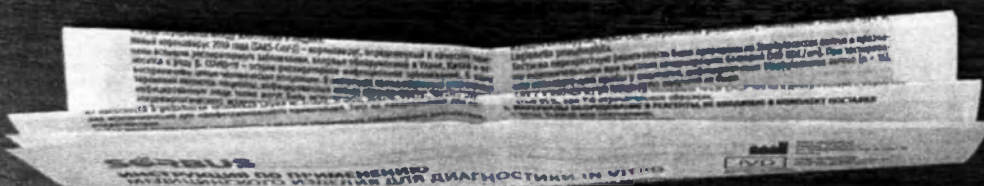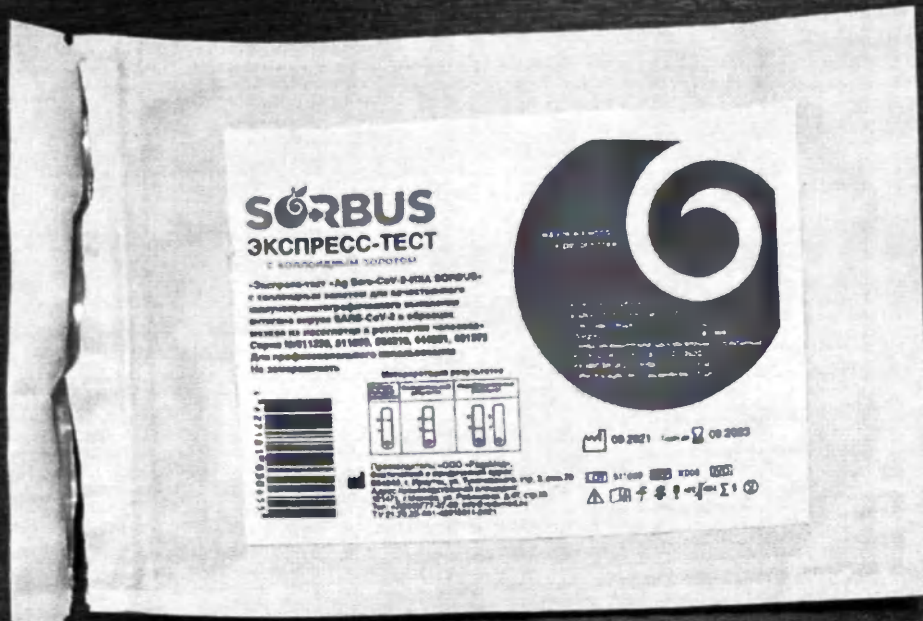

Вторичная упаковка и компоненты медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия № 511000. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест в фольгированном пакете

ФармМедПолис®

Зонд медицинский одноразовый стерильный

Производитель:
ООО «ФАРММЕДПОЛИС РТ»
420017, Республика Татарстан,
Ленинский район, село Большая
Кабана, Выставочная улица, 1.


Номер и дата регистрационного
удостоверения:
РЗН 2021/13989 от 12.04.2021

LOT 02/2021

04/2021

04/2026

36°C




ТУ 32.50.13-002-28731857-2020

STERILE EO

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Вариант исполнения Комплектация на 1 тест в фольгированном пакете – Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020, РУ №РЗН 2021/13989.


SORBUS Экспресс-тест на антиген
«Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS»
Тест-картридж **REF** X008
LOT 511000
Готов к использованию
2021-09
2023-09

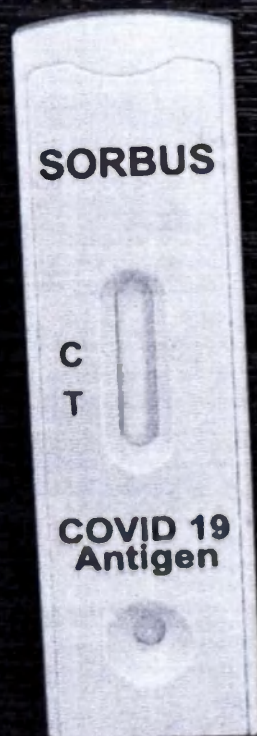

Тест-картридж и его первичная упаковка в медицинском изделии «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия № 511000. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест в фольгированном пакете – тест-картридж.



Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №511000. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест в фольгированном пакете – Буфер

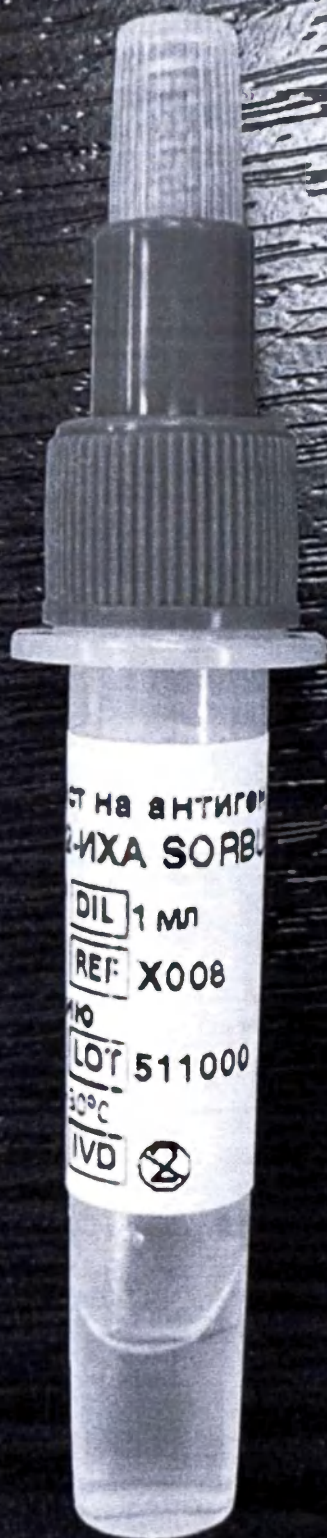


Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №511000. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест в фольгированном пакете – Буфер

SORBUS ЭКСПРЕСС-ТЕСТ

с коллоидным золотом


«Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах слюны из носоглотки и ротоглотки человека»
Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375
Для профессионального использования
Не закрывать




Примечание: «ООО «Цирми»
Фабричный и серийный номер
Рязань, г. Рязань, ул. Тургеневская, стр. 3, пом. 79
31401, Ульяновск, район Заволжье
Тел: +7(800)77-01-00, info@circmi.ru
TV RUS35-095-0090371-001

09.2021 год изд 09.2023

401375 000 X000 1000
⚠️ ⚠️ ⚠️ ⚠️ ⚠️ ⚠️ ⚠️ ⚠️ ⚠️ ⚠️



Экспресс-тест на антиген
«Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS»
Тест-кассеты (000) 2000
Серия №511220, 511000, 504318, 444331, 401375
Готов к использованию
3021-00
2023-00

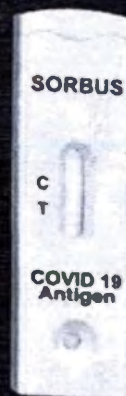

Новый коронавирус 2019 года (SARS-CoV-2) - возбудитель, обнаруженный в качестве патогена человека при исследовании заболеваний, которые развиваются в легких, носоглотке и желудочно-кишечном тракте. Вирус распространяется воздушно-капельным путем, а также при контакте с инфицированными поверхностями. В целях профилактики рекомендуется соблюдать меры личной гигиены, избегать скопления людей и использовать средства индивидуальной защиты.

Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах слюны из носоглотки и ротоглотки человека. Тест на антиген вируса SARS-CoV-2.

SORBUS
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Вторичная упаковка и компоненты медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах слюны из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №401375. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест в фольгированном пакете

ФармМедПолис

Зонд медицинский одноразовый стерильный

Производитель:
ООО «ФАРММЕДПОЛИС РТ»
420017, Республика Татарстан,
Ленинский район, село Большие
Кабаны, Выставочная улица, 1,
Кластер «В».

Номер и дата регистрационного
удостоверения:
РЗН 2021/13989 от 12.04.2021

LOT

02/2021

04/2021

04/2026



DO NOT USE AFTER EXPIRATION DATE • DISPOSE OF AFTER USE


STERILE EO

ТУ 32.50.13-002-28731857-2020

РУ №РЗН 2021/13989

ВСКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ


Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Вариант исполнения Комплектация на 1 тест в фольгированном пакете – Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020, РУ №РЗН 2021/13989.

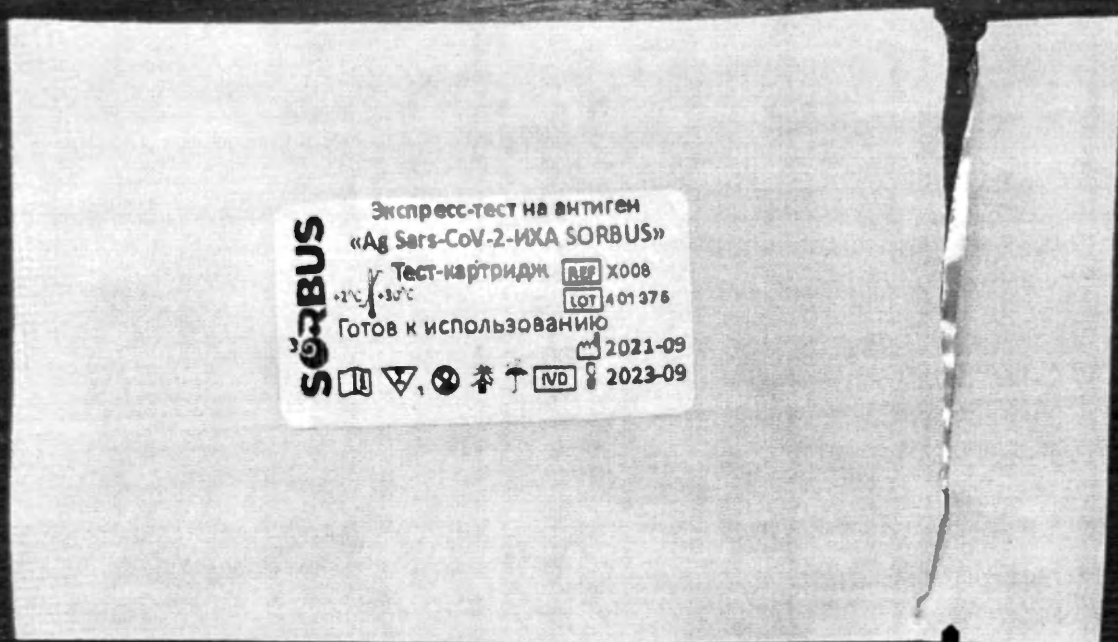

Тест-картридж и его первичная упаковка в медицинском изделии «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №401375. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест в фольгированном пакете – тест-картридж.





Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №401375. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест в фольгированном пакете – Буфер

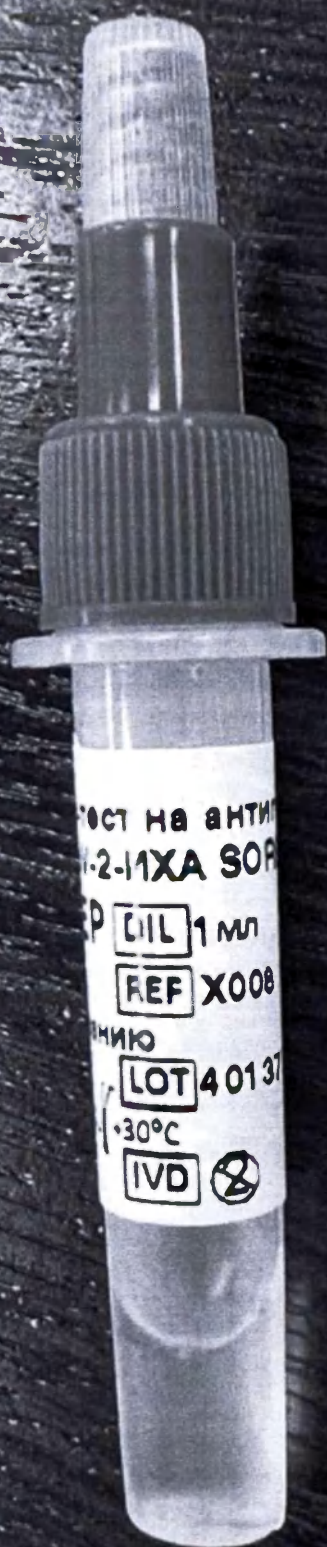

Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.

Серия №401375. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест в фольгированном пакете – Буфер


444331 22 WORK 1710
A 101 4 3 9 1-1-10

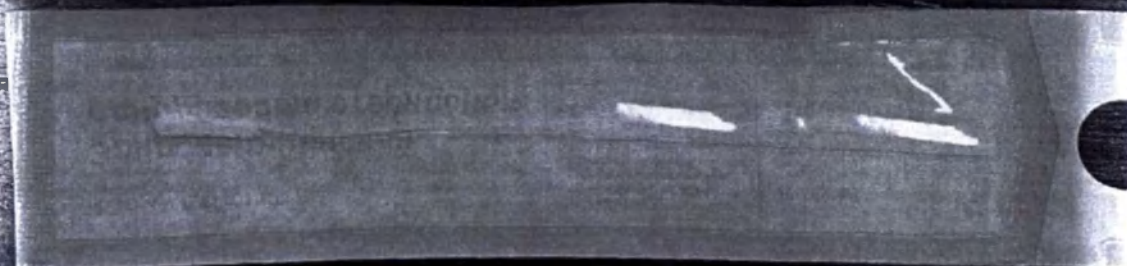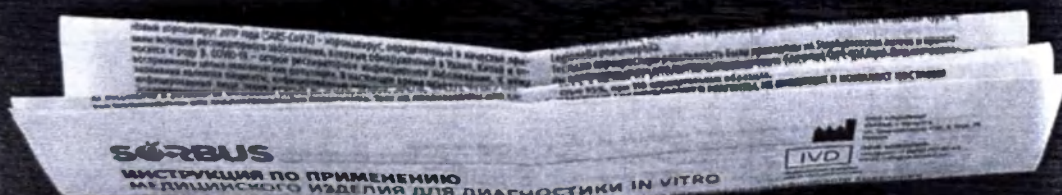

 **ООО ЦИПМИ**  **INFO@CIRMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**



Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-IgA SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
 Вариант исполнения Комплектация на 1 тест в фольгированном пакете - Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020, РУ №РН 2021/13989.

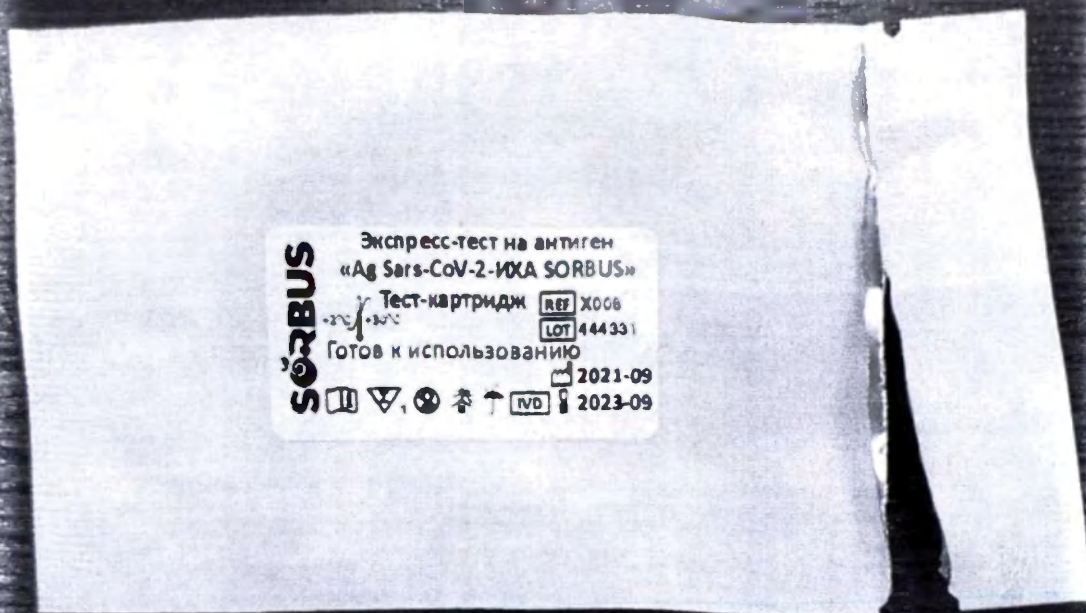

Тест-картридж и его первичная упаковка в медицинском изделии «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в мазках мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №444331. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест в фольгированном пакете – тест-картридж.



Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №444331. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест в фольгированном пакете – Буфер



тест на антиген
SARS-CoV-2-ИХА SORBUS

DIL 1 мл

REF X008

ИЮ


LOT 444331

-30°C

IVD



Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия № 444331. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест в фольгированном пакете – Буфер

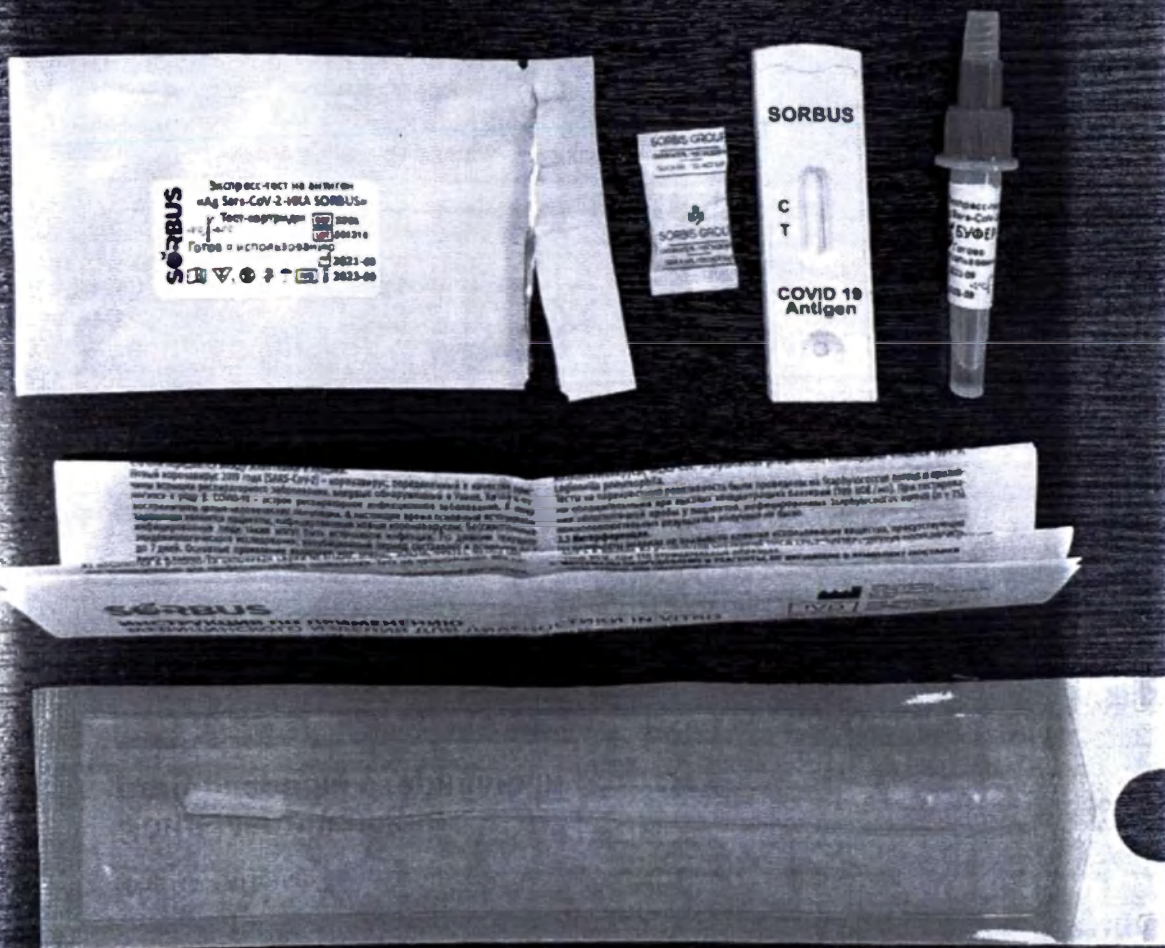

Вторичная упаковка и компоненты медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS»» предназначены для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах слюны и ротоглотки человека. Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серии №504318. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест в фольгированном пакете

ФармМедПолис

Зонд медицинский одноразовый стерильный

ТУ 32.50.13-002-28731857-2020

STERILE

Производитель:

ООО «ФАРММЕДПОЛИС РТ»
420017, Республика Татарстан,
Ленинский район, село Большое
Кабань, Выставочная улица, 1,
Кластер «В».

Номер и дата регистрационного

удостоверения:

РЗН 2021/13989 от 12.04.2021

LOT

02/2021

M

04/2021

S

04/2026

40°C

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

⊗

DO NOT USE AFTER EXPIRATION DATE - EXP. DATE OF ART. USE

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ГОДНОСТИ - УПРЕЖДЕЖЕНИЕ

STERILE


ТУ 32.50.13-002-28731857-2020

РЗН 2021/13989 от 12.04.2021

000 ЦИРМИ

Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.

Вариант исполнения Комплектация на 1 тест в фольгированном пакете – Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020, РУ №РЗН 2021/13989.

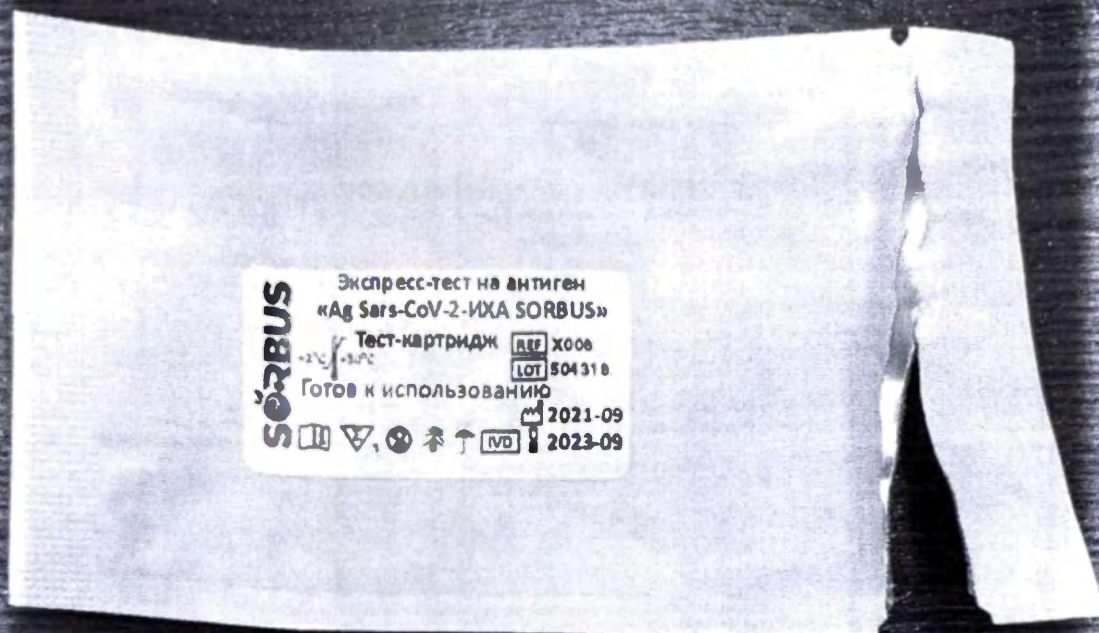

SORBUS
 Экспресс-тест на антиген
 «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS»
 Тест-картридж REF X008
 LOT 504318
 Готов к использованию
 2021-09
 2023-09




Тест-картридж и его первичная упаковка в медицинском изделии «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.

Серия №504318. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест в фольгированном пакете – тест-картридж.




Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-IgA SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №504318. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест в фольгированном пакете – Буфер

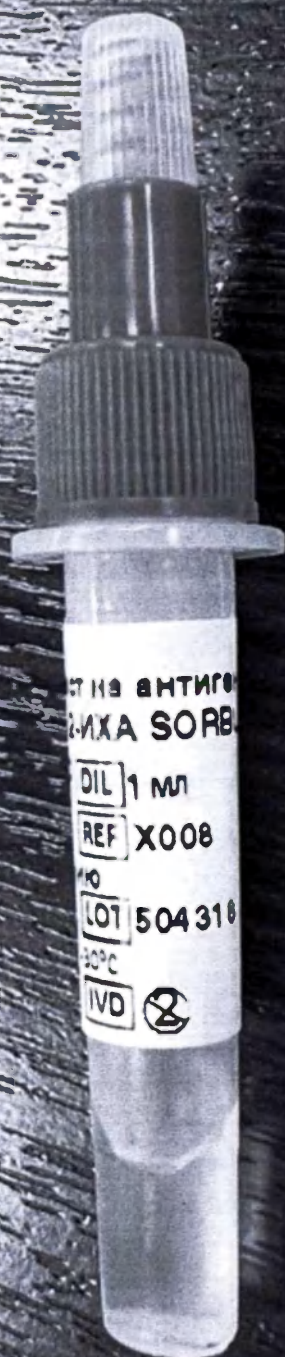


Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №504318. Вариант исполнения Комплектация на 1 тест в фольгированном пакете – Буфер



Вторичная упаковка и компоненты медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №401375. Вариант исполнения: Комплектация на 20 тестов

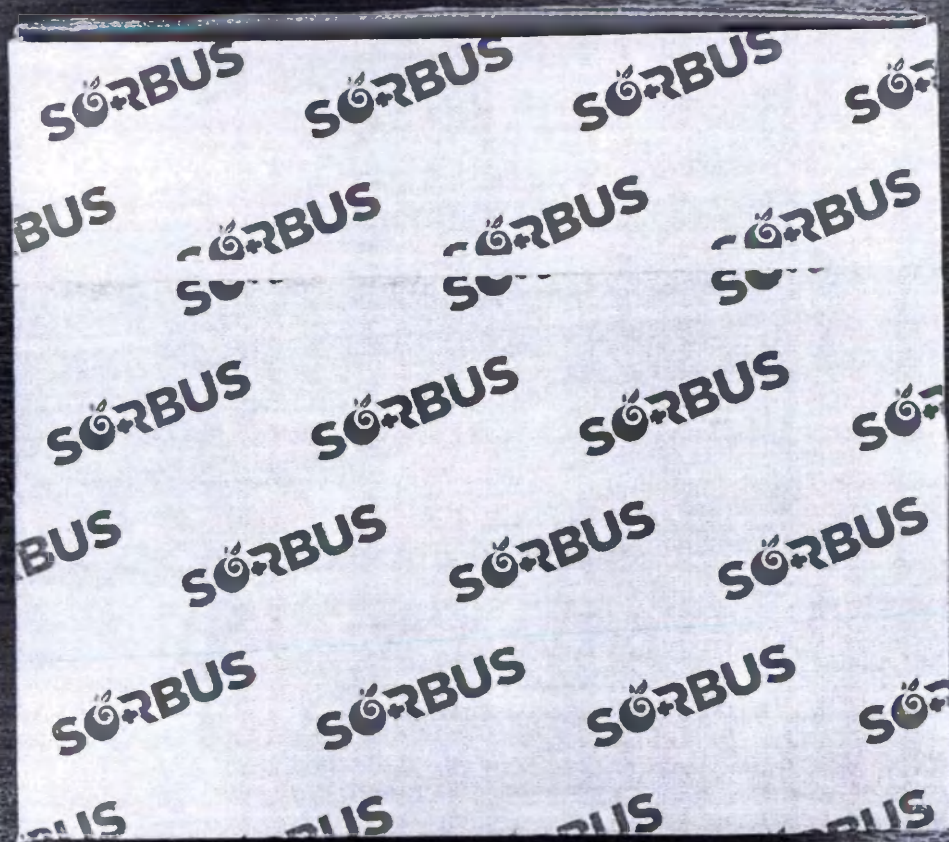


Вторичная упаковка медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Вариант исполнения: Комплектация на 20 тестов

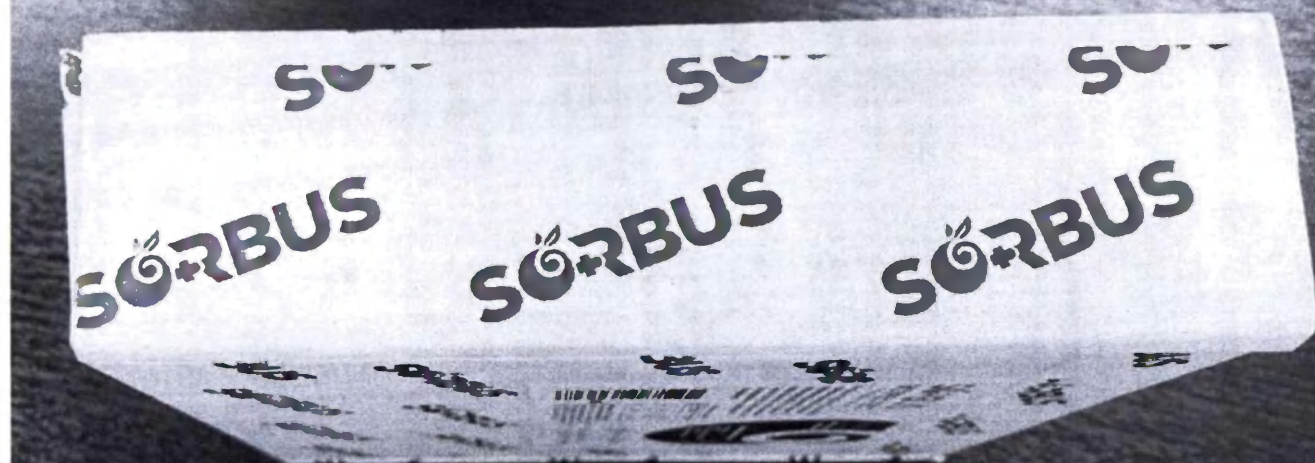


Вторичная упаковка медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Вариант исполнения: Комплектация на 20 тестов



Вторичная упаковка медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-IHA SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Вариант исполнения: Комплектация на 20 тестов

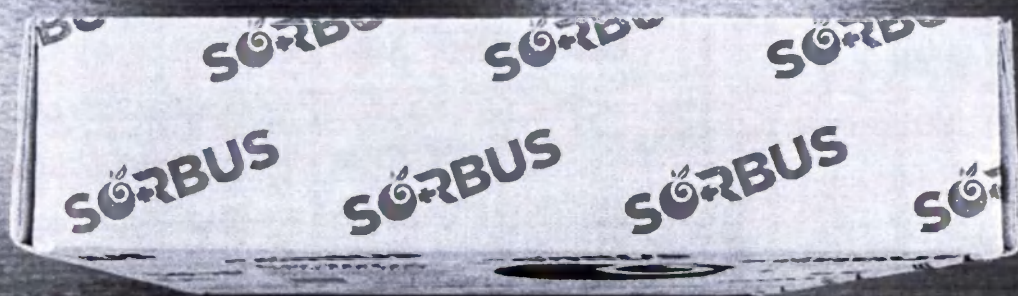


Вторичная упаковка медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Вариант исполнения: Комплектация на 20 тестов

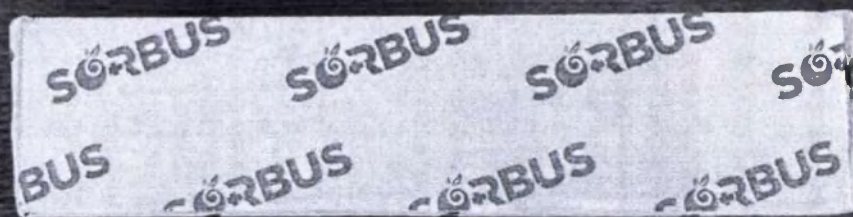

Вторичная упаковка медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Вариант исполнения: Комплектация на 20 тестов



Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Вариант исполнения Комплектация на 20 тестов – Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020, РУ №РЗН 2021/13989.

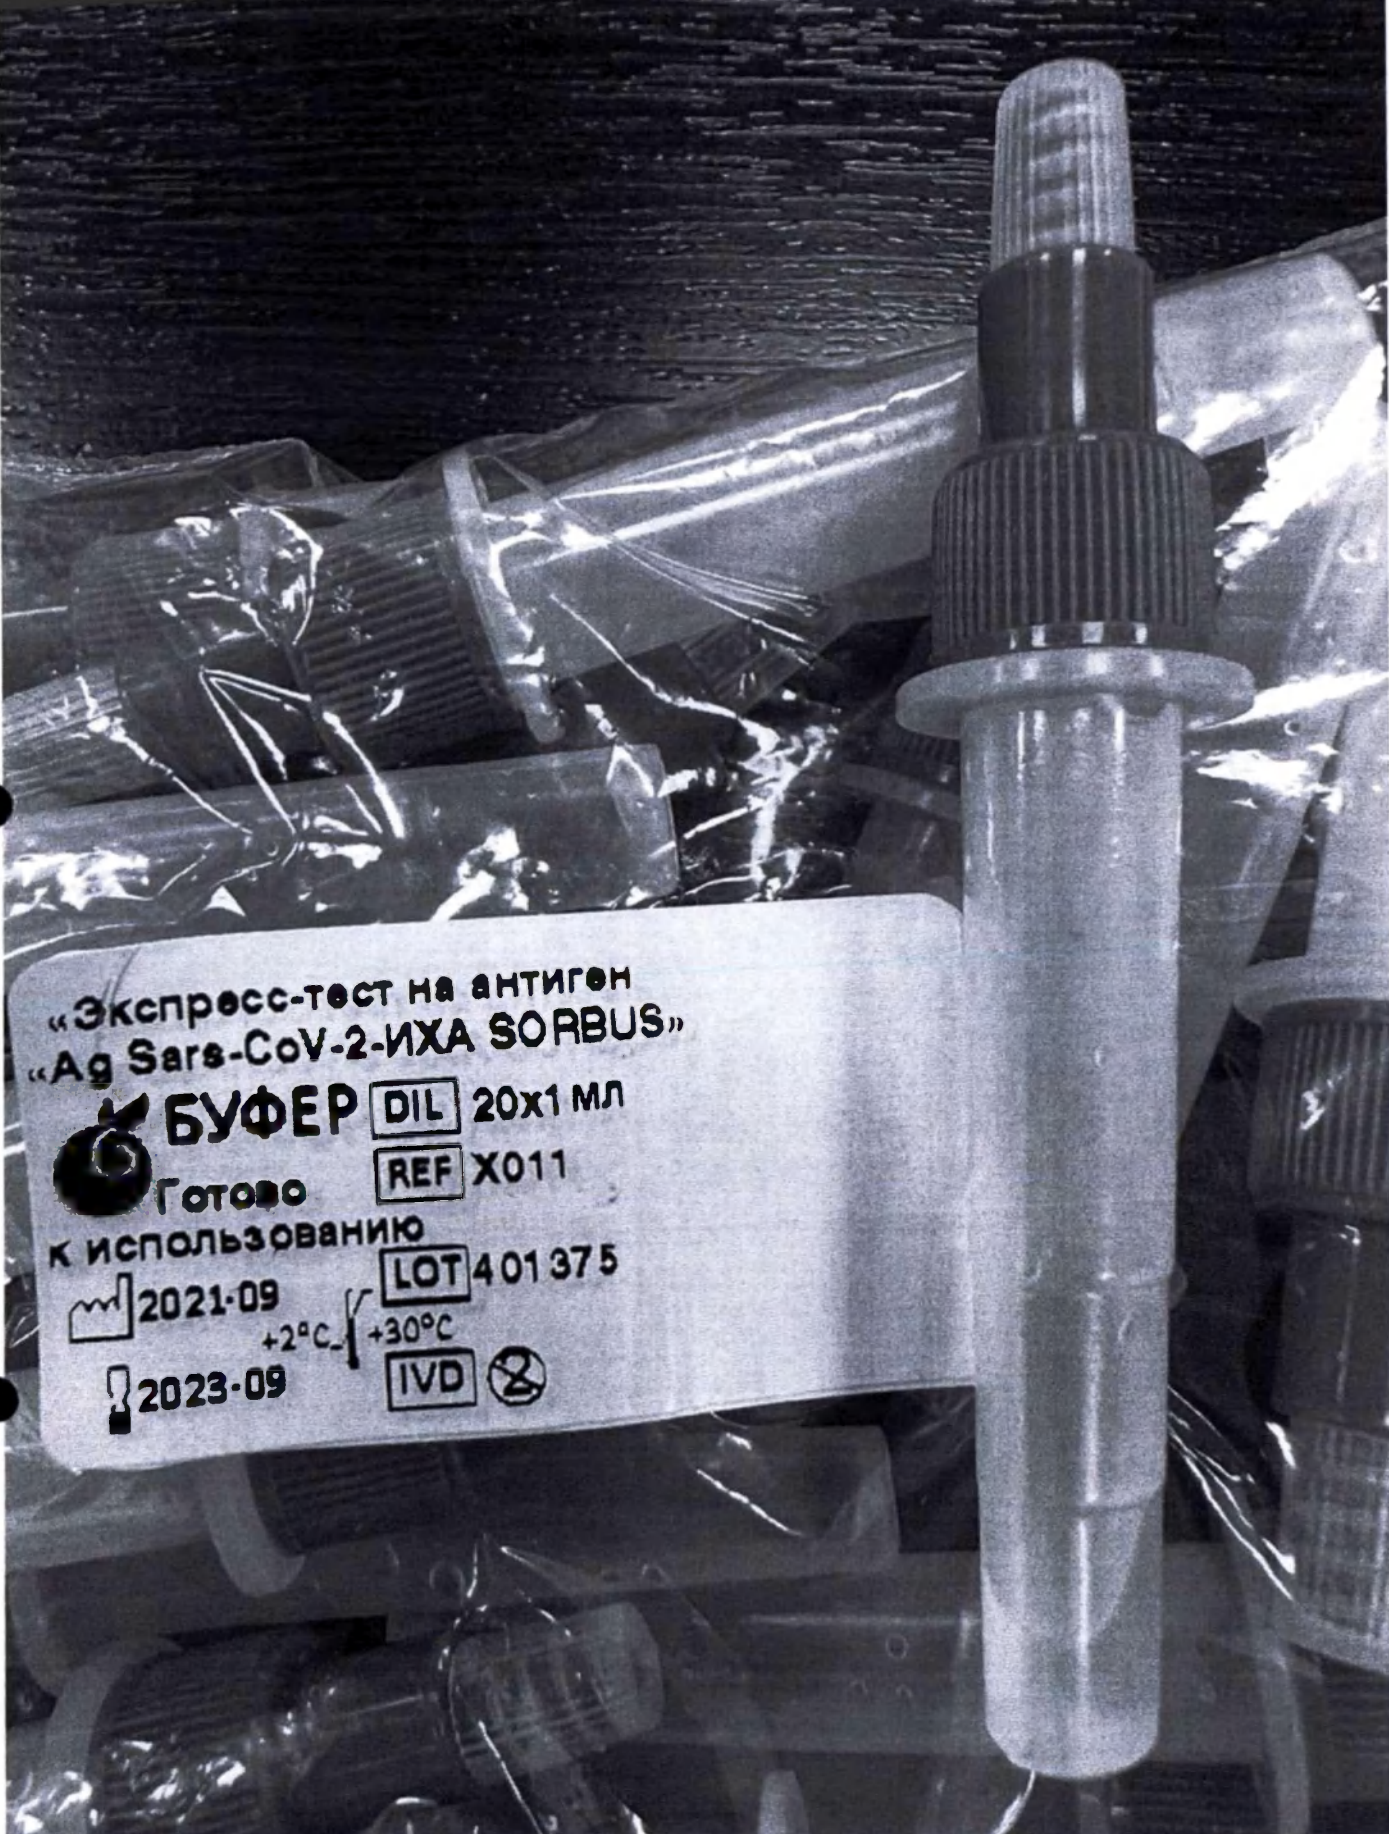

Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №401375. Вариант исполнения: Комплектация на 20 тестов – Буфер



Вторичная упаковка и компоненты медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №444331. Вариант исполнения: Комплектация на 20 тестов

ФармМедПолис

Зонд медицинский одноразовый стерильный

Производитель:
ООО «ФАРММЕДПОЛИС РТ»
420017, Республика Татарстан,
Ленинский район, село Большие
Кабаны, Выставочная улица, 1,
Кластер «В».

Номер и дата регистрационного
удостоверения:
РЗН 2021/13989 от 12.04.2021

Lot

02/2021

04/2021

04/2026



IVD





ТУ 32.50.13-002-28731857-2020

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ГОДНОСТИ - УТИЛИЗИРОВАТЬ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - DO NOT USE AFTER EXPIRATION DATE - DISPOSE OF AFTER USE

Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Вариант исполнения Комплектация на 20 тестов – Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020, РУ №РЗН 2021/13989.

Экспресс-тест на антиген
«Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS»
Тест-картридж REF X011
 LOT 444331
 Готов к использованию
 2021-09
 2023-09

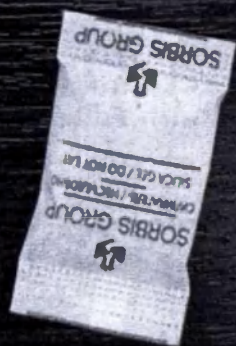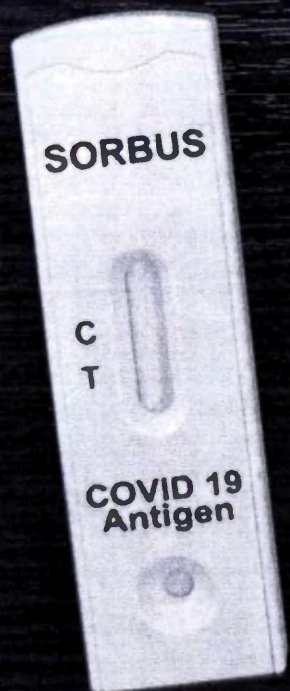

Тест-картридж и его первичная упаковка в медицинском изделии «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №444331. Вариант исполнения: Комплектация на 20 тестов – тест-картридж.



«Экспресс-тест на антиген
«Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS»
БУФЕР DIL 20x1 мл
Готово к использованию REF X011
LOT 444331
+2°C / +30°C
2021-09
2023-09
IVD

Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №444331. Вариант исполнения: Комплектация на 20 тестов – Буфер



Вторичная упаковка и компоненты медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-IgA SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №504318. Вариант исполнения: Комплектация на 20 тестов

ФармМедПолис®

Зонд медицинский одноразовый стерильный

ТУ 32.50.13-002 28731857-2020

STERILE EO

Производитель:

ООО «ФАРММЕДПОЛИС РТ»
420017, Республика Татарстан,
Лаишевский район, село Большие
Кабаны, Выставочная улица, 1,
Кластер «В».

Удостоверение:

Номер и дата регистрационного
ПЗН 2021/13969 от 12.04.2021

LOT

02/2021

04/2021

04/2026





IVD



ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ

Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Вариант исполнения Комплектация на 20 тестов – Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020, РУ №ПЗН 2021/13989.

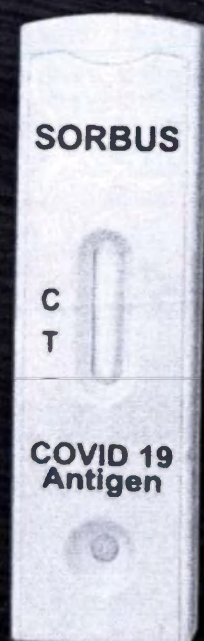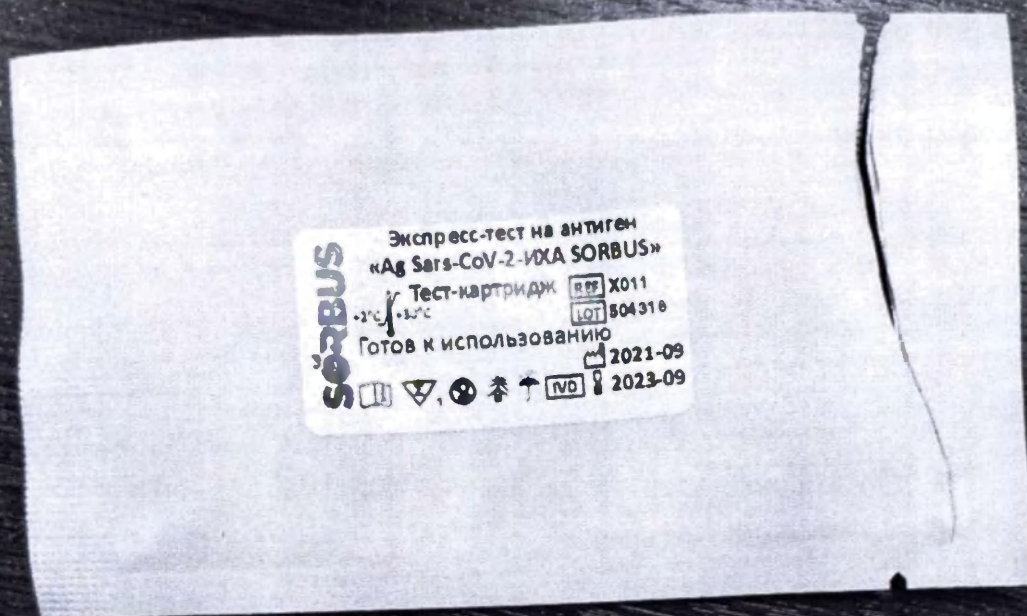

Тест-картридж и его первичная упаковка в медицинском изделии «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №504318. Вариант исполнения: Комплектация на 20 тестов – тест-картридж.



«Экспресс-тест на антиген
«Ag Sars-CoV-2-IHA SORBUS»
 **БУФЕР** DIL 20x1 мл
 Готово REF X011
 к использованию LOT 504318
 2021-09 +2°C - +30°C
 2023-09 IVD

Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-IHA SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
 Серия №504318. Вариант исполнения: Комплектация на 20 тестов – Буфер




Вторичная упаковка и компоненты медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №511000. Вариант исполнения: Комплектация на 20 тестов



Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.

Вариант исполнения Комплектация на 20 тестов – Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020, РУ №РЗН 2021/13989.


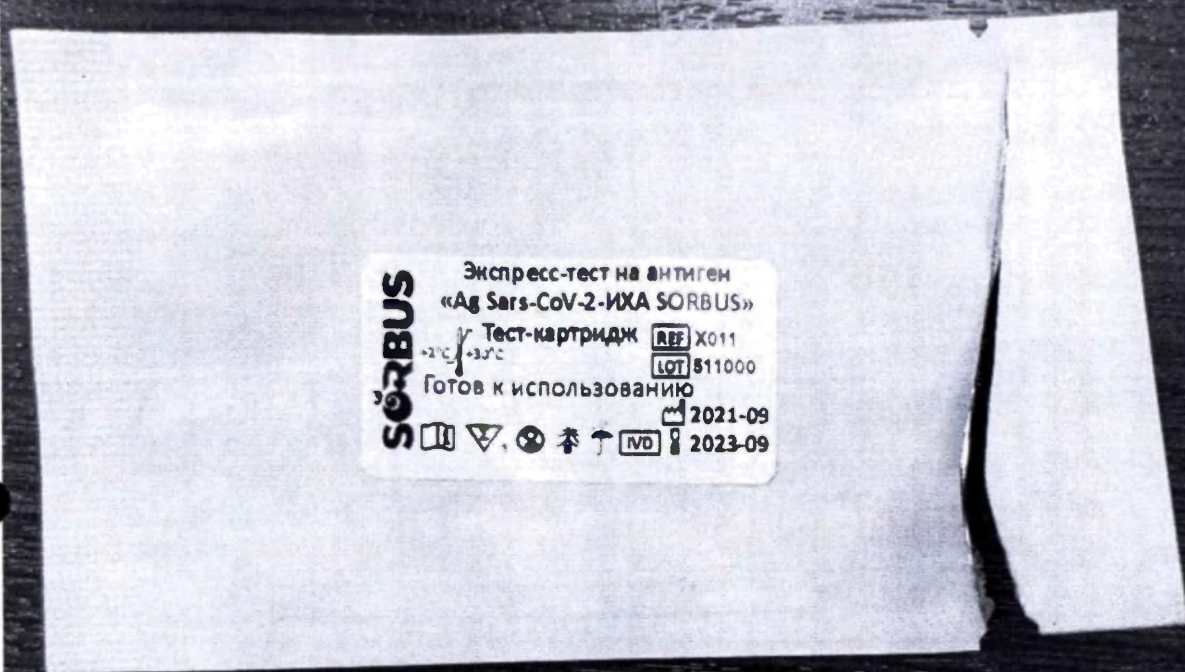


Тест-картридж и его первичная упаковка в медицинском изделии «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №511000. Вариант исполнения: Комплектация на 20 тестов – тест-картридж.




Вторичная упаковка и компоненты медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.

Серия №511220. Вариант исполнения: Комплектация на 20 тестов

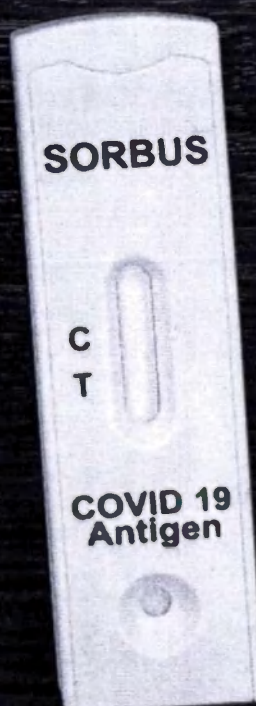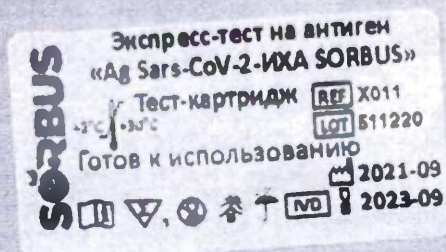

Тест-картридж и его первичная упаковка в медицинском изделии «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №511220. Вариант исполнения: Комплектация на 20 тестов – тест-картридж.

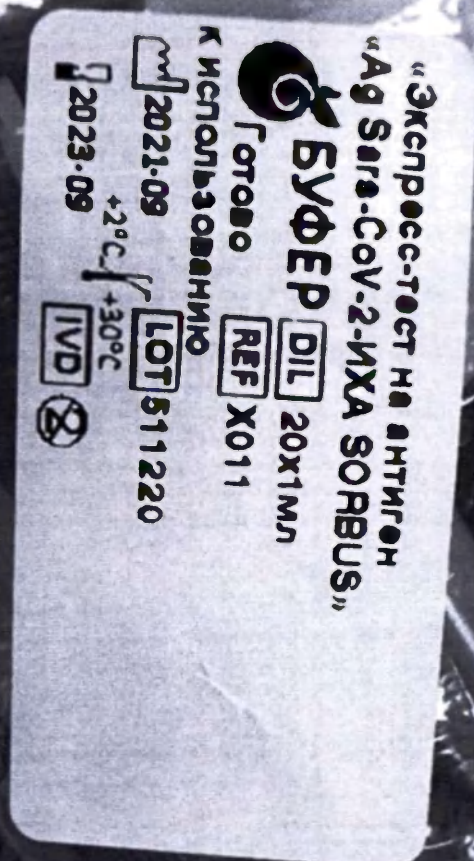


Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №511220. Вариант исполнения: Комплектация на 20 тестов – Буфер

SORBUS

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ

с коллоидным золотом


«Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека»
Серия №511220, 511000, 504318, 444331, 401375
Для профессионального использования
Не маркировать



Производитель: ООО «Цирми»,
г. Москва, ул. Гурьянова, стр. 3, пом. 79
Юридический адрес: 125080, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 3, стр. 19
Тел: +7 (495) 77 87 85, +7 (495) 77 87 86
Т: 77 87 85-86 - факс

09.2021 09.2023

401375 401375 401375 401375


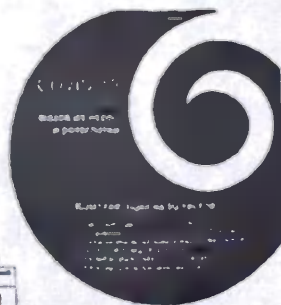


SORBUS

С Т

COVID-19

Antigen



SORBUS


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

«Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека»
Серия №511220, 511000, 504318, 444331, 401375
Для профессионального использования
Не маркировать




Исходитель:
г. Москва
г. Санкт-Петербург
г. Новосибирск
г. Екатеринбург
г. Челябинск
г. Самара
г. Казань
г. Пермь
г. Нижний Новгород
г. Волгоград
г. Саратов
г. Пенза
г. Ульяновск
г. Тольятти
г. Ижевск
г. Уфа
г. Куйбышев
г. Магнитогорск
г. Челябинск
г. Екатеринбург
г. Пермь
г. Нижний Новгород
г. Волгоград
г. Саратов
г. Пенза
г. Ульяновск
г. Тольятти
г. Ижевск
г. Уфа
г. Куйбышев
г. Магнитогорск

Вторичная упаковка и компоненты медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №401375. Вариант исполнения: Комплектация на 50 тестов

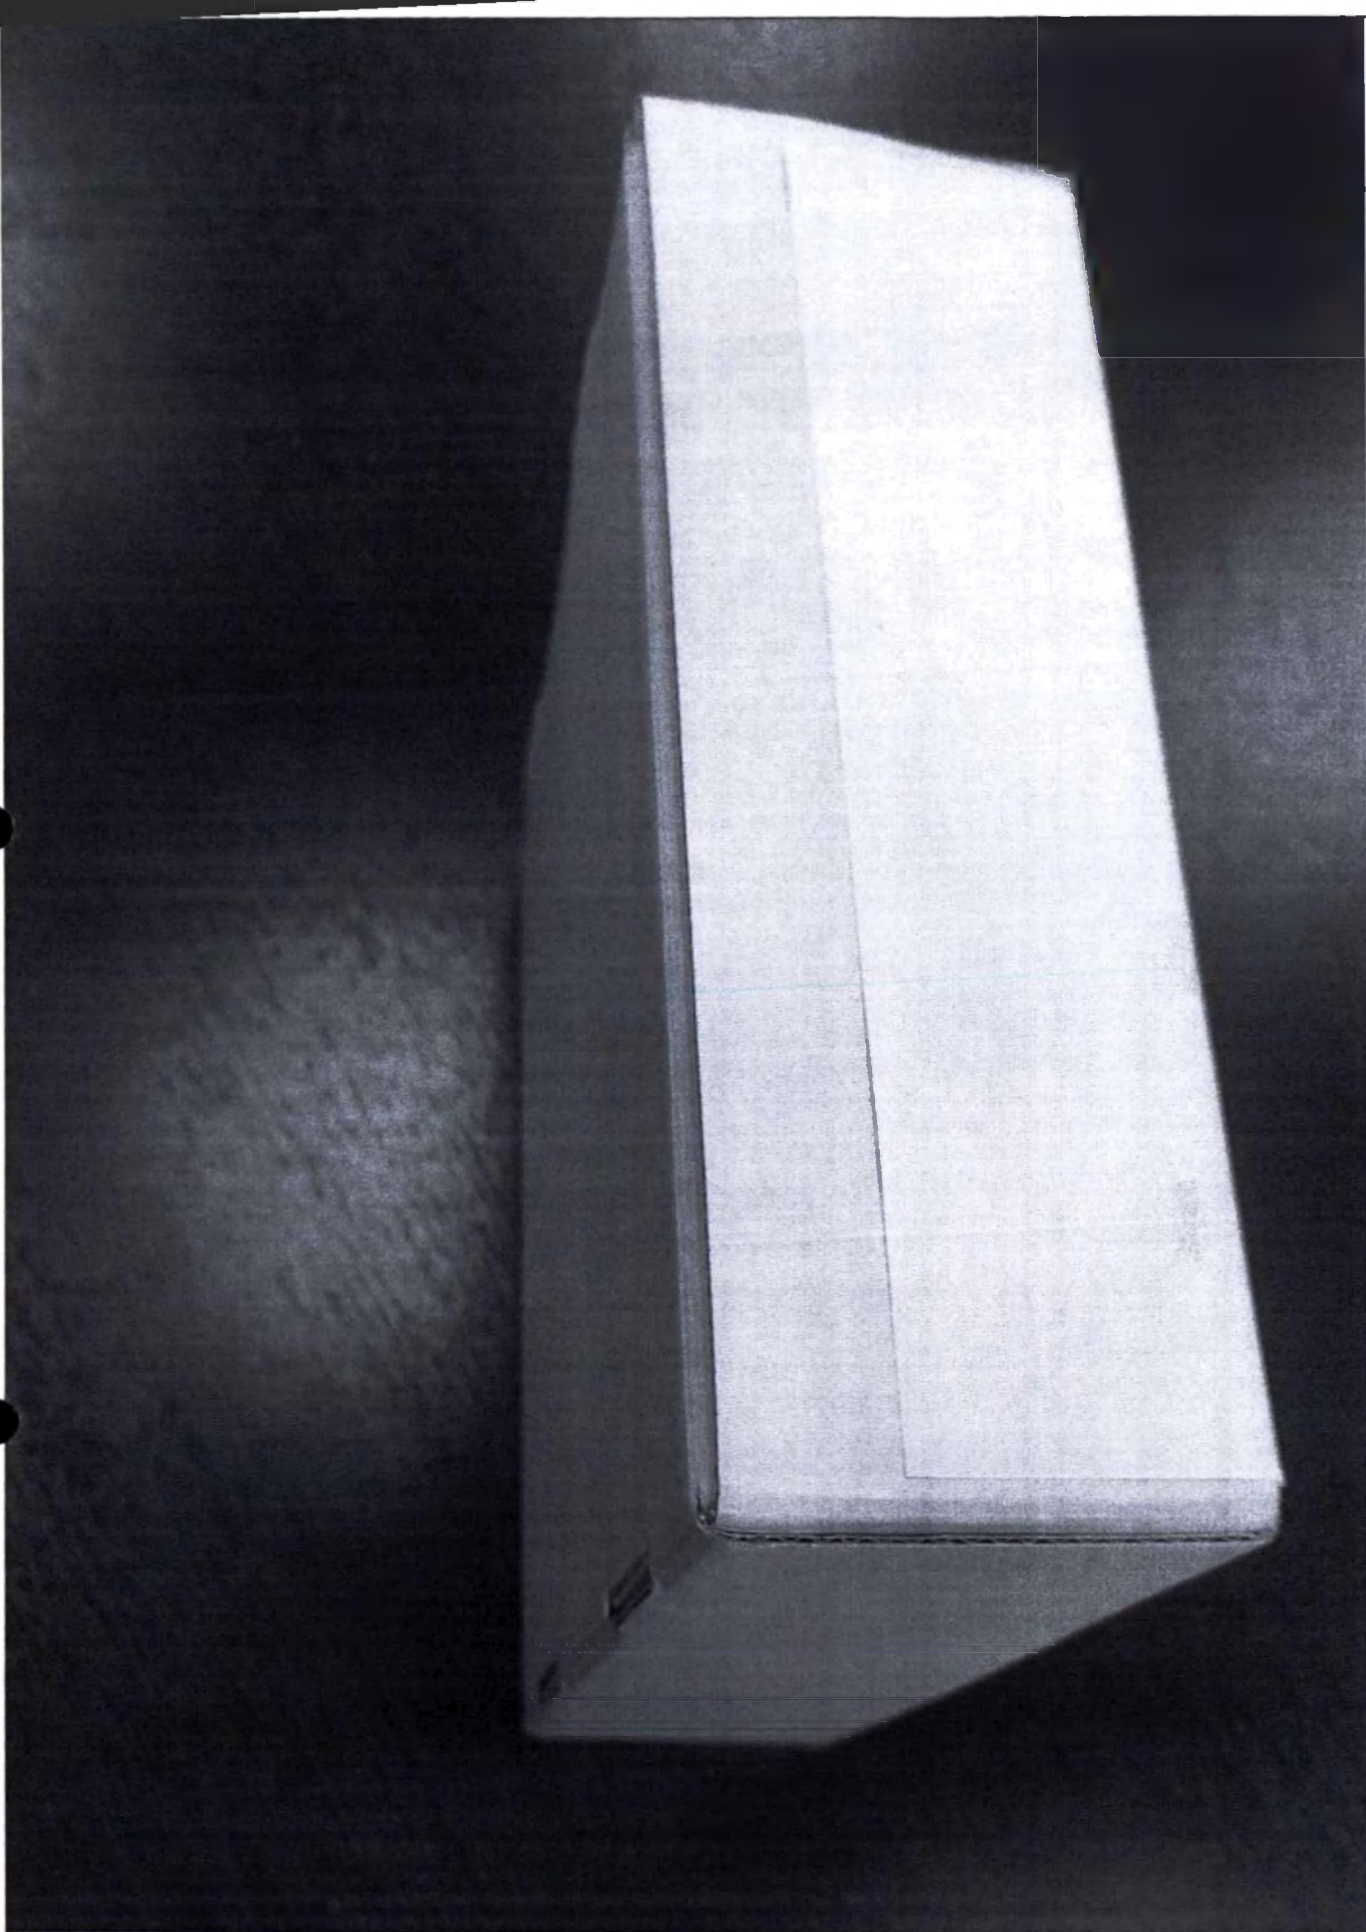

Вторичная упаковка медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Вариант исполнения: Комплектация на 50 тестов

Экспресс-тест на антиген
«Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS»
Тест-картридж REF X012
 LOT 401375
 Готов к использованию 2021-09
 2023-09

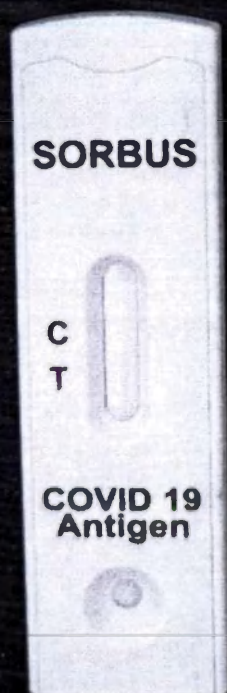

Тест-картридж и его первичная упаковка в медицинском изделии «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №401375. Вариант исполнения: Комплектация на 50 тестов – тест-картридж.

«Экспресс-тест на антиген
«Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS»

БУФЕР DIL 25x1 мл

Готово REF X012

к использованию

2021-09 LOT 401375

2023-09 +2°C/+30°C

IVD

«Экспресс-тест на антиген
«Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS»

БУФЕР DIL 25x1 мл

Готово REF X012

к использованию


2021-09 LOT 401375

2023-09 +2°C/+30°C

IVD

Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.

Серия №401375. Вариант исполнения: Комплектация на 50 тестов – Буфер

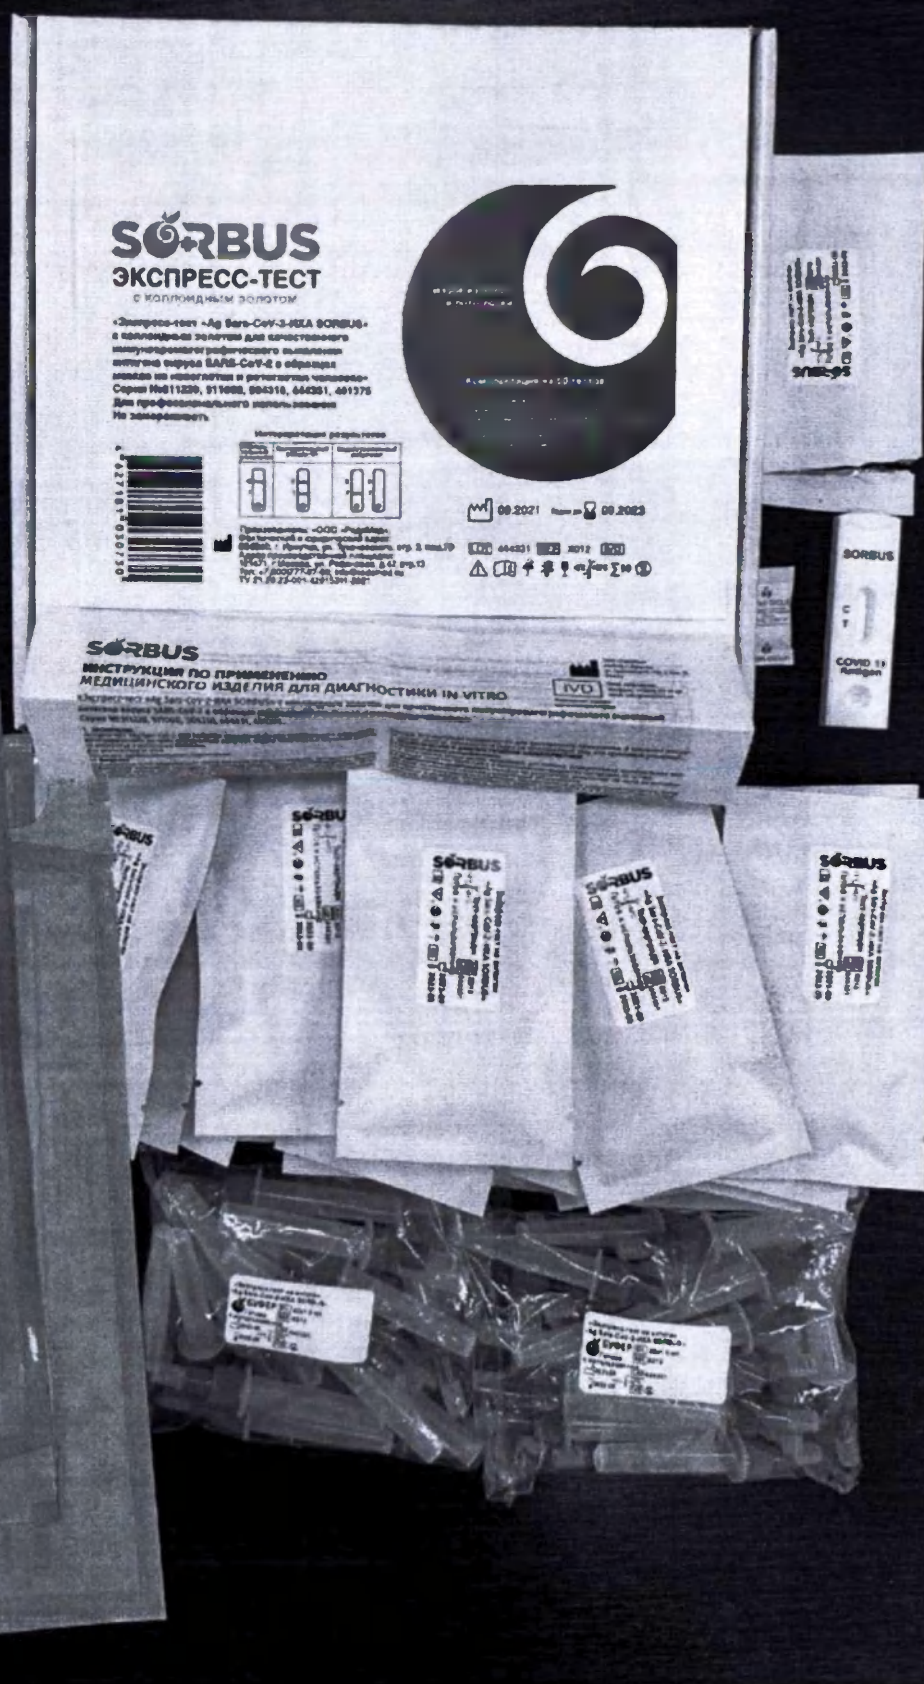


Вторичная упаковка и компоненты медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №444331. Вариант исполнения: Комплектация на 50 тестов



Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.

Вариант исполнения Комплектация на 50 тестов – Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020, РУ №РЗН 2021/13989.

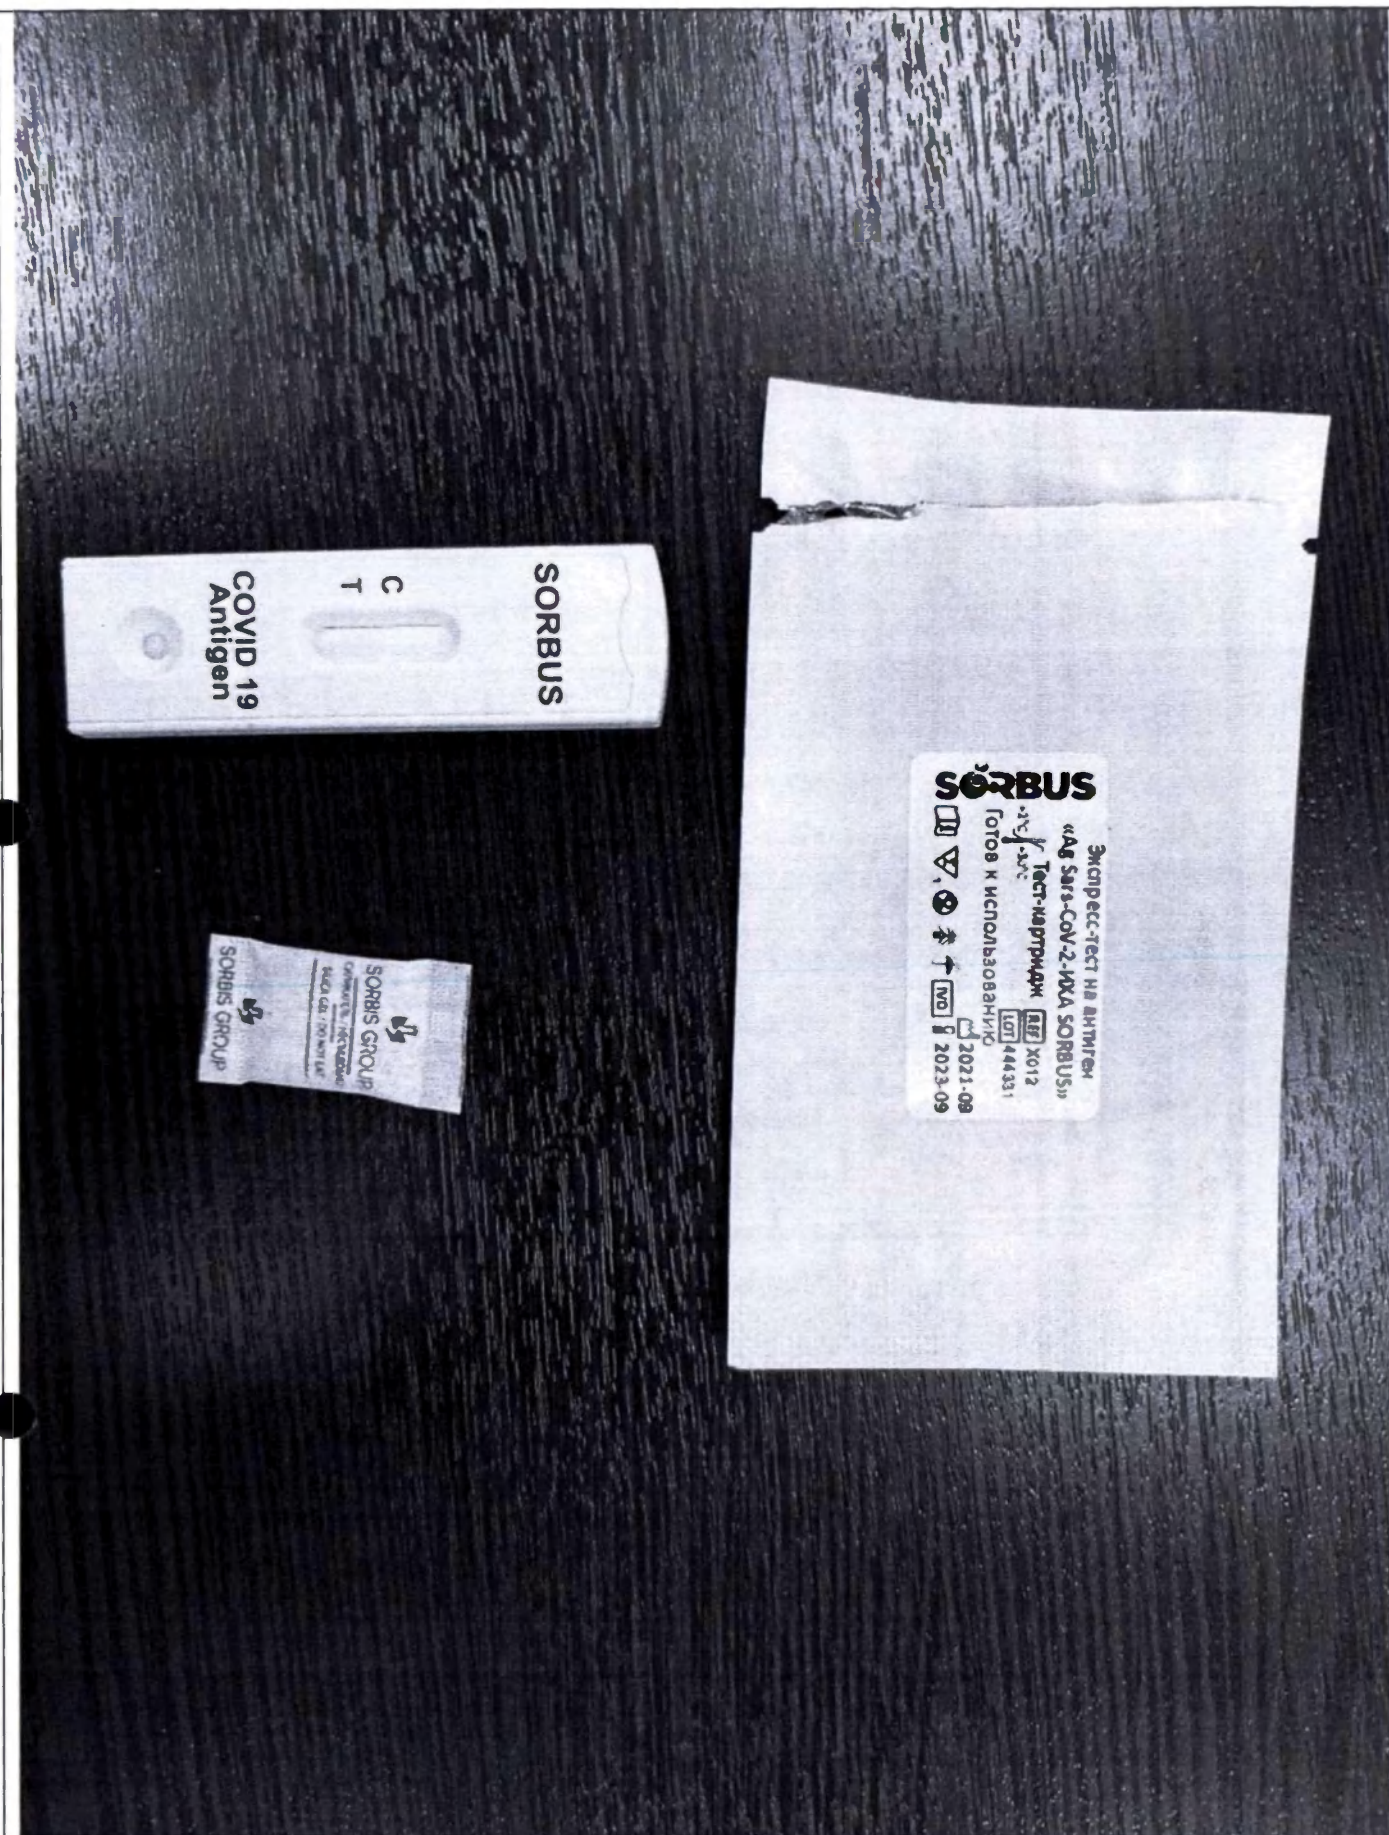

Тест-картридж и его первичная упаковка в медицинском изделии «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №444331. Вариант исполнения: Комплектация на 50 тестов – тест-картридж.



Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-IHA SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №444331. Вариант исполнения: Комплектация на 50 тестов – Буфер



Вторичная упаковка и компоненты медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №11220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №504318. Вариант исполнения: Комплектация на 50 тестов

ФармМедПолис

Зонд медицинский одноразовый стерильный

Производитель:
ООО «ФАРММЕДПОЛИС РТ»
420017, Республика Татарстан,
Ленинский район, село Большие
Казаны, Выставочная улица, 1,
Клестер «В».

Номер и дата регистрации:
Удостоверения:
РЗН 2021/13989 от 12.04.2021

LOT

02/2021

04/2021

04/2026

IVD


STERILE

ТУ 32.50.13-002-28731857-2020

DO NOT USE AFTER EXPIRATION DATE / PURPOSE OF AFTER USE

Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.

Вариант исполнения Комплектация на 50 тестов – Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020, РУ №РЗН 2021/13989.

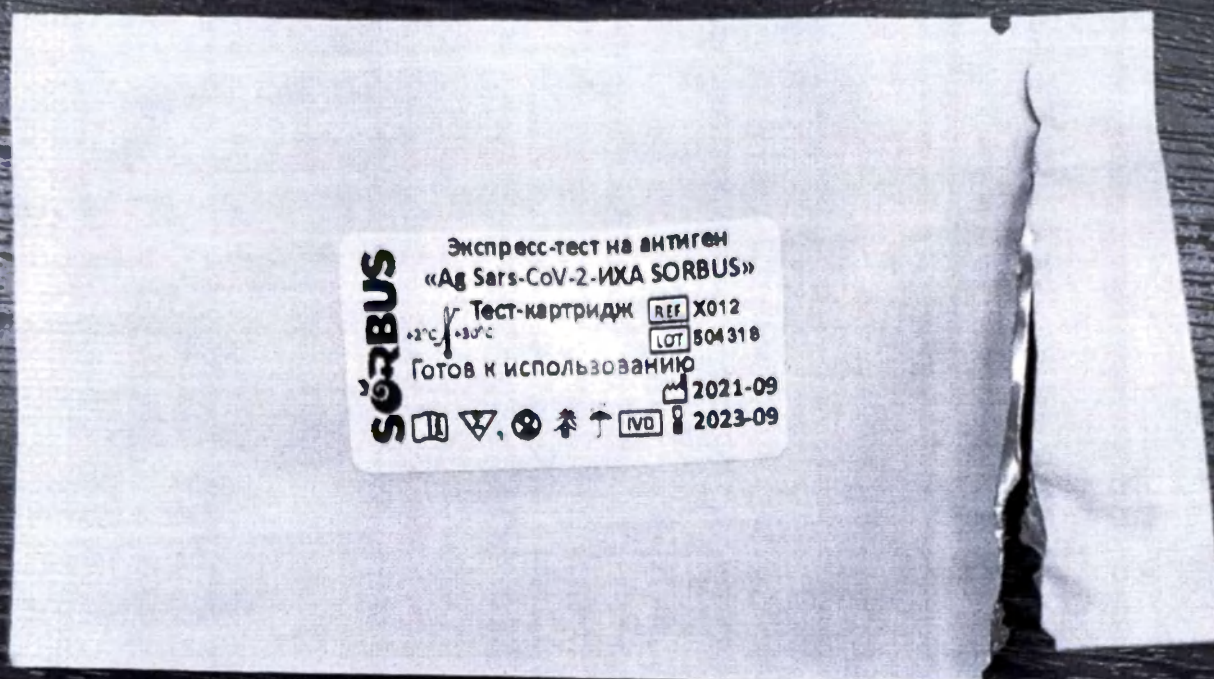

Тест-картридж и его первичная упаковка в медицинском изделии «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №504318. Вариант исполнения: Комплектация на 50 тестов – тест-картридж.




Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №504318. Вариант исполнения: Комплектация на 50 тестов – Буфер




Вторичная упаковка и компоненты медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №511000. Вариант исполнения: Комплектация на 50 тестов



Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sar-CoV-2-H1N1A-SORBIUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в мазках из ротоглотки и ротоглотки человека. – Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 10-375
 Вариант исполнения Комплектация на 50 тестов – Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020, РУ №РЗН 2021/13989.

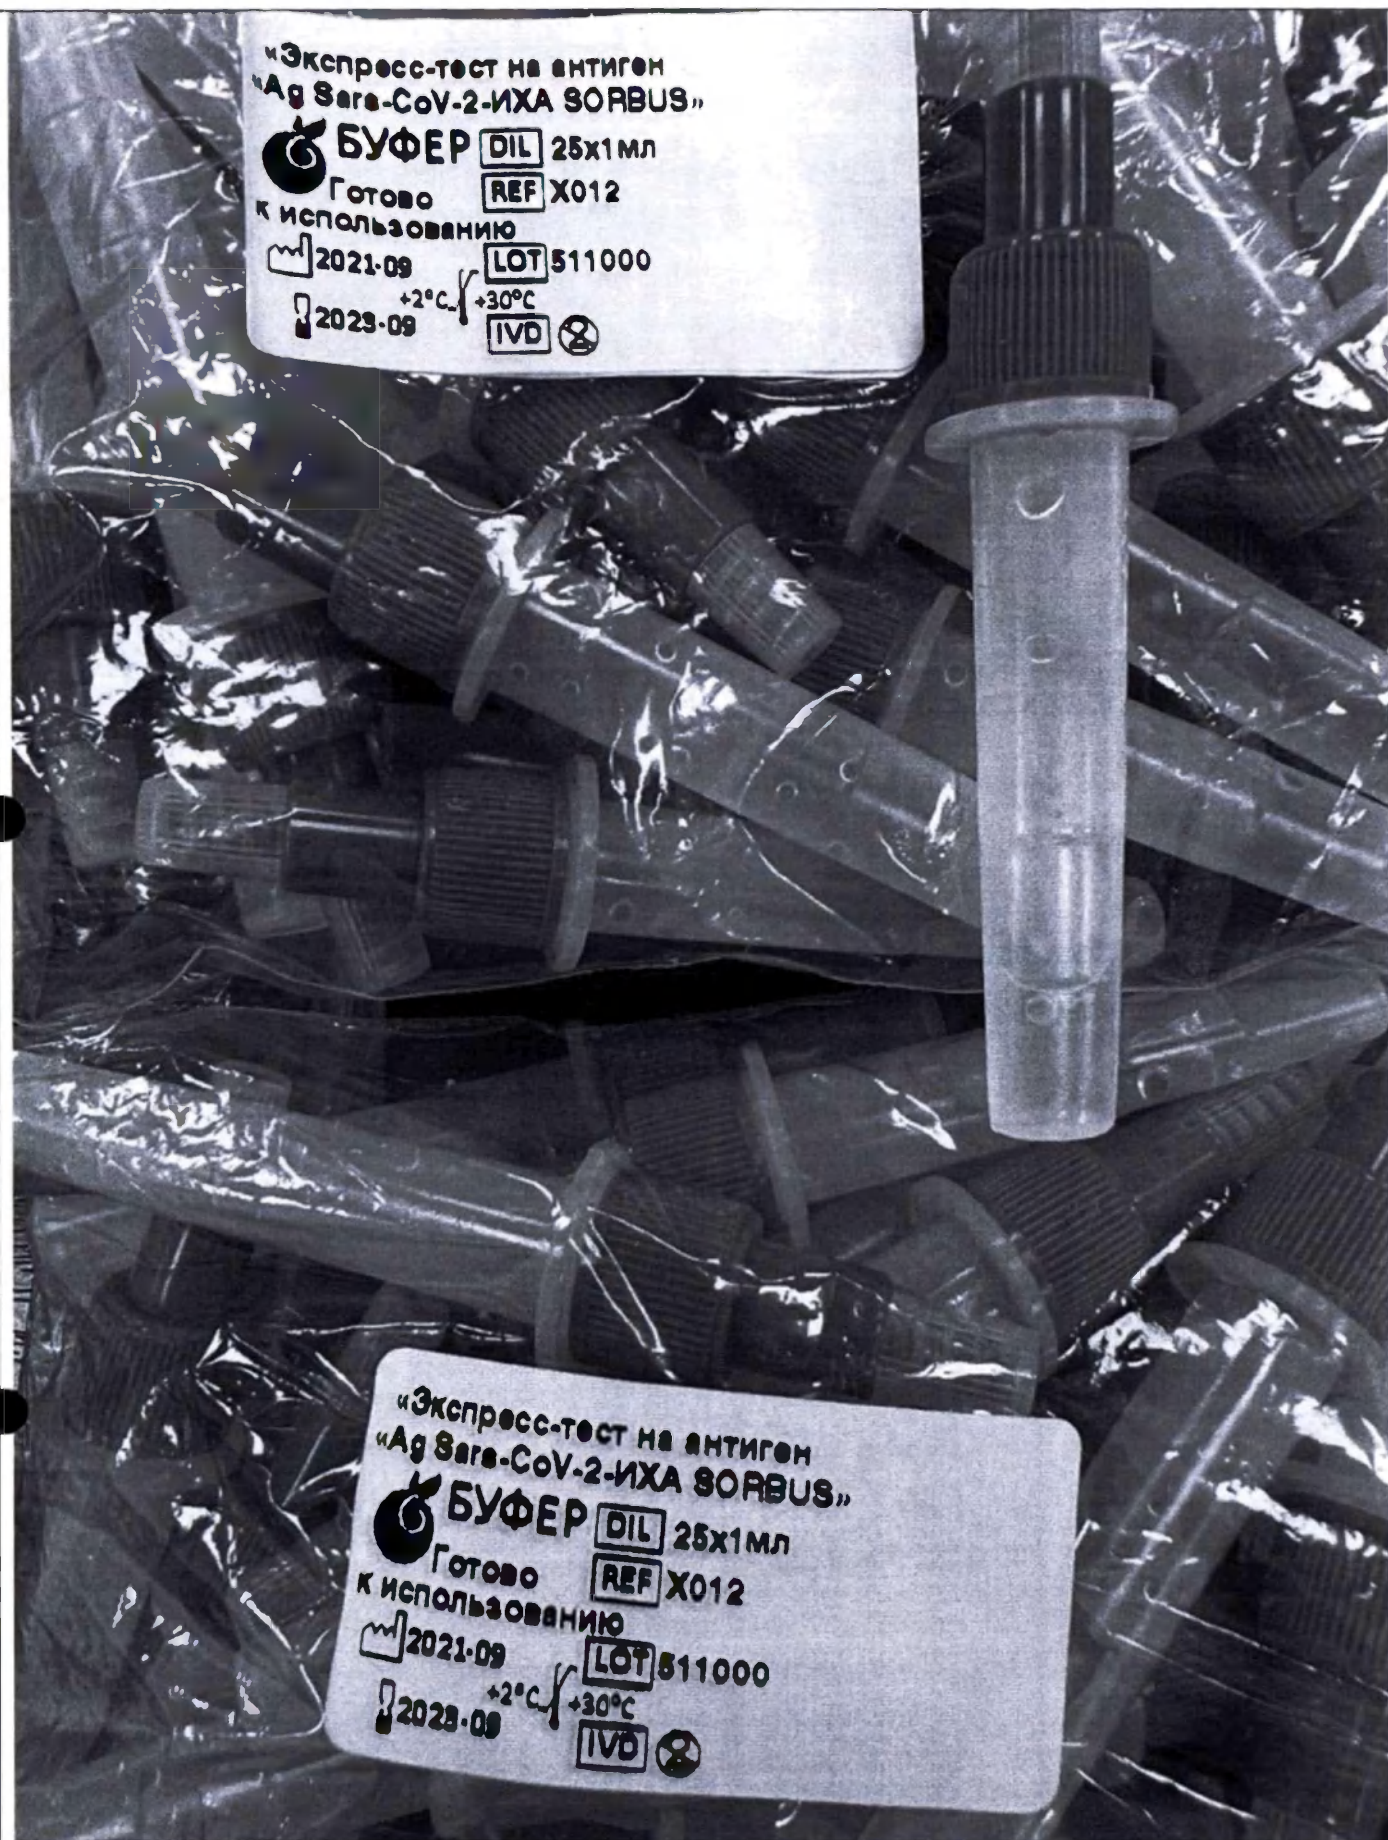

Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №511000. Вариант исполнения: Комплектация на 50 тестов

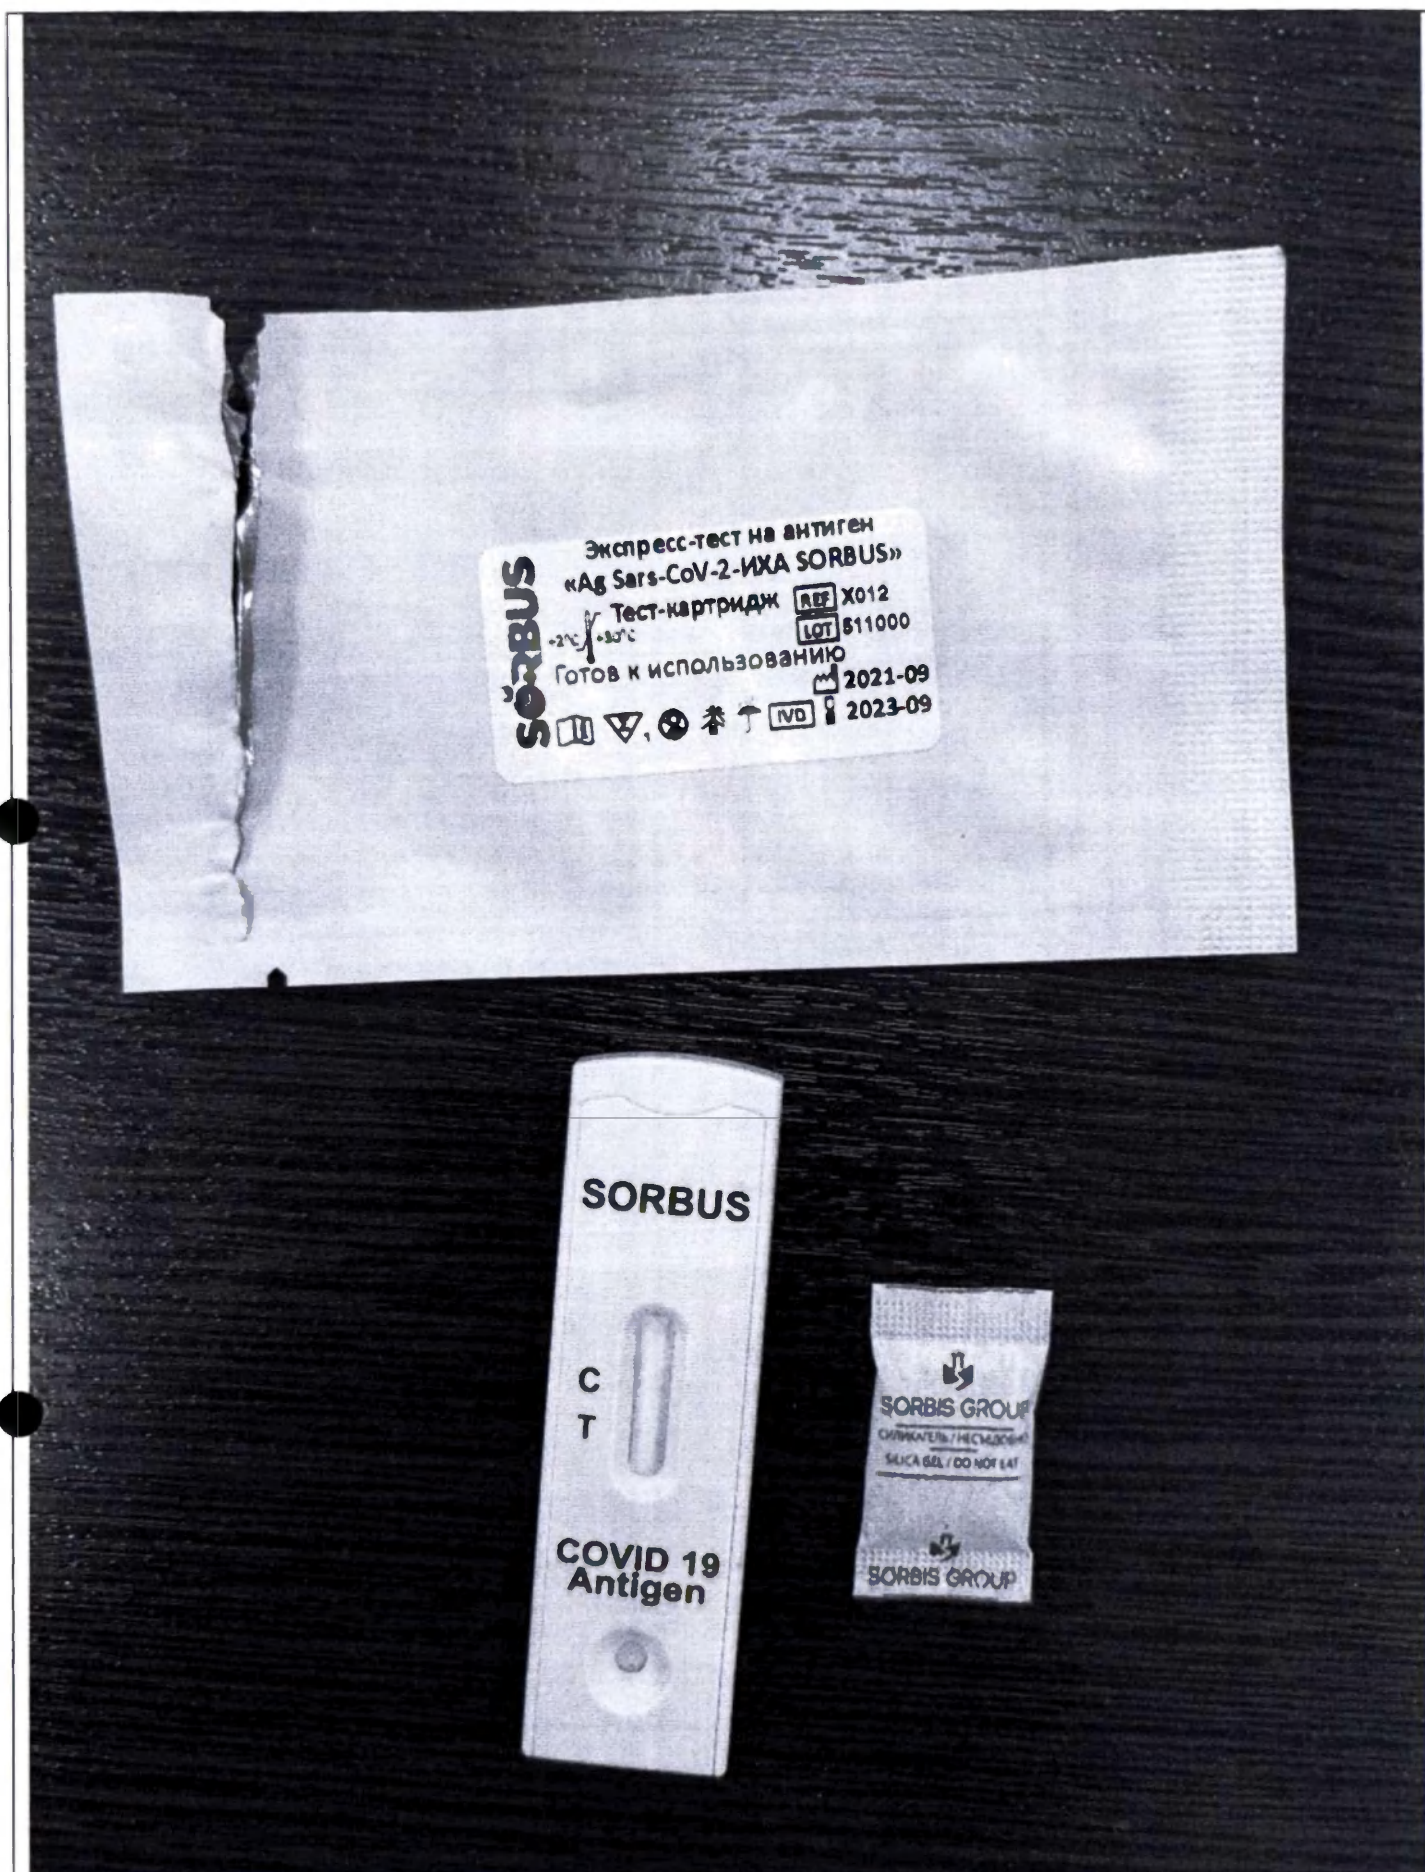

Тест-картридж и его первичная упаковка в медицинском изделии «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №511000. Вариант исполнения: Комплектация на 50 тестов – тест-картридж.



Вторичная упаковка и компоненты медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №511220. Вариант исполнения: Комплектация на 50 тестов

ФармМедПолис

Зонд медицинский одноразовый стерильный


Производитель:
ООО «ФАРММЕДПОЛИС РТ»
420017, Республика Татарстан,
Ленинский район, село Большое
Кабань, Выставочная улица, 1,
Кластер «В».

Номер и дата регистрационного
удостоверения:
РЗН 2021/13989 от 12.04.2021

LOT 02/2021

04/2021

04/2026



ТУ 32.50.13-002-28731857-2020

РЗН 2021/13989

04/2021

04/2026

04/2021

04/2026

04/2021

04/2026

04/2021



04/2026

04/2021

04/2026

Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-IHA SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.

Вариант исполнения Комплектация на 50 тестов – Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020, РУ №РЗН 2021/13989.

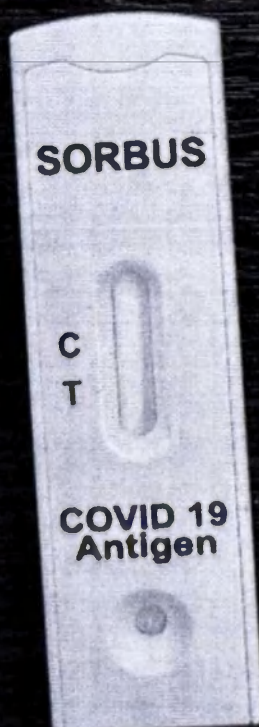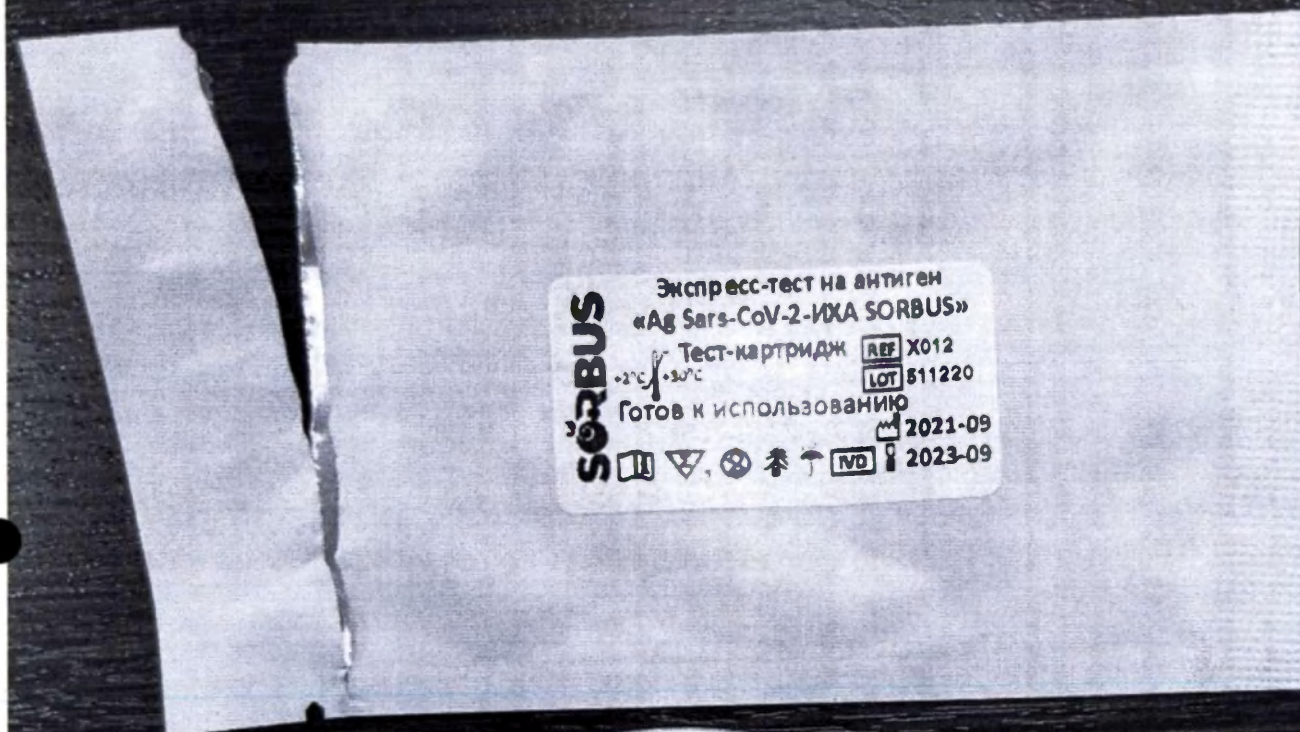

Тест-картридж и его первичная упаковка в медицинском изделии «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №511220. Вариант исполнения: Комплектация на 50 тестов – тест-картридж.

«Экспресс-тест на антиген
«Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS»

 **БУФЕР** **DIL** 25x1мл
REF X012

Готово
к использованию

 2021-09 **LOT** 511220

 +2°C / +30°C
IVD 

«Экспресс-тест на антиген
«Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS»

 **БУФЕР** **DIL** 25x1мл
REF X012

Готово
к использованию

 2021-09 **LOT** 511220

 +2°C / +30°C
IVD 

Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.

Серия №511220. Вариант исполнения: Комплектация на 50 тестов – Буфер



Вторичная упаковка и компоненты медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.

Серия №401375. Вариант исполнения: Комплектация на 100 тестов



Вторичная упаковка медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Вариант исполнения: Комплектация на 100 тестов

ФармМедПолис®

Зонд медицинский одноразовый стерильный

Производитель:
ООО «ФАРММЕДПОЛИС РТ»
420017, Республика Татарстан,
Ленинский район, село Большие
Кабаны, Выставочная улица, 1,
Кластер «В».

Номер и дата регистрации
удостоверения:
РЗН 2021/13989 от 12.04.2021

LOT 02/2021
04/2021
04/2026





ТУ 32.50.13-002-28731857-2020

STERILE

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ ИСХОДА СРОКА ГОДНОСТИ • УТИЛИЗировать ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ • DO NOT USE AFTER EXPIRATION DATE • DISPOSE OF AFTER USE

Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.

Вариант исполнения Комплектация на 100 тестов – Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020, РУ №РЗН 2021/13989.

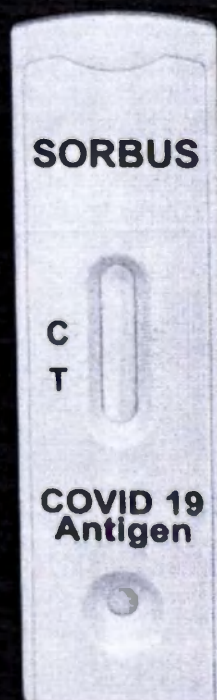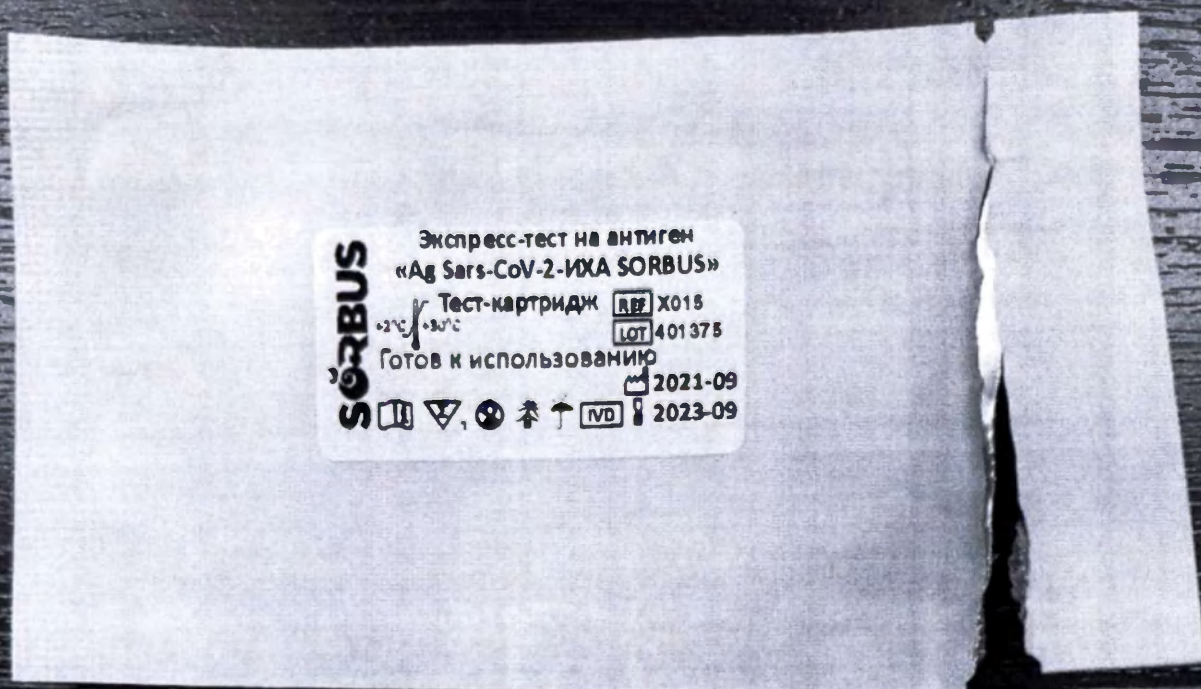

Тест-картридж и его первичная упаковка в медицинском изделии «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №401375. Вариант исполнения: Комплектация на 100 тестов – тест-картридж.



Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №401375. Вариант исполнения: Комплектация на 100 тестов – Буфер




Вторичная упаковка и компоненты медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-IHA SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №444331. Вариант исполнения: Комплектация на 100 тестов

ФармМедПолис

Зонд медицинский одноразовый стерильный

Производитель:
ООО «ФАРММЕДПОЛИС РТ»,
420017, республика Татарстан,
Ленинский район, село Болышево
Кибены, Выставочная улица, 1,
Кластер «В».

Номер и дата регистрационного
уведомления:
РЗН 2021/13989 от 12.04.2021

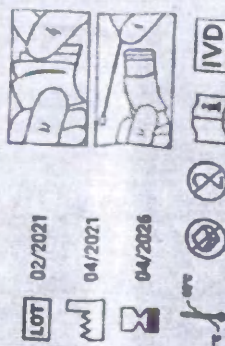


LOT

02/2021

04/2021

04/2026



ТУ 32.50.13-002-2020, РУ №РЗН 2021/13989

Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Вариант исполнения Комплектация на 100 тестов – Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020, РУ №РЗН 2021/13989.



Тест-картридж и его первичная упаковка в медицинском изделии «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №444331. Вариант исполнения: Комплектация на 100 тестов – Тест-картридж



Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №444331. Вариант исполнения: Комплектация на 100 тестов – Буфер



Вторичная упаковка и компоненты медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №504318. Вариант исполнения: Комплектация на 100 тестов



Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.

Вариант исполнения Комплектация на 100 тестов – Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020, РУ №РЗН 2021/13989.



Тест-картридж и его первичная упаковка в медицинском изделии «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.

Серия №504318. Вариант исполнения: Комплектация на 100 тестов – Тест-картридж



Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-IgA SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.

Серия №504318. Вариант исполнения: Комплектация на 100 тестов – Буфер



Вторичная упаковка и компоненты медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №511000. Вариант исполнения: Комплектация на 100 тестов

ФармМедПолис

Зонд медицинский одноразовый стерильный

ТУ 32.50.13-002-28731857-2020

СТЕРИЛЬНО


Производитель:
ООО «ФАРММЕДПОЛИС РТ»
420017, Республика Татарстан,
Ленинский район, село Большая
Кибень, Выставочная улица, 1,
Кластер «В».

Номер и дата регистрационного
удостоверения:
РЗН 2021/13989 от 12.04.2021

Lot 02/2021

04/2021

04/2026



IVD

2


2

2

DO NOT USE AFTER EXPIRATION DATE - DO NOT USE AFTER EXPIRATION DATE - DO NOT USE AFTER EXPIRATION DATE

Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.

Вариант исполнения Комплектация на 100 шт. – Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020, РУ №РЗН 2021/13989.

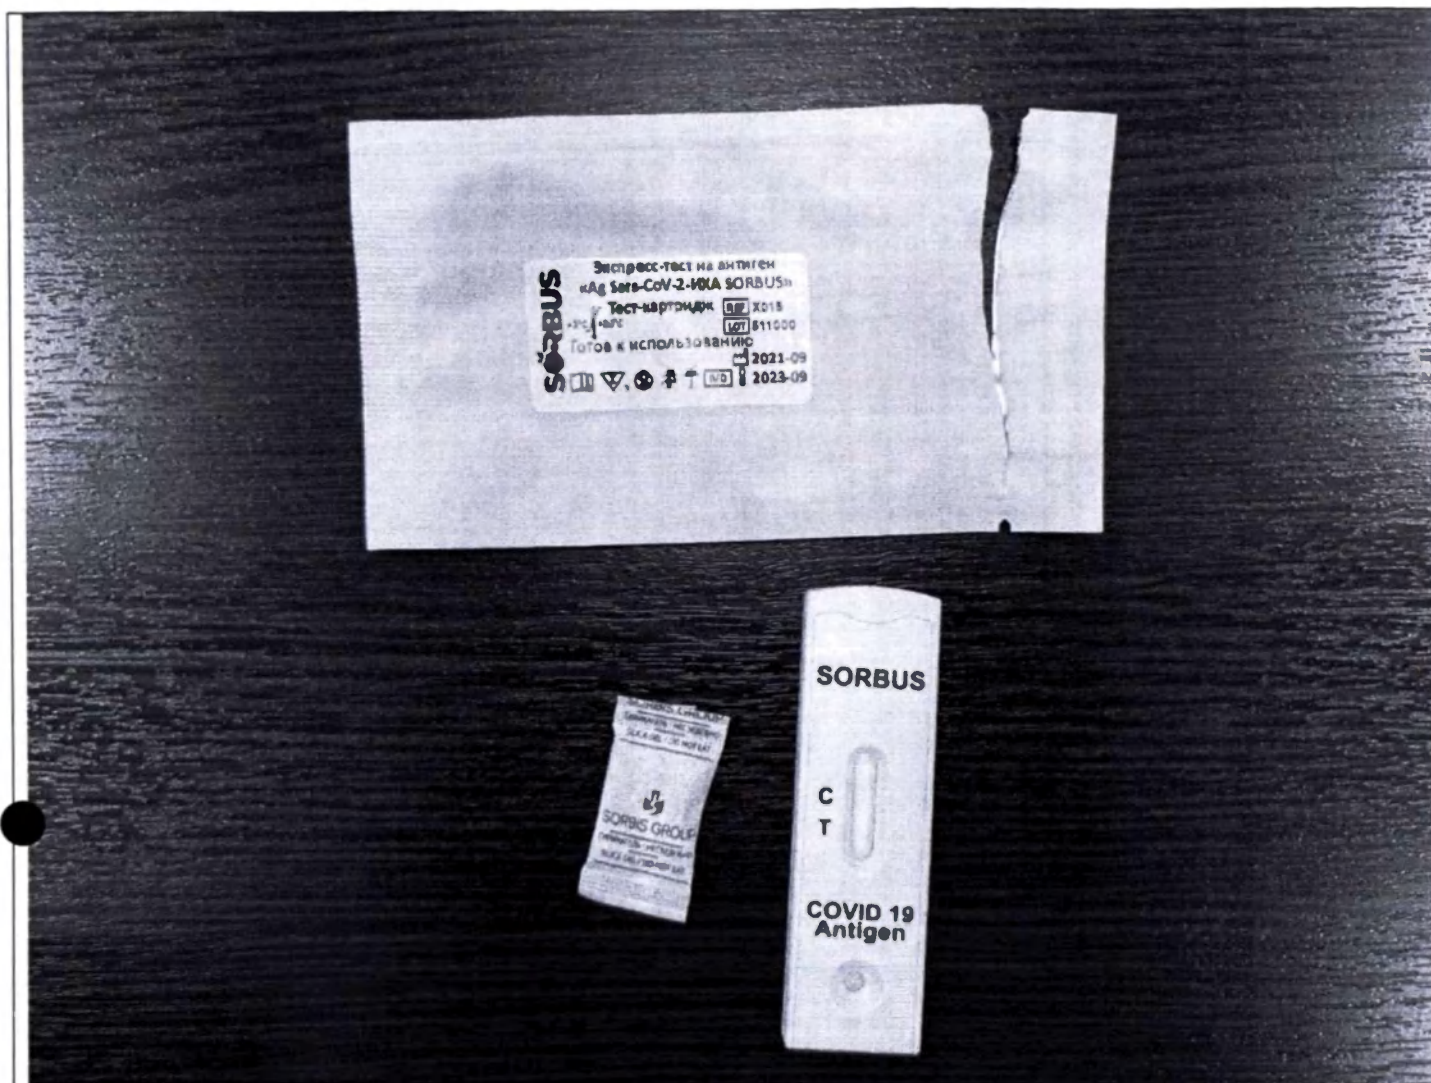

Тест-картридж и его первичная упаковка в медицинском изделии «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №511000. Вариант исполнения: Комплектация на 100 тестов – Тест-картридж



Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-IgA SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.

Серия №511000. Вариант исполнения: Комплектация на 100 тестов – Буфер



Вторичная упаковка и компоненты медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.

Серия №511220. Вариант исполнения: Комплектация на 100 тестов



Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.

Вариант исполнения Комплектация на 100 тестов – Зонд медицинский одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-002-28731857-2020, РУ №РЗН 2021/13989.



Тест-картридж и его первичная упаковка в медицинском изделии «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №511220. Вариант исполнения: Комплектация на 100 тестов – Тест-картридж



Тест-картридж и его первичная упаковка в медицинском изделии «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №511220. Вариант исполнения: Комплектация на 100 тестов – Тест-картридж



Тест-картридж и его первичная упаковка в медицинском изделии «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375. Серия №511220. Вариант исполнения: Комплектация на 100 тестов – Тест-картридж



Компонент медицинского изделия «Экспресс-тест «Ag Sars-CoV-2-ИХА SORBUS» с коллоидным золотом для качественного иммунохроматографического выявления антигена вируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки человека.» Серии №511220, 511000, 504318, 444331, 401375.
Серия №511220. Вариант исполнения: Комплектация на 100 тестов – Буфер



Прошито и скреплено печатью

124 ЛИСТОВ

