

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
ООО «Компания «БиВи»»

Носова Т.А.

«21» *ноябрь* 2022 г.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
77 АГ 5987789  
КУСАКОВ Р.В.



Фотографические изображения изделия:

**Набор реагентов для количественного определения антимюллера гормона электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Anti-Mullerian Hormone (eCLIA)/AMH))**

Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.  
(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай



Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения антимюллера гормона электрохемилюминесцентным методом в сыворотке

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Би человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Anti-Mullerian Hormone (eCLIA)/AMH))




Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения антимюллера гормона электрохемилюминесцентным методом в сыворотке  
ООО ЦРМИ [INFO@CIRMI.RU](mailto:INFO@CIRMI.RU) [WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU](http://WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU) ви человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Anti-Mullerian Hormone (eCLIA)/AMH))



Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения антимюллерова гормона электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме




Калибратор (высокий уровень), Калибратор (низкий уровень), Материал контрольный (высокий уровень), Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов  
 ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU люллова гормона электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для  
 диагностики in vitro (Anti-Mullerian Hormone (eCLIA)/AMH))

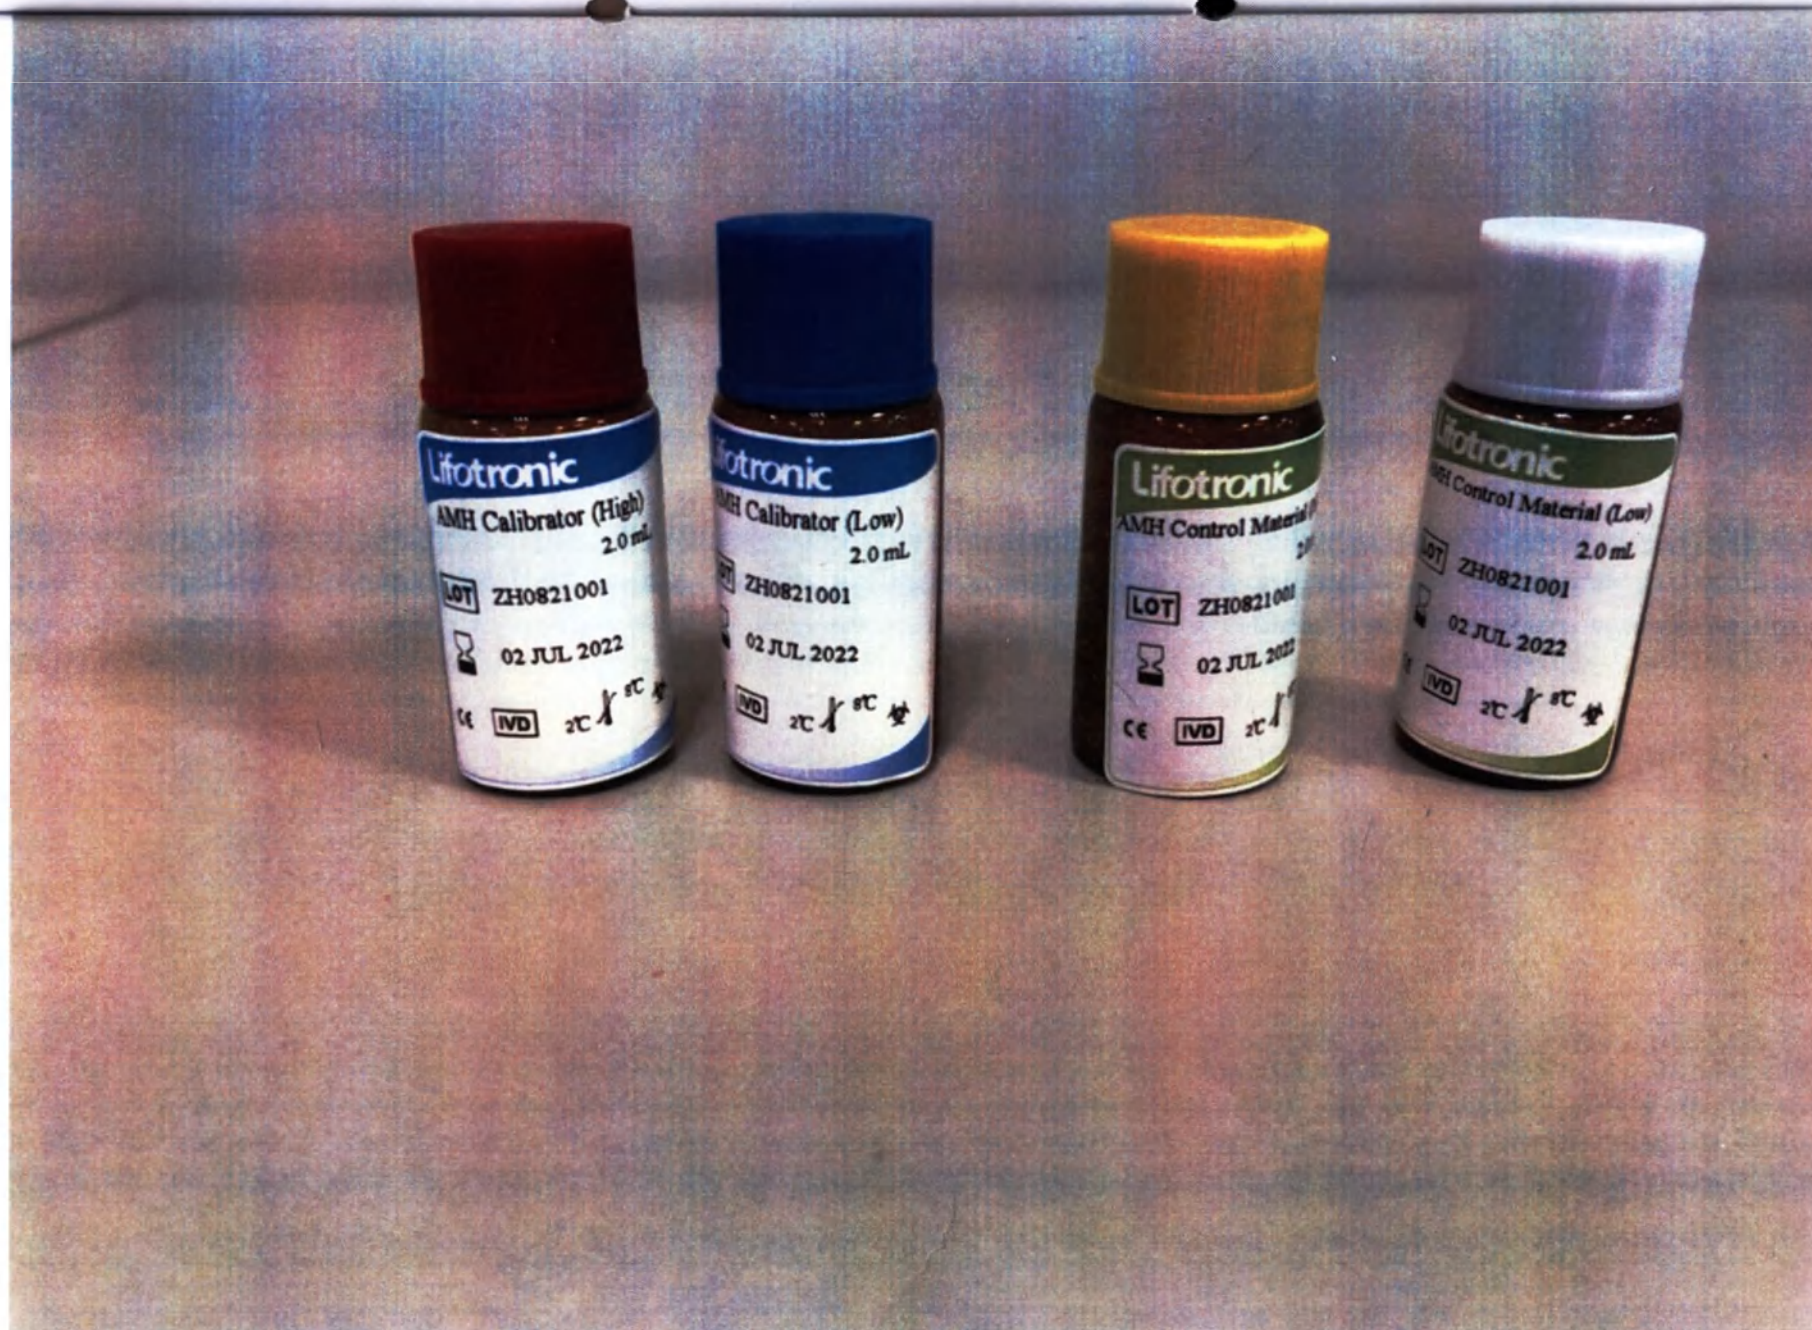


Калибратор (высокий уровень), Калибратор (низкий уровень), Материал контрольный (высокий уровень), Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов

мюллерова гормона электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Anti-Mullerian Hormone (eCLIA)/AMH))

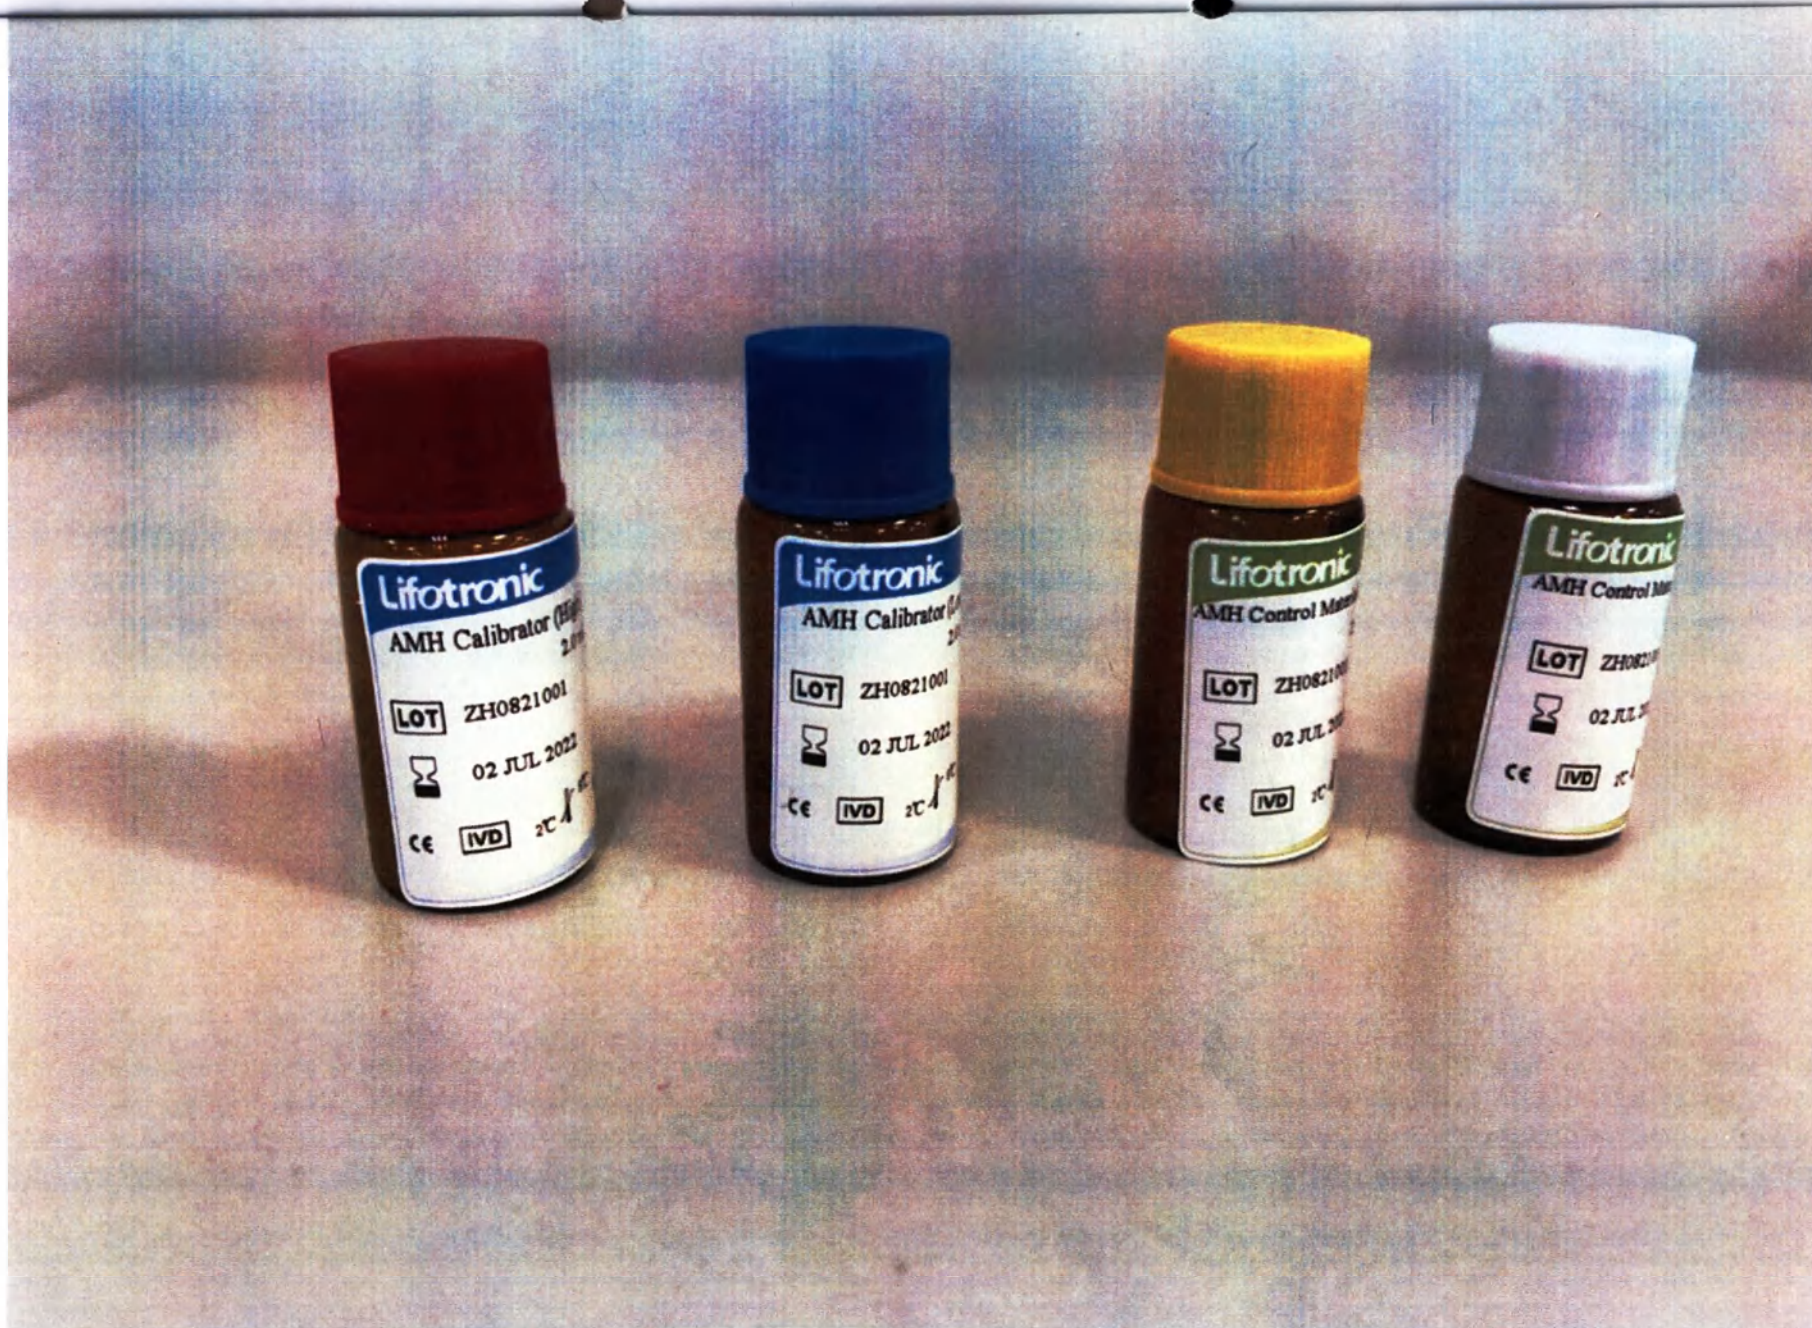

Калибратор (высокий уровень), Калибратор (низкий уровень), Материал контрольный (высокий уровень), Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU юллерова гормона электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Anti-Mullerian Hormone (eCLIA)/AMH))

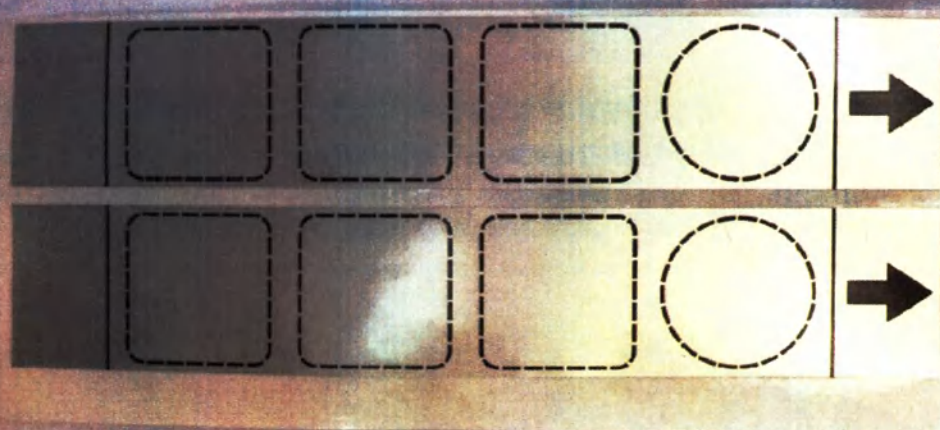

### AMH Quality Control RFID

**LOT** ZH0821001

 02 JUL 2022

QC Range (Low): 0.805-2.123 ng/mL

QC Range (High): 5.091-13.42 ng/mL

**Lifotronic**

Этикетка результатов значений материалов контрольных (Набор реагентов для количественного определения антимюллерова гормона электрохемилуминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Anti-Mullerian Hormone (eCLIA)/AMH))

Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью и подписью: 7 листа (-ов)

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Носова Т.А  
М.П.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
77 АГ 5987789  
КУСАЙЛО Р.В.

