

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

12 2021 г.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789

КУСАНЛО Р.В.

Фотографические изображения изделия:

Кассета с реагентами для регулировки высокого напряжения (High-Voltage Adjustment Reagent) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro

«Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.»
(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай



High-Voltage Adjustment Reagent

Components

MB 1×7.0mL

REF 697015

LOT 2103190100

RB 1×10.0mL

18 MAR 2022

Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.
Unit A, 4th Floor, Building 15, Yiping Estate, No. 1008
Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen City,
Guangdong Province, 518055, P. R. China
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726



High-Voltage Adjustment Reagent

MB 7.0 mL

LOT 2103190100

RB 10.0 mL

SN 00002

19 MAR 2021

18 MAR 2022



Lifotronic

High-Voltage Adjustment Reagent


【Product name】

High-Voltage Adjustment Reagent

【Specification】

REF NO.	Package Size
679015	50 T

【Intended use】

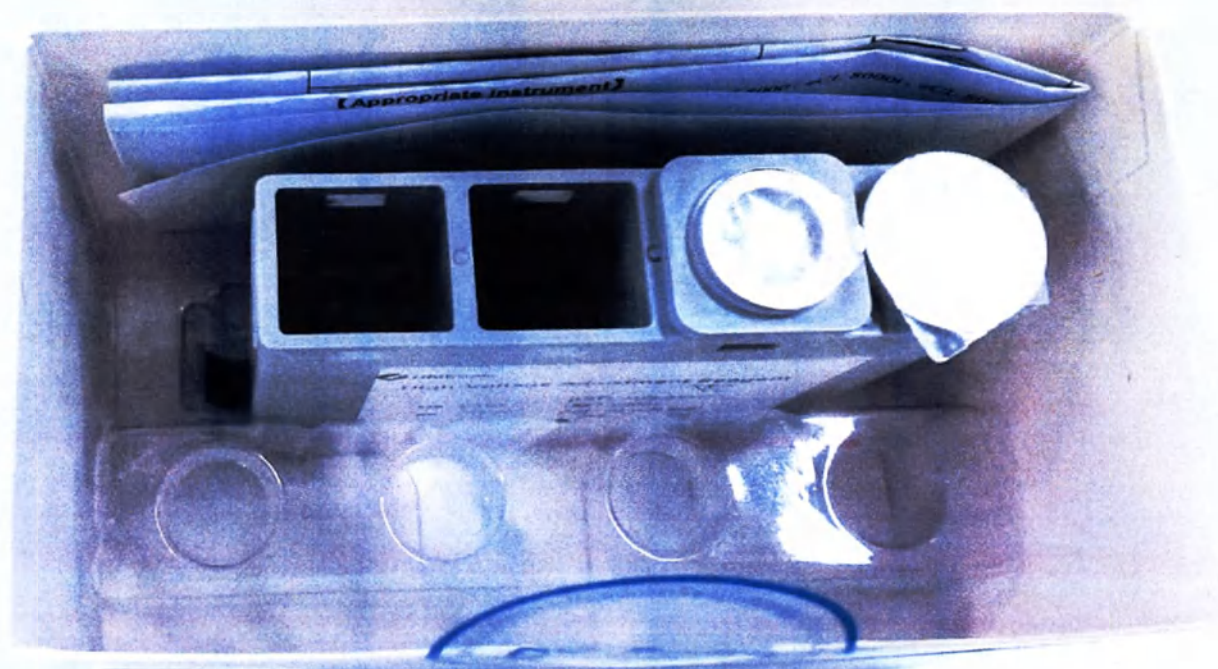

Общий вид медицинского изделия (Кассета с реагентами для регулировки высокого напряжения (High-Voltage Adjustment Reagent) для автоматических электрохемилюминесцентных анализаторов ECL для диагностики in vitro)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 3 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А.
М.П.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАЙЛО Р.В.