

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»»
Носова Т.А.



2022 г.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАЙЛО Р.В.


Фотографические изображения изделия:

**Набор реагентов для количественного определения ракового антигена 125
электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro
(Cancer Antigen 125 (eCLIA) / CA125)**


Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.
(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай



Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения ракового антигена 125 электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Cancer Antigen 125 (eCLIA) / CA125))

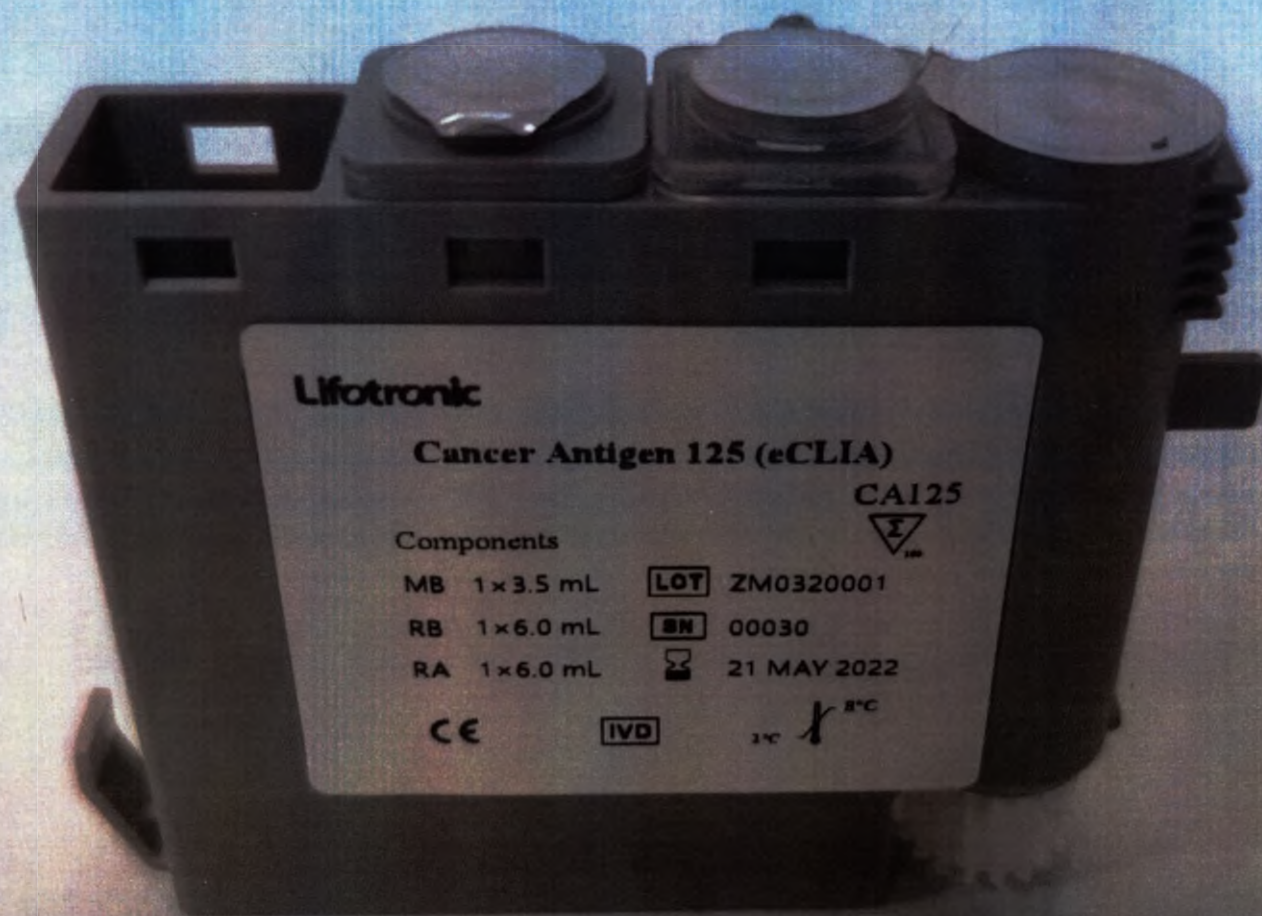


Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения ракового антигена 125 электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Cancer Antigen 125 (eCLIA) / CA125))

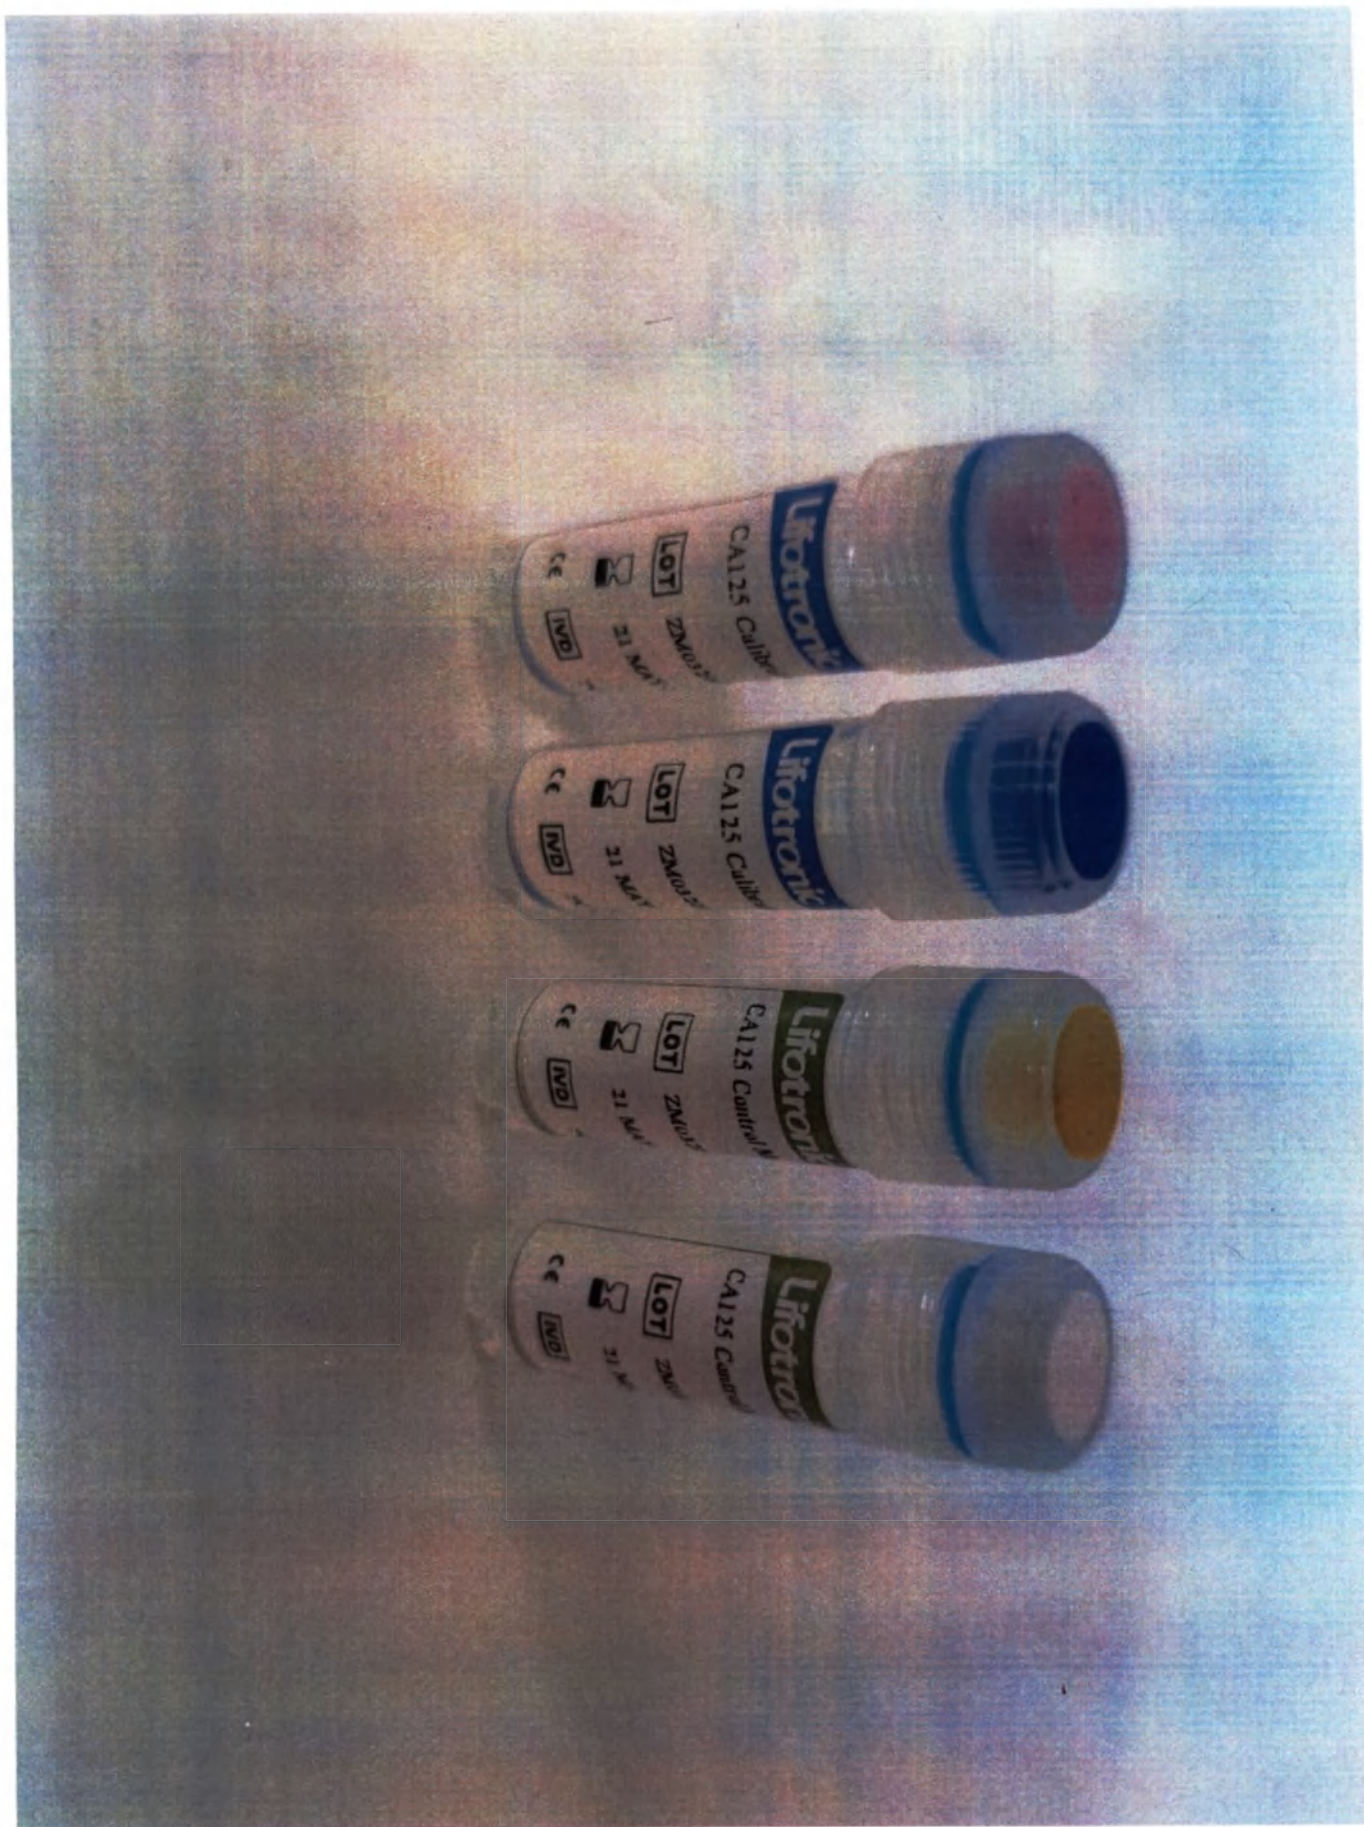





Калибратор (высокий уровень), Калибратор (низкий уровень), Материал контрольный (высокий уровень), Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов для количественного определения ракового антигена 125 электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Cancer Antigen 125 (eCLIA) / CA125))

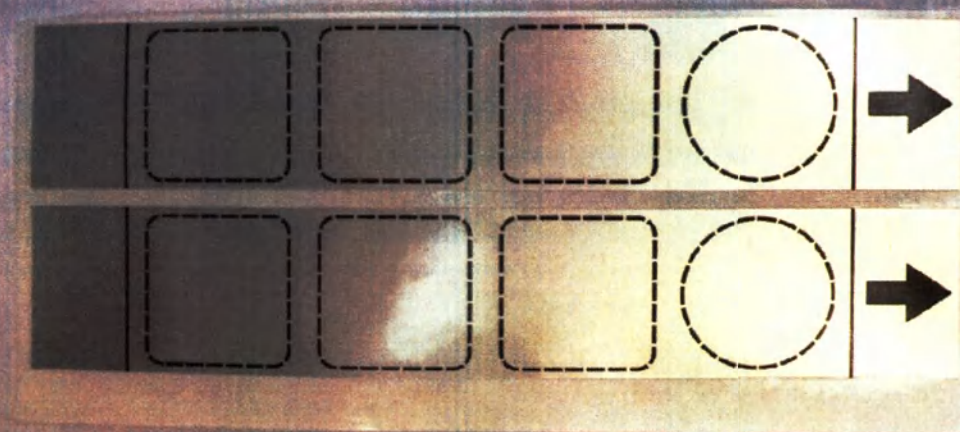

CEA Quality Control RFID

LOT ZM0220001

 27 MAY 2022

QC Range (Low): 4.071-10.73 ng/mL

QC Range (High): 68.90-181.6 ng/mL

Lifotronic

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 8 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77-АА-6387789
КУСАНКО Р.В.

