

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»»

Носова Т.А.

«28» *ноябрь* 2022 г.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАЙЛО Р. В.


Фотографические изображения изделия:

**Набор реагентов для количественного определения антител к тиреоглобулину
электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro
(Thyroglobulin Antibody (Electrochemiluminescence Immunoassay) / Anti-TG)**

Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.
(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай



Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения антител к тиреоглобулину электрохемилюминесцентным методом на FCL для диагностики in vitro (Thyroglobulin Antibody (Electrochemiluminescence Immunoassay) / Anti-TG)

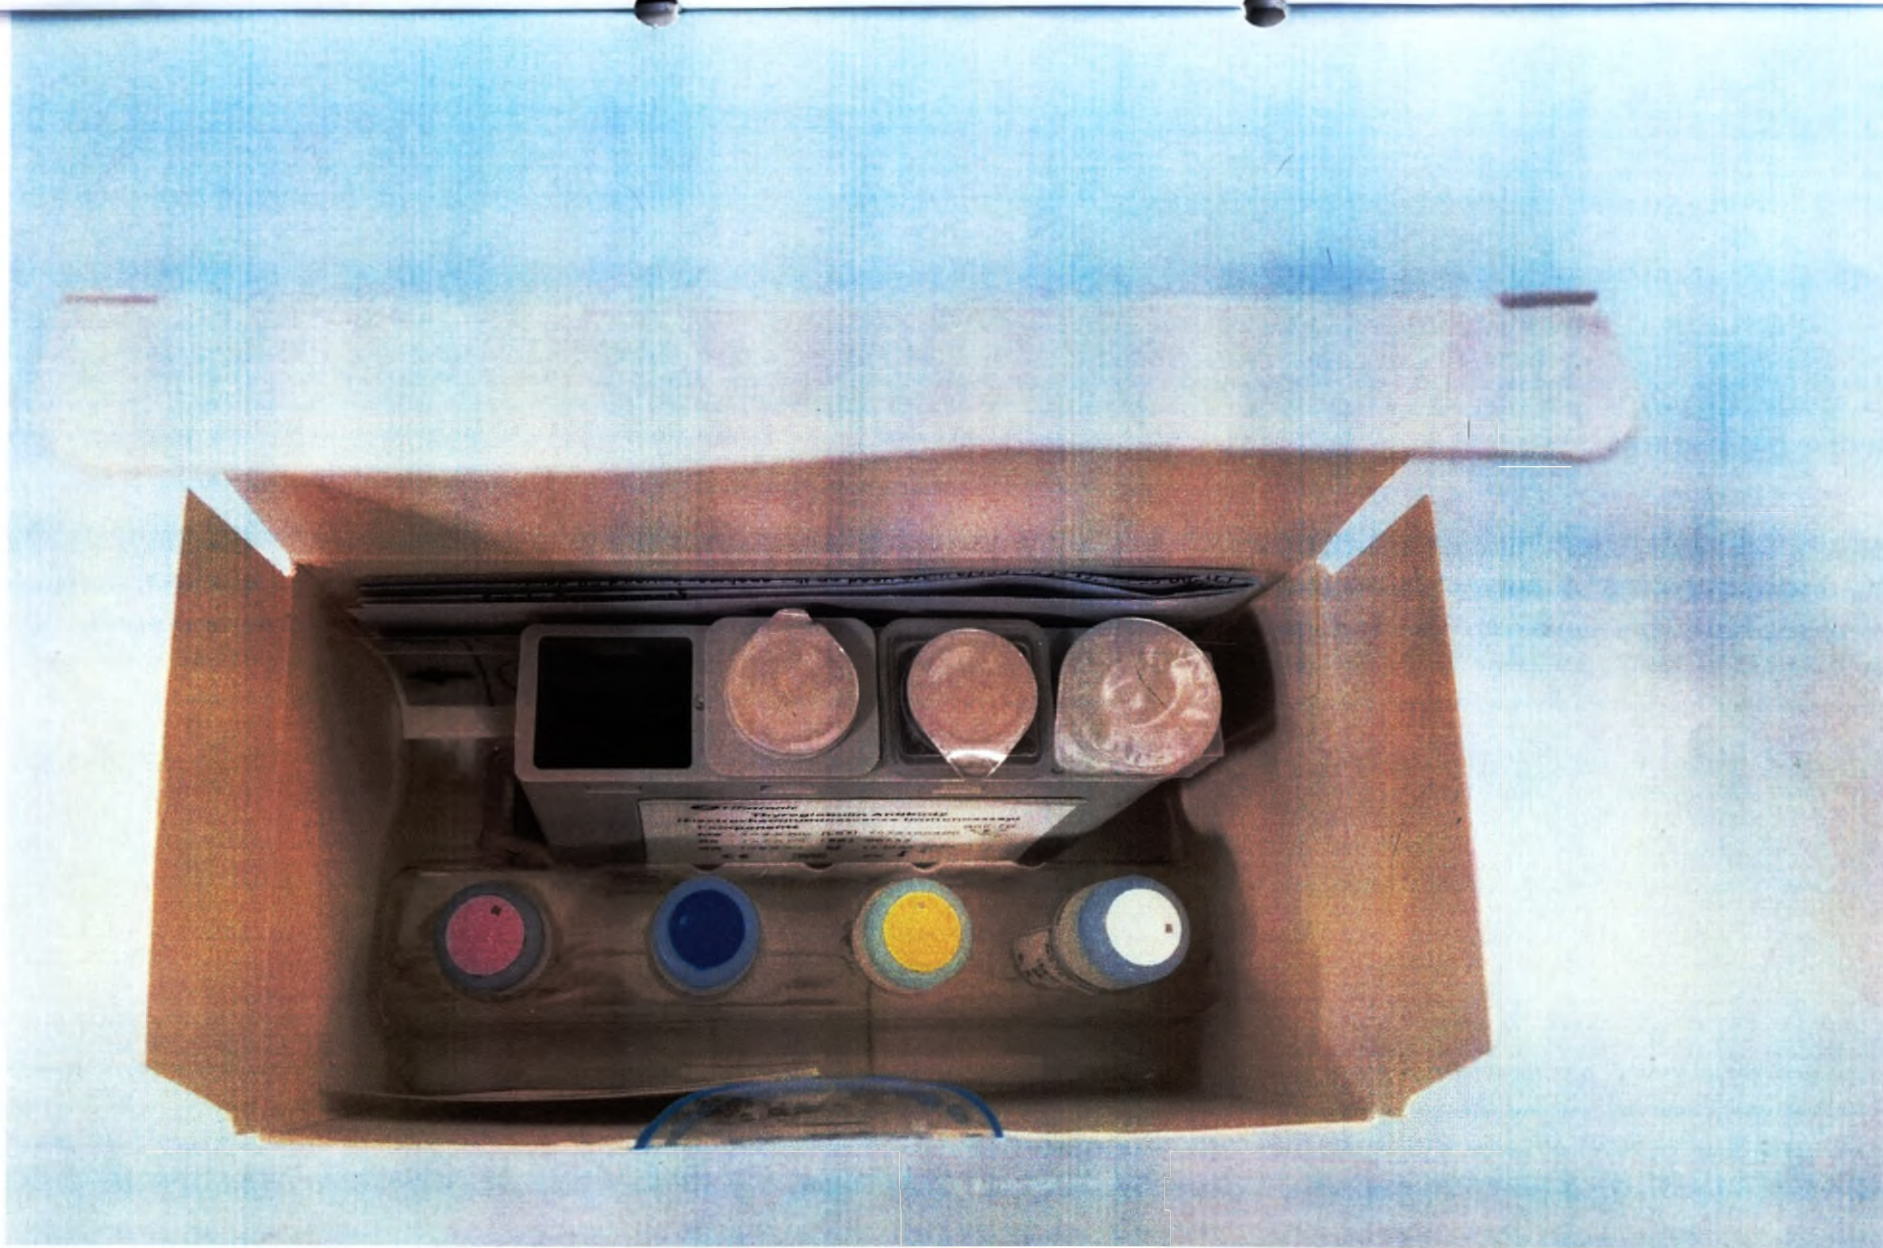


Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения антител к тиреоглобулину электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Thyroglobulin Antibody (Electrochemiluminescence Immunoassay) / Anti-TG)




Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения антител к тиреоглобулину электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Thyroglobulin Antibody (Electrochemiluminescence Immunoassay) / Anti-TG)




Калибратор (высокий уровень), Калибратор (низкий уровень), Материал контрольный (высокий уровень), Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов к тиреоглобулину электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Thyroglobulin Antibody (Electrochemiluminescence Immunoassay) / Anti-TG)

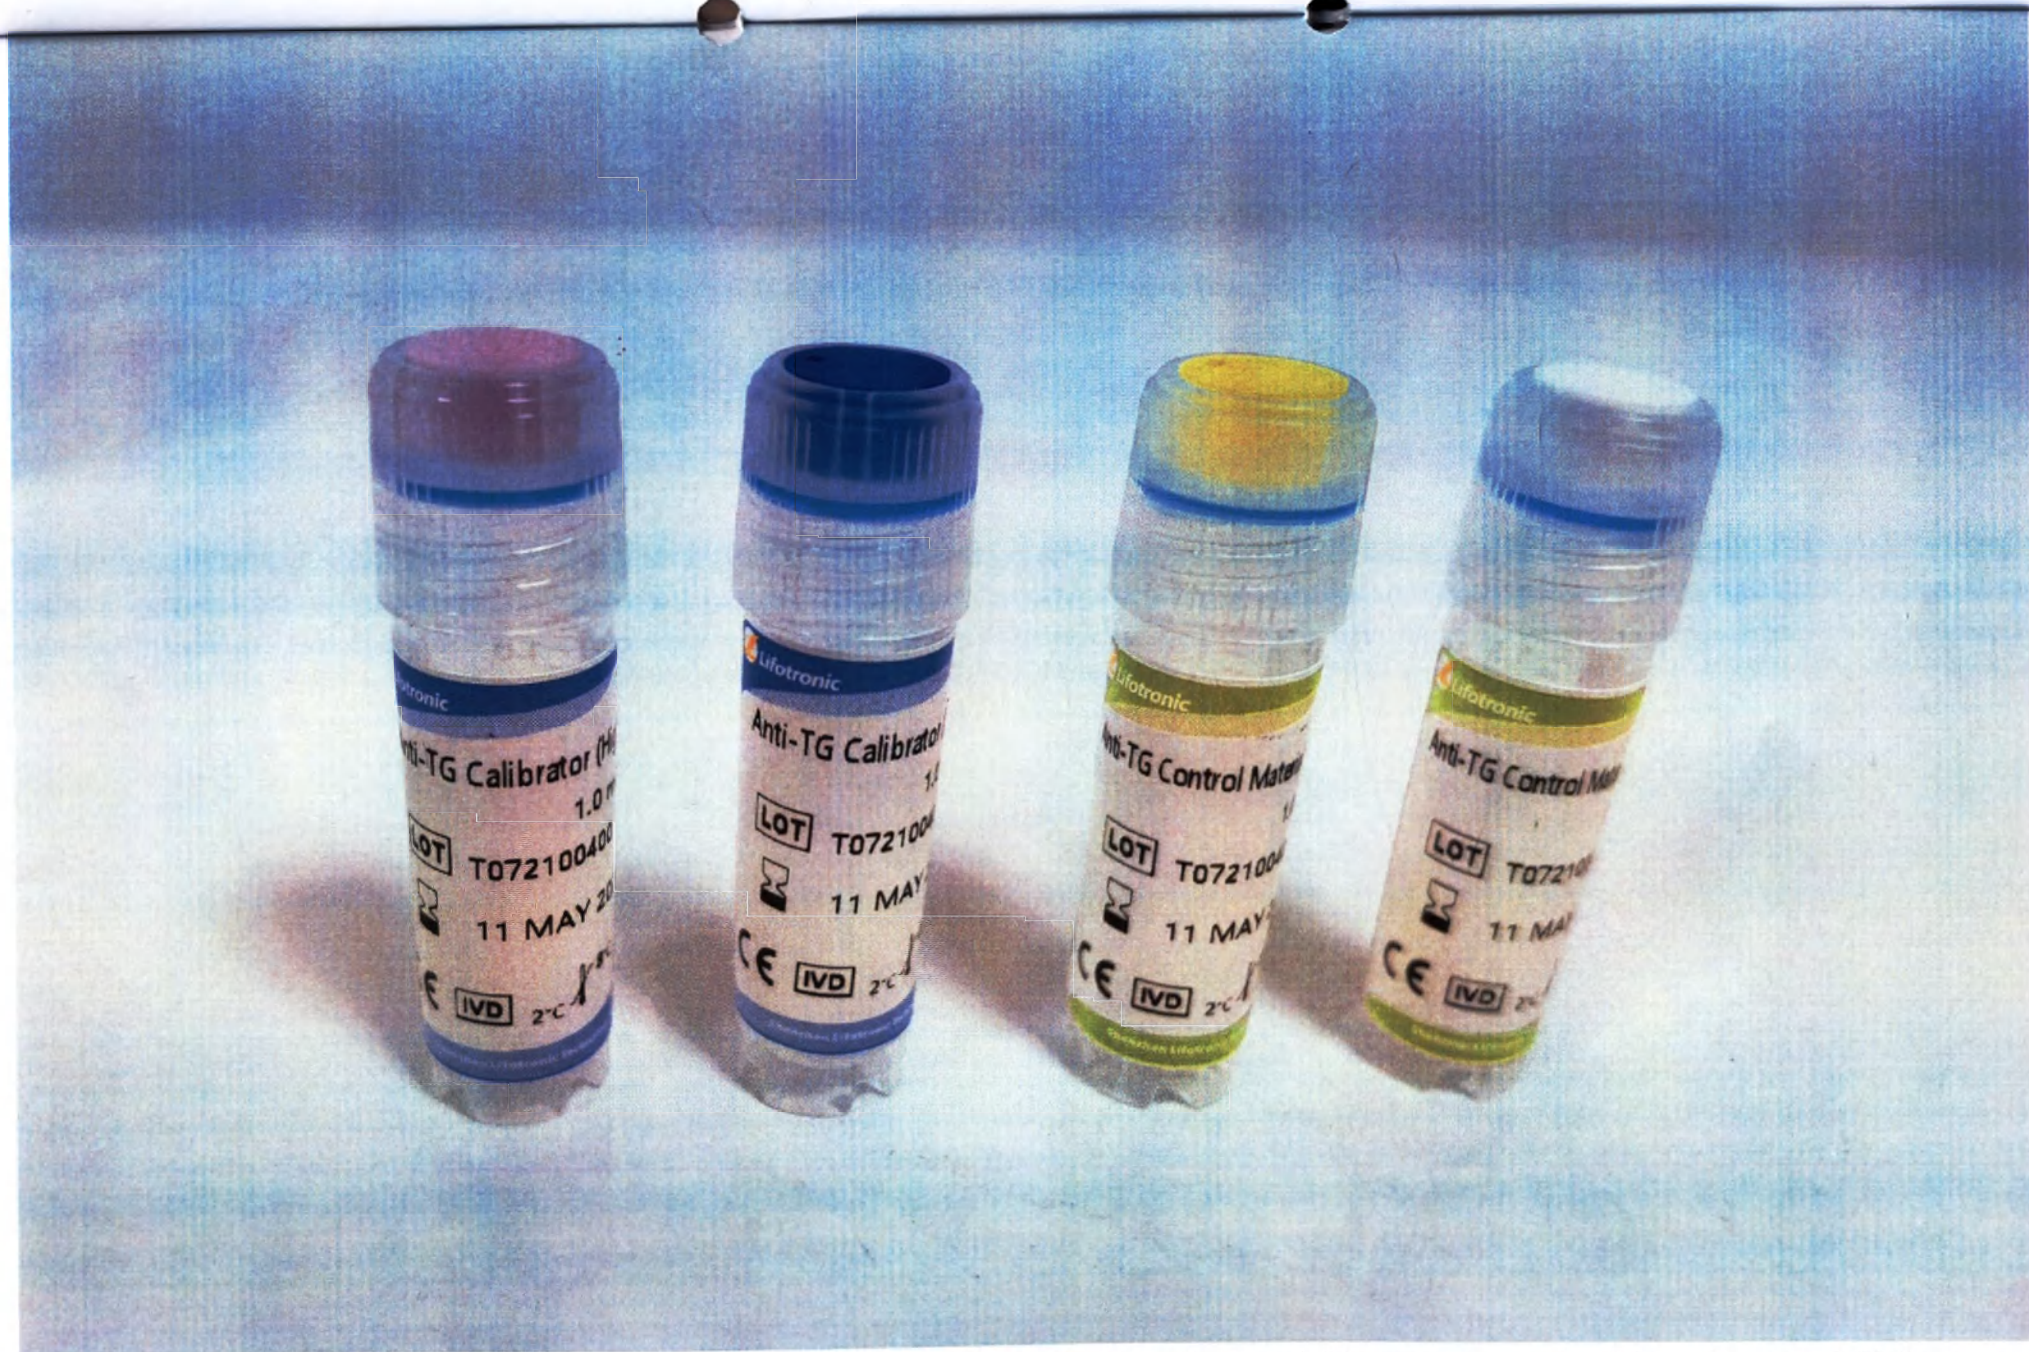

Калибратор (высокий уровень), Калибратор (низкий уровень), Материал контрольный (высокий уровень), Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов 000 ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU ител к тиреоглобулину электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Thyroglobulin Antibody (Electrochemiluminescence Immunoassay) / Anti-TG)

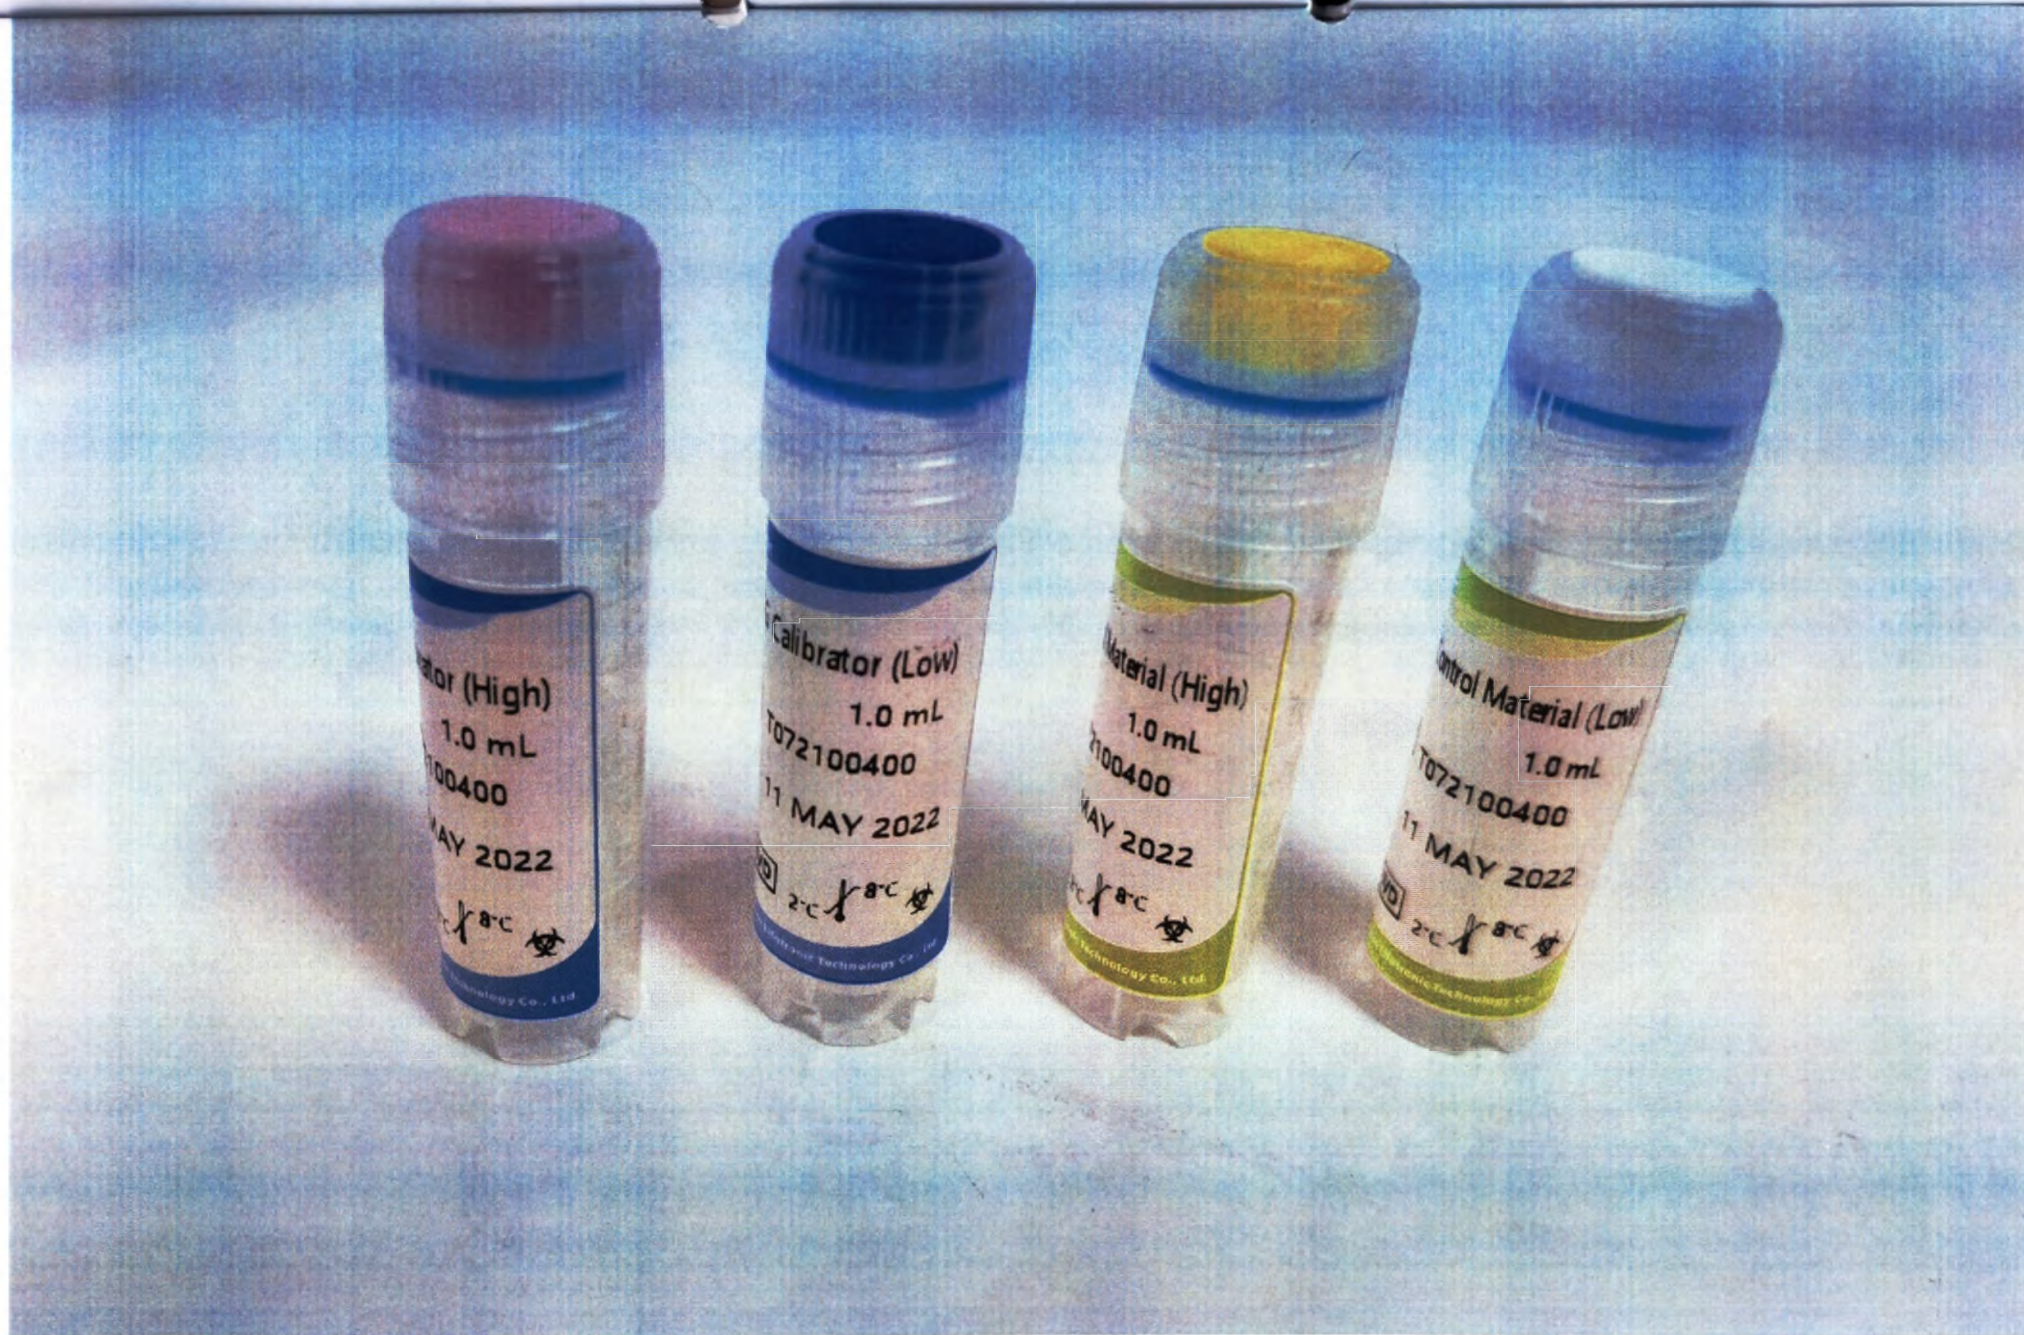

Калибратор (высокий уровень), Калибратор (низкий уровень), Материал контрольный (высокий уровень), Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов

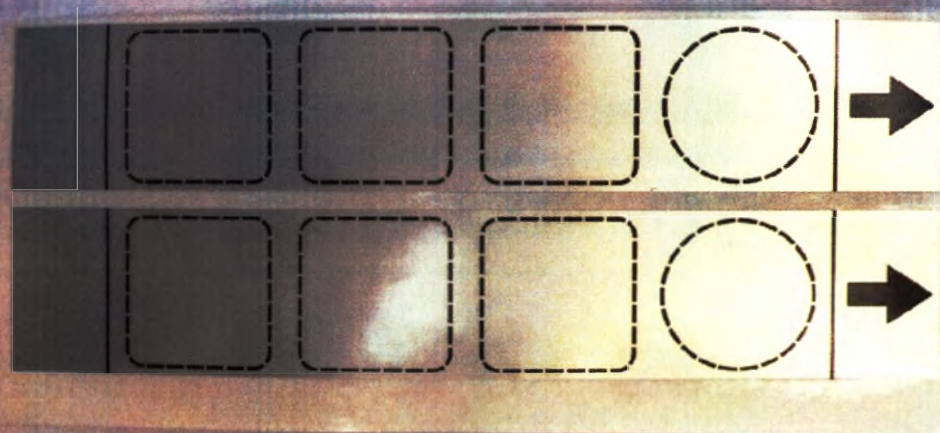

Anti-TG Quality Control

LOT


T072100400



11 MAY 2022

QC Range (Low) : 79.471-185.433 IU/mL

QC Range (High) : 601.720-1404.012 IU/mL



Этикетка результатов значений материалов контрольных (Набор реагентов для количественного определения антител к тиреоглобулину электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Thyroglobulin Antibody (Electrochemiluminescence Immunoassay) / Anti-TG)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 9 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А.
М.П.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАЙЛО Р.В.

