



«Анализатор автоматический иммунохимический хемилюминесцентный MagnoLIA с принадлежностями по СНАБ 421457.002 ТУ («MagnoLIA»)»



Фотографические изображения медицинского изделия

Наименование	Наличие маркировки
Основной состав:	
Анализатор автоматический иммунохимический хемилюминесцентный MagnoLIA со встроенным «ПО MagnoLIA»	Стр.2,3,4
Силовой кабель для подключения анализатора к источнику питания	Стр.5
Ethernet кабель для подключения анализатора к автоматизированному рабочему месту	Стр.5
Трубопроводы: гидравлические соединители, трубки, заглушки и электрические датчики для внешних резервуаров	Стр.6
Штатив для реакционных кювет	Стр.6
Сменные наконечники в штативе	Стр. 7
Штатив для флаконов с калибраторами/контрольными сыворотками	Стр.8
Штатив для пробирок с образцами	Стр.8
Резервуар 5 Л для промывочного раствора	Стр.9
Резервуар 10 Л для отходов	Стр.9
Реакционные кюветы	Стр.10
Водно-солевой раствор для промывки реакционных кювет «Буфер W1»	Стр.11
«Претриггер»	Стр.12
«Триггер»	Стр.12
Концентрированный водный раствор для промывки игл «Триал 5000х»	Стр.12
Водно-солевой раствор для разведения образцов сыворотки и плазмы крови «Дилуэнт 1»	Стр.13
Паспорт	-
Руководство по эксплуатации.	-
Принадлежности:	
Ручки для подъема и перемещения	14
Металлический кронштейн для установки автоматизированного рабочего места	14
Плавкий предохранитель (дополнительный)	15




Анализатор автоматический иммунохимический хемилюминесцентный Magnolia со встроенным «ПО Magnolia»

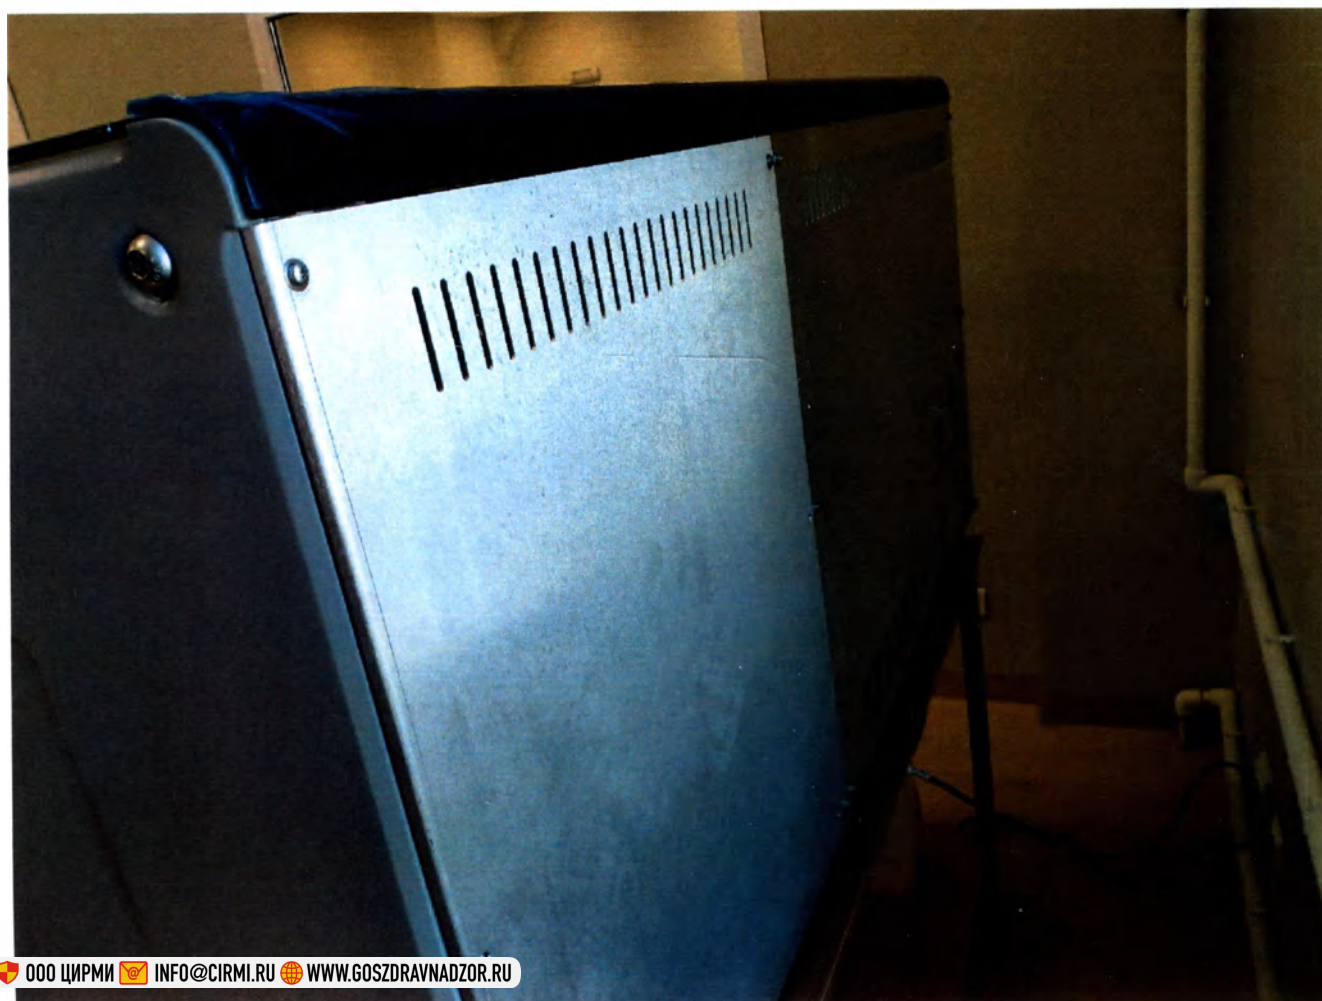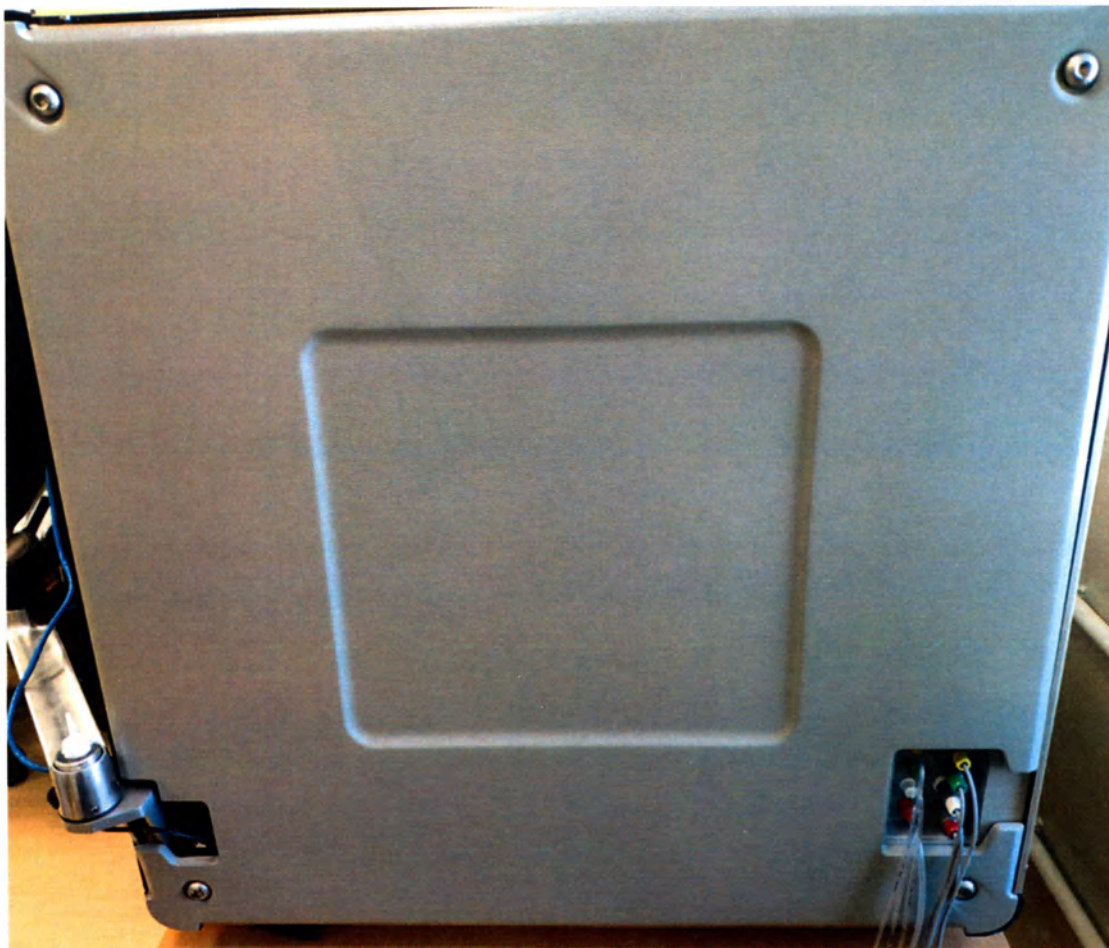

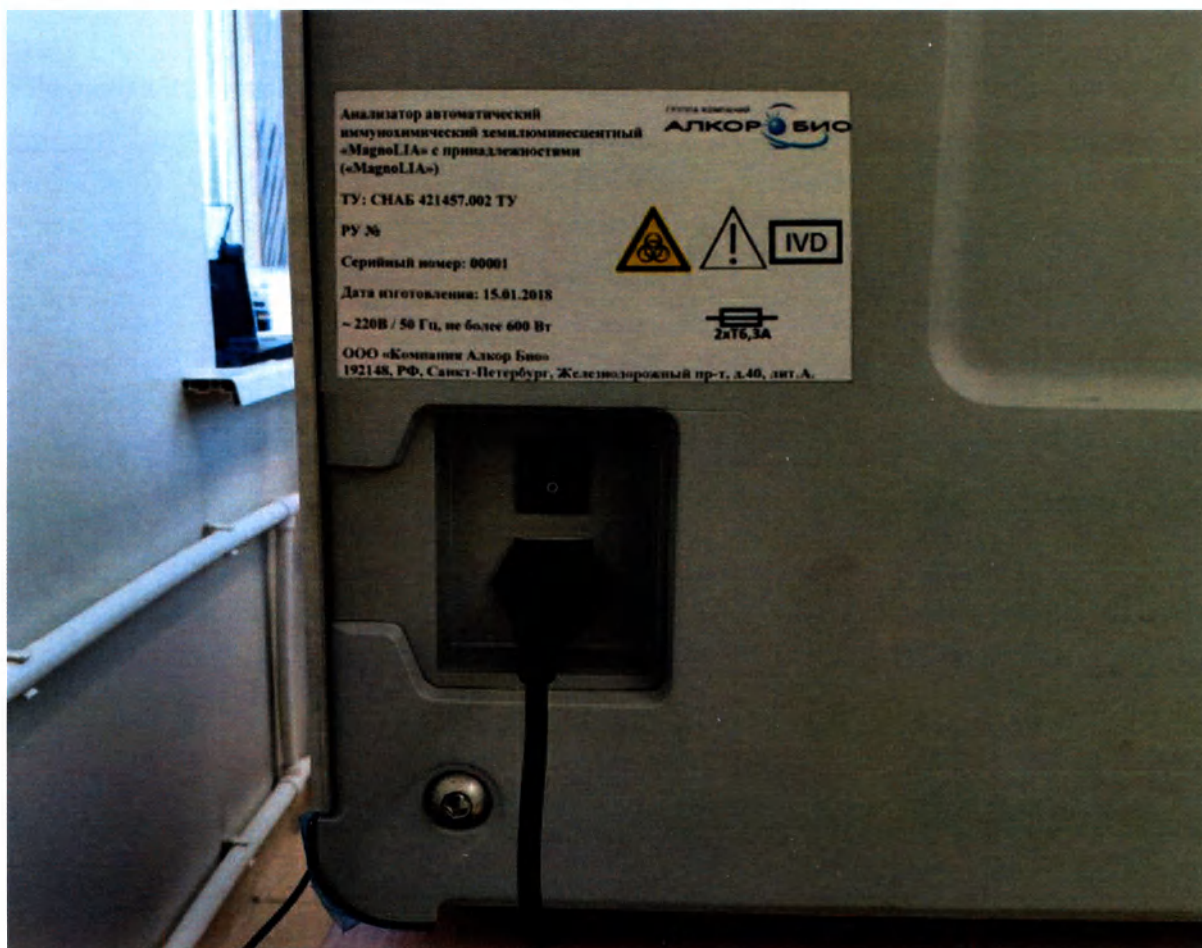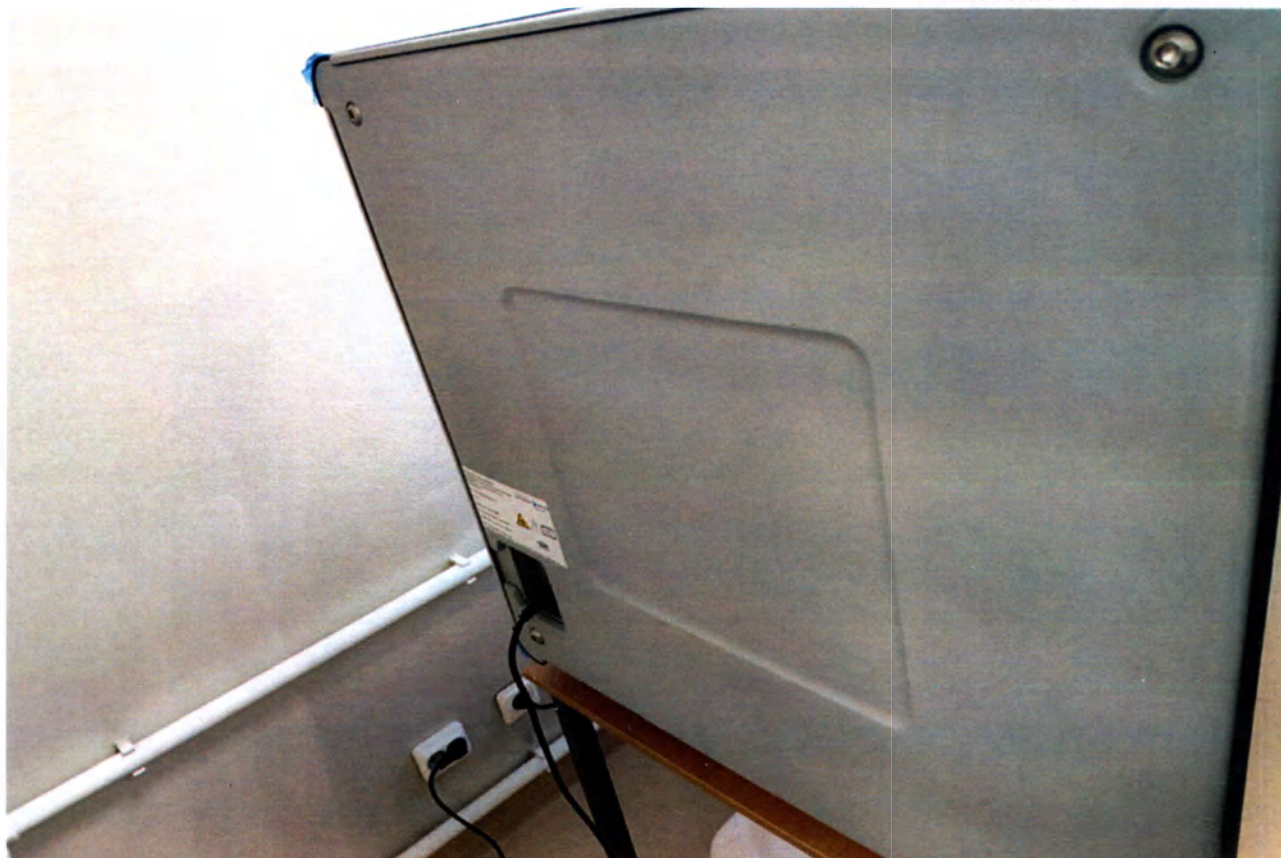

Силовой кабель для подключения анализатора к источнику питания

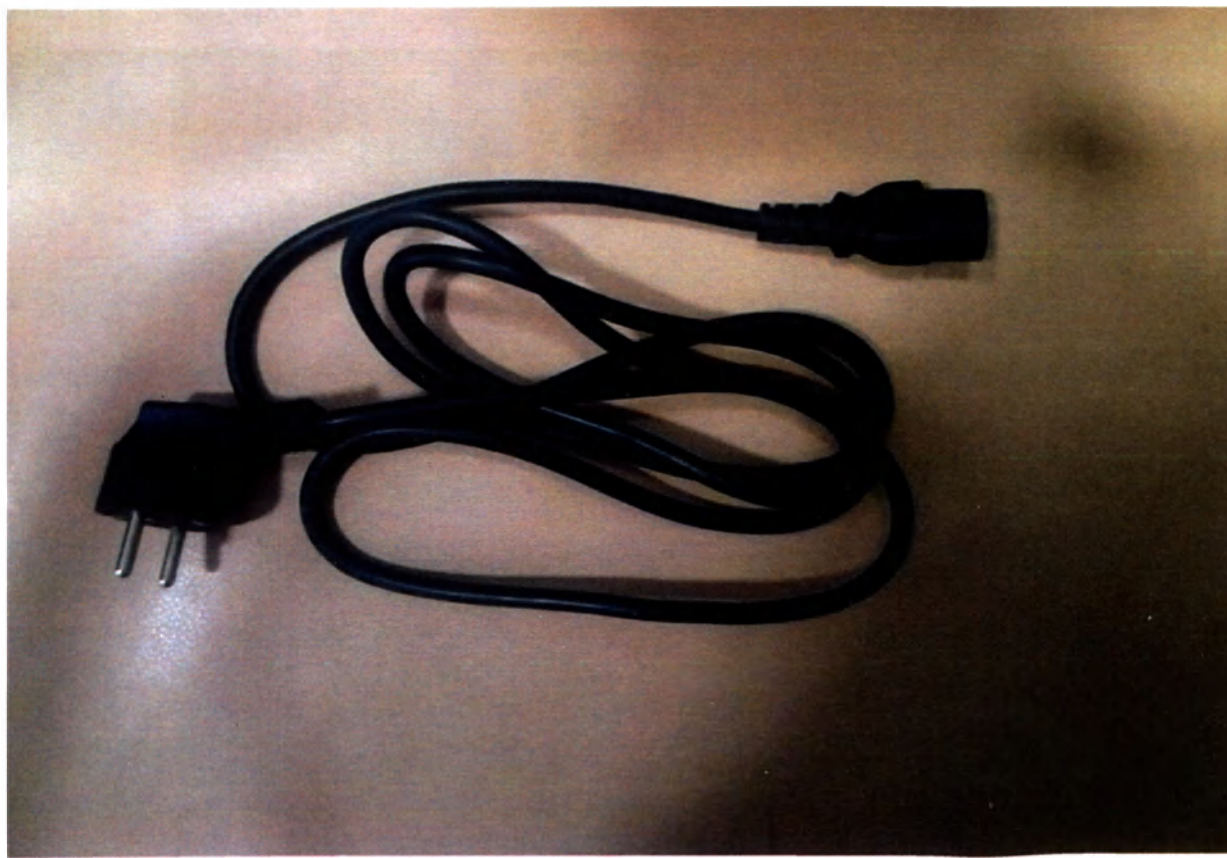


Ethernet кабель для подключения анализатора к автоматизированному рабочему месту




Трубопроводы: гидравлические соединители, трубки, заглушки и электрические датчики для внешних резервуаров




Штатив для реакционных кювет

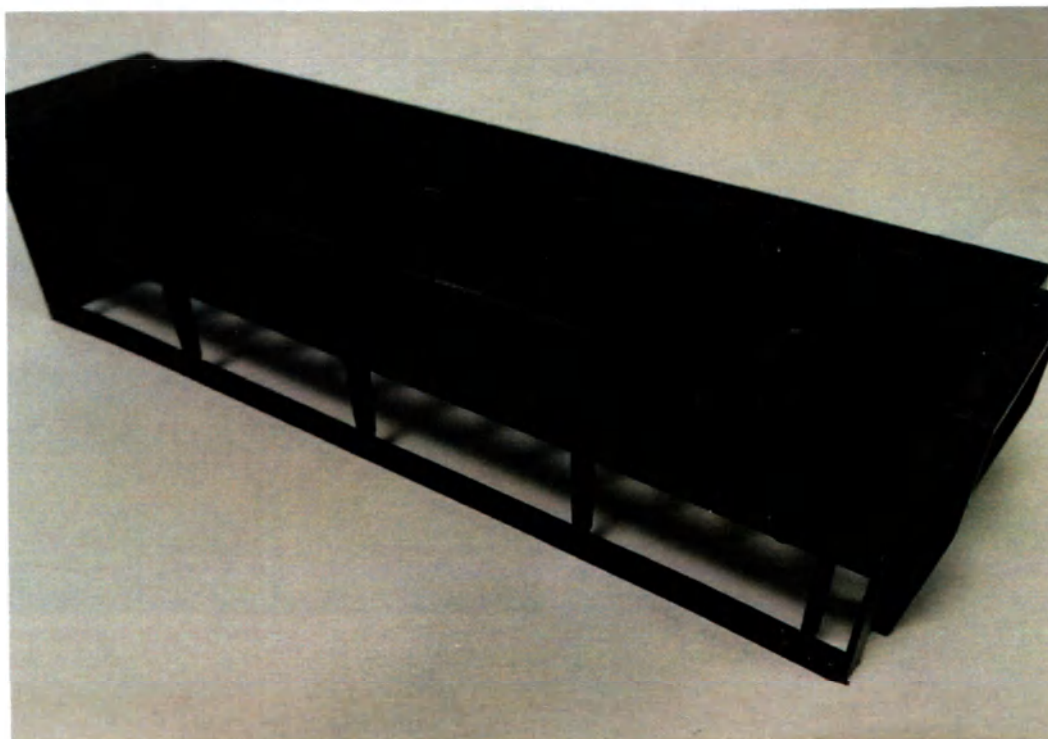

Сменные наконечники в штативе

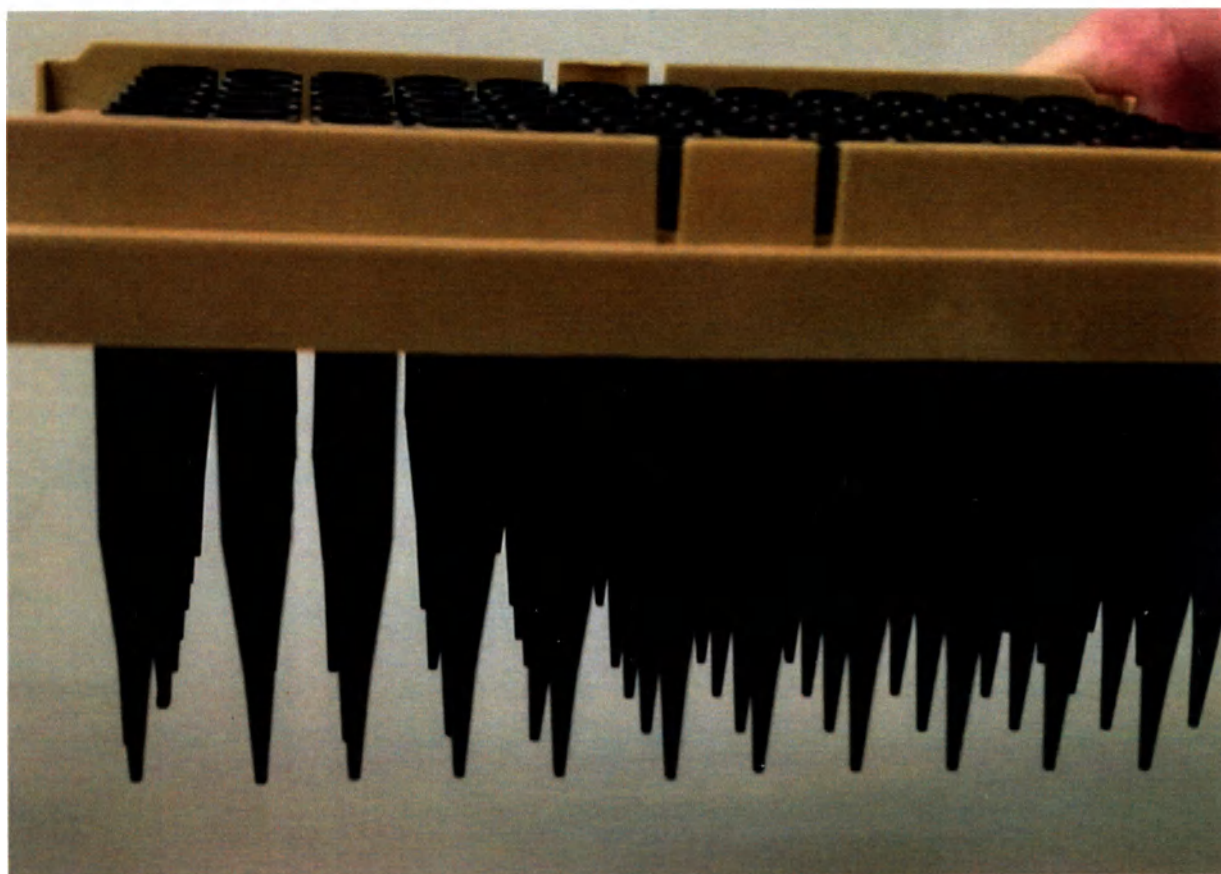


Штатив для флаконов с калибраторами/контрольными сыворотками

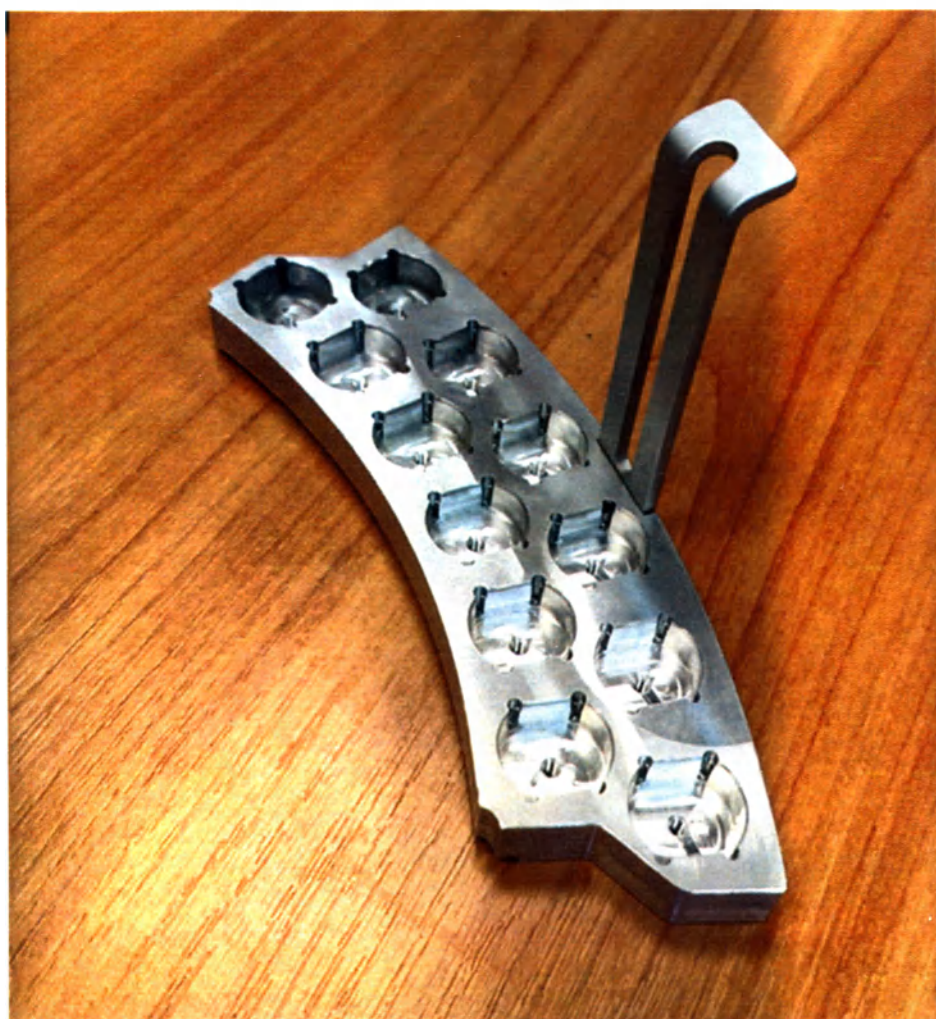

Штатив для пробирок с образцами





Резервуар 5 Л для промывочного раствора

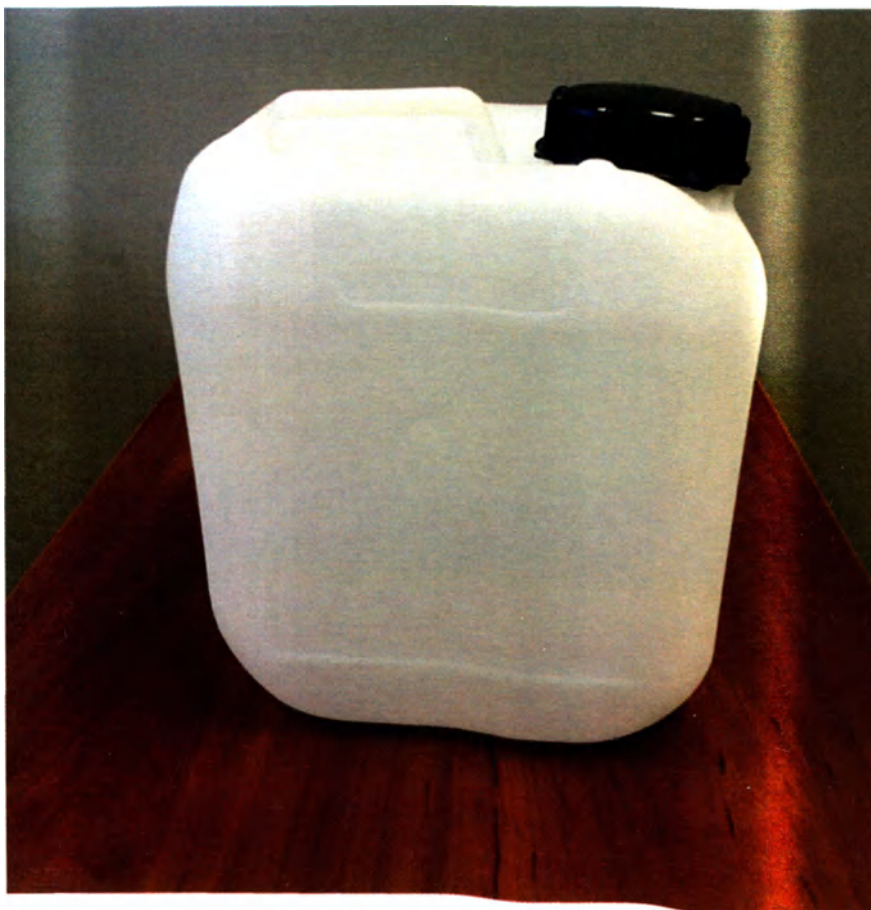

Резервуар 10 Л для отходов



Реакционные кюветы

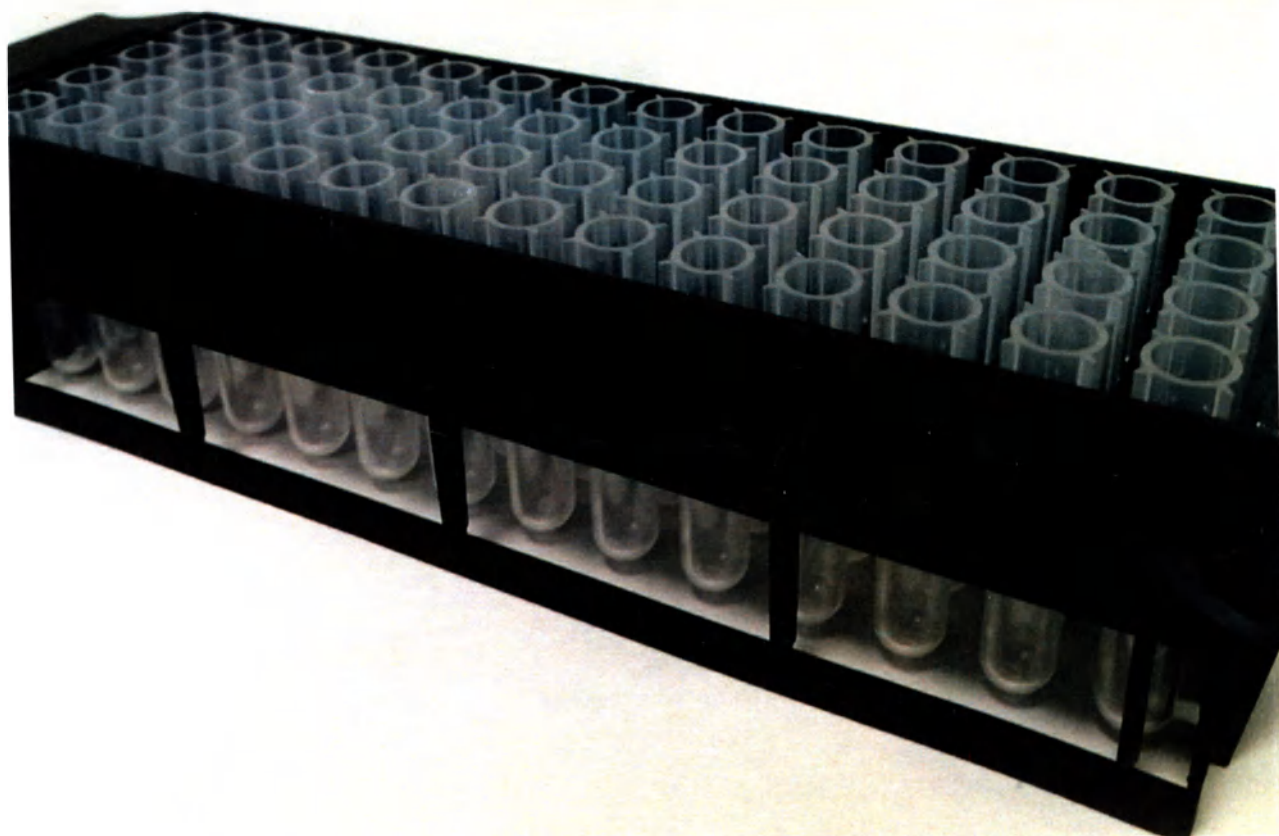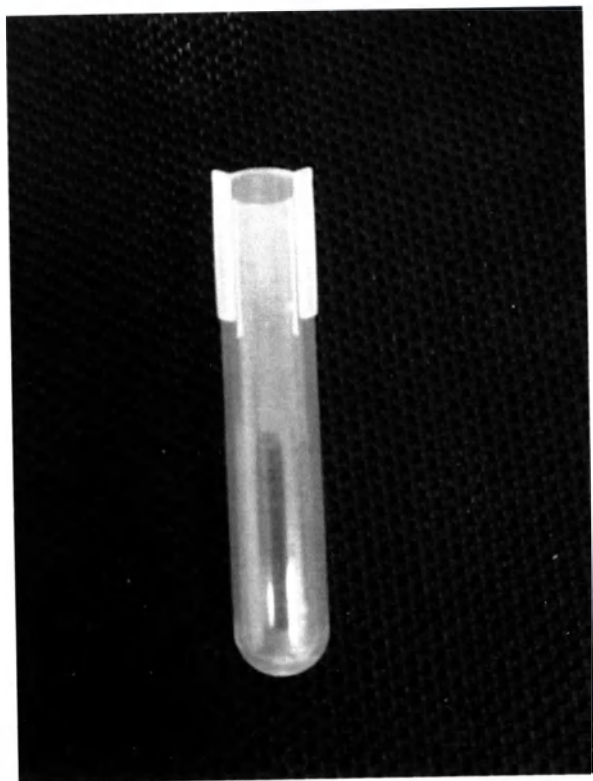


Водно-солевой раствор для промывки реакционных кювет «Буфер W1»



«Претриггер», «Триггер»



Концентрированный водный раствор для промывки игл «Триал 5000х»

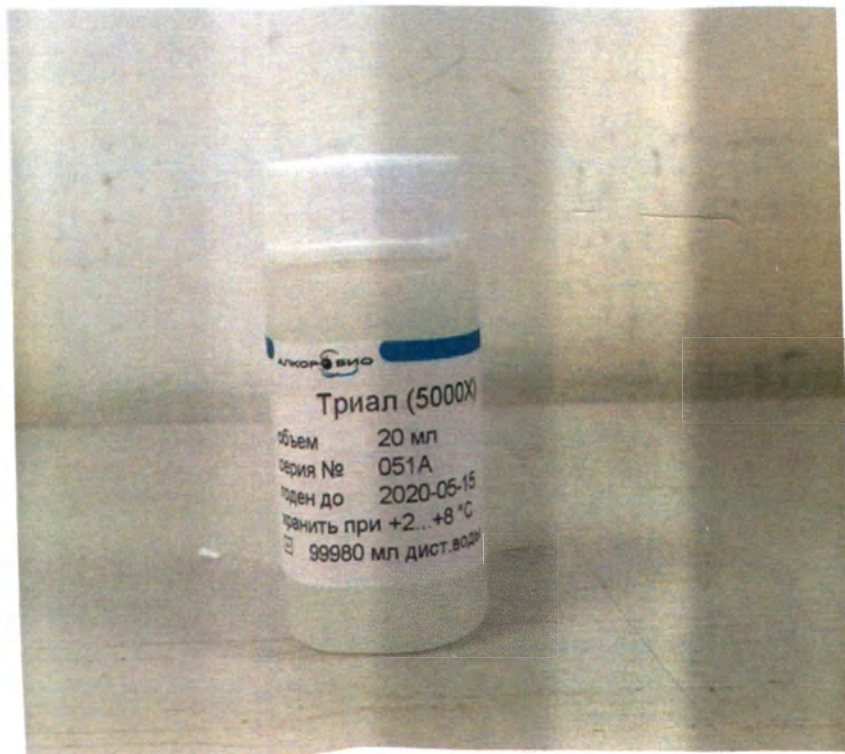


Водно-солевой раствор для разведения образцов сыворотки и плазмы крови «Дилуэнт 1»



Ручки для подъема и перемещения



Металлический кронштейн для установки автоматизированного рабочего места

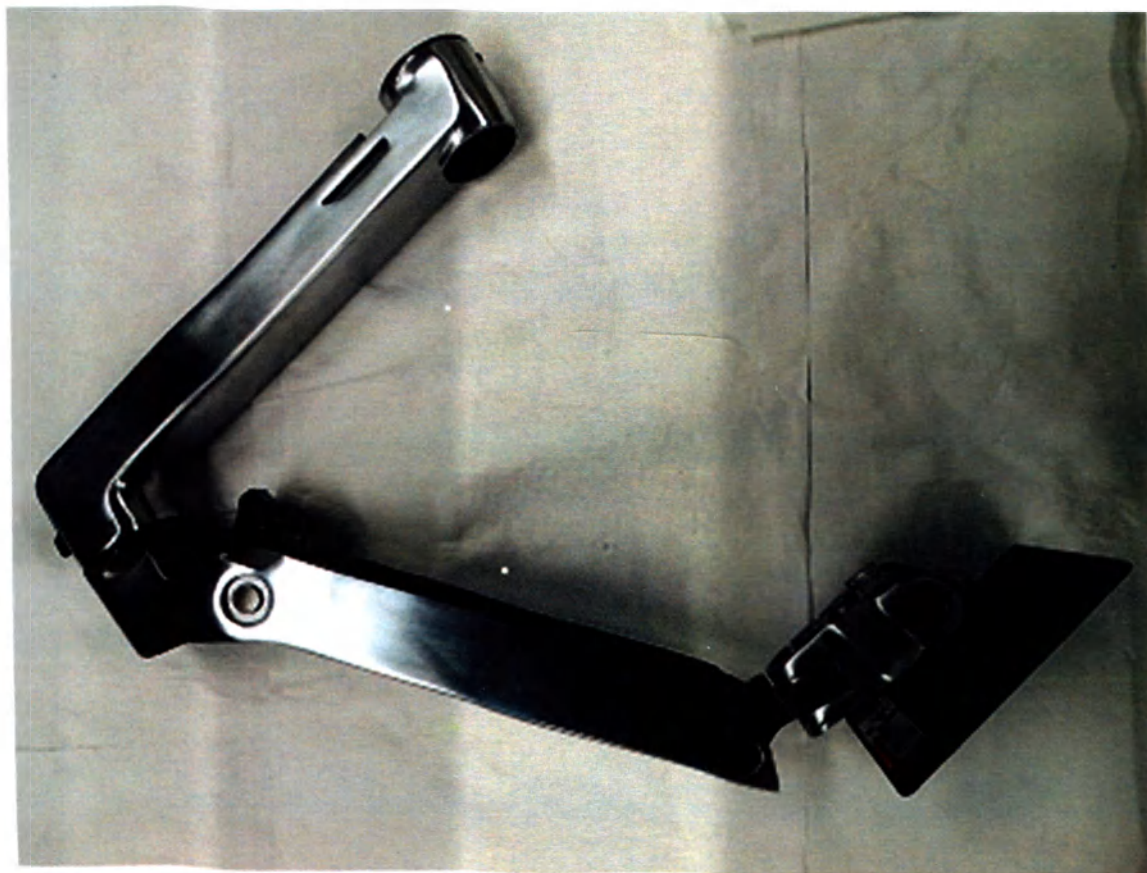


Плавкий предохранитель (дополнительный)



Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 13 (пятидесять) лист 06

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Д.Г. Полинцев

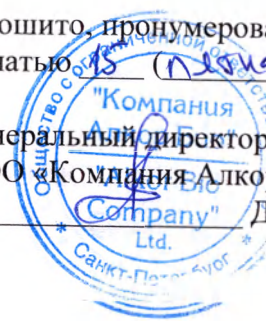


**«Анализатор автоматический иммунохимический
хемилюминесцентный MagnoLIA с принадлежностями
по СНАБ 421457.002 ТУ («MagnoLIA»)»**

Образцы маркировки медицинского изделия

Наименование	Наличие маркировки
Основной состав:	
Анализатор автоматический иммунохимический хемилюминесцентный MagnoLIA со встроенным «ПО MagnoLIA»	Стр.2
Силовой кабель для подключения анализатора к источнику питания	-
Ethernet кабель для подключения анализатора к автоматизированному рабочему месту	-
Трубопроводы: гидравлические соединители, трубки, заглушки и электрические датчики для внешних резервуаров	-
Штатив для реакционных кювет	-
Сменные наконечники в штативе	-
Штатив для флаконов с калибраторами/контрольными сыворотками	-
Штатив для пробирок с образцами	-
Резервуар 5 Л для промывочного раствора	-
Резервуар 10 Л для отходов	Стр.7
Реакционные кюветы	-
Водно-солевой раствор для промывки реакционных кювет «Буфер W1»	Стр.3
«Претриггер»	Стр.4
«Триггер»	Стр.4
Концентрированный водный раствор для промывки игл «Триал 5000х»	Стр.5
Водно-солевой раствор для разведения образцов сыворотки и плазмы крови «Дилуэнт 1»	Стр.6
Паспорт	-
Руководство по эксплуатации.	-
Принадлежности:	
Ручки для подъема и перемещения	-
Металлический кронштейн для установки автоматизированного рабочего места	-
Плавкий предохранитель (дополнительный)	-

Анализатор автоматический иммунохимический хемилюминесцентный MagnoLIA
со встроенным «ПО MagnoLIA»

Паспортная табличка

Анализатор автоматический	ГРУППА КОМПАНИЙ АЛКОР БИО
иммунохимический хемилюминесцентный	
«MagnoLIA» с принадлежностями	
ТУ: СНАБ 421457.002 ТУ	
РУ №	
Серийный номер: 00001	  
Дата изготовления: 15.01.2018	
~ 220В / 50 Гц, не более 600 Вт	 2xT6,3A
ООО «Компания Алкор Био»	
192148, РФ, Санкт-Петербург, Железнодорожный пр-т, д.40, лит.А.	

Лицевая панель



Водно-солевой раствор для промывки реакционных кювет
«Буфер W1»



МГОО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
тел./факс: +7(812)6778779, 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

**Водно-солевой раствор
для промывки реакционных кювет
«Буфер W1»**

Объем - 1л
Готов к использованию

REF 2180101

IVD




LOT 0004

+18  +25

 2020-03-12



 700

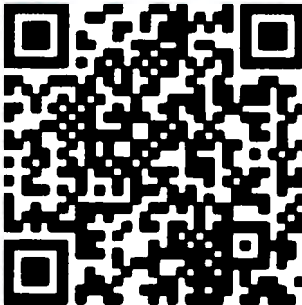

СНАБ 421457.002 ТУ
РУ

«Претриггер», «Триггер»



ООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
тел./факс: +7(812)6778779, 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

Претриггер

Объем - 0,1 л

Готов к использованию

REF 2180101

IVD

LOT 0004

+2

2020-03-12

500



СНАБ 421457.002 ТУ
РУ



ООО «Компания Алкор Био»
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
тел./факс: +7(812)6778779, 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

Триггер

Объем - 0,1 л

Готов к использованию

REF 2180101


IVD

LOT 0004

+18


2020-03-12

500

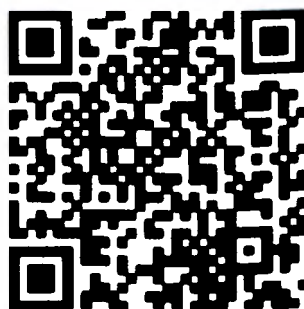


СНАБ 421457.002 ТУ
РУ

Концентрированный водный раствор для промывки игл «Триал 5000х», 0,02 Л

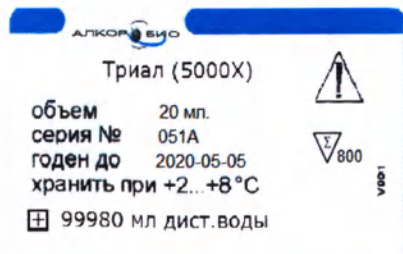

Маркировка вторичной упаковки



Резервуар 10 Л для отходов



Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 7 (семь) ли

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Д.Г. Польшин

