

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

«30» июня 2022 г.






ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789

КУСАЙЛО Р. В.

Фотографические изображения изделия:

Набор реагентов для количественного определения антител к тиреоидной пероксидазе электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Thyroid Peroxidase Antibody (Electrochemiluminescence Immunoassay) / Anti-TPO)


Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd. («Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»),
Китай

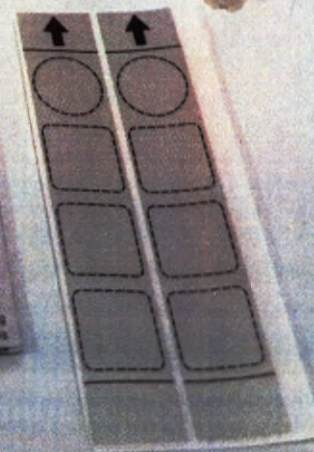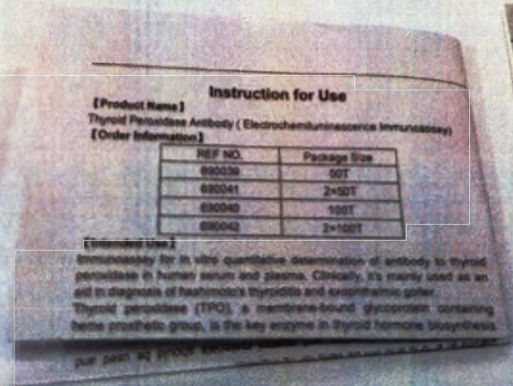

Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения антител к тиреоидной пероксидазе электрохемилюминесцентным методом на анализаторах




Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения антител к тиреоидной пероксидазе электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Thyroid Peroxidase Antibody (Electrochemiluminescence Immunoassay) / Anti-TPO))

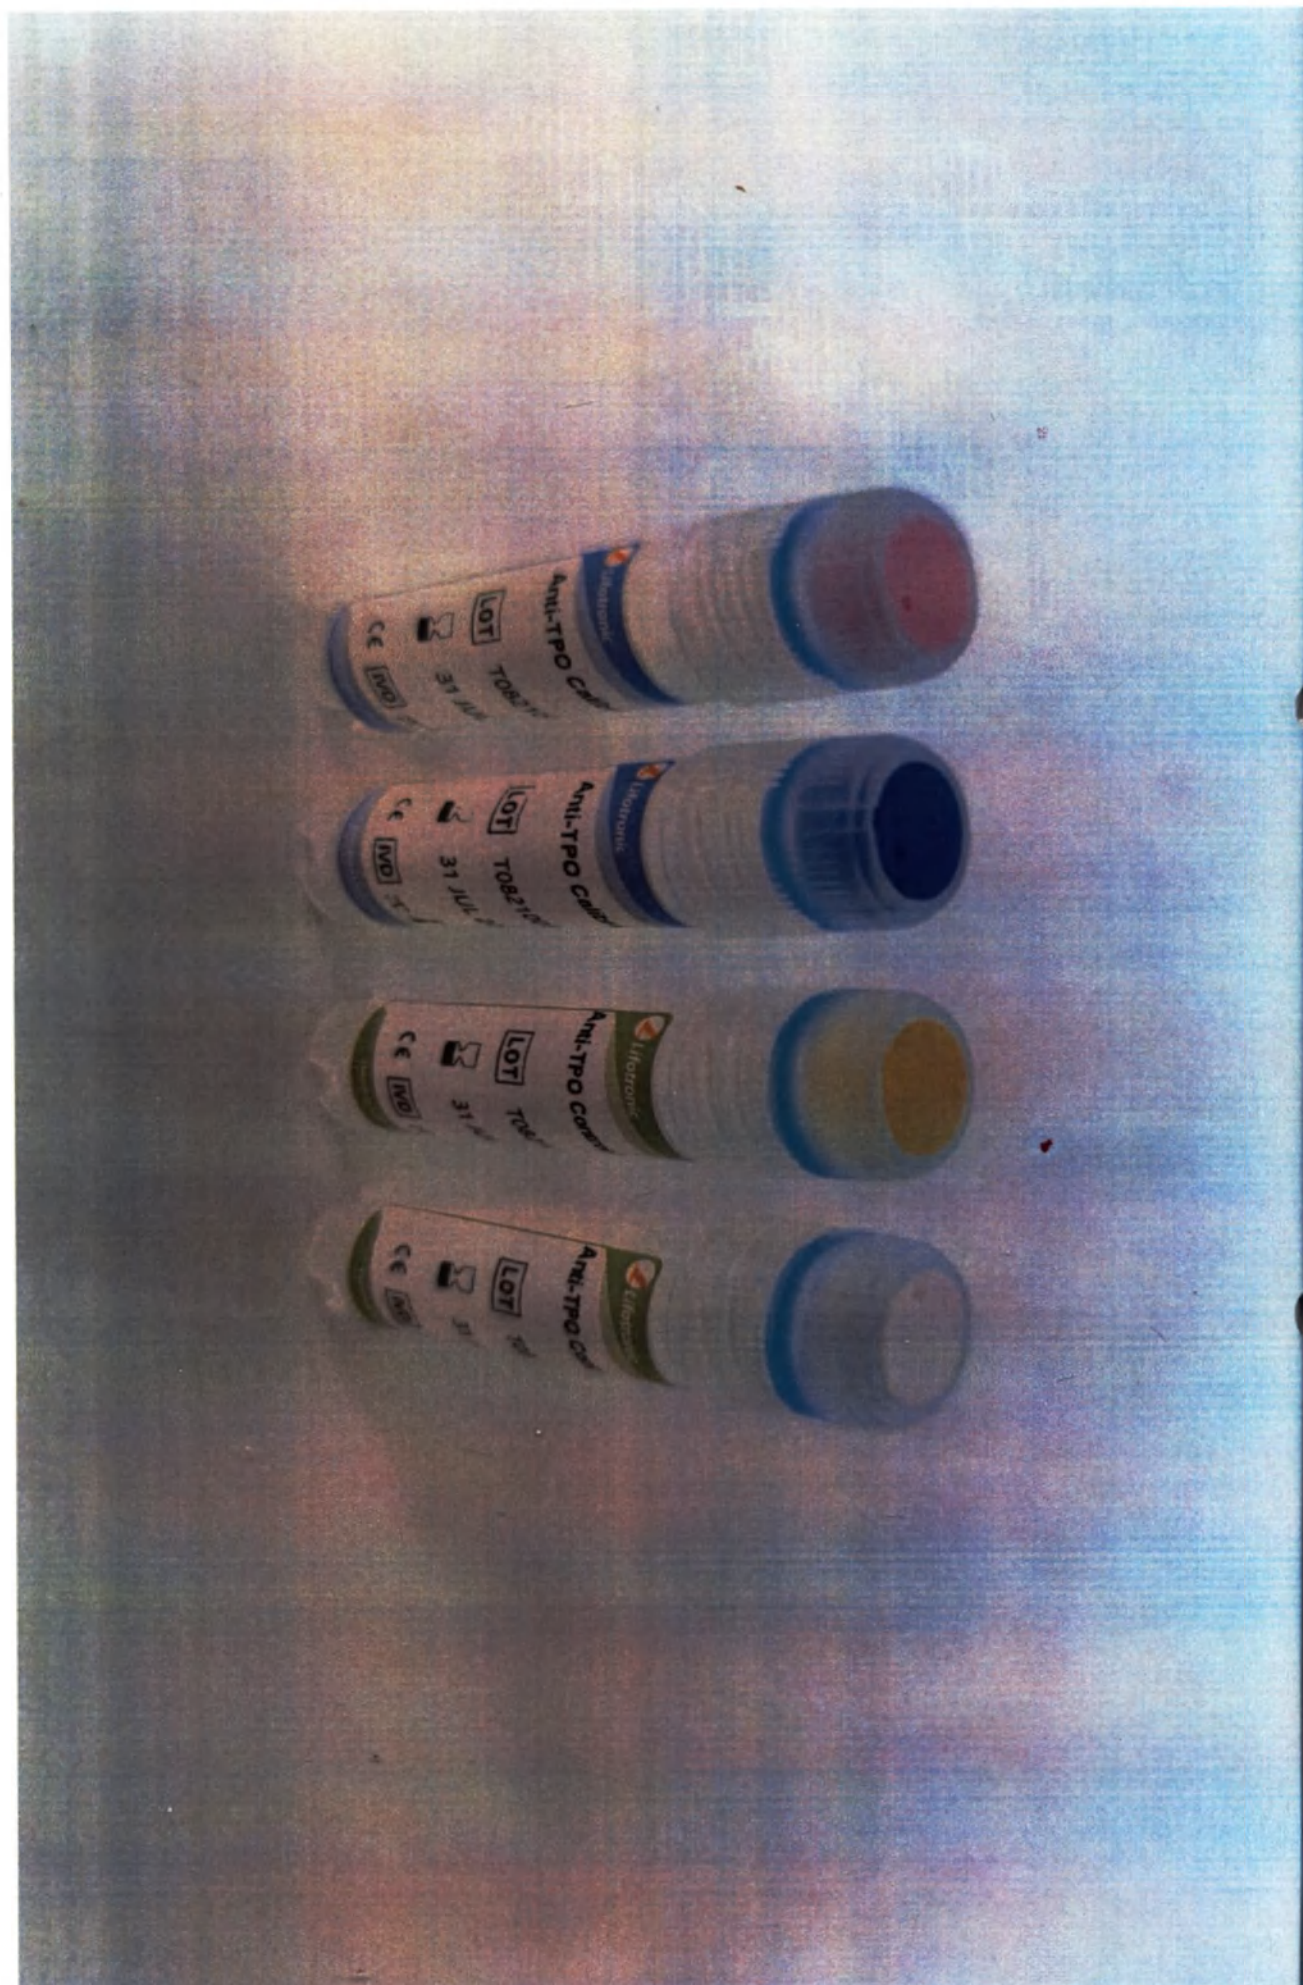



Калибратор (низкий и высокий уровень), Материал контрольный (низкий и высокий уровень) (Набор реагентов для количественного определения антител к тиреоидной пероксидазе электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Thyroid Peroxidase Antibody (Electrochemiluminescence Immunoassay) / Anti-TPO))

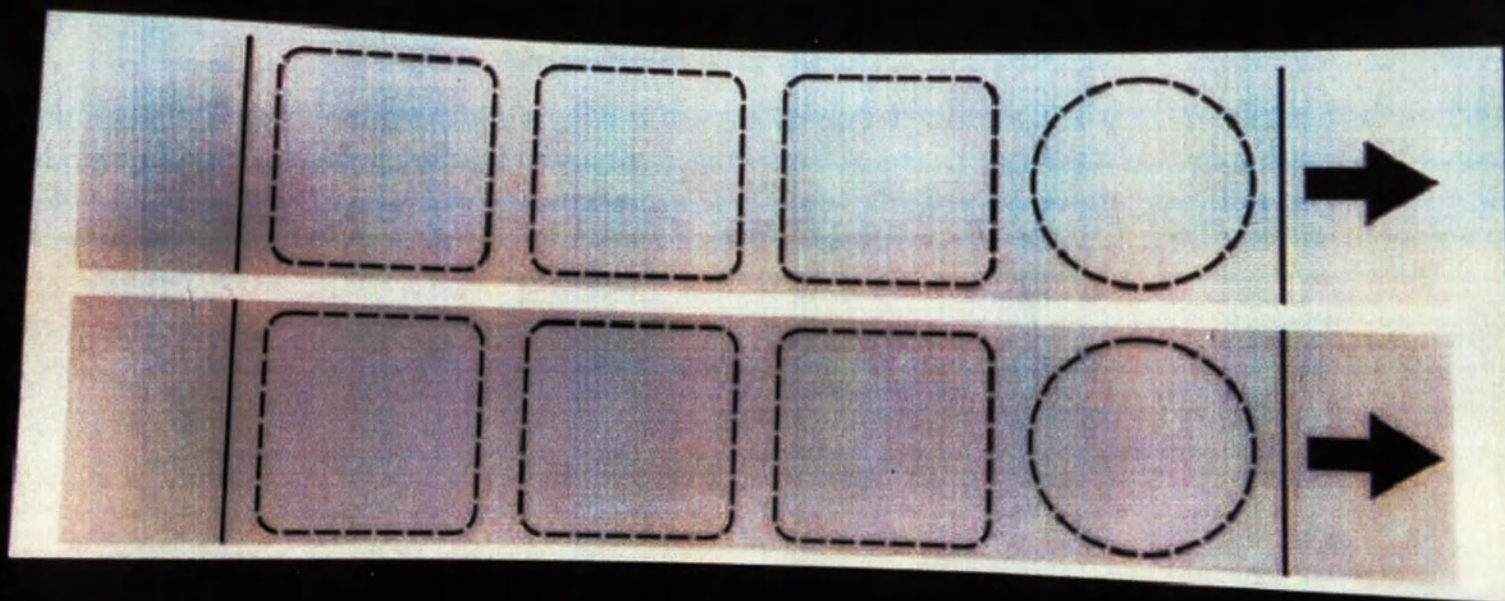


Anti-TPO Quality Control

LOT T082100600  31 JUL 2022

QC Range (Low): 19.361-35.955 IU/mL

QC Range (High): 56.299-104.555 IU/mL



Этикетка результатов значений материалов контрольных (Набор реагентов для количественного определения антител к тиреоидной пероксидазе электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Thyroid Peroxidase Antibody (Electrochemiluminescence Immunoassay) / Anti-TPO))

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 7 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.

