

ФОТОГРАФИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Набор реагентов Coronavirus COVID-19 для экстракции и выявления РНК коронавируса методом ОТ-ПЦР (COVID-19 Coronavirus Kit for PCR Analysis of Nucleic Acids), LOT 21091501, 21101201»
Производства


«Хунань Жуньмэй Джин Технолоджи Ко., Лтд.»
Hunan Runmei Gene Technology Co., Ltd.

Набор реагентов Coronavirus COVID-19 для экстракции и выявления РНК коронавируса методом ОТ-ПЦР (COVID-19 Coronavirus Kit for PCR Analysis of Nucleic Acids), LOT 21091501, в составе:

1. Набор для экстракции и изоляции вирусных нуклеиновых кислот (Маркировка)


Набор реагентов Coronavirus COVID-19 для экстракции и выявления РНК коронавируса методом ОТ-ПЦР (COVID-19 Coronavirus Kit for PCR Analysis of Nucleic Acids)	
1. Набор для экстракции и изоляции вирусных нуклеиновых кислот, в составе:	
1.1. Лизирующий раствор - 1 фла.	
1.2. Промывочный раствор 1 - 1 фла.	
1.3. Промывочный раствор 2 - 1 фла.	
1.4. Элюирующий раствор - 1 фла.	
1.5. Магнитные частицы - 1 фла.	
Инструкция по применению - 1 шт.	
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ	
LOT 21091501	15.09.2021 14.09.2022
CE	РУ № от
Hanna Research Center Technology Co., Ltd. («Хунань Жуаньшань Джен Текнолоджи Ко., Лтд.», Китай) Room 401-I, Building 3, Shaohe Medical and Health Industrial Park, No. 1048, Zhongqing Road, Shaping Street, Kaifu District, Changsha, Hunan Province, China	
Представитель производителя в РФ: ООО «МедТех», 108814, г. Москва, километр Калужское шоссе 24-й (п. Соосенское), владение 1, строение 1, помещение XIV/л. 7/пом. 43, Тел +7 (495) 101-62-12, E-mail: info@medtechld.com	

1. Набор для экстракции и изоляции вирусных нуклеиновых кислот (Общий вид)

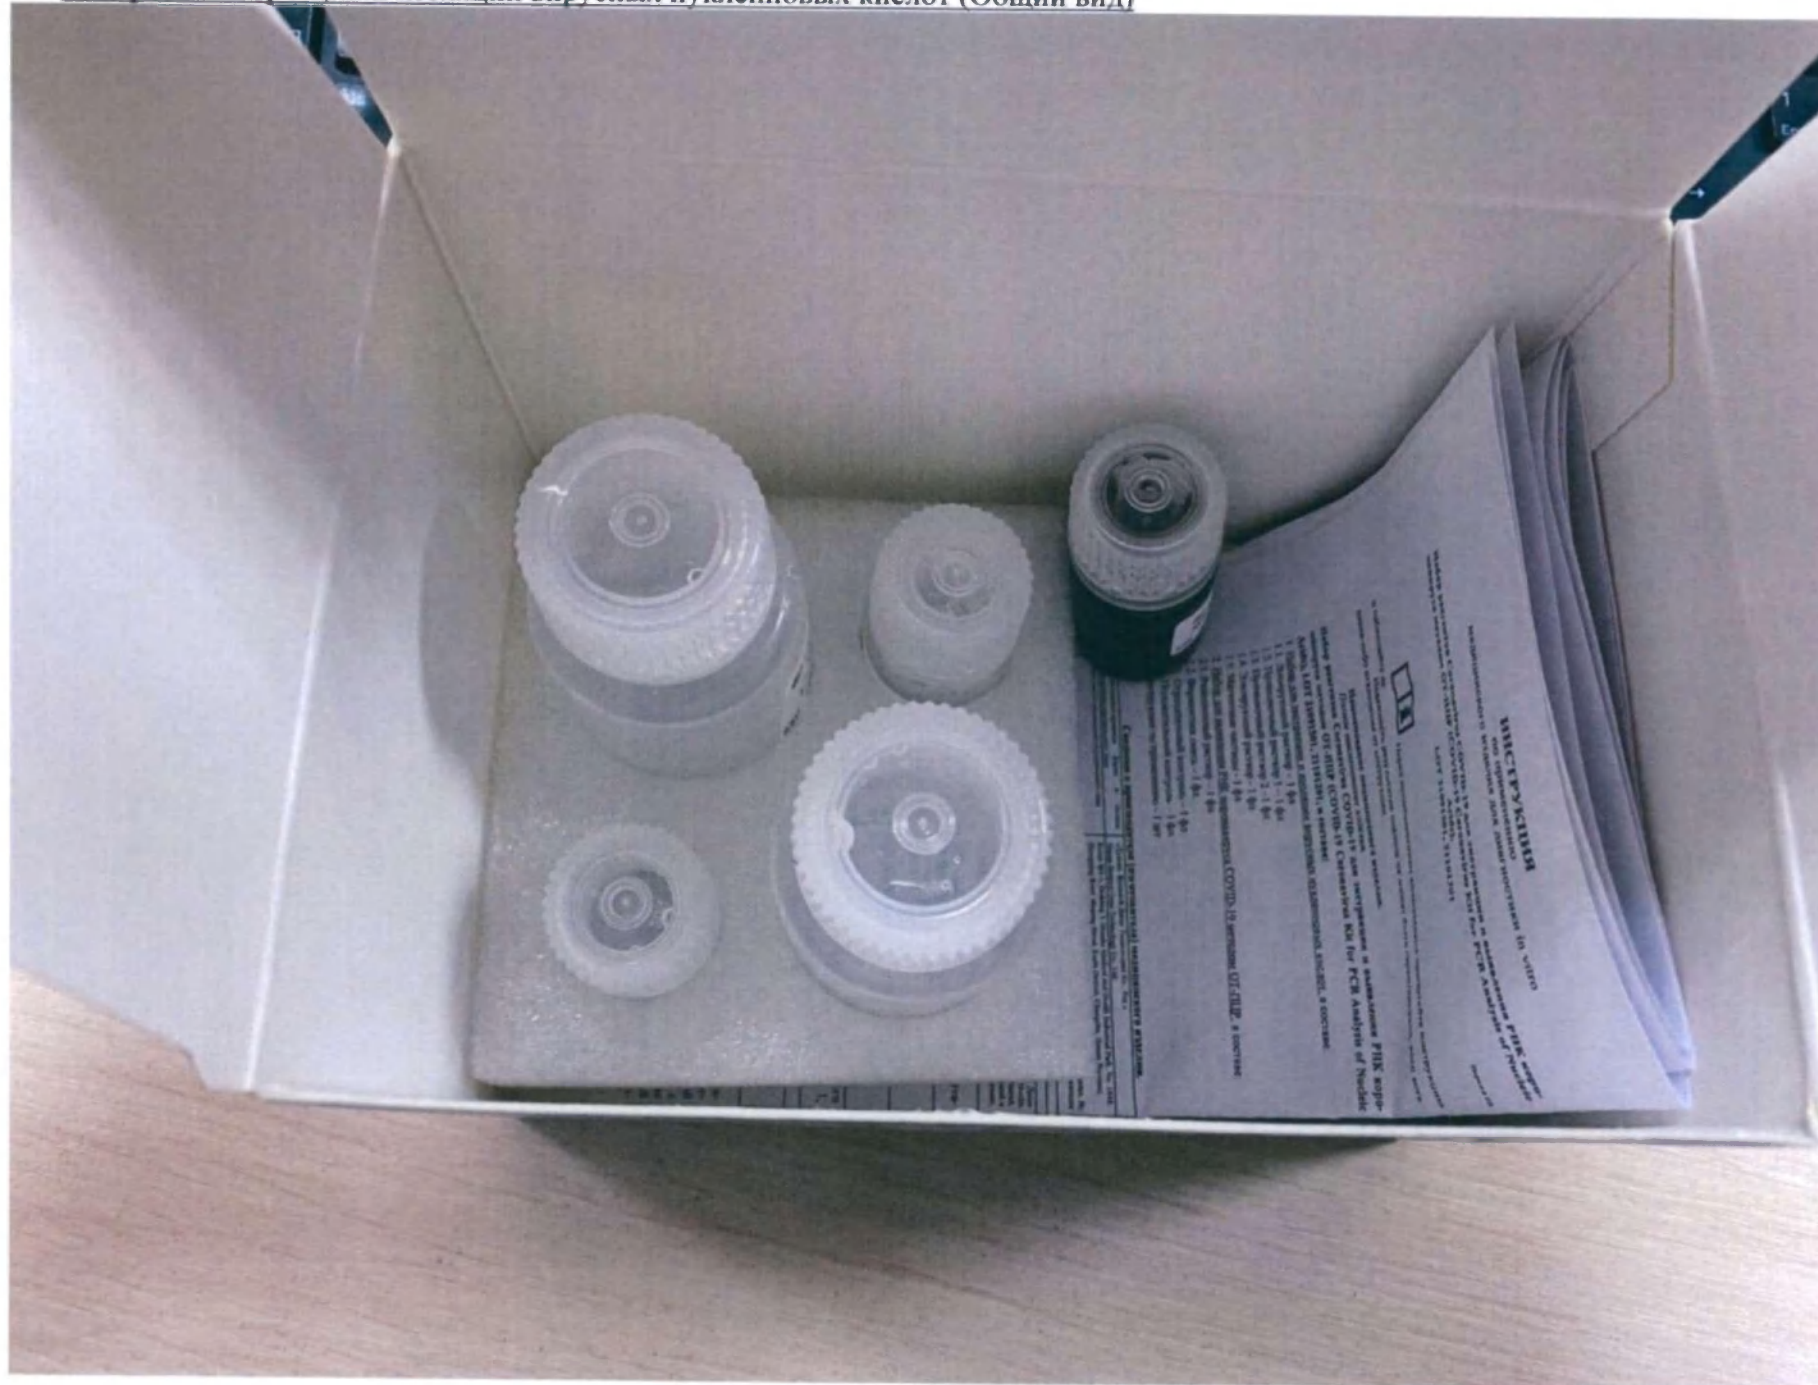

1. Набор для экстракции и изоляции вирусных нуклеиновых кислот, в составе:

1.1. Лизирующий раствор – 1 фл.

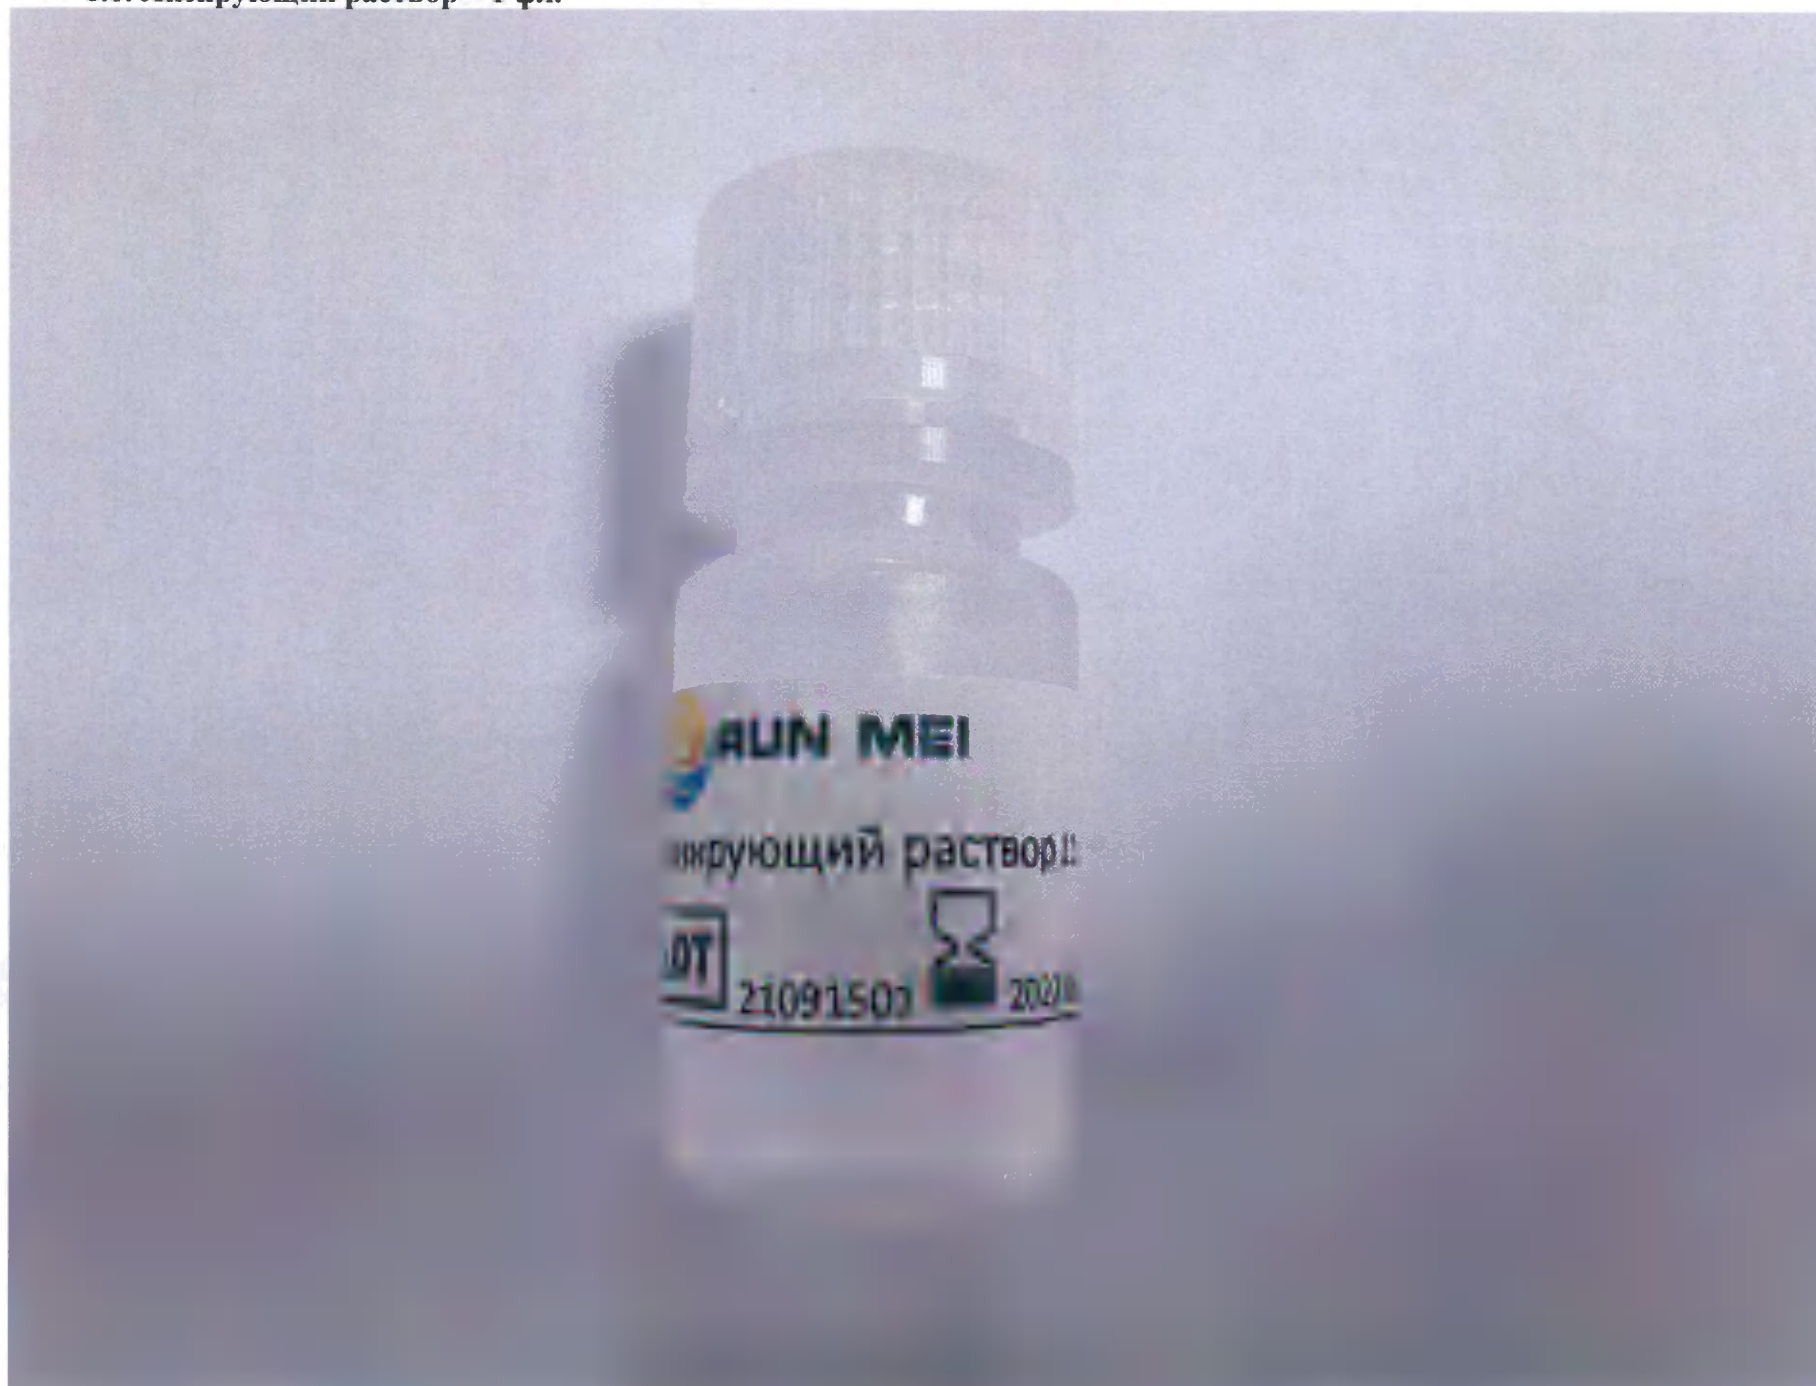

1.2. Промывочный раствор 1 – 1 фл.



1.3. Промывочный раствор 2 –1 фл.




1.4. Элюирующий раствор - 1 фл.



1.5. Магнитные частицы - 1 фл.



2. Набор для выявления РНК коронавируса COVID-19 методом ОТ-ПЦР (маркировка):

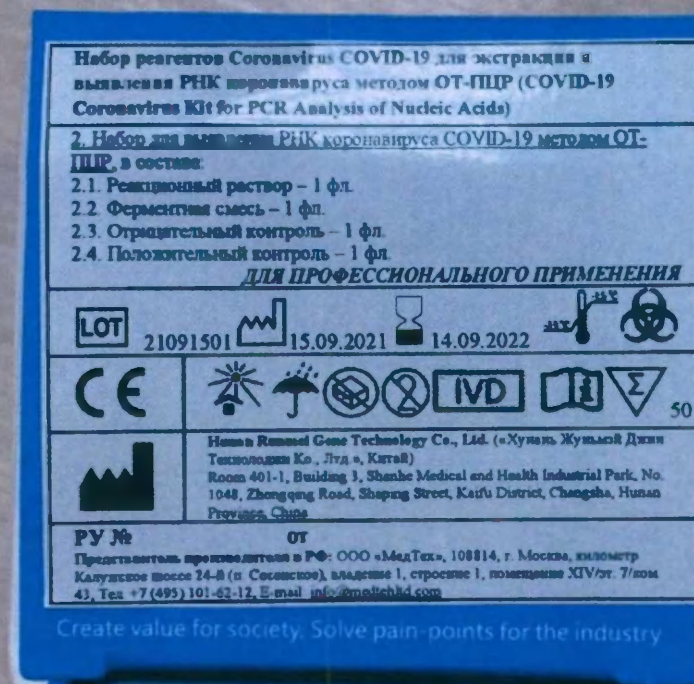

2. Набор для выявления РНК коронавируса COVID-19 методом ОТ-ПЦР (общий вид):



2. Набор для выявления РНК коронавируса COVID-19 методом ОТ-ПЦР, в составе:

2.1. Реакционный раствор – 1 фл.



2.2. Ферментная смесь – 1 фл.



2.3. Отрицательный контроль – 1 фл.



2.4. Положительный контроль – 1 фл.



по применению

по применению

... для диагностики *in vitro*

Acidos).

1

in comparison with

Полное наименование графа 2000

1091501, 21101201, и другие;

- 20

Category	Item	Quantity	Unit Price	Total
Materials	Concrete	100	1.50	150.00
	Reinforcement	50	3.00	150.00
Labor	Excavation	200	0.75	150.00
	Foundation	100	1.50	150.00
Equipment	Excavator	10	15.00	150.00
	Truck	5	30.00	150.00
Permits	Excavation	1	100.00	100.00
	Foundation	1	100.00	100.00
Insurance	Excavation	1	100.00	100.00
	Foundation	1	100.00	100.00
Miscellaneous	Tools	10	10.00	100.00
	Materials	10	10.00	100.00

11-11-11 (11-11-11) 11-11-11

Общество с ограниченной ответственностью "АВТОМАТИКА"

«МедТех»

NOTICE	HANDLING INFORMATION	800-4MOTORS
--------	----------------------	-------------

СОННИКОМ
ВЫВОДИМ
СЛУЖ

корпусного типа (в см)	10814	г. Москва	24-й корпус	Лауреат профессор
------------------------	-------	-----------	-------------	----------------------

Адрес (место нахождения) юридического лица _____

№ документа
по дате

01-62-12

19/095

[illegible]

Адрес застройки № 111/112
Адрес застройки № 111/112

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОЮЗНОЕ АГЕНТСТВО
ОБЩЕСТВЕННЫХ СООБЩЕСТВ

1. Вопросы

SARS-CoV-2 в клинических и ротофарингеальной жидкостях пациентов с COVID-19

Смысл из полноты
КМ. Смысл из полноты
КМ. Смысл из полноты

лаваж) методом флуоресцентной диагностики с использованием лабораторной аппаратуры SARS-CoV-2 с помощью флуоресцентной лампы.

ОСНОВНОГО
СРЕДСТВА (6) ПУТЯ
СВЯЗАННОГО

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

10

10

10

10


100

Набор реагентов Coronavirus COVID-19 для экстракции и выявления РНК коронавируса методом ОТ-ПЦР (COVID-19 Coronavirus Kit for PCR Analysis of Nucleic Acids), LOT 21101201, в составе:

1. Набор для экстракции и изоляции вирусных нуклеиновых кислот (Маркировка)

Набор реагентов Coronavirus COVID-19 для экстракции и выявления РНК коронавируса методом ОТ-ПЦР (COVID-19 Coronavirus Kit for PCR Analysis of Nucleic Acids)	
1. Набор для экстракции и изоляции вирусных нуклеиновых кислот, в составе: 1.1. Лизирующий раствор – 1 фла. 1.2. Промывочный раствор 1 – 1 фла. 1.3. Промывочный раствор 2 – 1 фла. 1.4. Элюирующий раствор – 1 фла. 1.5. Магнитные частицы – 1 фла. Инструкция по применению - 1 шт.	
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ	
LOT 21101201	12.10.2021 11.10.2022
CE	РУ № ОТ
	Henan Ruasnd Gene Technology Co., Ltd. («Хуань Юньшань Даши Технологии Ко., Лтд.», Китай) Room 401-1, Building 3, Shanhe Medical and Health Industrial Park, No. 1048, Zhongqing Road, Shaping Street, Kaifu District, Changsha, Hunan Province, China
Представитель производителя в РФ: ООО «МедТех», 108814, г. Москва, километр Калужское шоссе 24-й (п. Сосенское), владение 1, строение 1, помещение XIV/эт. 7/ком. 43. Тел. +7 (495) 101-62-12, E-mail: info@medietid.com	

1. Набор для экстракции и изоляции вирусных нуклеиновых кислот (Общий вид)

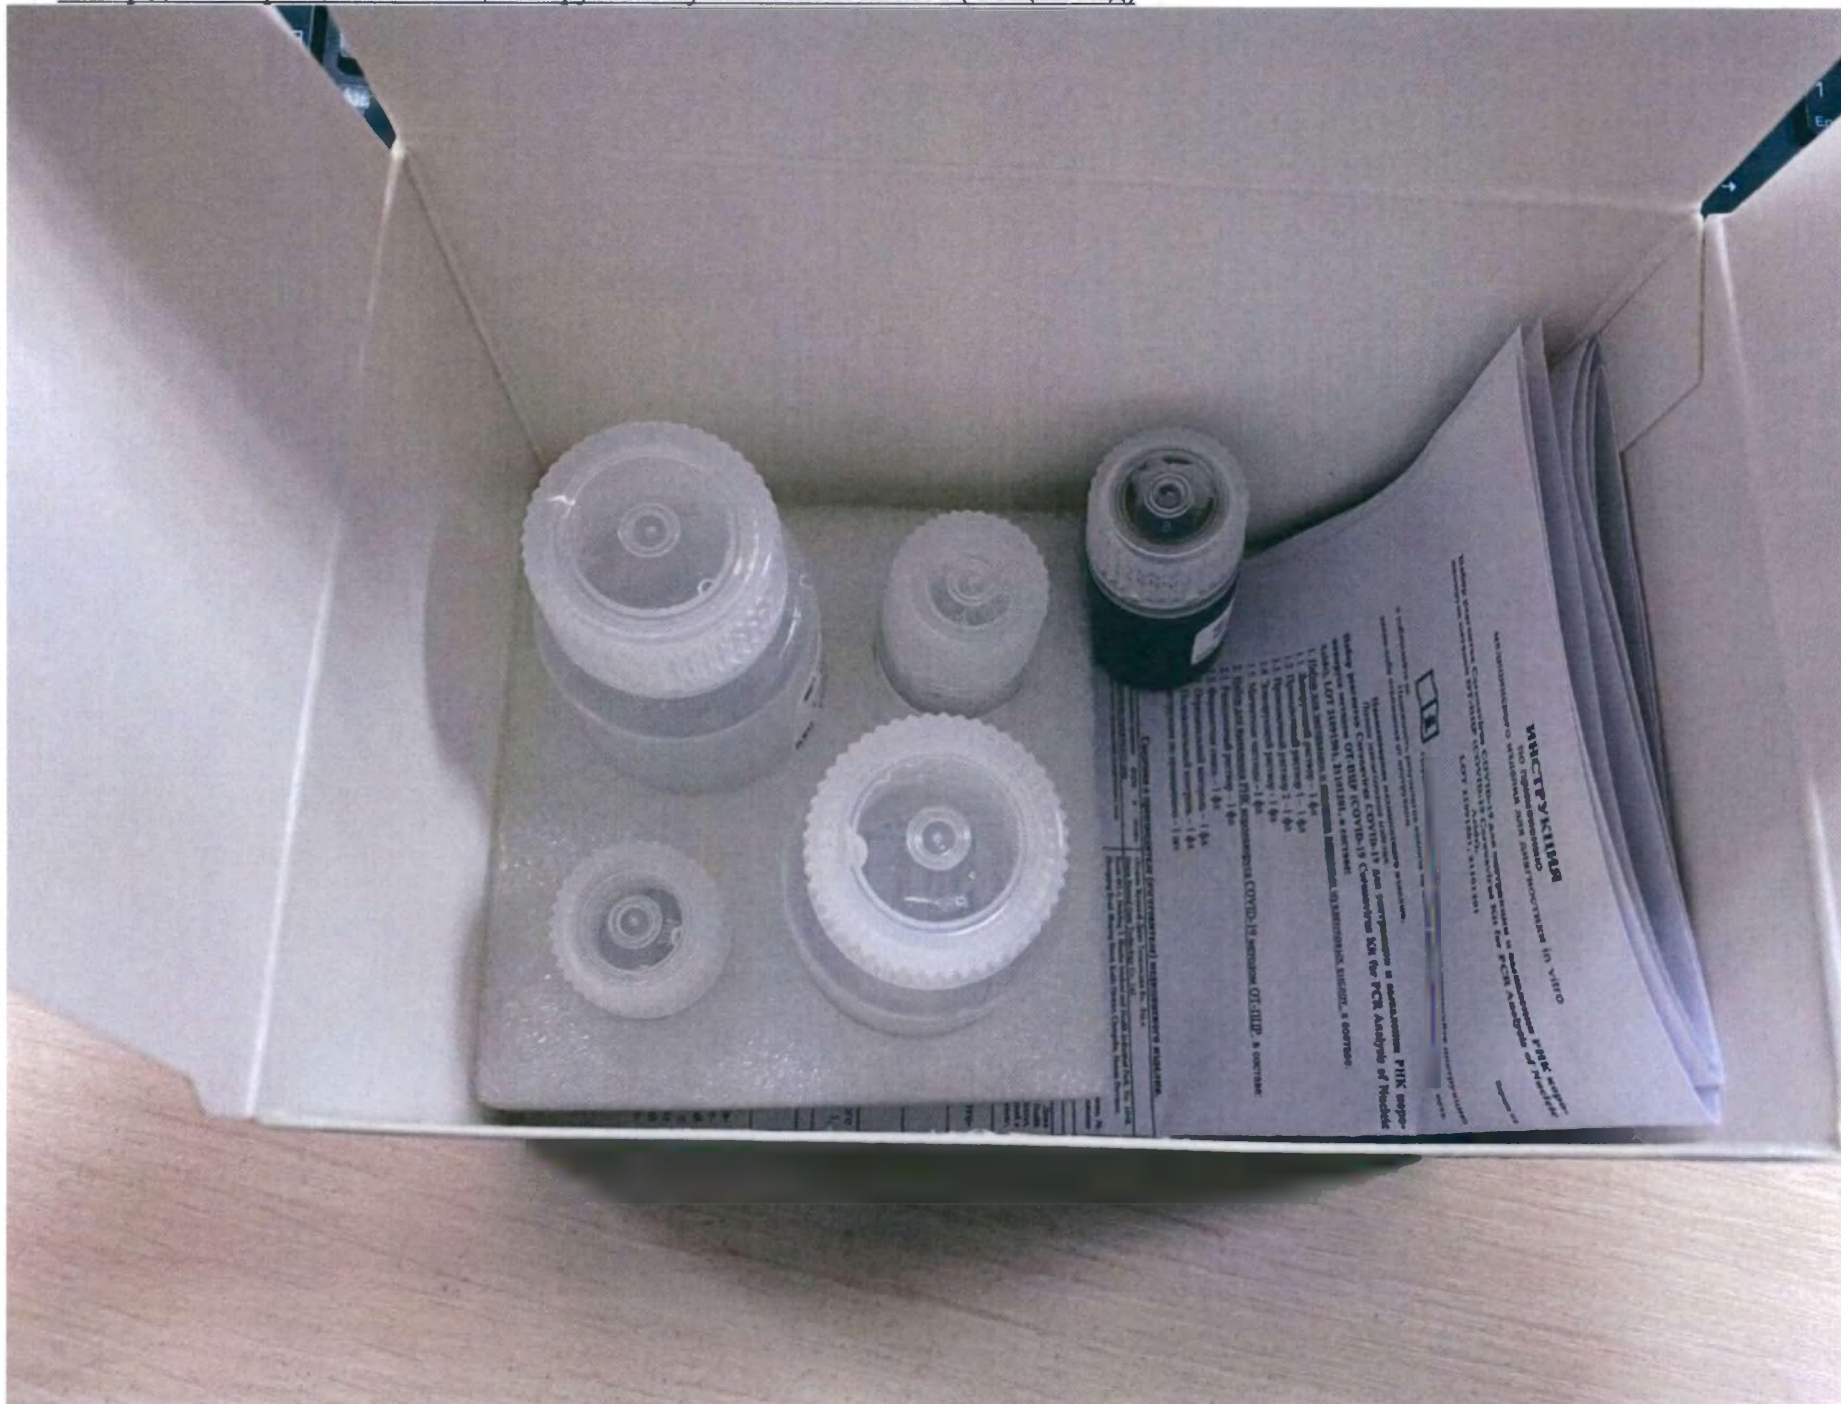


1. Набор для экстракции и изоляции вирусных нуклеиновых кислот, в составе:

1.1. Лизирующий раствор – 1 фл.



1.2. Промывочный раствор 1 – 1 фл.

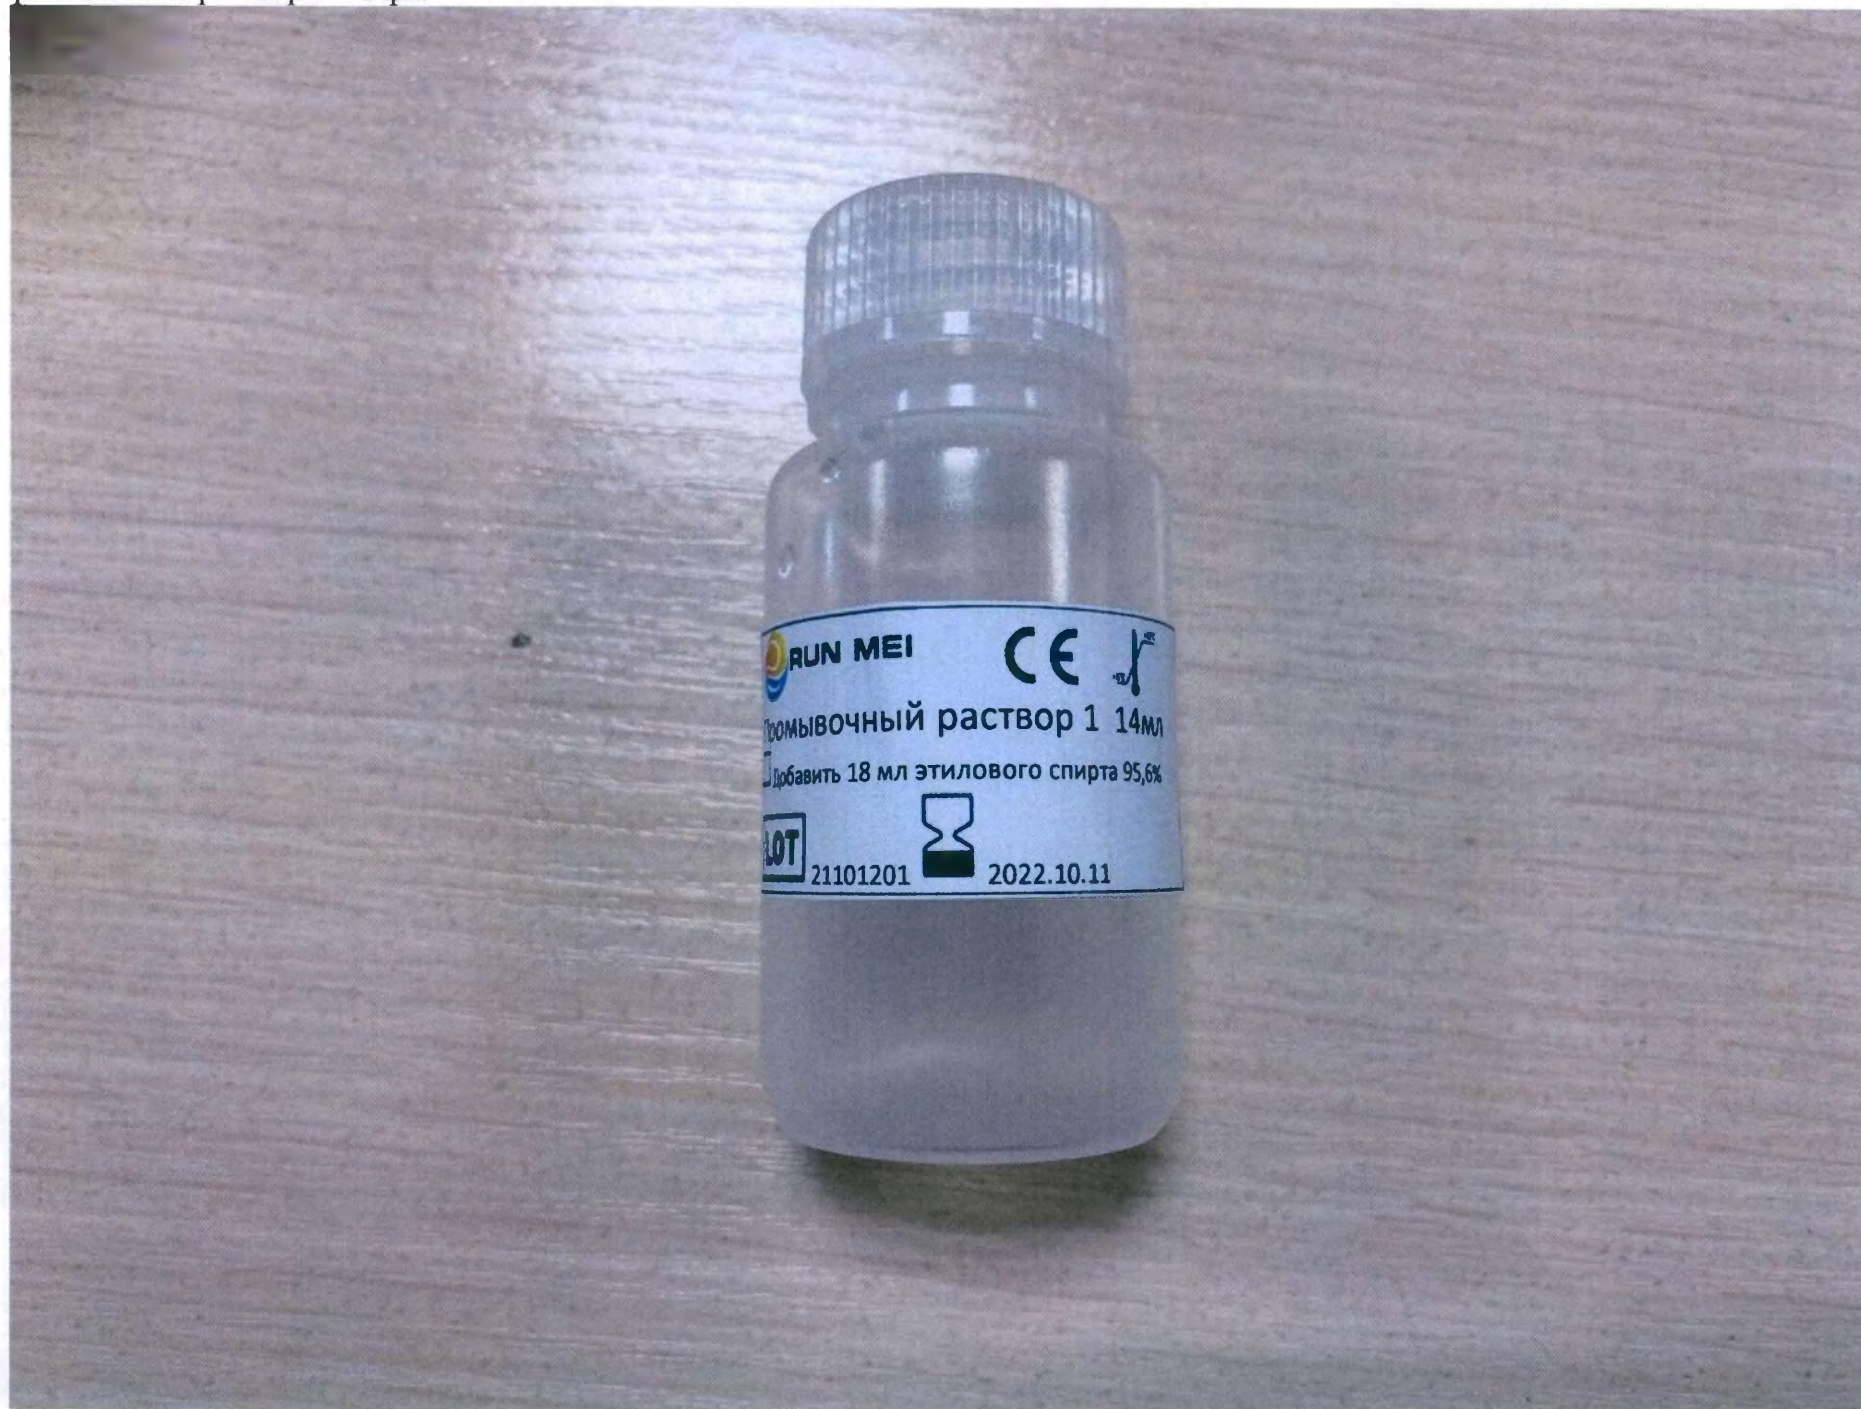

1.3. Промывочный раствор 2 – 1 фл.




1.4. Элюирующий раствор – 1 фла



1.5. Магнитные частицы – 1 фл.



2. Набор для выявления РНК коронавируса COVID-19 методом ОТ-ПЦР (маркировка):

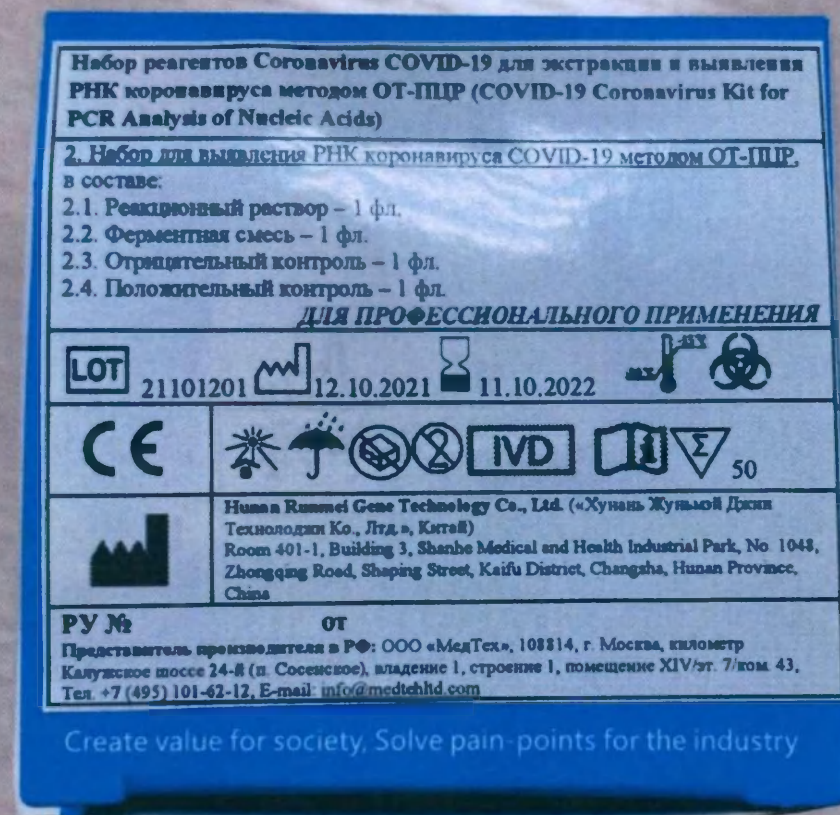

2. Набор для выявления РНК коронавируса COVID-19 методом ОТ-ПЦР (общий вид)



2. Набор для выявления РНК коронавируса COVID-19 методом ОТ-ПЦР, в составе:

2.1. Реакционный раствор – 1 фл.



2.2. Ферментная смесь – 1 фл.



2.3. Отрицательный контроль – 1 фл.



2.4. Положительный контроль – 1 фл.



МЕДИЦИНСКОГО УЧЕБНИКА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
СИМПТОМОВ

Набор реагентов Coronavirus COVID-19 для исследований и диагностики с использованием ПЦР (определяется методом ОТ-ПЦР Coronavirus K1 for PCR Analysis of Nucleic Acids)
LOT 21091591, 21101201



и собирайте ее. Перед использованием инструмента прочтите инструкцию.

Надежность результатов анализа не может быть гарантирована, если есть какие-либо отклонения от инструкции.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Набор реагентов Coronavirus COVID-19 для тестирования в автоматизированном ПНК экспресса методом ОТ-ПЦР (COVID-19 Coronavirus kit for PCR Analysis of Nucleic Acids), LOT 21001591, 21010201, в картридже

1. Набор для экспресс-диагностики в составе:
 - 1.1. Дисперсионный раствор – 1 фла
 - 1.2. Промывочный раствор – 1 фла
 - 1.3. Промывочный раствор 2 – 1 фла
 - 1.4. Завершающий раствор – 1 фла
 - 1.5. Мгновенная палочка – 1 фла
2. Набор для анализа РНК коронавируса COVID-19 методом ОТ-ПЦР, в составе:
 - 2.1. Реакционный раствор – 1 фла
 - 2.2. Ферментный состав – 1 фла
 - 2.3. Отрицательный контроль – 1 фла
 - 2.4. Положительный контроль – 1 фла
 3. Инструкция по применению – 1 шт

[illegible]

Составные об уполномоченном представителе производителя (интер-
нет-адрес на территории РФ)

Организация-примовая форма и полное наименование юридического лица	ООО «МедТек» 108814, г. Москва, 24-35 километр Калужского шоссе (в Сосновом), здание 1, строение 1 пом. XIV этаж 1 этаж 43 +7 (495) 101-62-12 info@medinfid.com
Сопровождающие (наименование юридического лица (в случае, если юридического лица нет))	Адрес (место нахождения) юридического лица
Номер телефона	Адрес электронной почты юридического лица (в случае, если юридического лица нет)

[illegible]

Всего прошито и скреплено
печатью 29 лист(ов)

