


**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности количественного определения тиреоглобулина
иммунохемилюминесцентным методом
в сыворотке и плазме крови человека
на иммунохимических анализаторах ARCHITECT
«Тиреоглобулин Контрольные материалы
(ARCHITECT Thyroglobulin Controls)»**





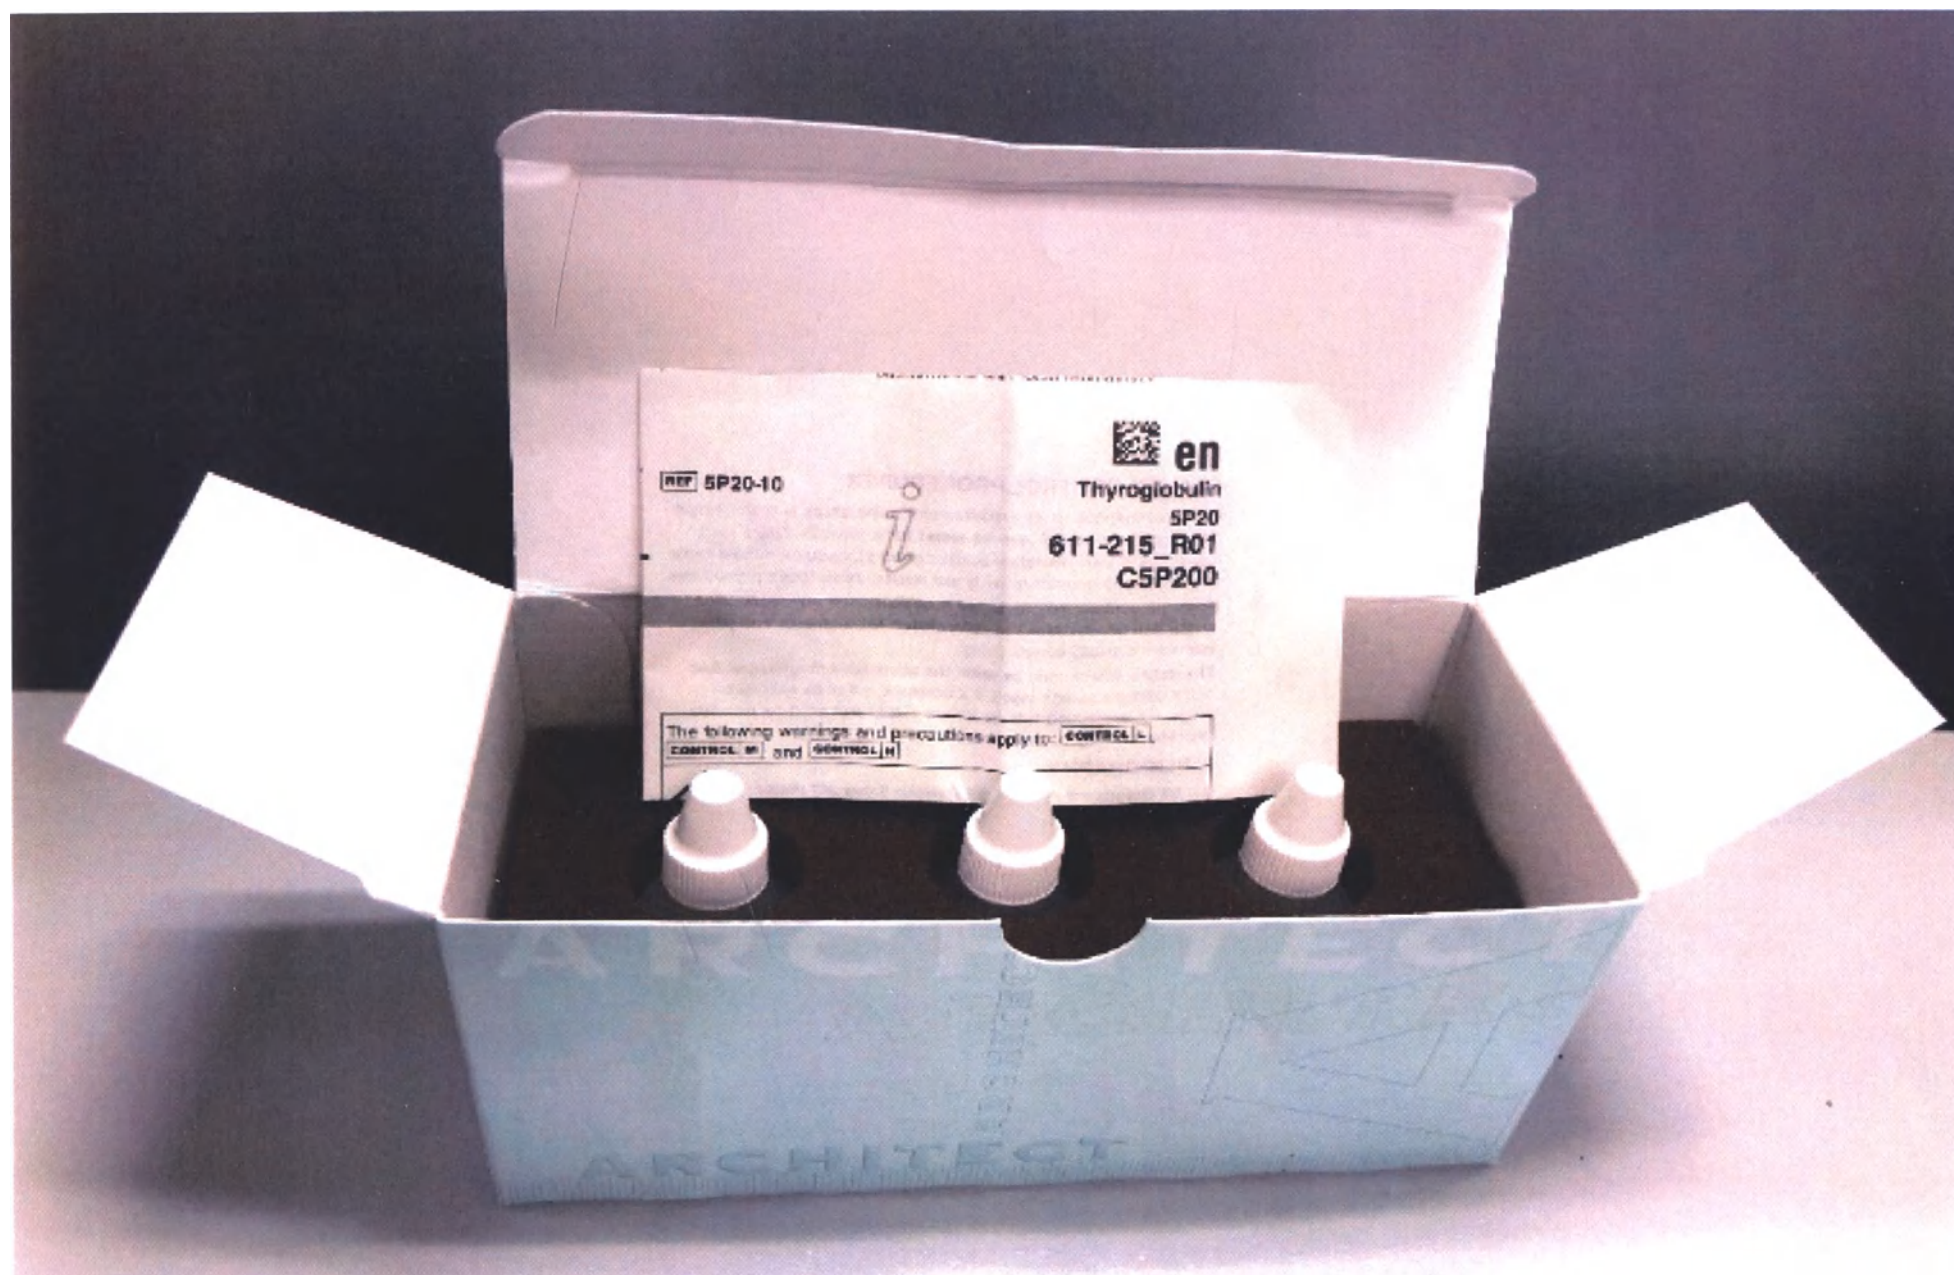

10

Hydrophobic Interactions

04-02-05

55



ARCHITECT Thyroglobulin Controls

GROUP NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
CONTROL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[Gluconate] ⁻	[Fructose] ⁻
1.00	0.69
7.60	4.50 - 10.60
350.00	210.00 - 480.00

[illegible]

11

ARCHITECT
Thyroglobulin Controls

Created August 2016.

5P20-10

10

en
Theogebur
611-215-PO1
CSP200

INDEEDED USE

THE ALACRISTECT Phytoglycogen Coarctate and for the estimation of total protein and the detection of systematic analytical deviations of the ALACRISTECT 1600 series when used for the quantitative determination of ALACRISTECT 1600 in human serum and plasma.

ARCHITECT (ogenovir) without using the ARCHITECT (Tg) in human serum and plasma. Refer to the reagent package insert and the ARCHITECT System Operations Manual for additional information.

CONTENTS

3 Bottles (8.0 ml. each) of ARCHITECT Thyroglobulin Controls. Low Control, Medium Control, and High Control contain thyroglobulin in phosphate buffer with protein (bovine) stabilizers. Preservatives: ProClin 300 and ProClin 950.

The controls are at the following ranges and concentrations:

Control Range

The following earnings and expenditures apply to: Robert Ross, Jr.
 (date born) Jan 1941 (date death) NA



WARNINGS

Contains methylisothiazolones.
May cause an allergic skin reaction

Prevention

Avoid breathing mist | vapors | spray.

P272

Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.

P2280

Wear protective gloves | protective clothing | eye protection.

Response



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 листов



Макет маркировки на медицинское изделие
Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности количественного определения тиреоглобулина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека
на иммунохимических анализаторах ARCHITECT
«Тиреоглобулин Контрольные материалы
(ARCHITECT Thyroglobulin Controls)»



05P20-10



Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности количественного определения тиреоглобулина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах ARCHITECT

«Тиреоглобулин Контрольные материалы (ARCHITECT Thyroglobulin Controls)»

в составе: Контроль L (ARCHITECT Thyroglobulin CONTROL L) – 1 флакон х 8,0 мл; Контроль M (ARCHITECT Thyroglobulin CONTROL M) – 1 флакон х 8,0 мл; Контроль H (ARCHITECT Thyroglobulin CONTROL H) – 1 флакон х 8,0 мл; Инструкция по применению / Производитель: Abbott GmbH & Co. KG (Эбботт ГмбХ и Ко. КГ), Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany / Место производства: Fujirebio Diagnostics, Inc. 201 Great Valley Parkway Malvern, Pennsylvania 19355, USA / Страна происхождения: США / РУ № ____/____ от ____/____/____ / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Данное изделие содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

611-220_R01

www.abbottdiagnostics.com/IFU


Thyroglobulin Ctrls

SP20-10



ARCHITECT Thyroglobulin Controls

		CONC		RANGE
		ng/mL, µg/L		ng/mL, µg/L
CONTROL L	1 x 8.0 mL	1.00		0.69 - 1.31
CONTROL M	1 x 8.0 mL	7.50		4.50 - 10.50
CONTROL H	1 x 8.0 mL	350.00		210.00 - 490.00



Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580

PRODUCED FOR ABBOTT BY

Fujirebio Diagnostics, Inc.
201 Great Valley Parkway
Malvern, Pennsylvania 19355, USA


PRODUCT OF USA



**Thyroglobulin
Ctrls**

ARCHITECT Thyroglobulin

CONTROL L




317-450_R01
ABBOTT
65205 Wiesbaden, Germany



IVD REF 5P20L
8.0 mL
1.00 ng/mL

ARCHITECT Thyroglobulin

CONTROL M




317-455_R01
ABBOTT
65205 Wiesbaden, Germany



IVD REF 5P20M
8.0 mL
7.50 ng/mL

ARCHITECT Thyroglobulin

CONTROL H



317-460_R01
ABBOTT
65205 Wiesbaden, Germany



IVD REF 5P20N
8.0 mL
350.00 ng/mL

