

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
ООО «Компания «БиВи»»

Носова Т.А.

2022 г.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
77 АГ 5987789

КУСАЙЛО Р. В.


Фотографические изображения изделия:

**Набор реагентов для количественного определения фолатов электрохемилюминесцентным методом в сыворотке крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Folate (Electrochemiluminescence Immunoassay)/Folate)**

Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.  
(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай



Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения фолатов электрохемилюминесцентным методом в сыворотке крови человека

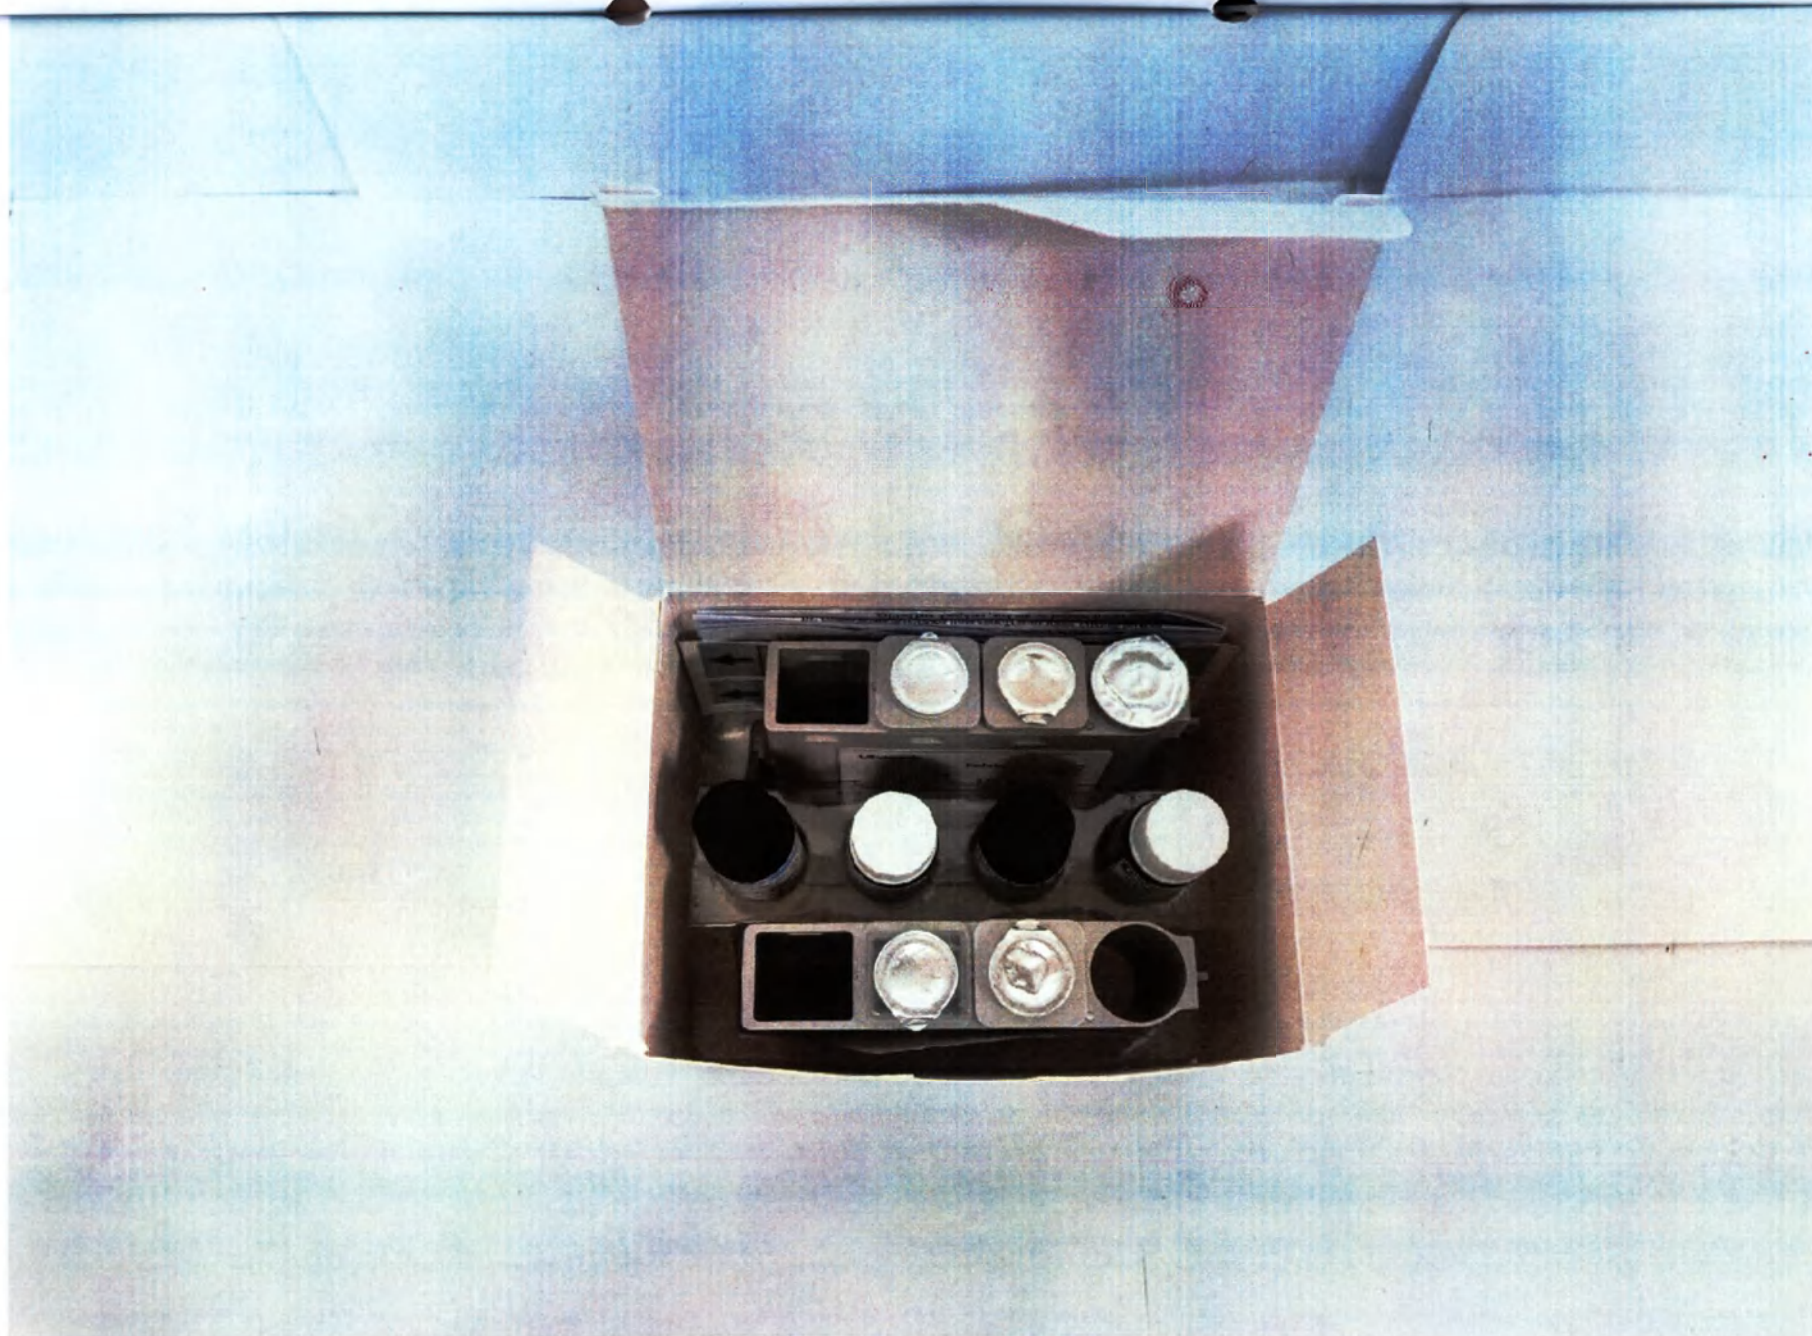

Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения фолатов электрохемилюминесцентным методом в сыворотке крови человека



Кассеты с реагентами (Набор реагентов для количественного определения фолатов электрохемилюминесцентным методом в сыворотке крови человека на




Калибратор (высокий уровень), Калибратор (низкий уровень), Материал контрольный (высокий уровень), Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов ООО Цирми [info@cirmi.ru](mailto:info@cirmi.ru) [www.goszdravnadzor.ru](http://www.goszdravnadzor.ru) тов электрохемилюминесцентным методом в сыворотке крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Folate (Electrochemiluminescence Immunoassay)/Folate)



Калибратор (высокий уровень), Калибратор (низкий уровень), Материал контрольный (высокий уровень), Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов для определения фолата электрохемилюминесцентным методом в сыворотке крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Folate (Electrochemiluminescence Immunoassay)/Folate))



Калибратор (высокий уровень), Калибратор (низкий уровень), Материал контрольный (высокий уровень), Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU ов электрохемилюминесцентным методом в сыворотке крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Folate (Electrochemiluminescence Immunoassay)/Folate)

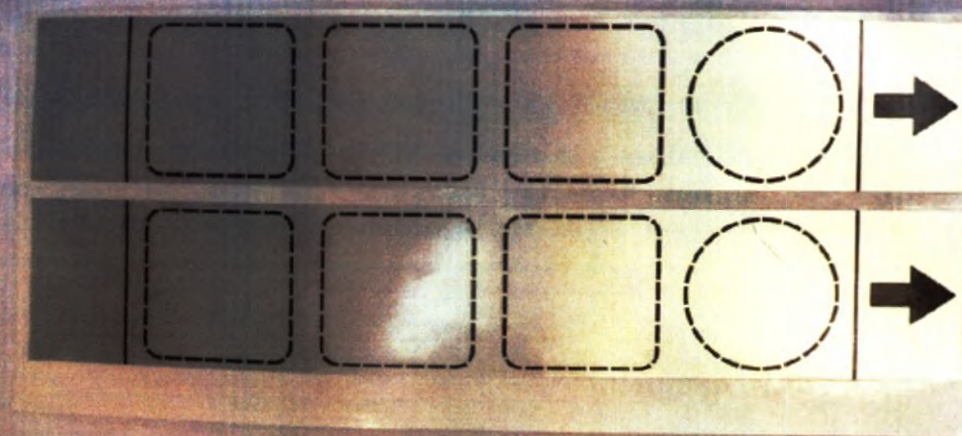

Этикетки для запечатывания флаконов (Набор реагентов для количественного определения фолатов электрохемилюминесцентным методом в сыворотке крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Folate (Electrochemiluminescence Immunoassay)/Folate)

### Folate Control Material RFID

**LOT** A012100200  2022-05-19

**QC Range (Low):** 4.459-8.239 ng/mL

**QC Range (High):** 8.330-15.45 ng/mL

**Lifotronic**

Этикетка результатов значений материалов контрольных (Набор реагентов для количественного определения фолатов электрохемилюминесцентным методом в

Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью и подписью: 2 листа (-ов)

Генеральный директор \_\_\_\_\_ / Носова Т.А  
М.П.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
77 АГ 5987789  
КУСАЙЛО Р. В.