



Согласовано

Общество с ограниченной ответственностью КАРЛ ШТОРЦ –
Эндоскопы ВОСТОК (ООО КШТЭ ВОСТОК)

Организация

Россия, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, 7, стр. 4
Адрес

Генеральный директор
Должность

Мартин Пьер Колас
Фамилия, Имя

Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись/Signature



Фотографические изображения

**Эндоскоп жесткий для гинекологических манипуляций в вариантах исполнения с
принадлежностями**

2021



Рис. 1. Эндоскоп жесткий для гинекологических манипуляций в вариантах исполнения. Транспортная упаковка.



Рис. 2. Эндоскоп жесткий для гинекологических манипуляций в вариантах исполнения. Маркировка на транспортной упаковке.



**Рис. 3. Эндоскоп жесткий HOPKINS для фертилоскопии, направление наблюдения 30°, диаметр 2,9 мм, длина 30 см.
Упаковка.**



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ—ENDOSCOPE

SN 1215KH

QTY 1

REF 26120BA

HOPKINS® Optik 30°, 2,9 mm, 30 cm
HOPKINS® Telescope 30°, 2.9 mm, 30 cm
Optique HOPKINS® 30°, 2,9mm, 30cm
Sistema ottico HOPKINS® 30°, 2,9 mm, 30 cm
Óptica HOPKINS® 30°, 2,9 mm, 30 cm
Ótica HOPKINS® 30°, 2,9 mm, 30 cm



RxONLY

CE 0123

(01)04048551083832(240)26120BA(21)1215KH

Рис. 4. Эндоскоп жесткий HOPKINS для фертилоскопии, направление наблюдения 30°, диаметр 2,9 мм, длина 30 см.
Маркировка на упаковке.

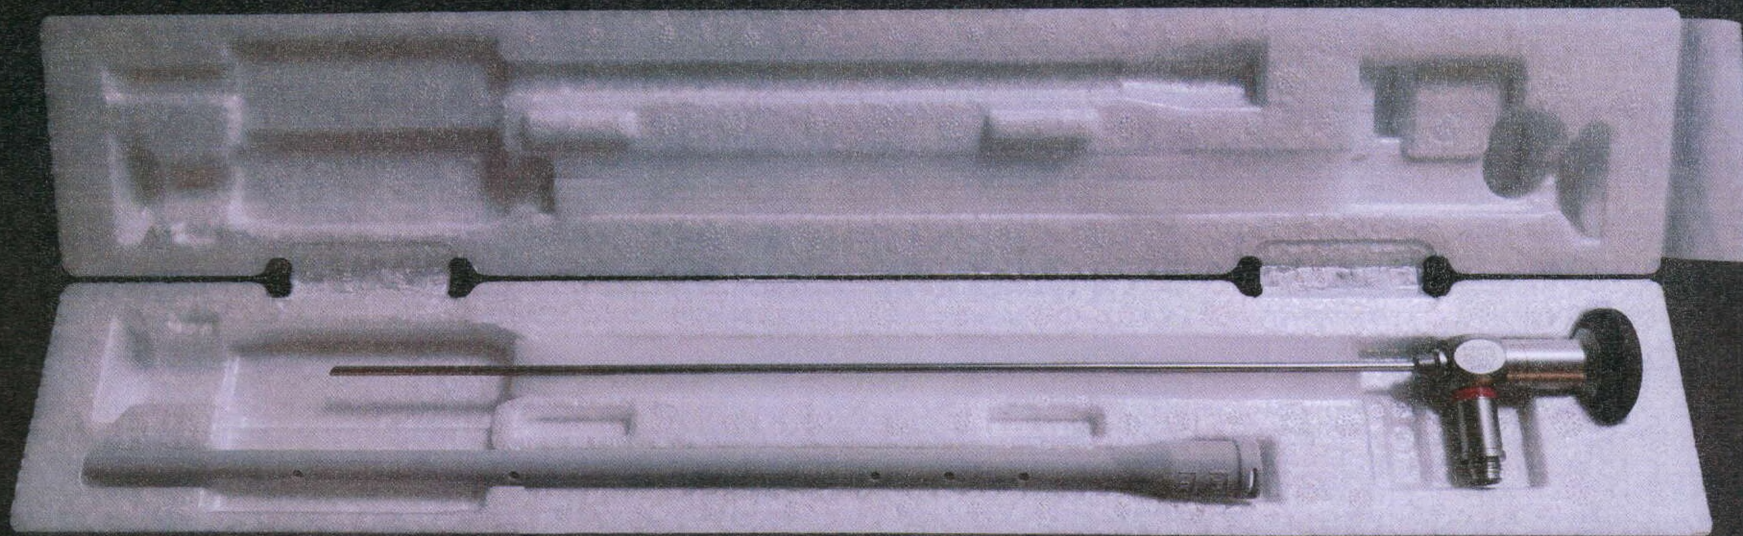


Рис. 5. Эндоскоп жесткий HOPKINS для фертилоскопии, направление наблюдения 30°, диаметр 2,9 мм, длина 30 см.

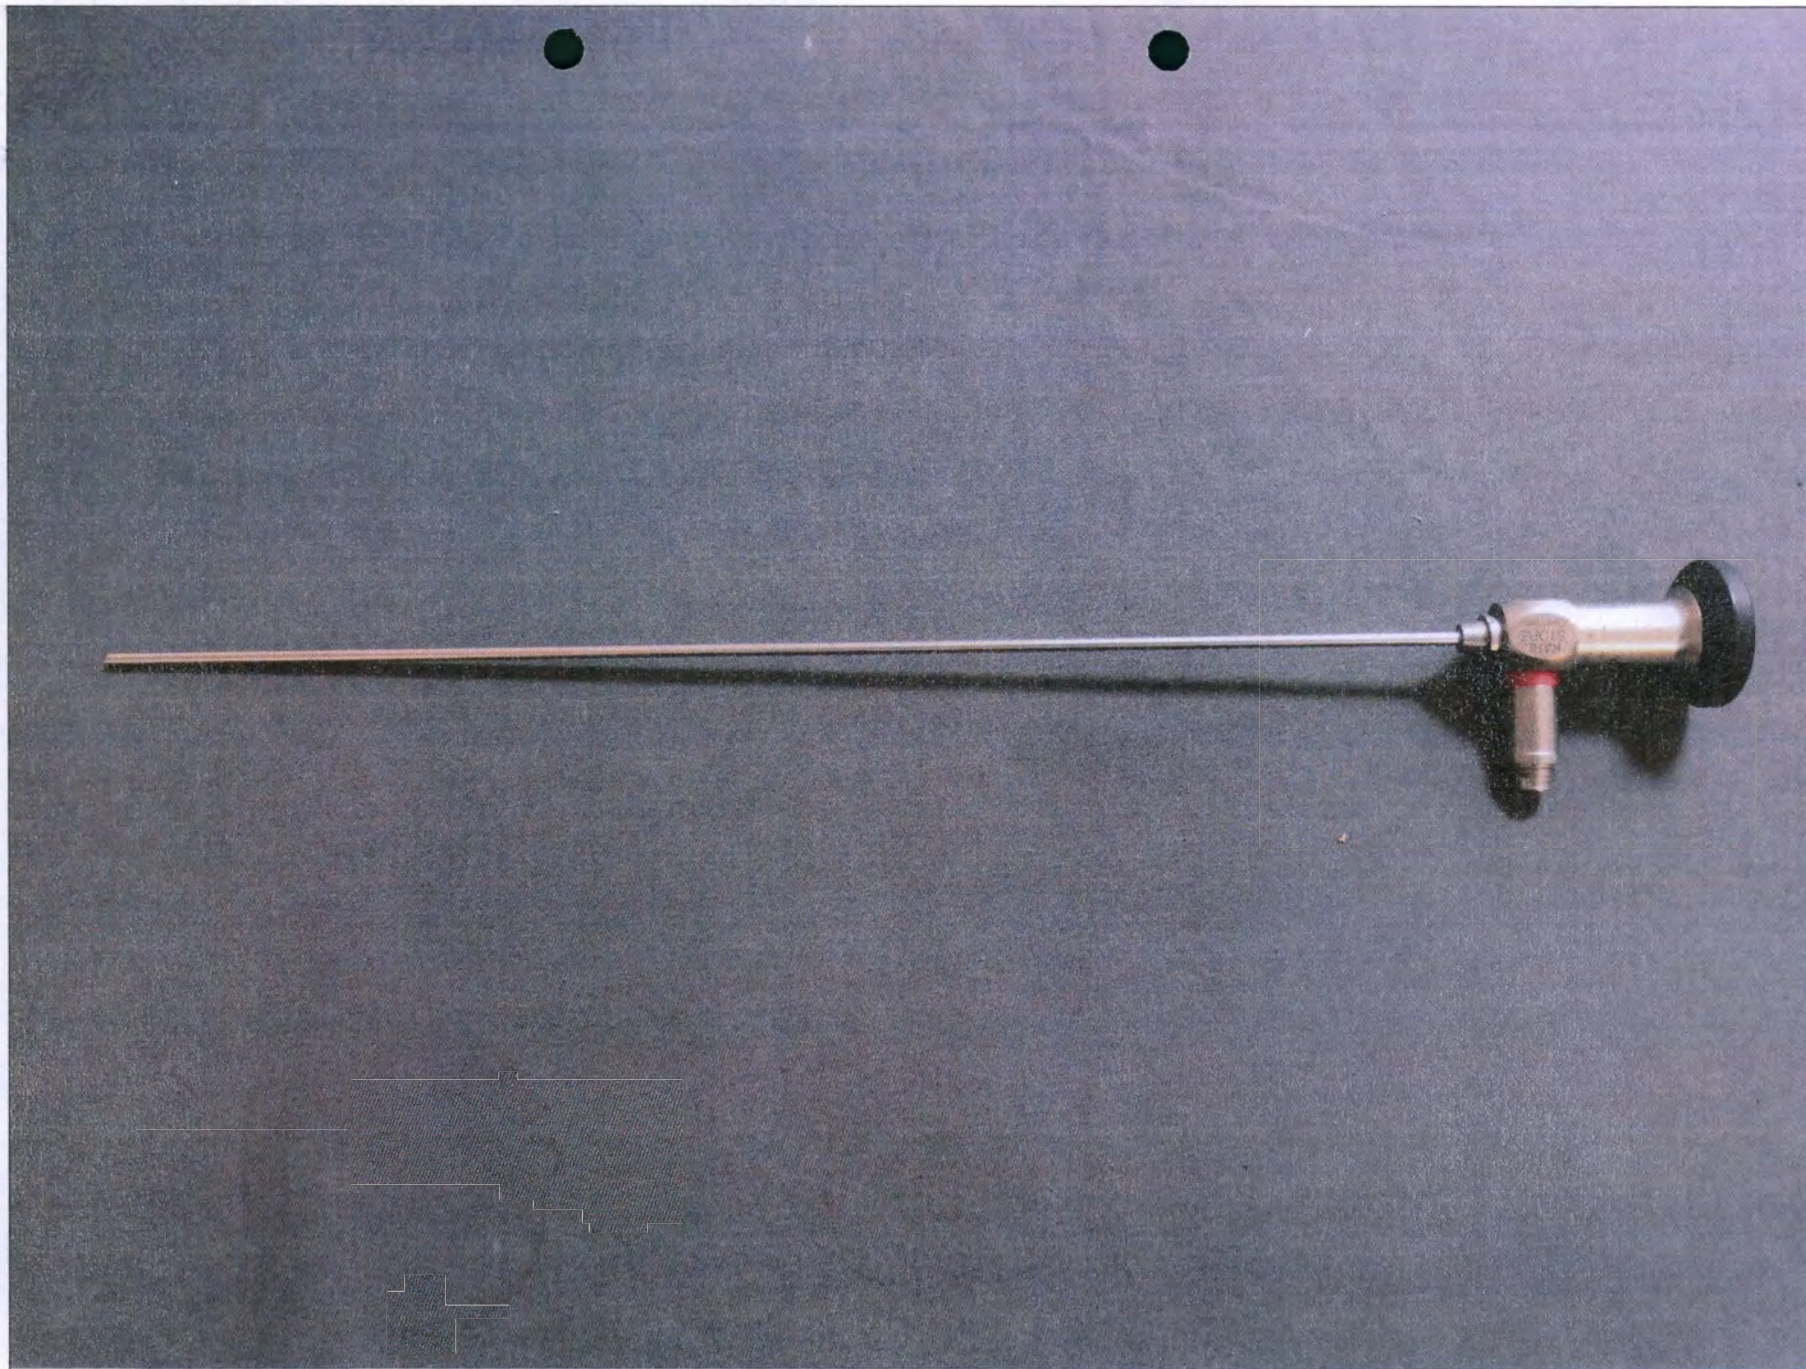


Рис. 6. Эндоскоп.

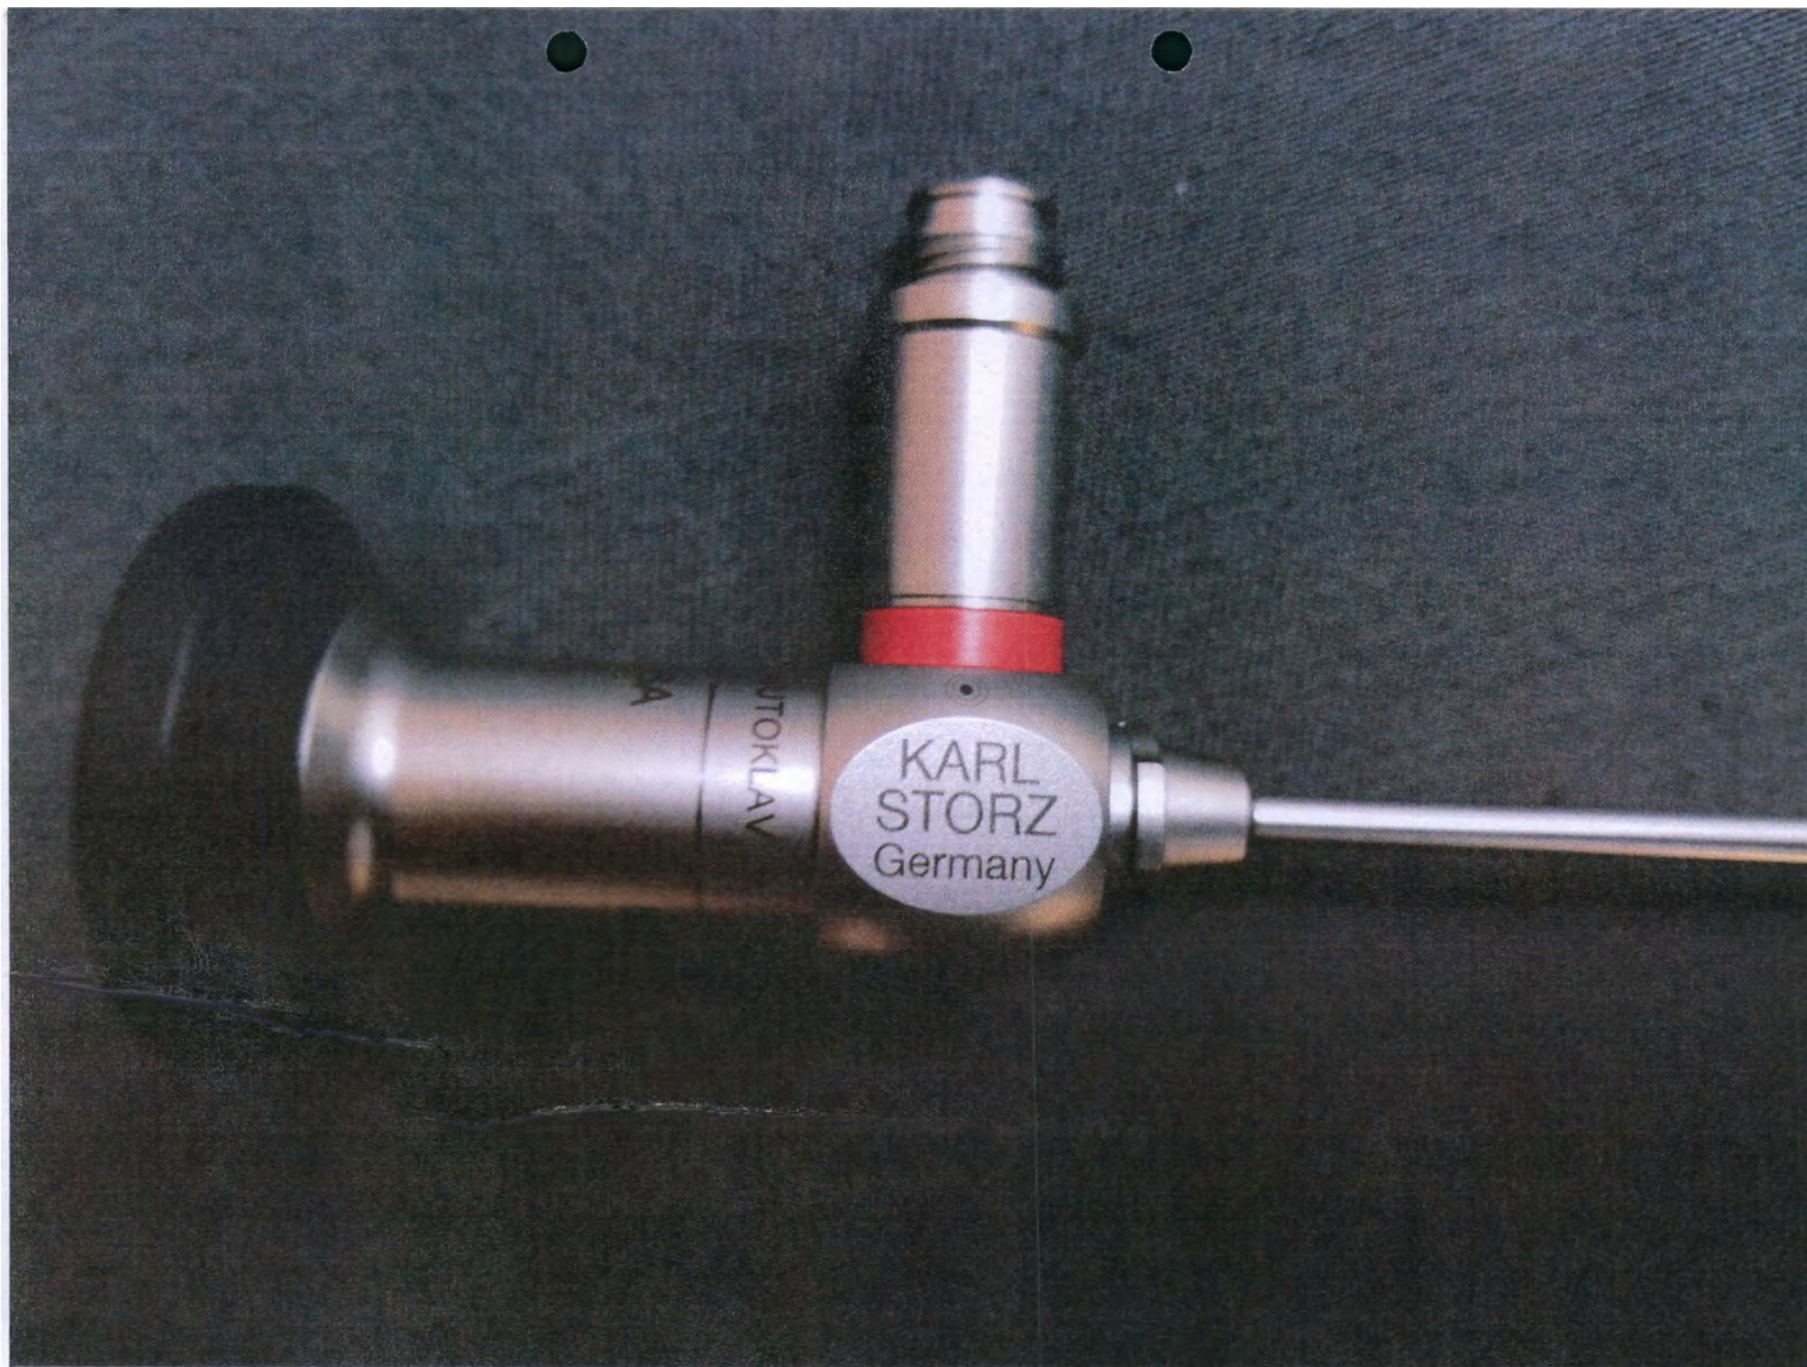


Рис. 7. Эндоскоп.



Рис. 8. Эндоскоп.



Рис. 9. Эндоскоп.

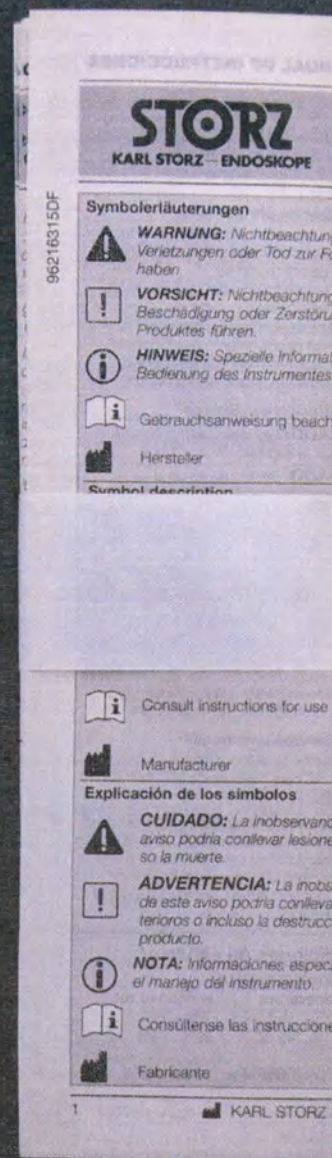


Рис. 10. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.

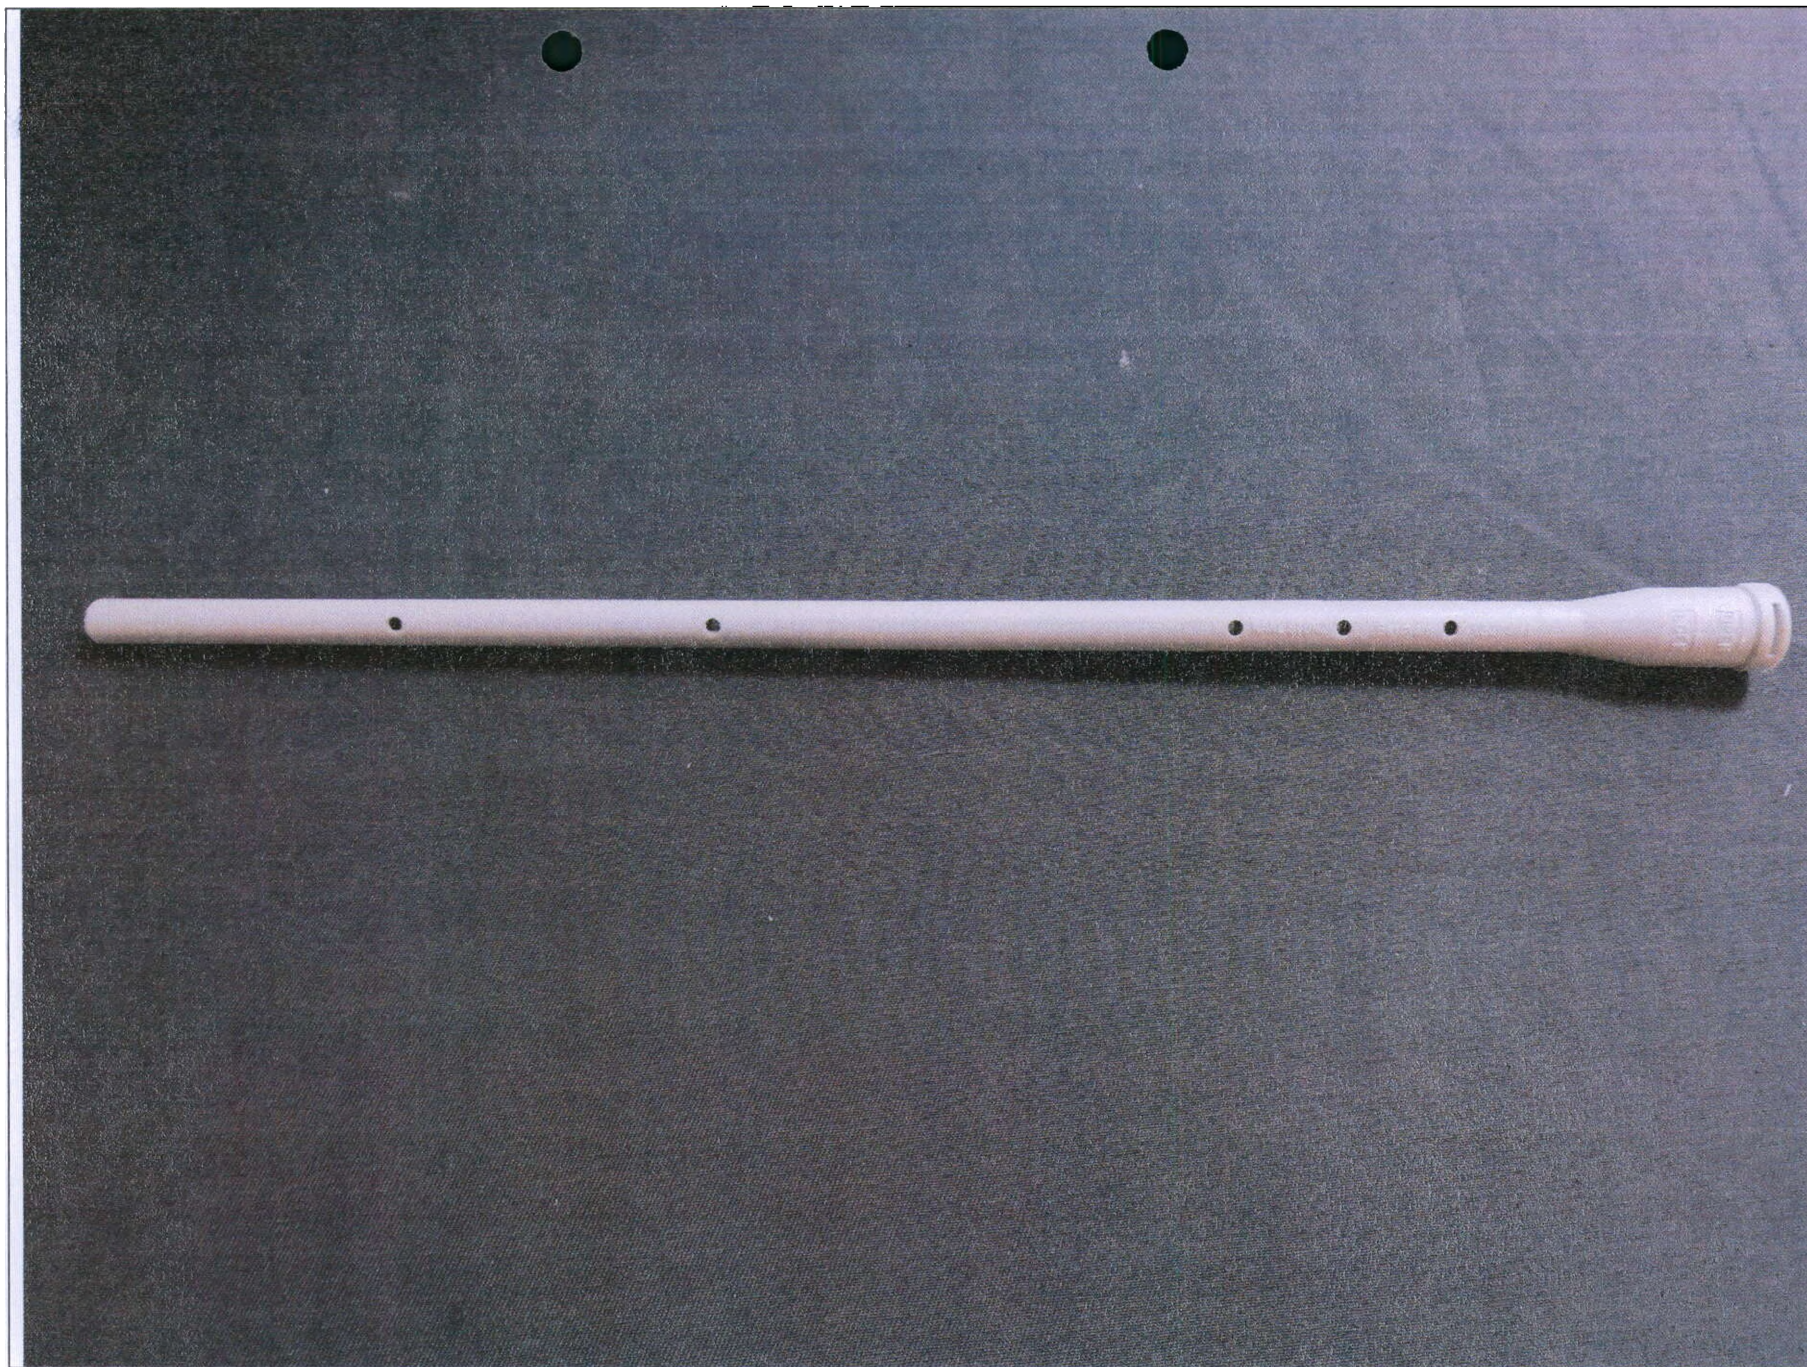


Рис. 11. Гильза защитная, для эндоскопов длиной 30 см



**Рис. 12. Эндоскоп жесткий HOPKINS для фетоскопии, типоразмер: направление наблюдения 0°, диаметр 2 мм, длина 26 см.
Упаковка.**

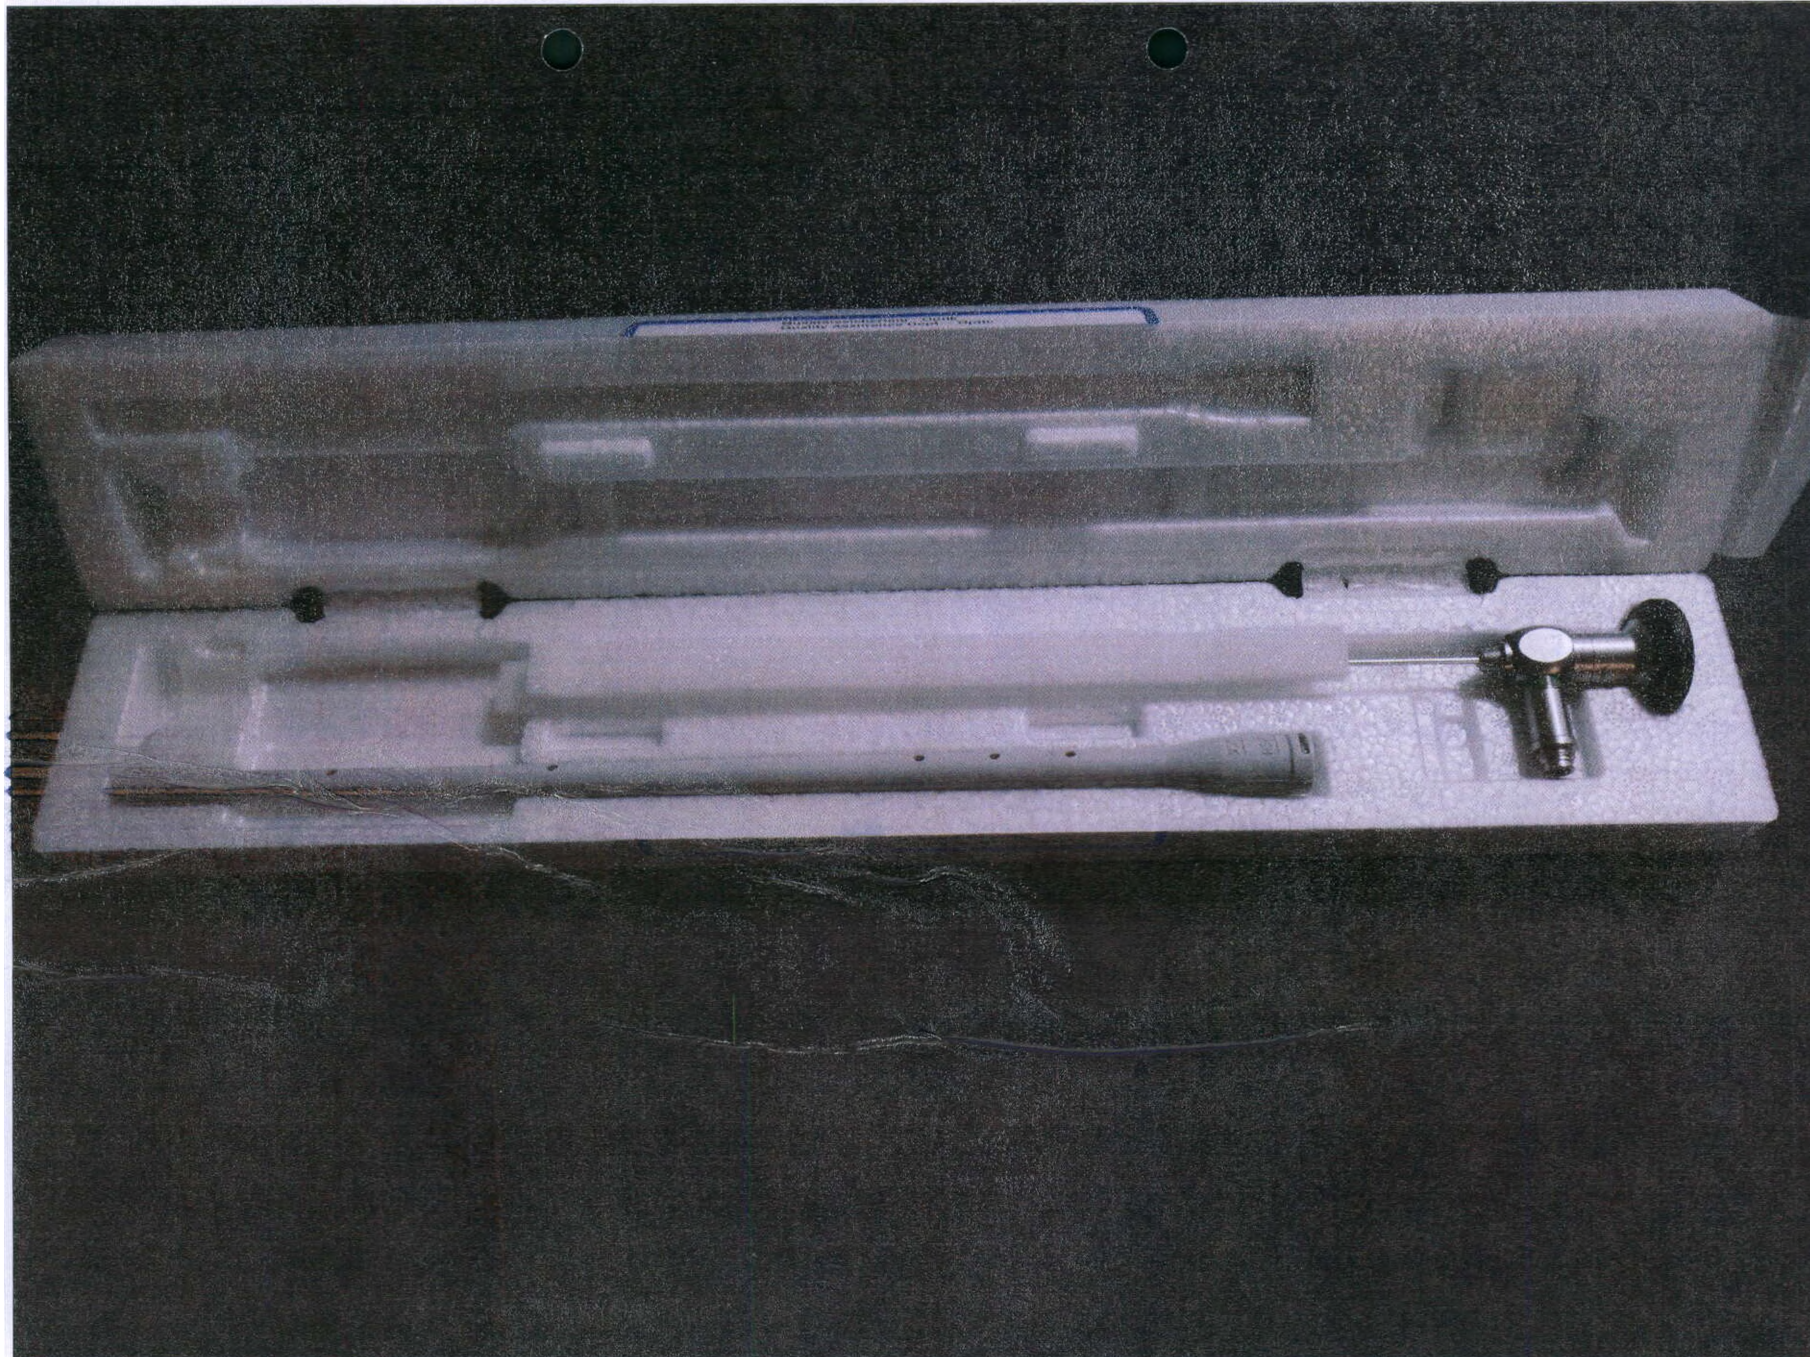


Рис. 14. Эндоскоп жесткий HOPKINS для фетоскопии, типоразмер: направление наблюдения 0°, диаметр 2 мм, длина 26 см.

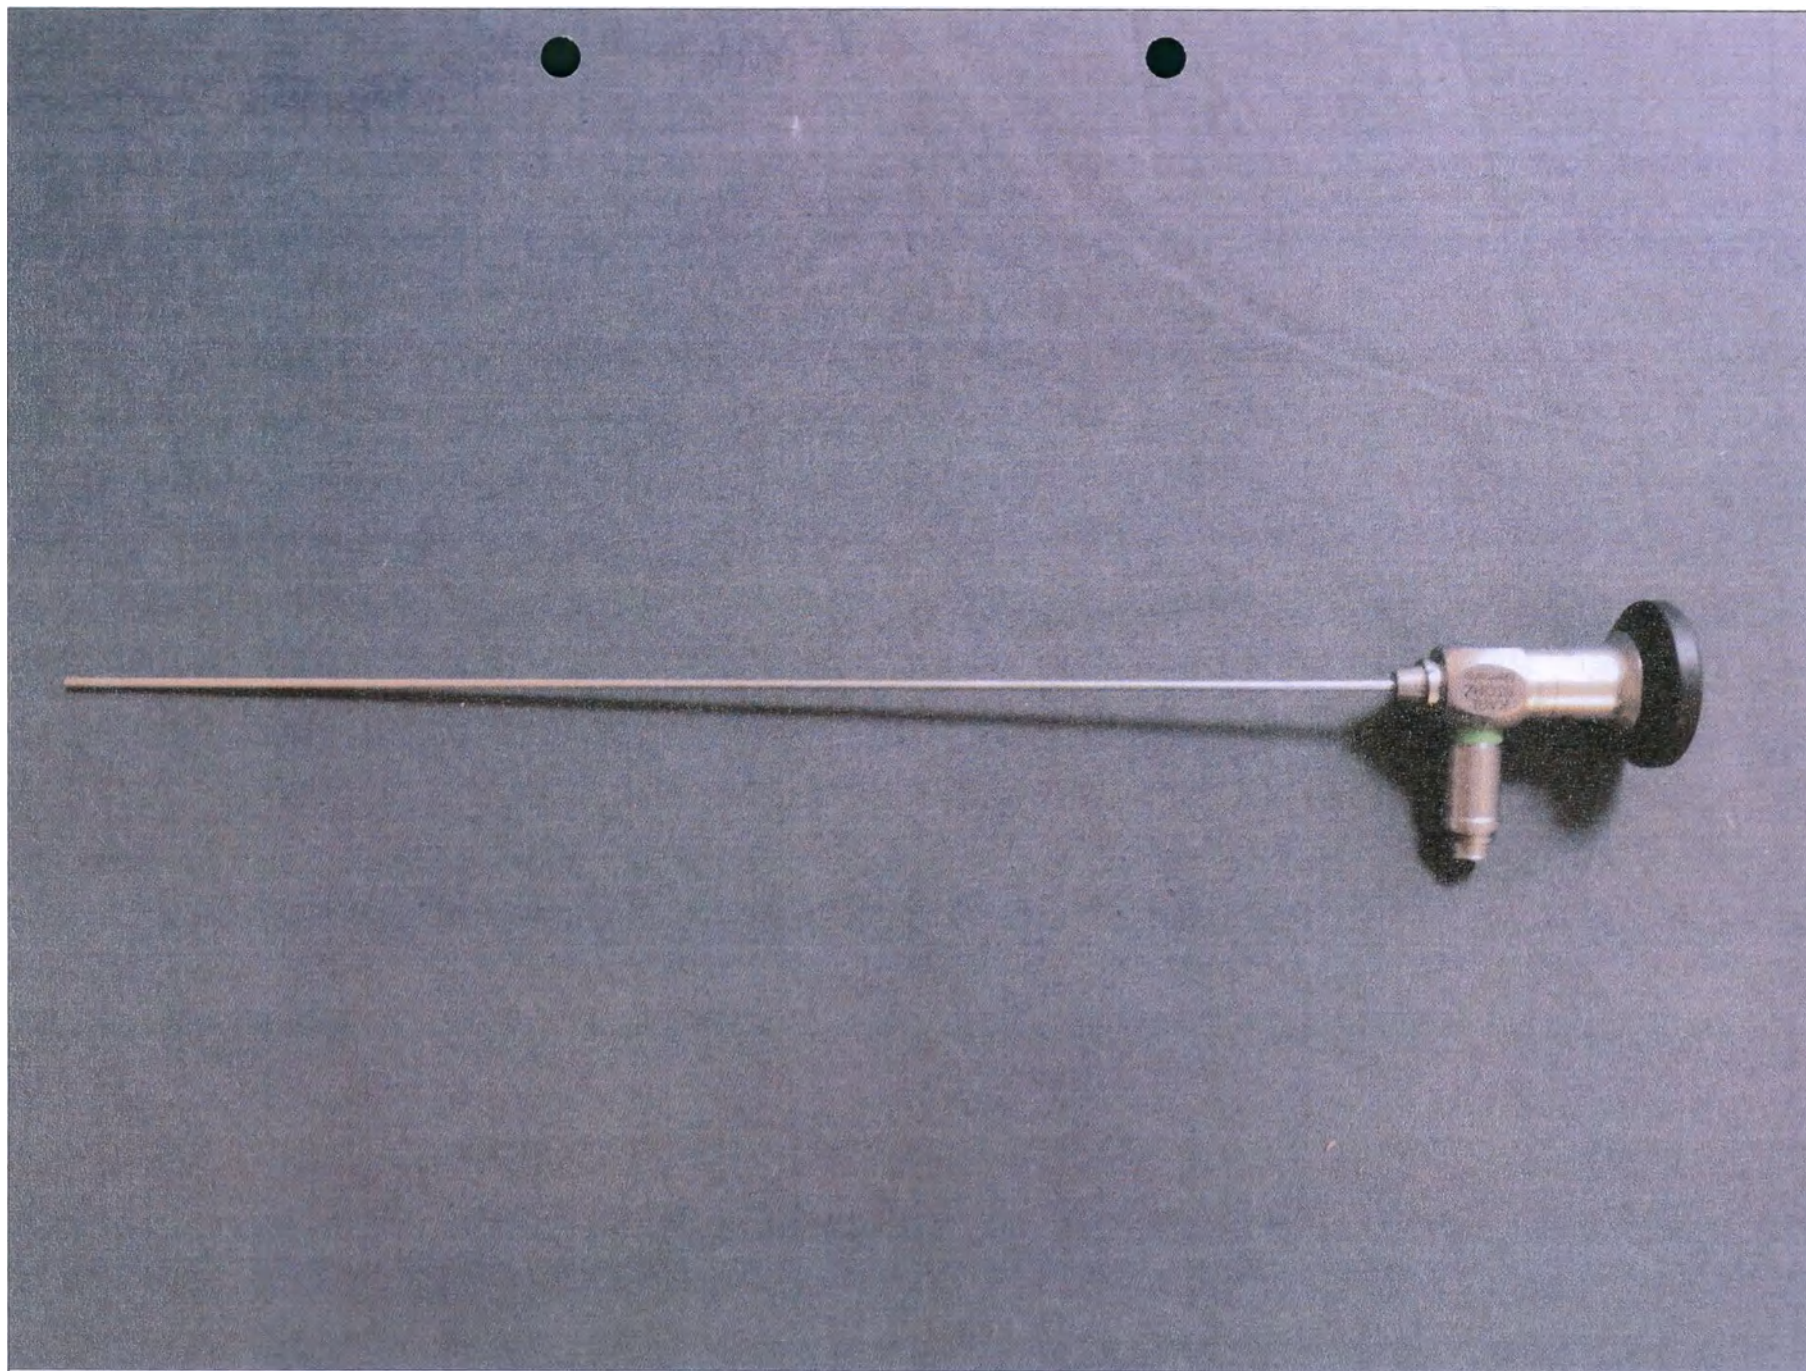


Рис. 15. Эндоскоп

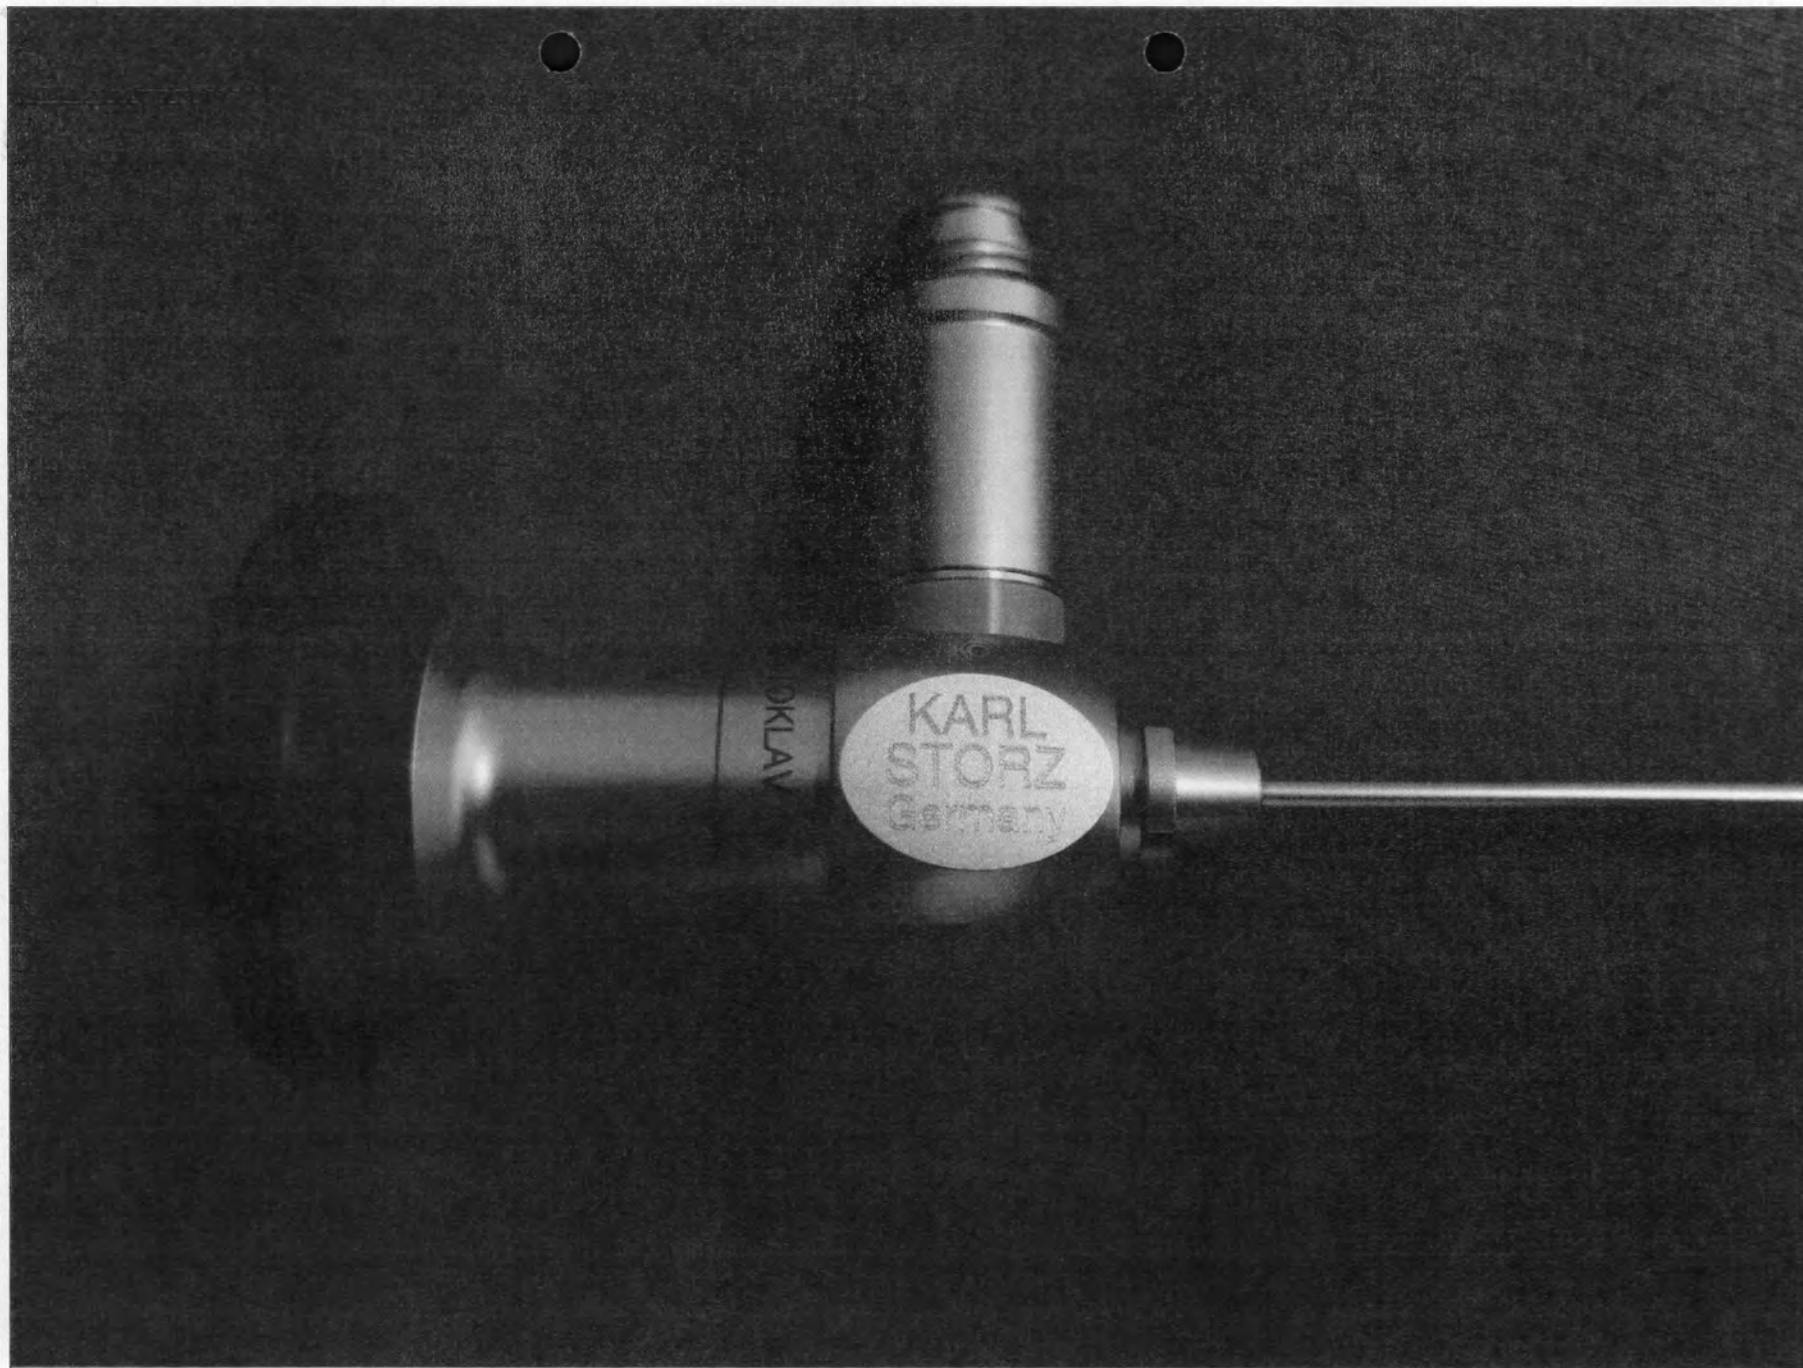


Рис. 16. Эндоскоп



Рис. 17. Эндоскоп



Рис. 18. Эндоскоп

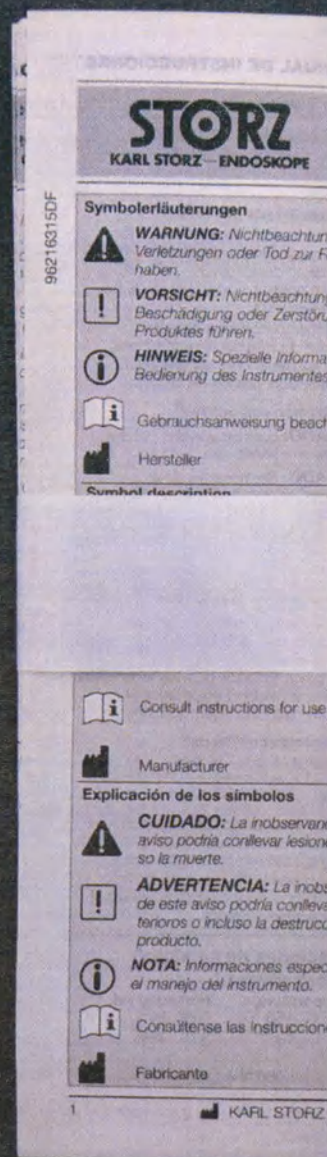


Рис. 19. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.

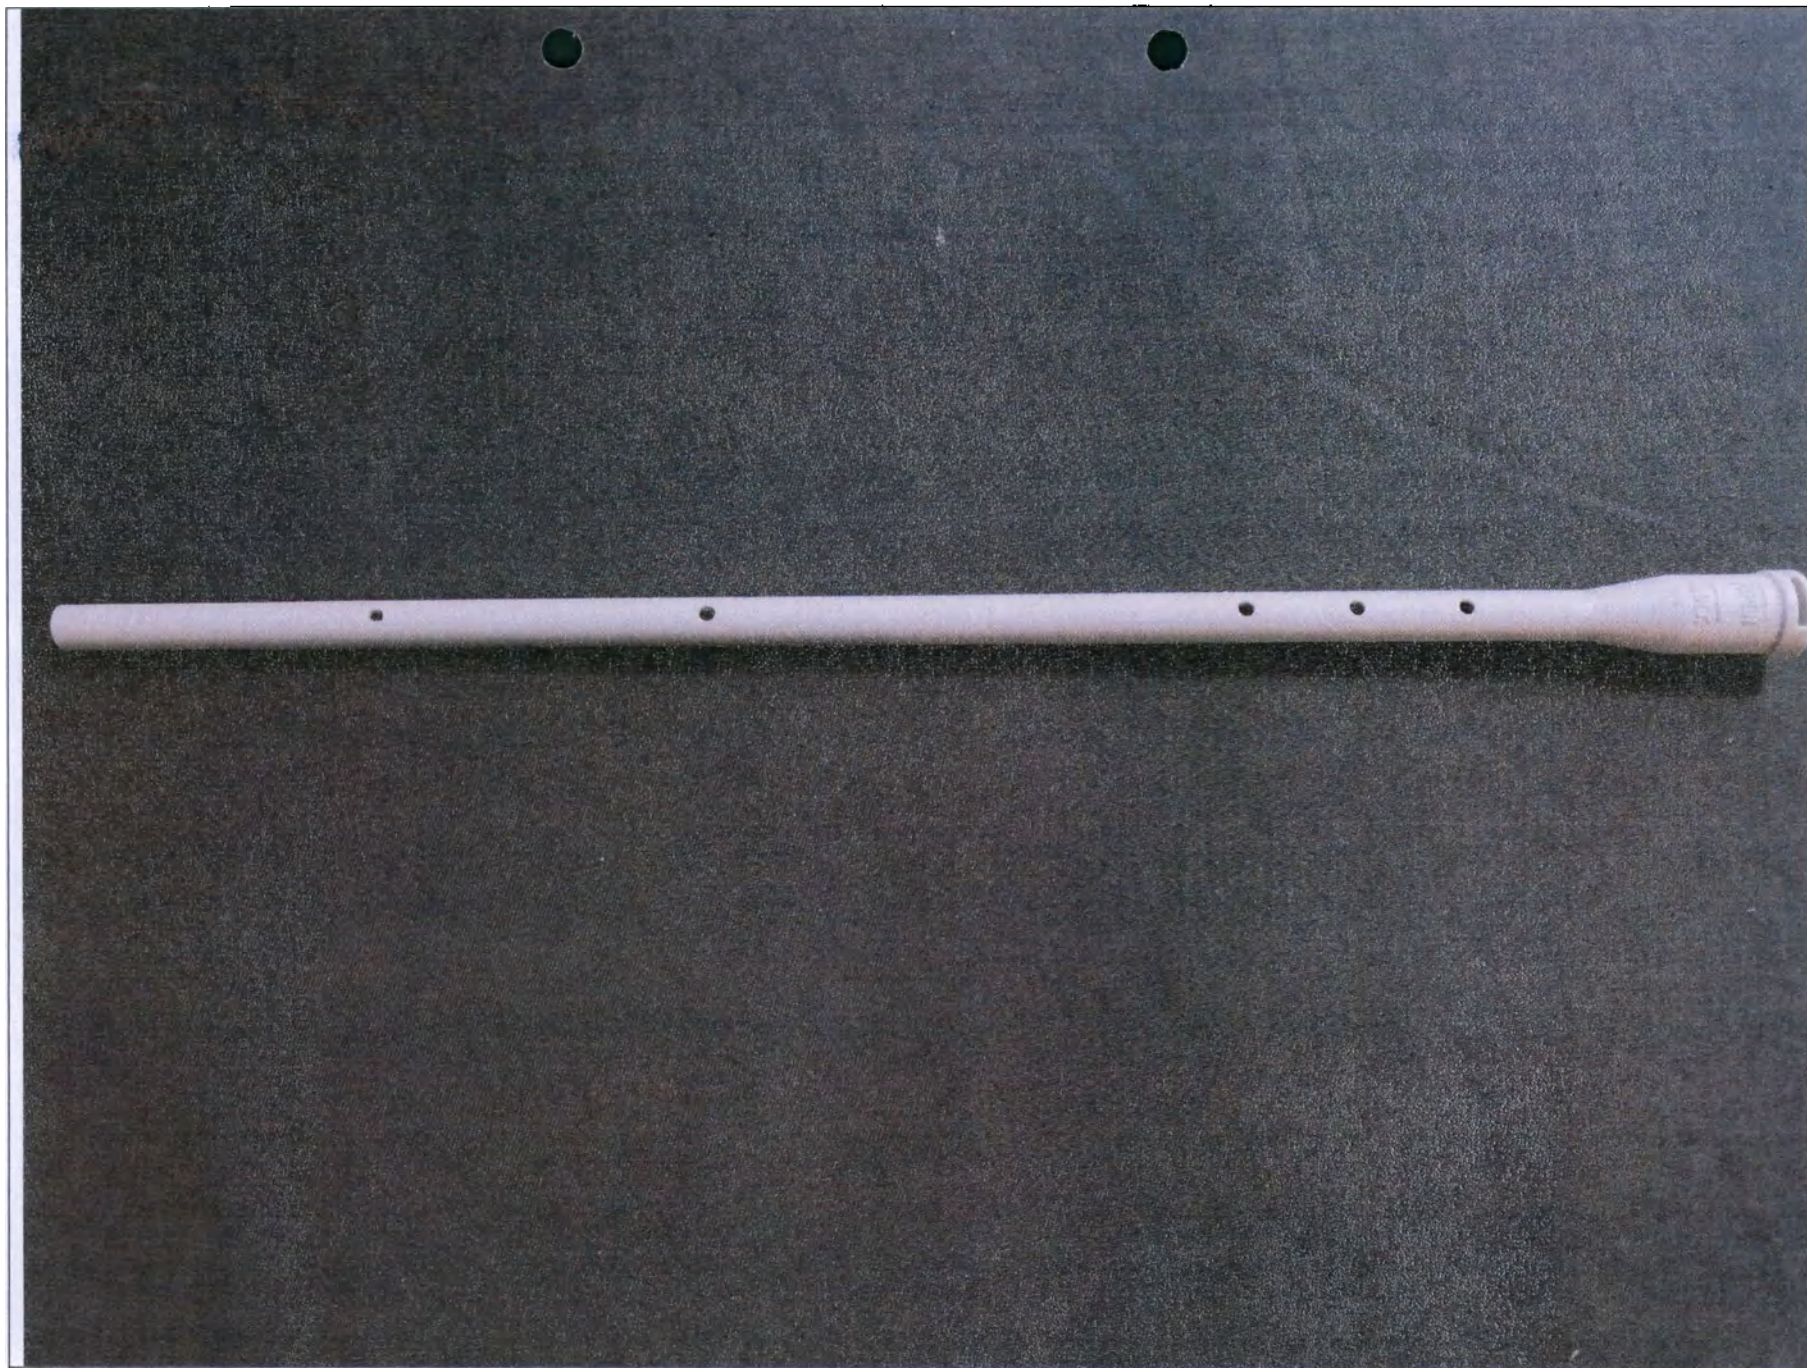


Рис. 20. Гильза защитная, для эндоскопов длиной 30 см.



Рис. 21. Гистероскоп жесткий HOPKINS по HAMOU, направление наблюдения 30°, диаметр 2,9 мм, длина 30 см. Упаковка.

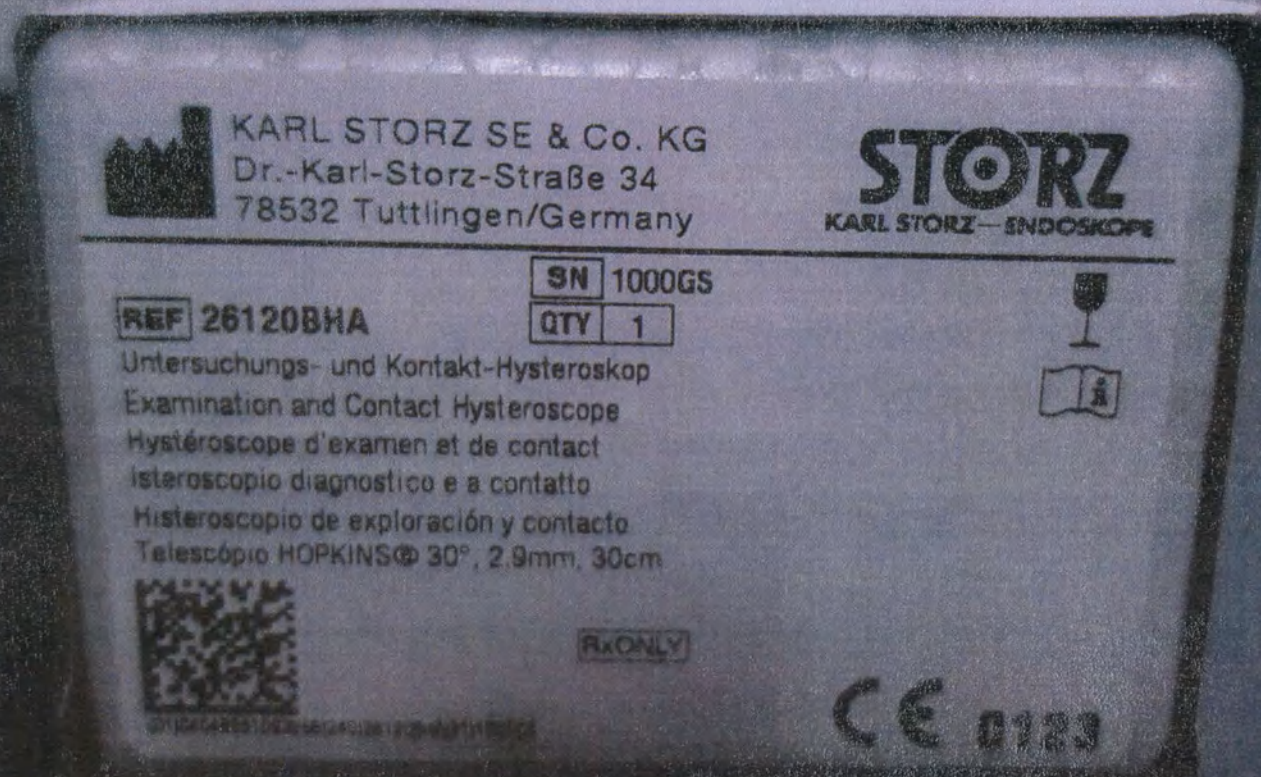


Рис. 22. Гистероскоп жесткий HOPKINS по HAMOU, направление наблюдения 30°, диаметр 2,9 мм, длина 30 см.
Маркировка на упаковке

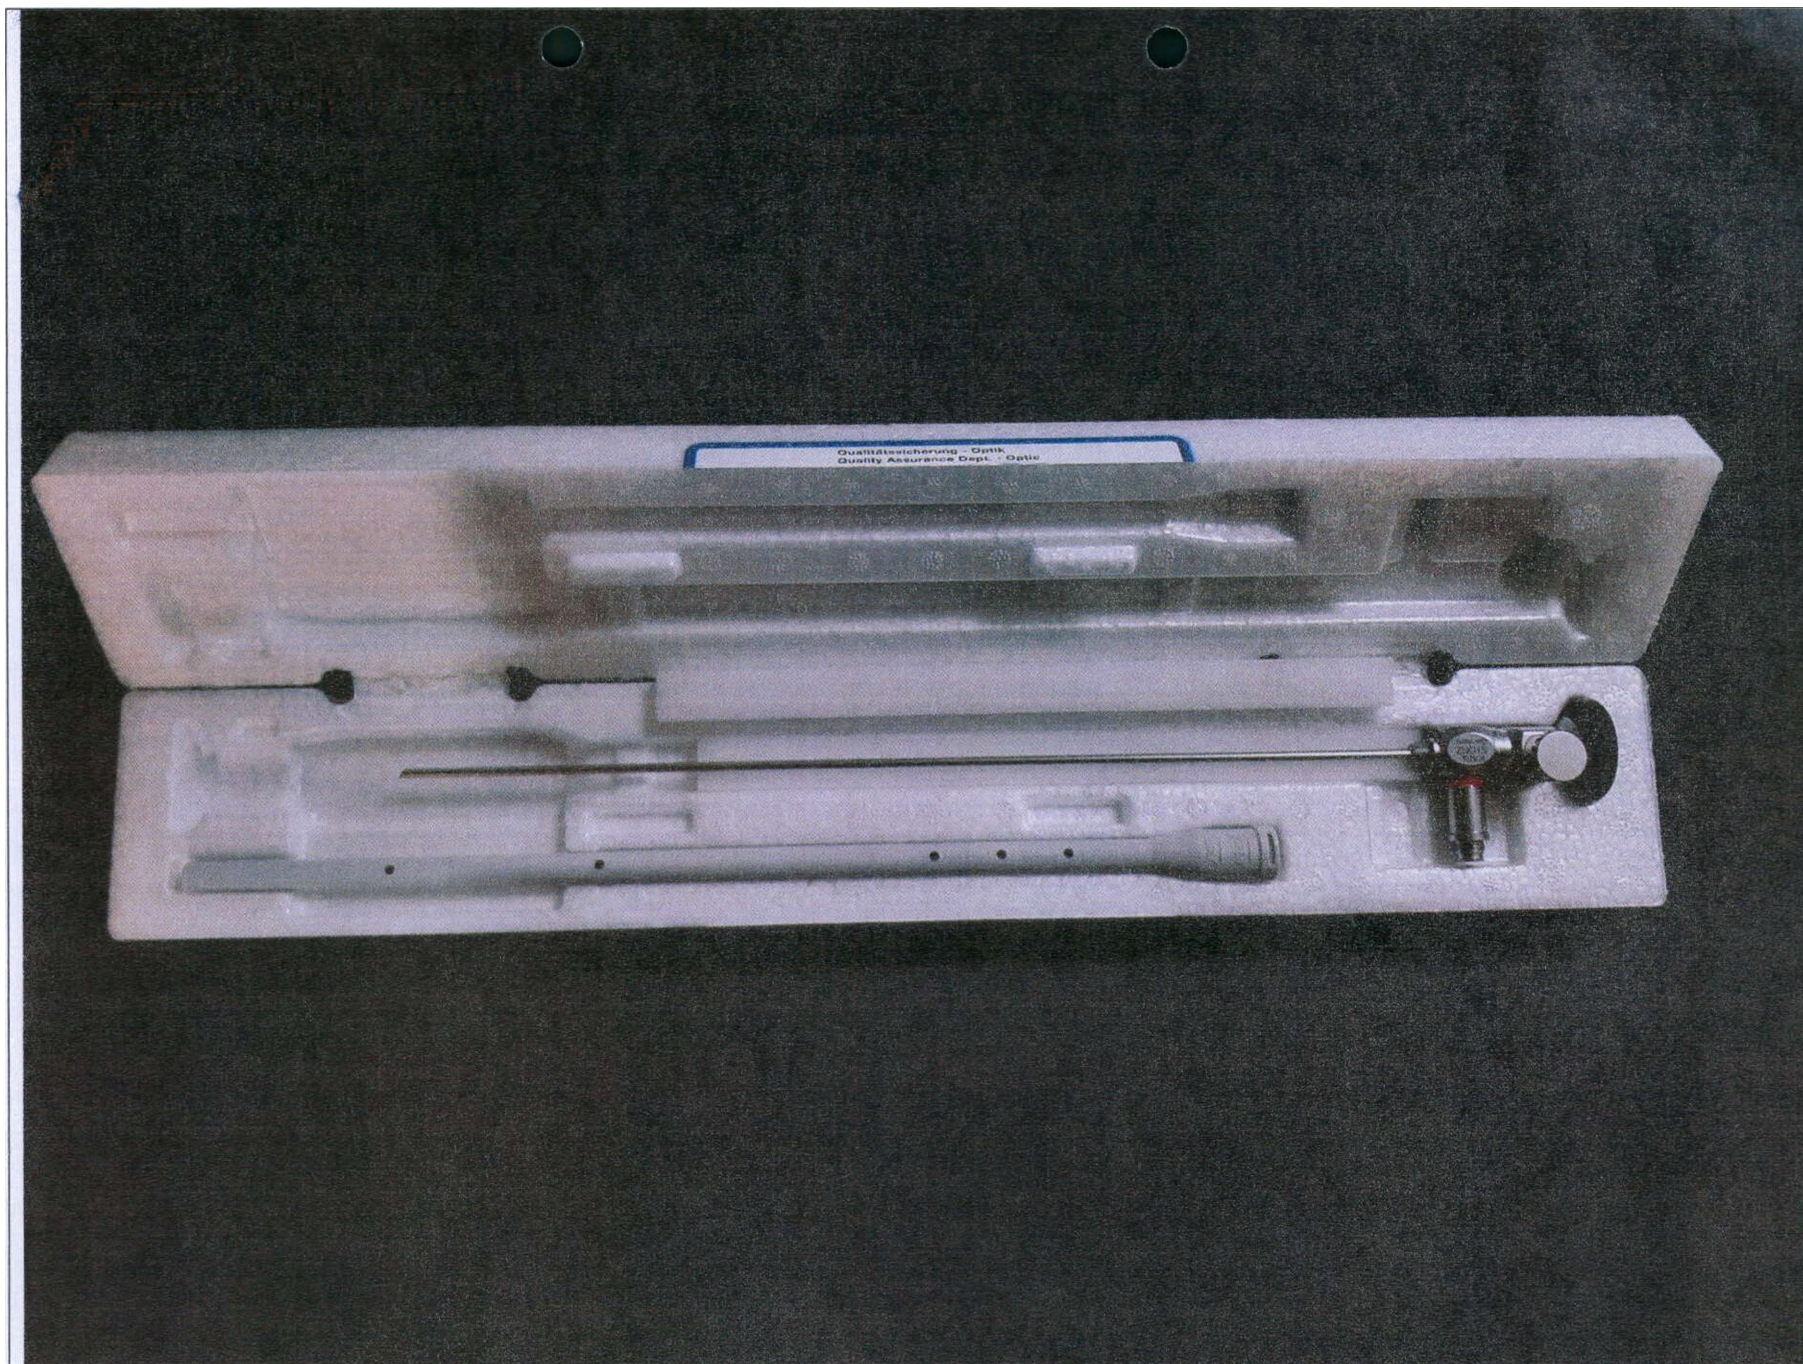


Рис. 23. Гистероскоп жесткий HOPKINS по HAMOU, направление наблюдения 30°, диаметр 2,9 мм, длина 30 см.

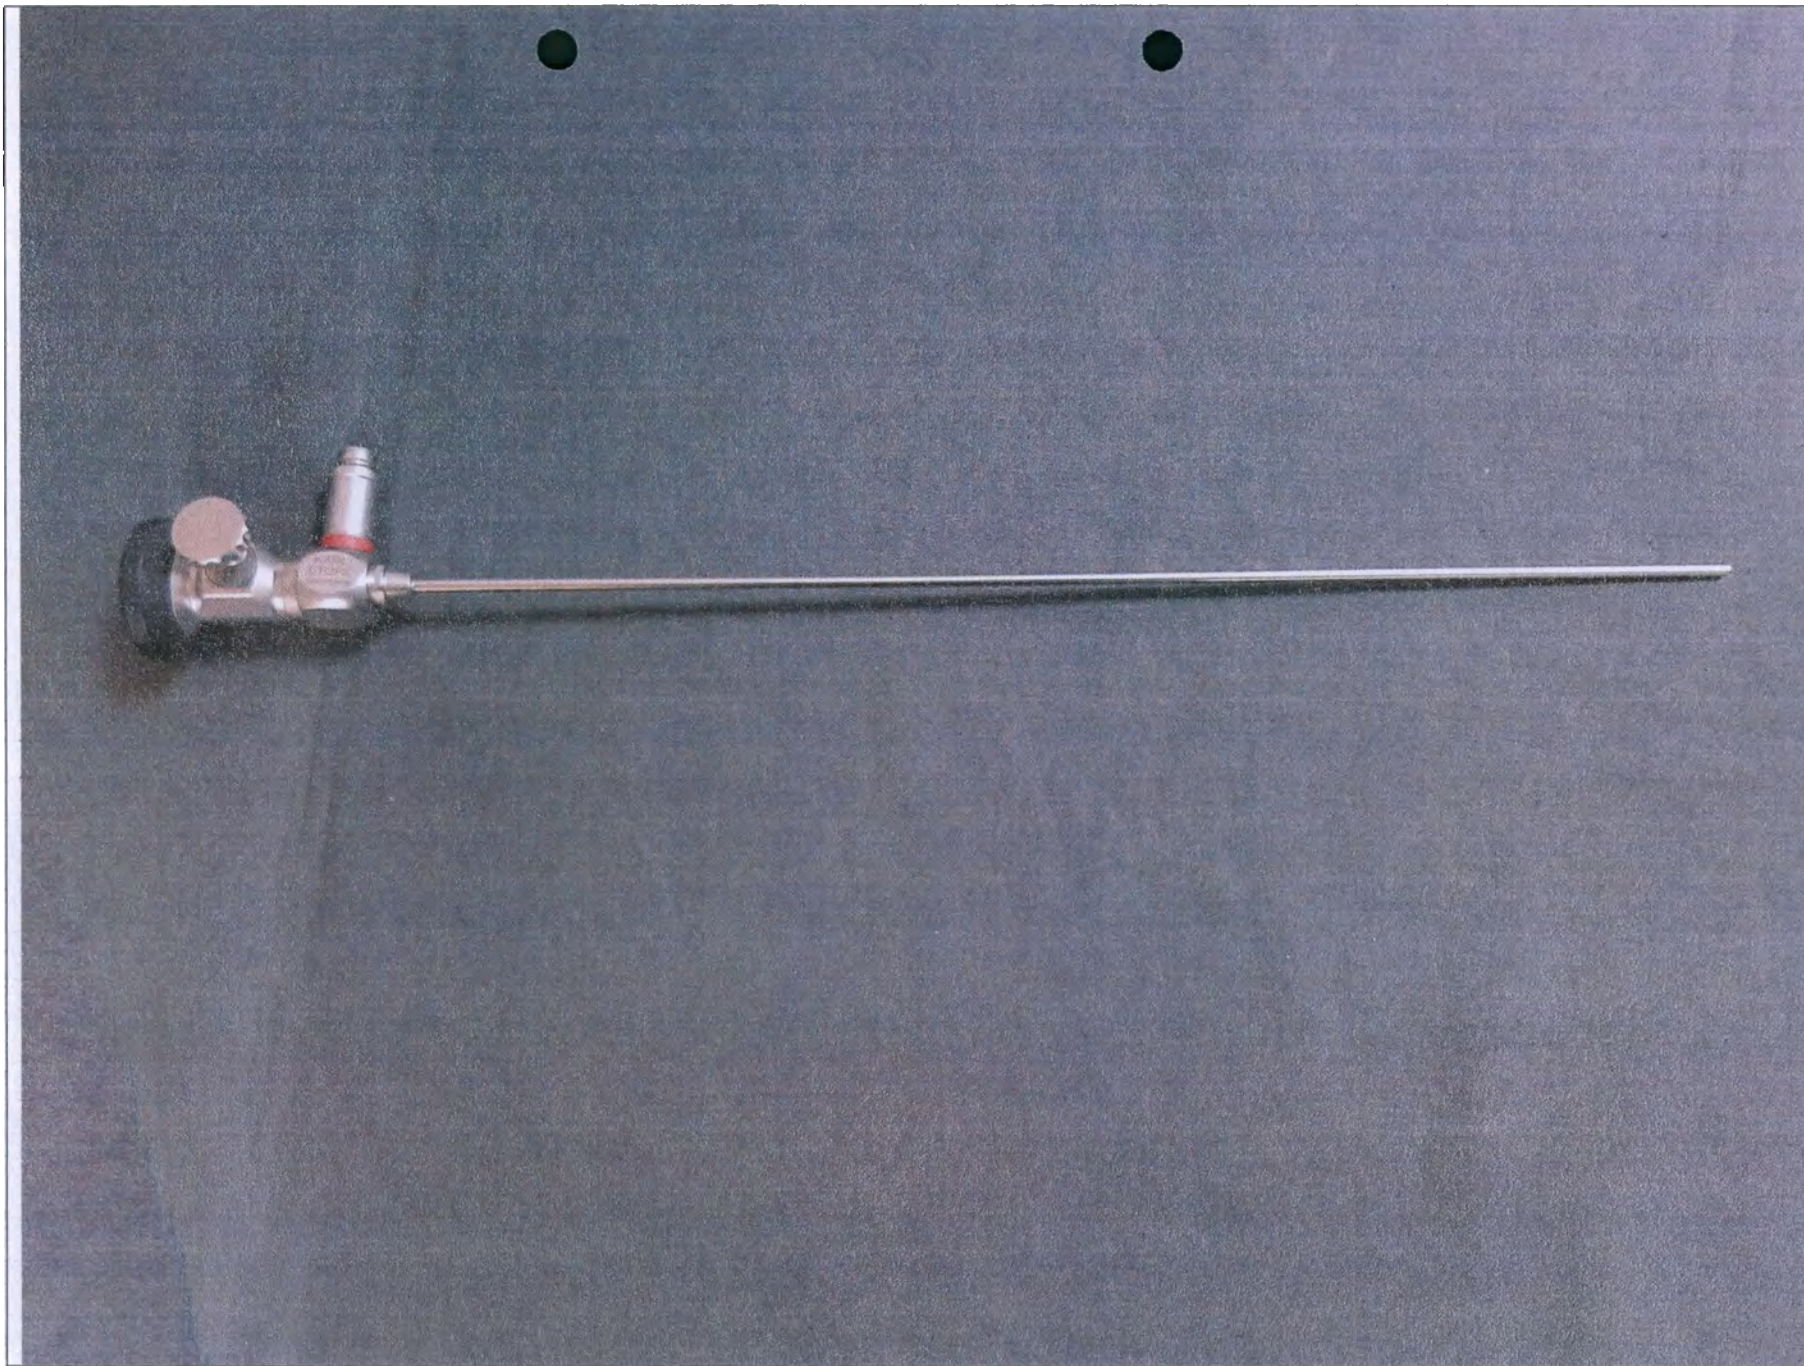


Рис. 24. Гистероскоп

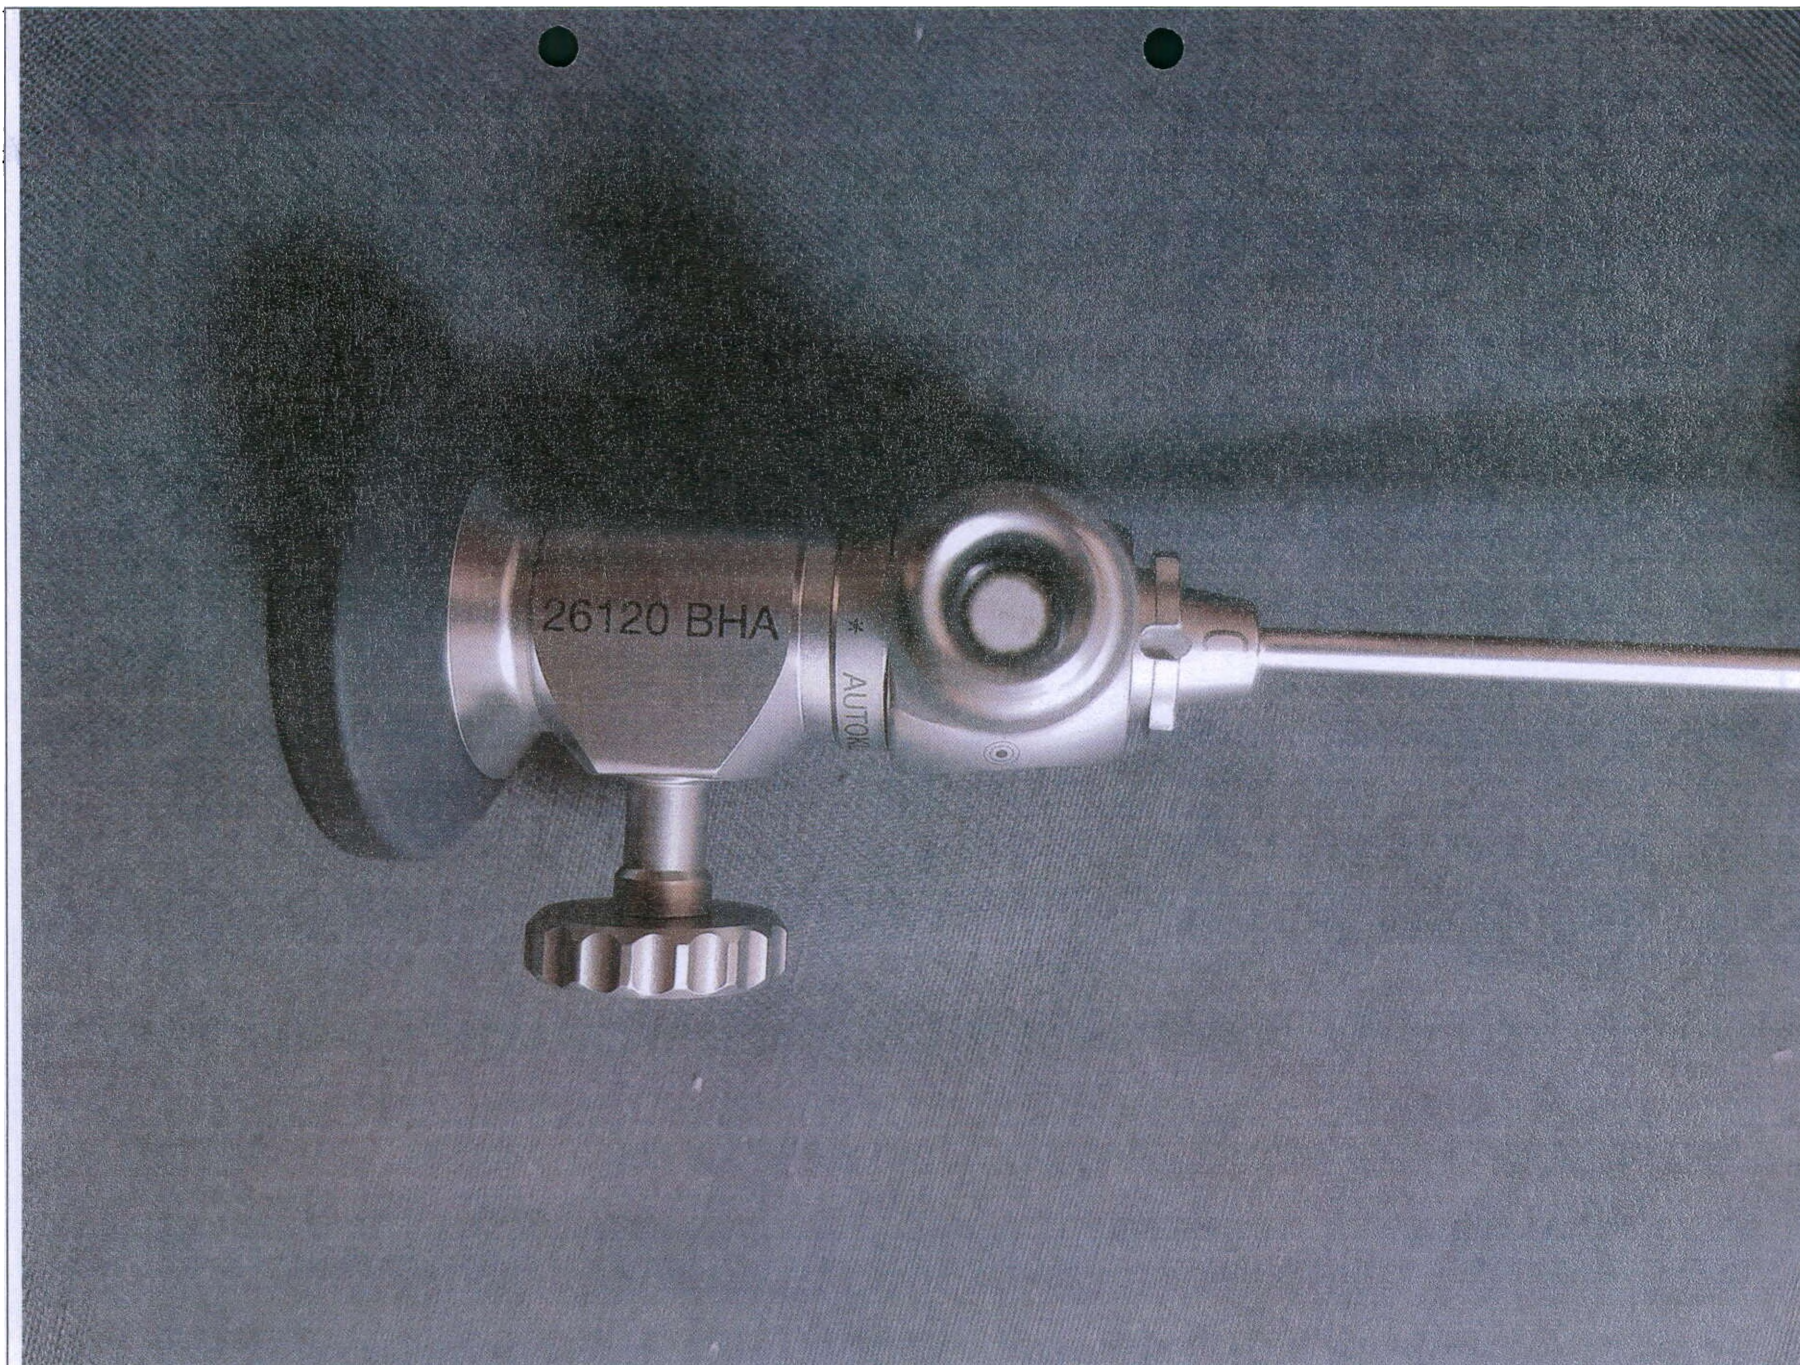


Рис. 25. Гистероскоп

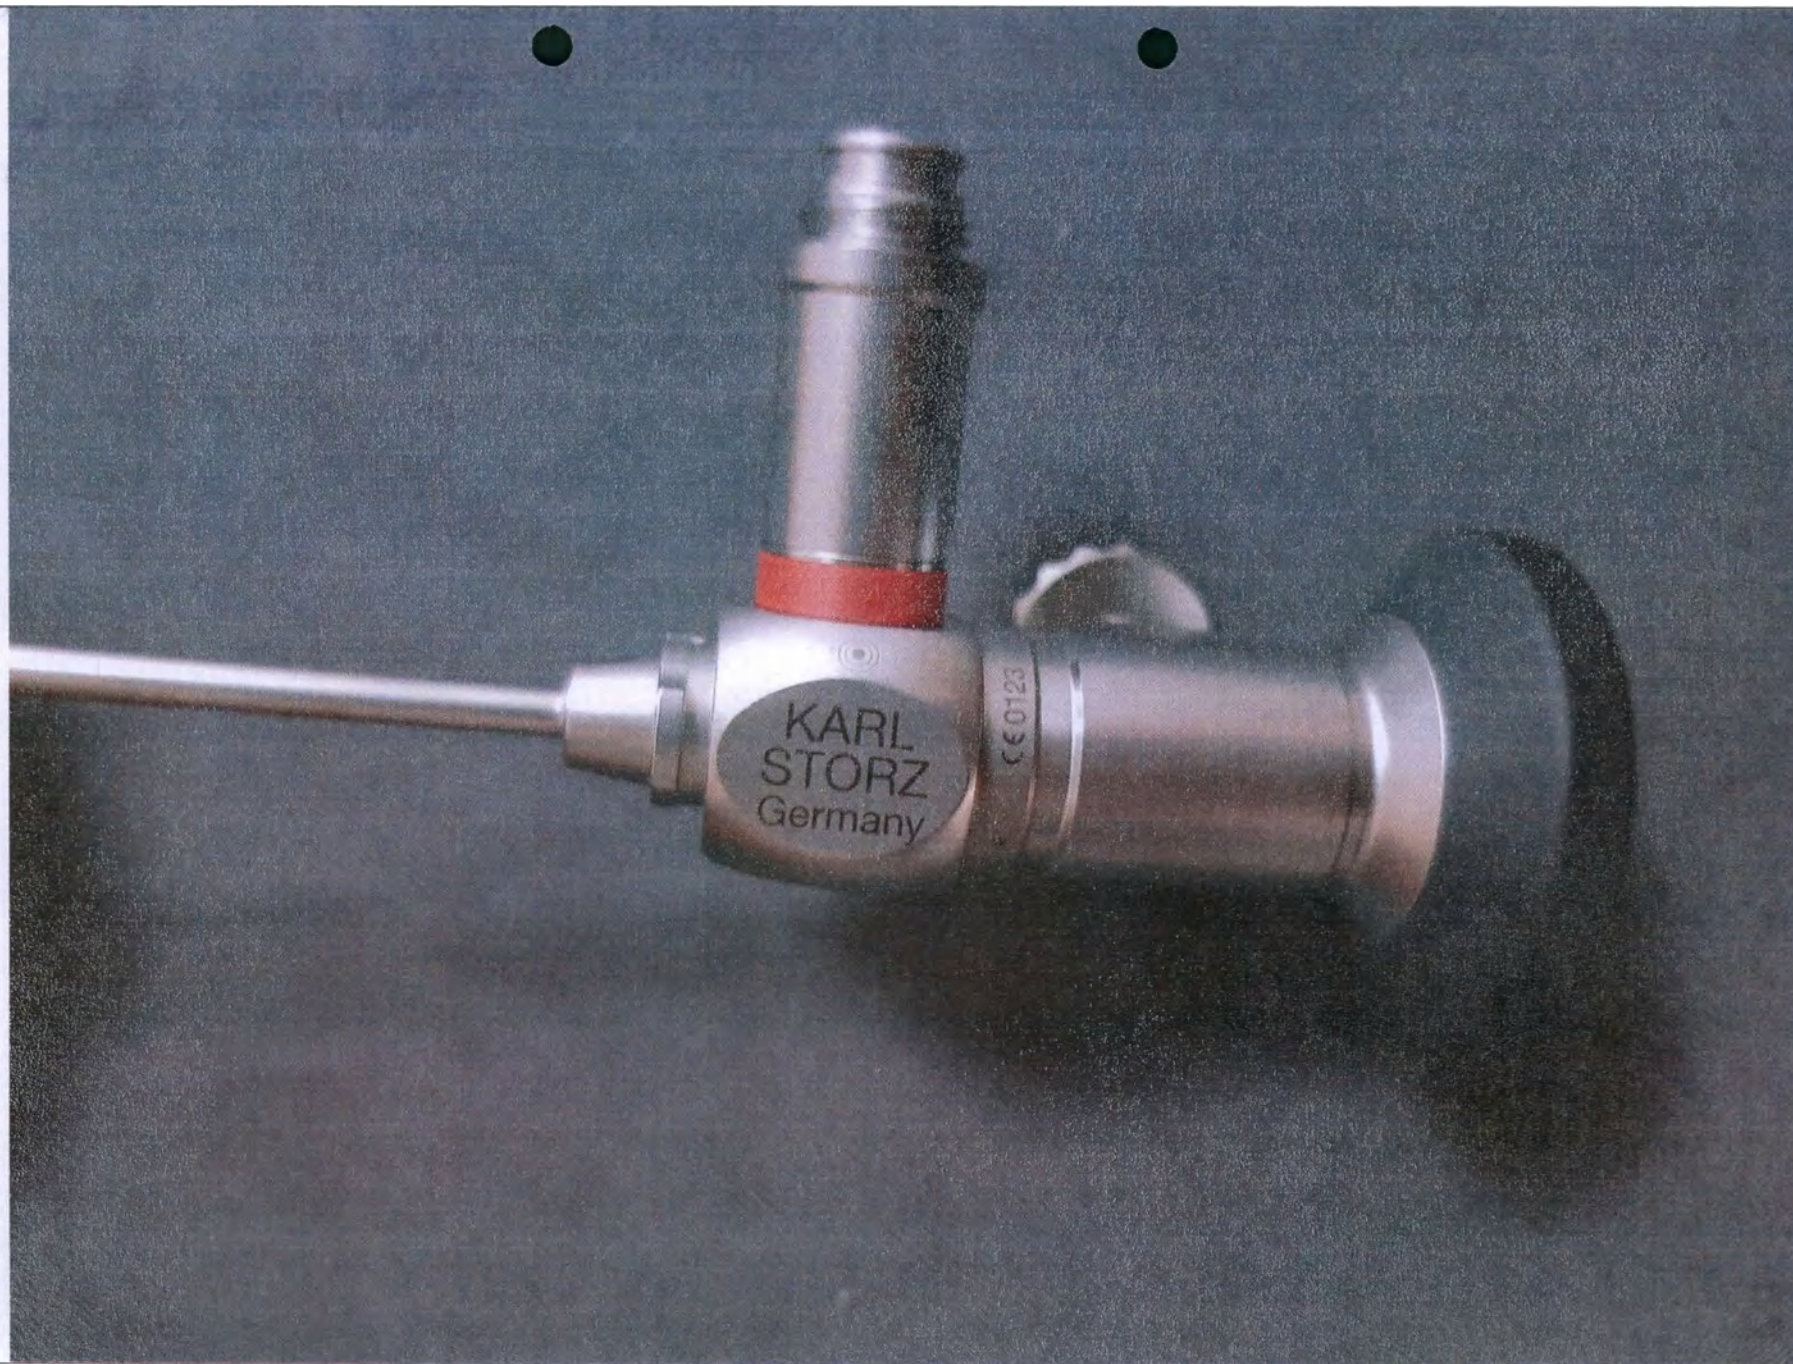


Рис. 26. Гистероскоп

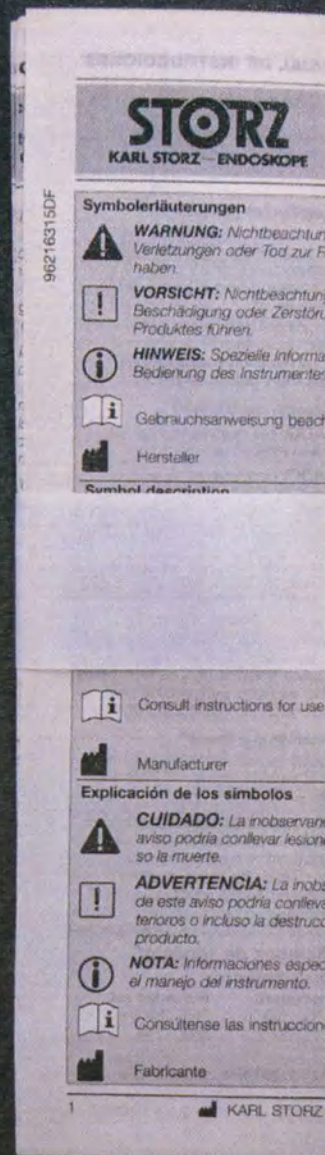


Рис. 27. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.



Рис. 28. Гильза защитная, для эндоскопов длиной 30 см



Рис. 29. Гистероскоп жесткий НОРКИНС, типоразмер: направление наблюдения 0°, диаметр 2,9 мм, длина 30 см. Упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSCOPE

REF 26120AA

SN 1200V5

QTY 1

HOPKINS Optik 0°, 2,9 mm, 30 cm
HOPKINS Telescope 0°, 2,9 mm, 30 cm
Optique HOPKINS® de 0°, 2,9mm, 30cm
Sist. ottico HOPKINS® 0°, 2,9 mm, 30 cm
Óptica HOPKINS® 0°, 2,9 mm, 30 cm
Ótica HOPKINS 0°, 2,9 mm, 30 cm



RxONLY

CE 0123



Рис. 30. Гистероскоп жесткий HOPKINS, типоразмер: направление наблюдения 0°, диаметр 2,9 мм, длина 30 см.
Маркировка на упаковке.

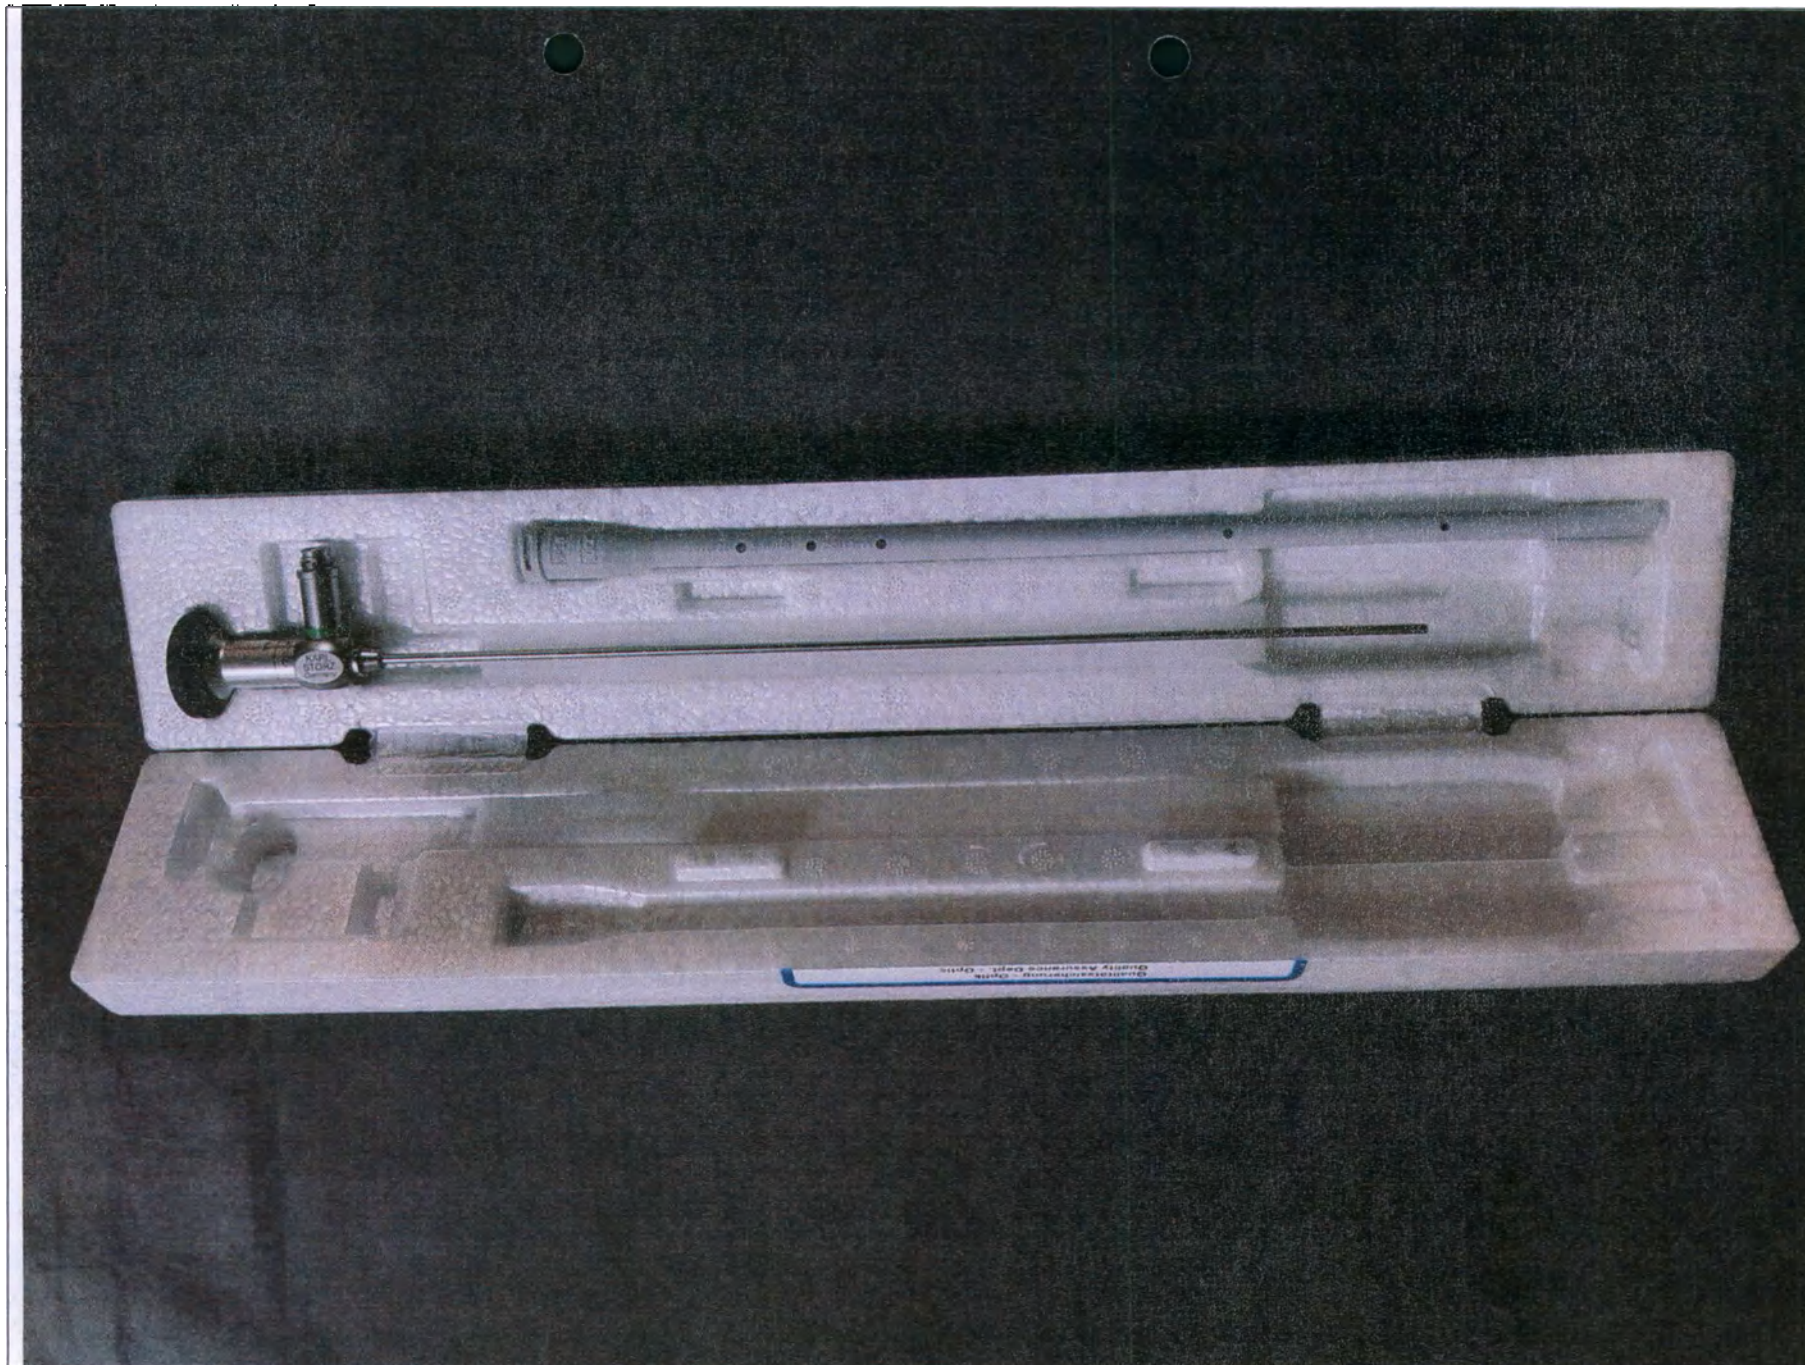


Рис. 31. Гистероскоп жесткий HOPKINS, типоразмер: направление наблюдения 0°, диаметр 2,9 мм, длина 30 см.

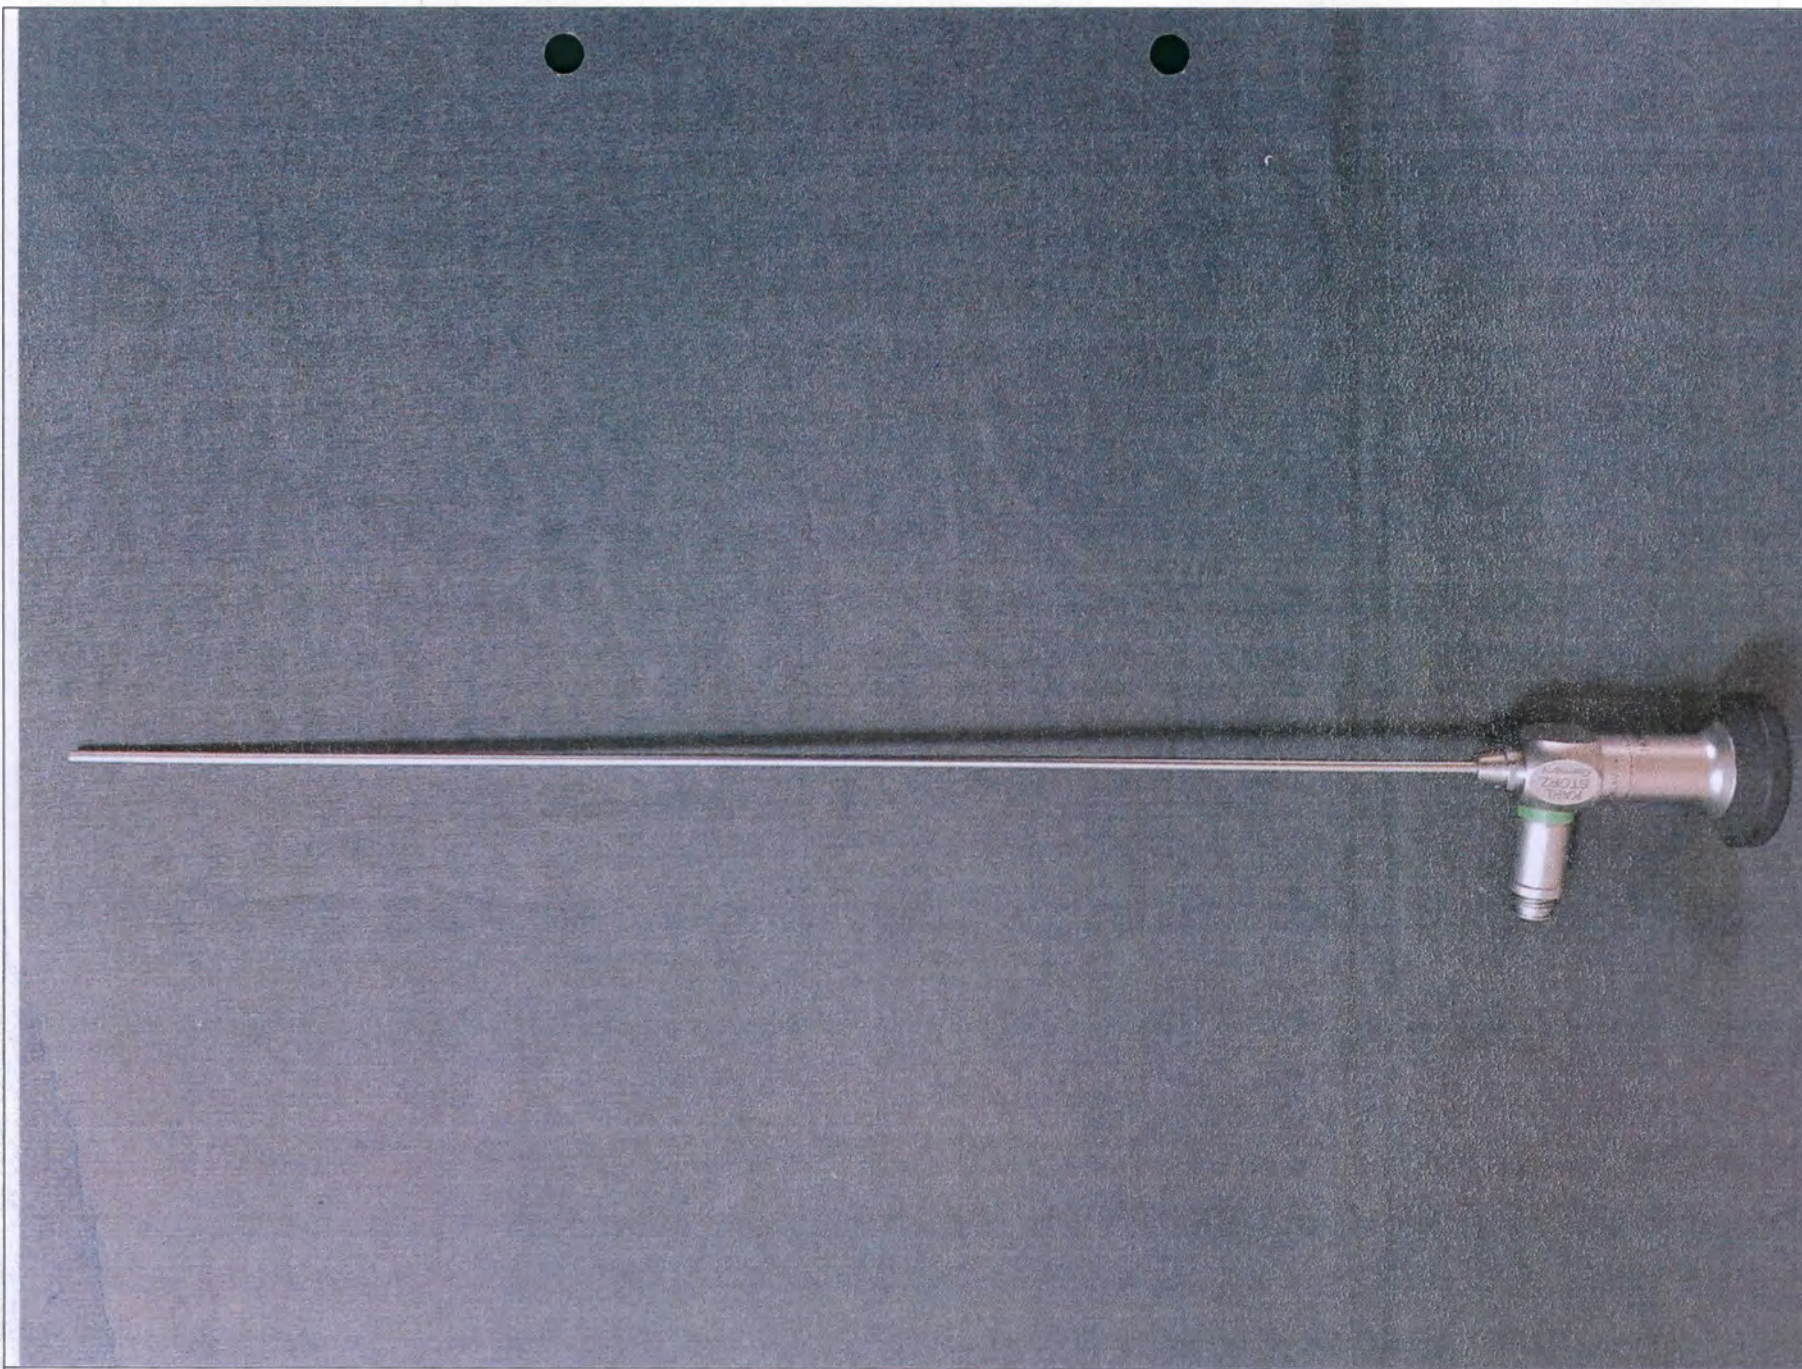


Рис. 32. Гистероскоп

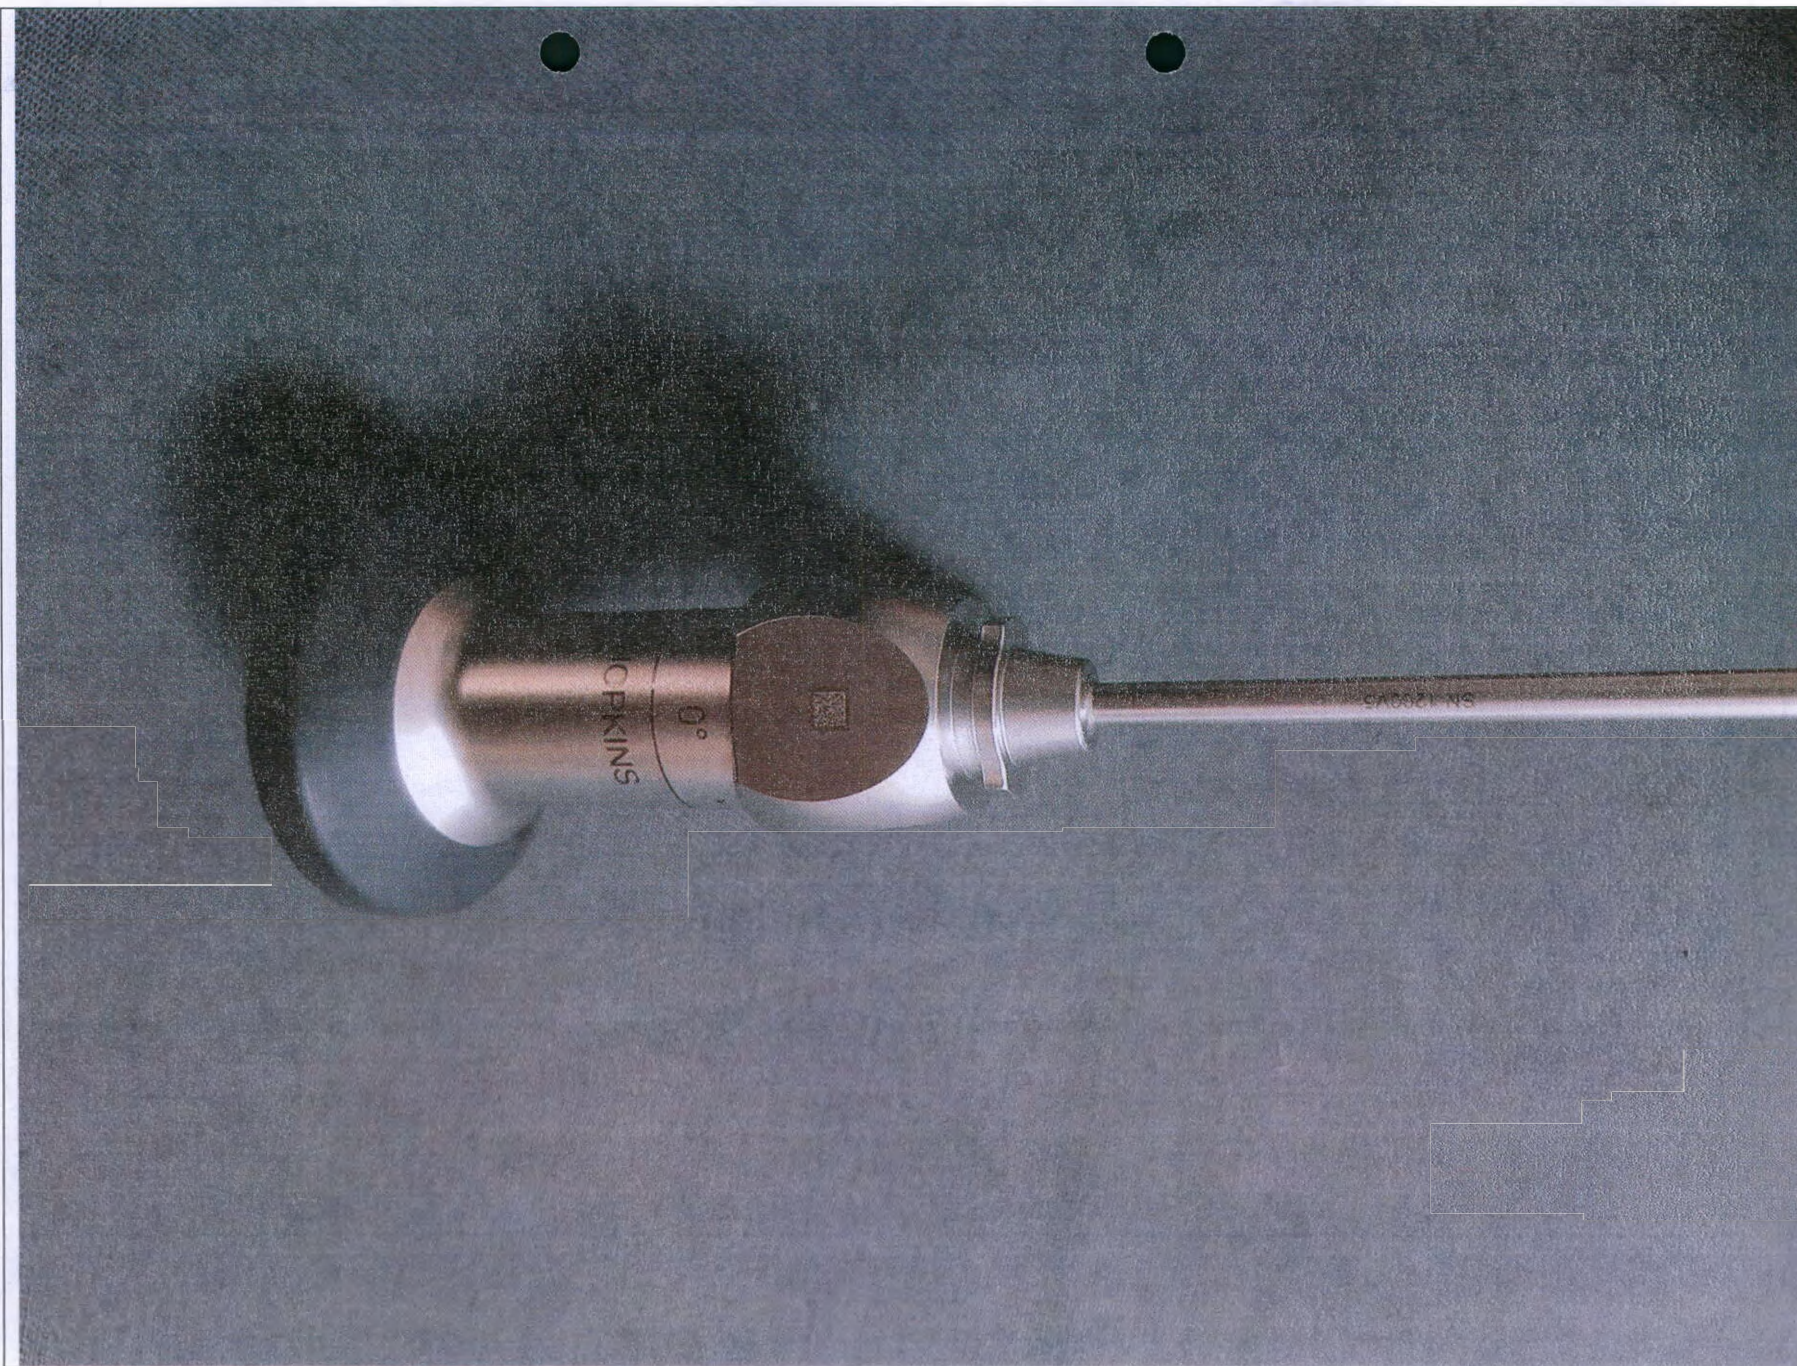


Рис. 33. Гистероскоп

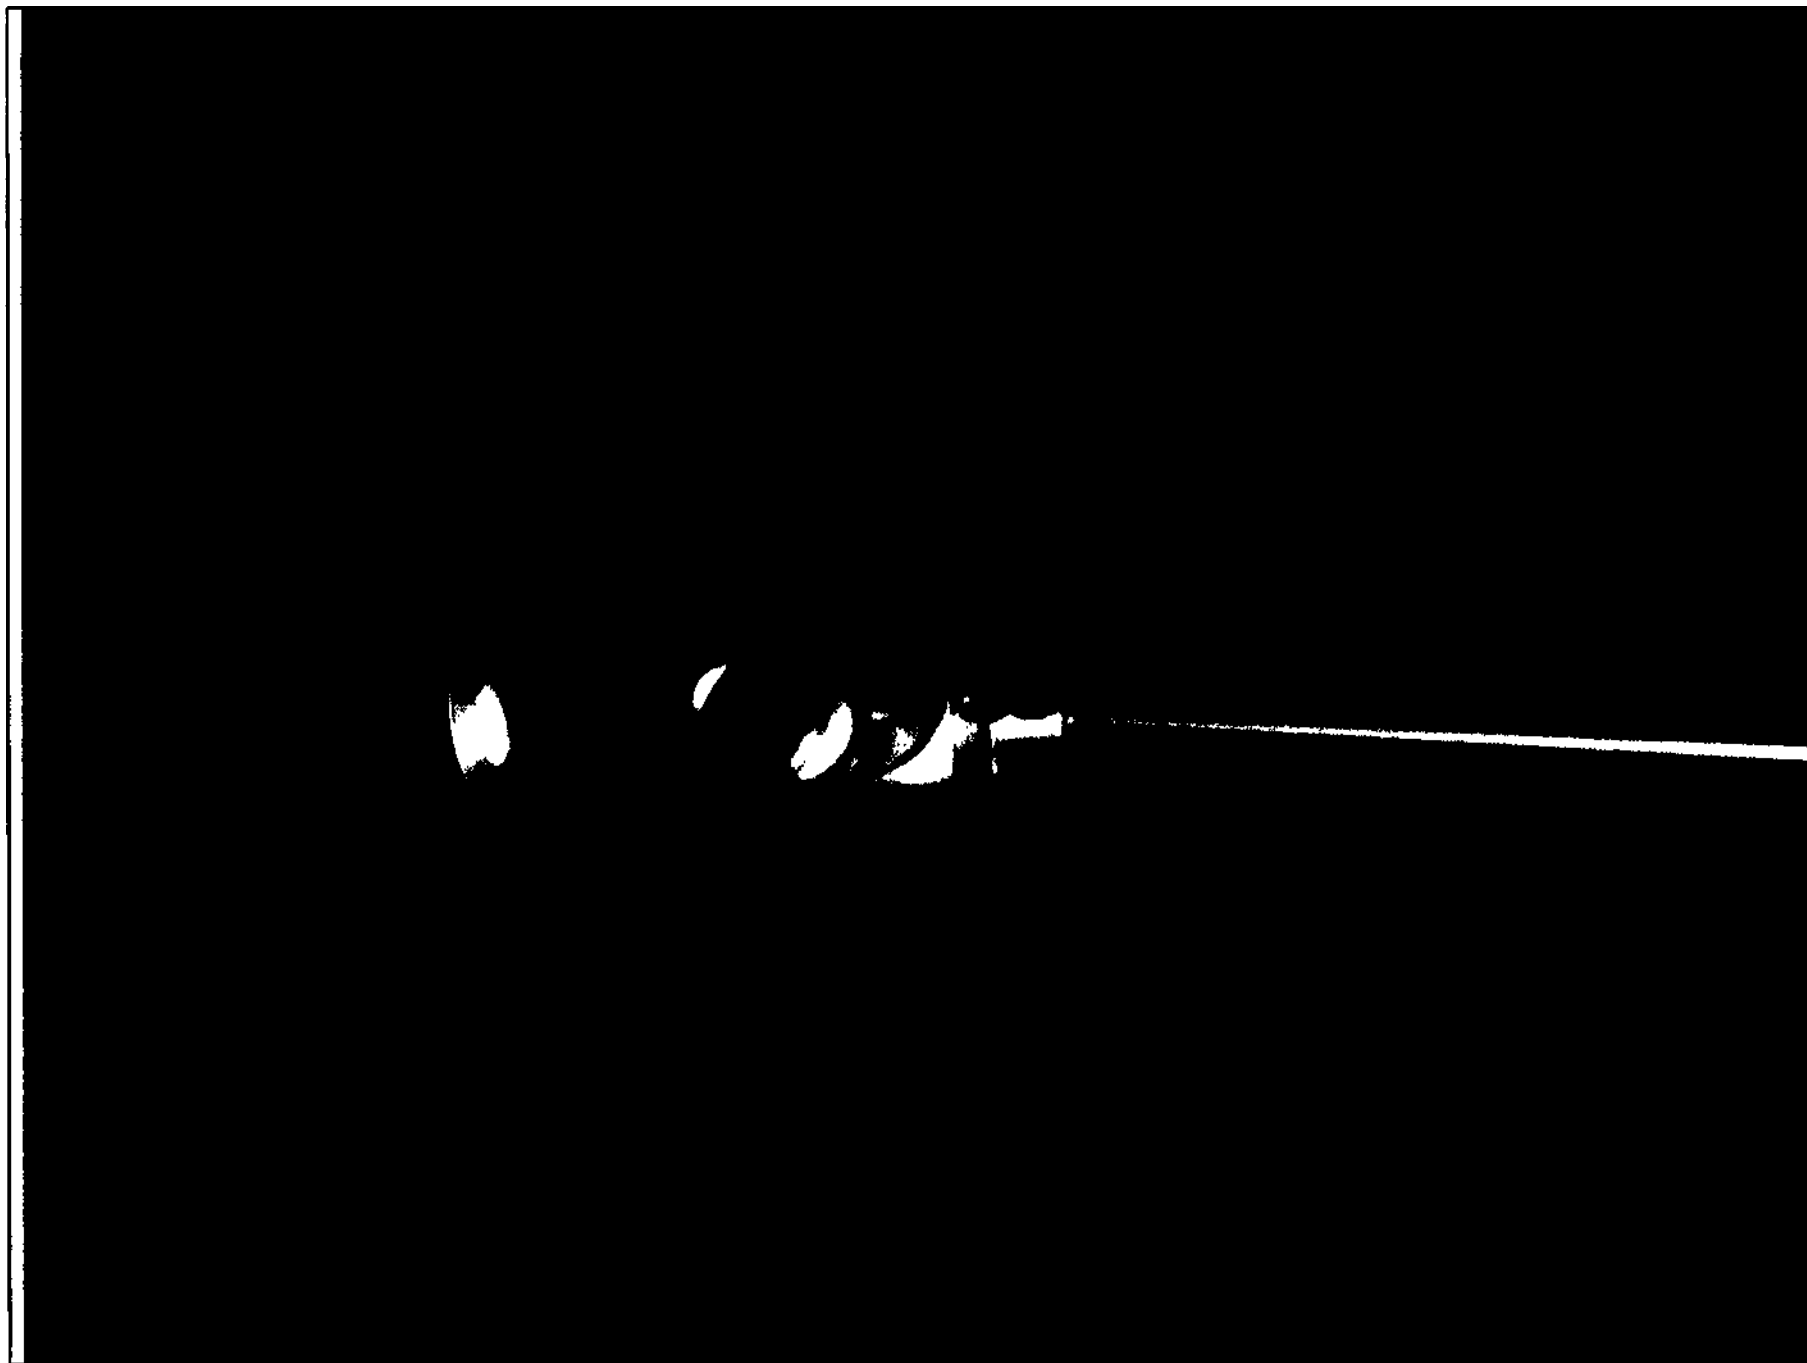


Рис. 34. Гистероскоп

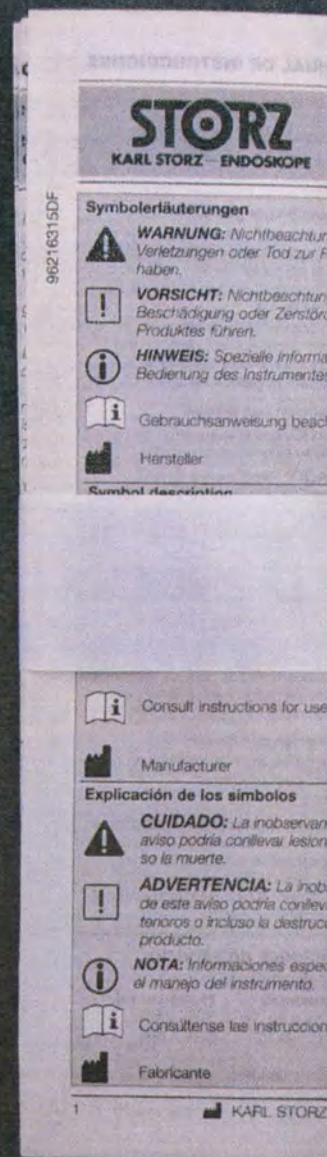


Рис. 35. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.



Рис. 36. Гильза защитная, для эндоскопов длиной 30 см.

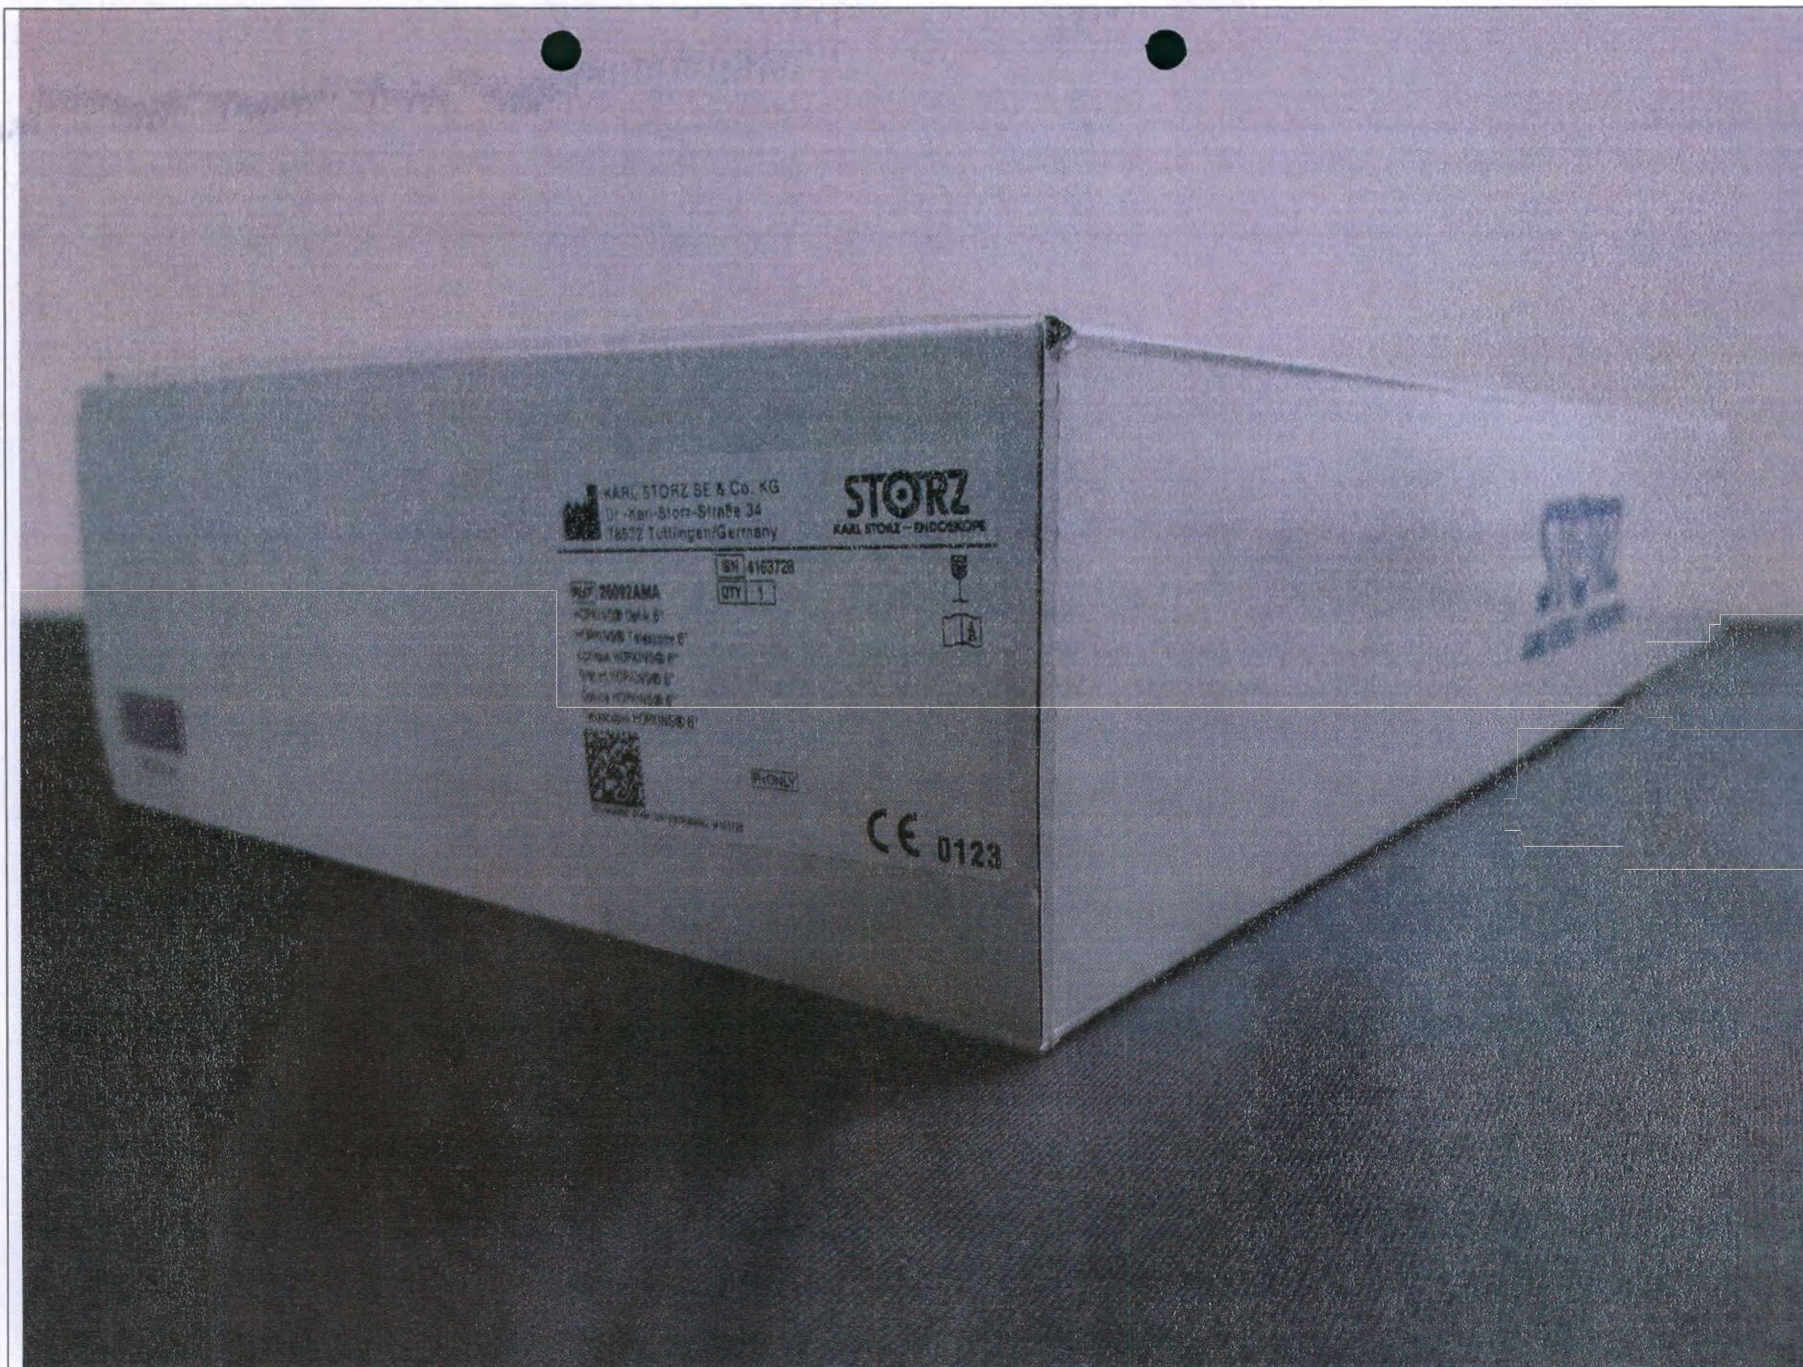


Рис. 37. Гистероскоп жесткий HOPKINS с параллельным окуляром, с инструментальным каналом, типоразмер: направление наблюдения 6°, диаметр 24 Шр, длина 20 см. Упаковка.

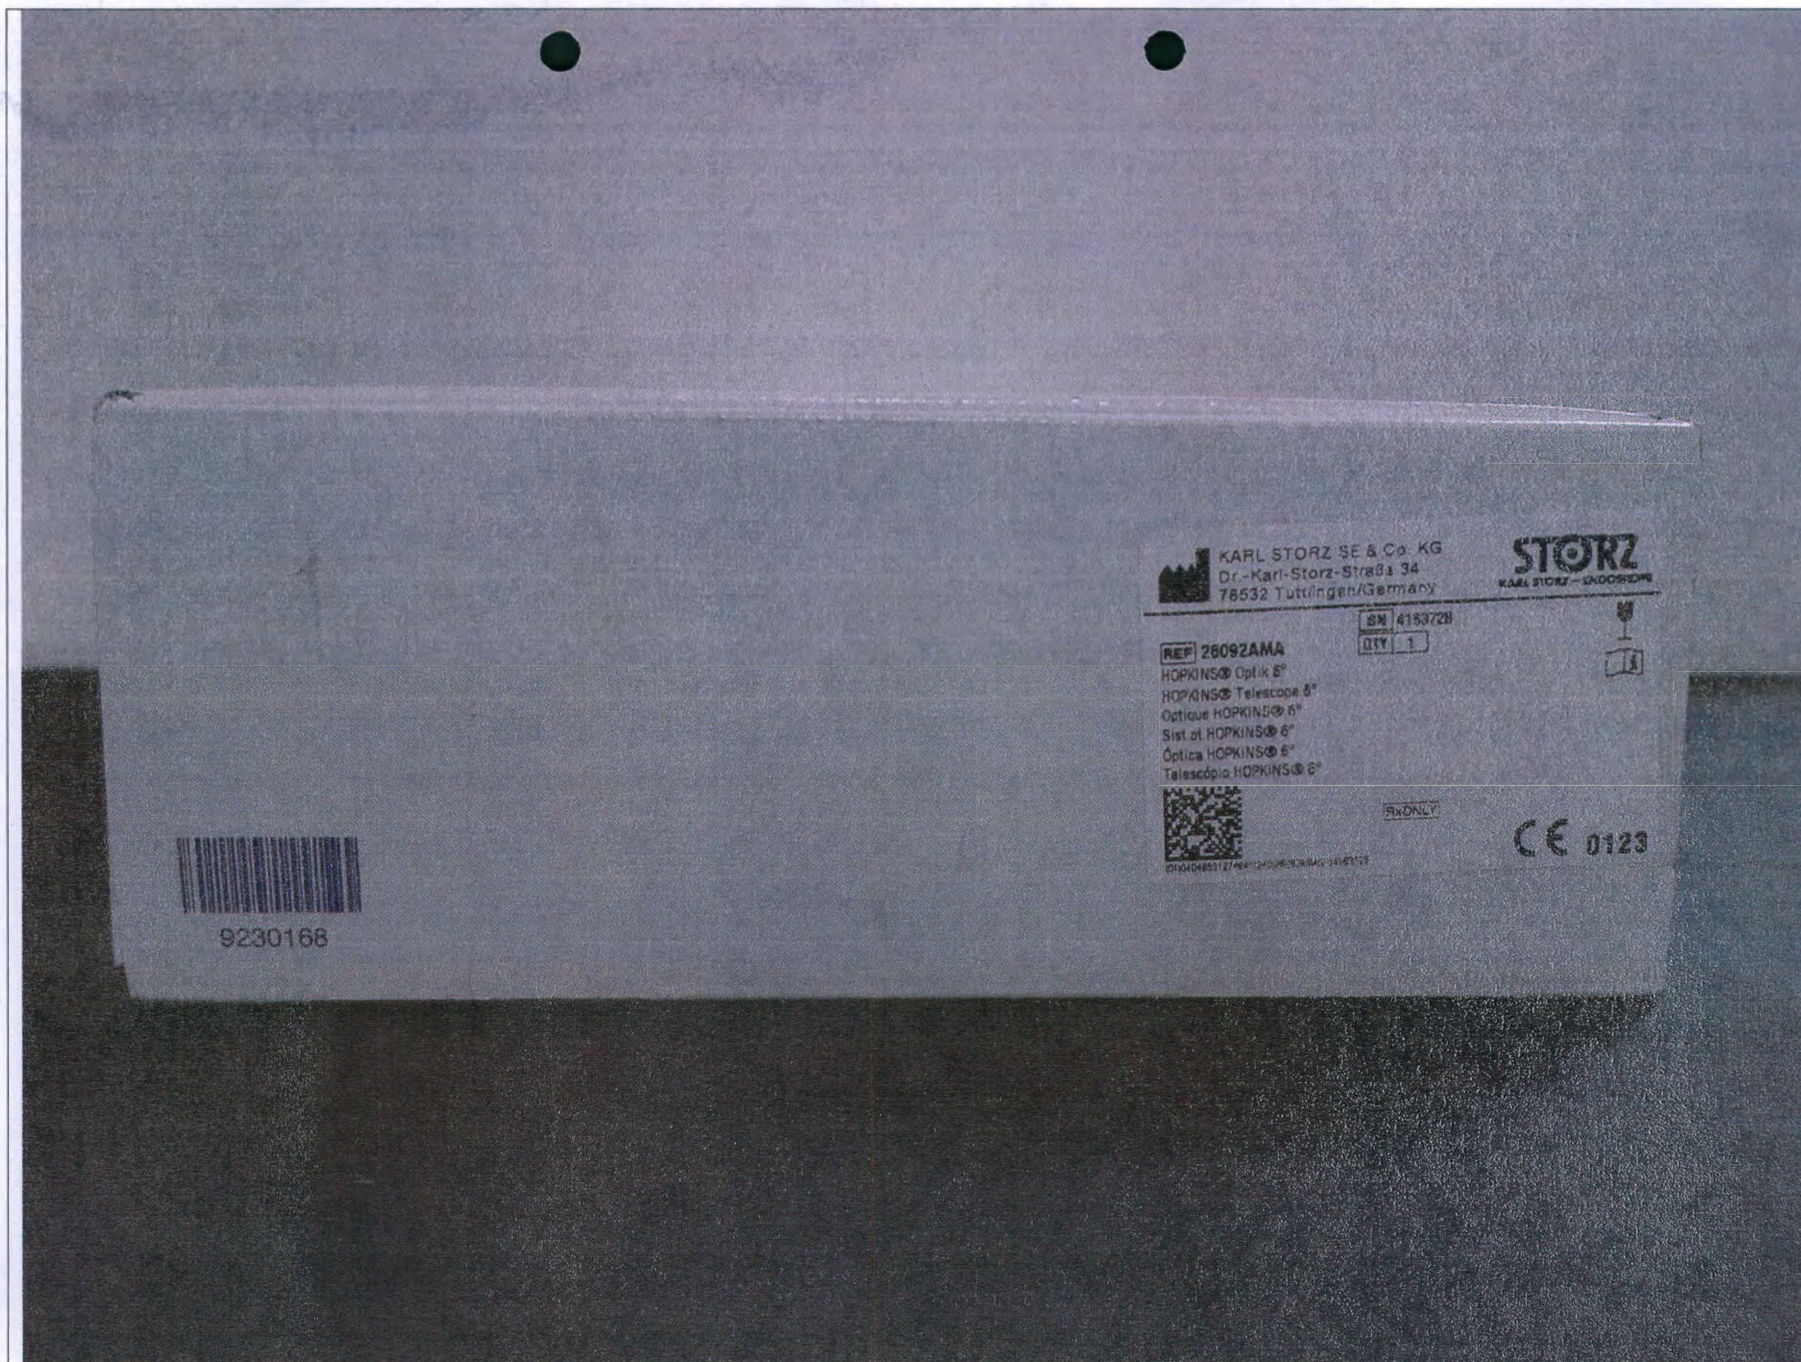


Рис. 38. Гистероскоп жесткий HOPKINS с параллельным окуляром, с инструментальным каналом, типоразмер: направление наблюдения 6°, диаметр 24 Шр, длина 20 см. Маркировка на упаковке.

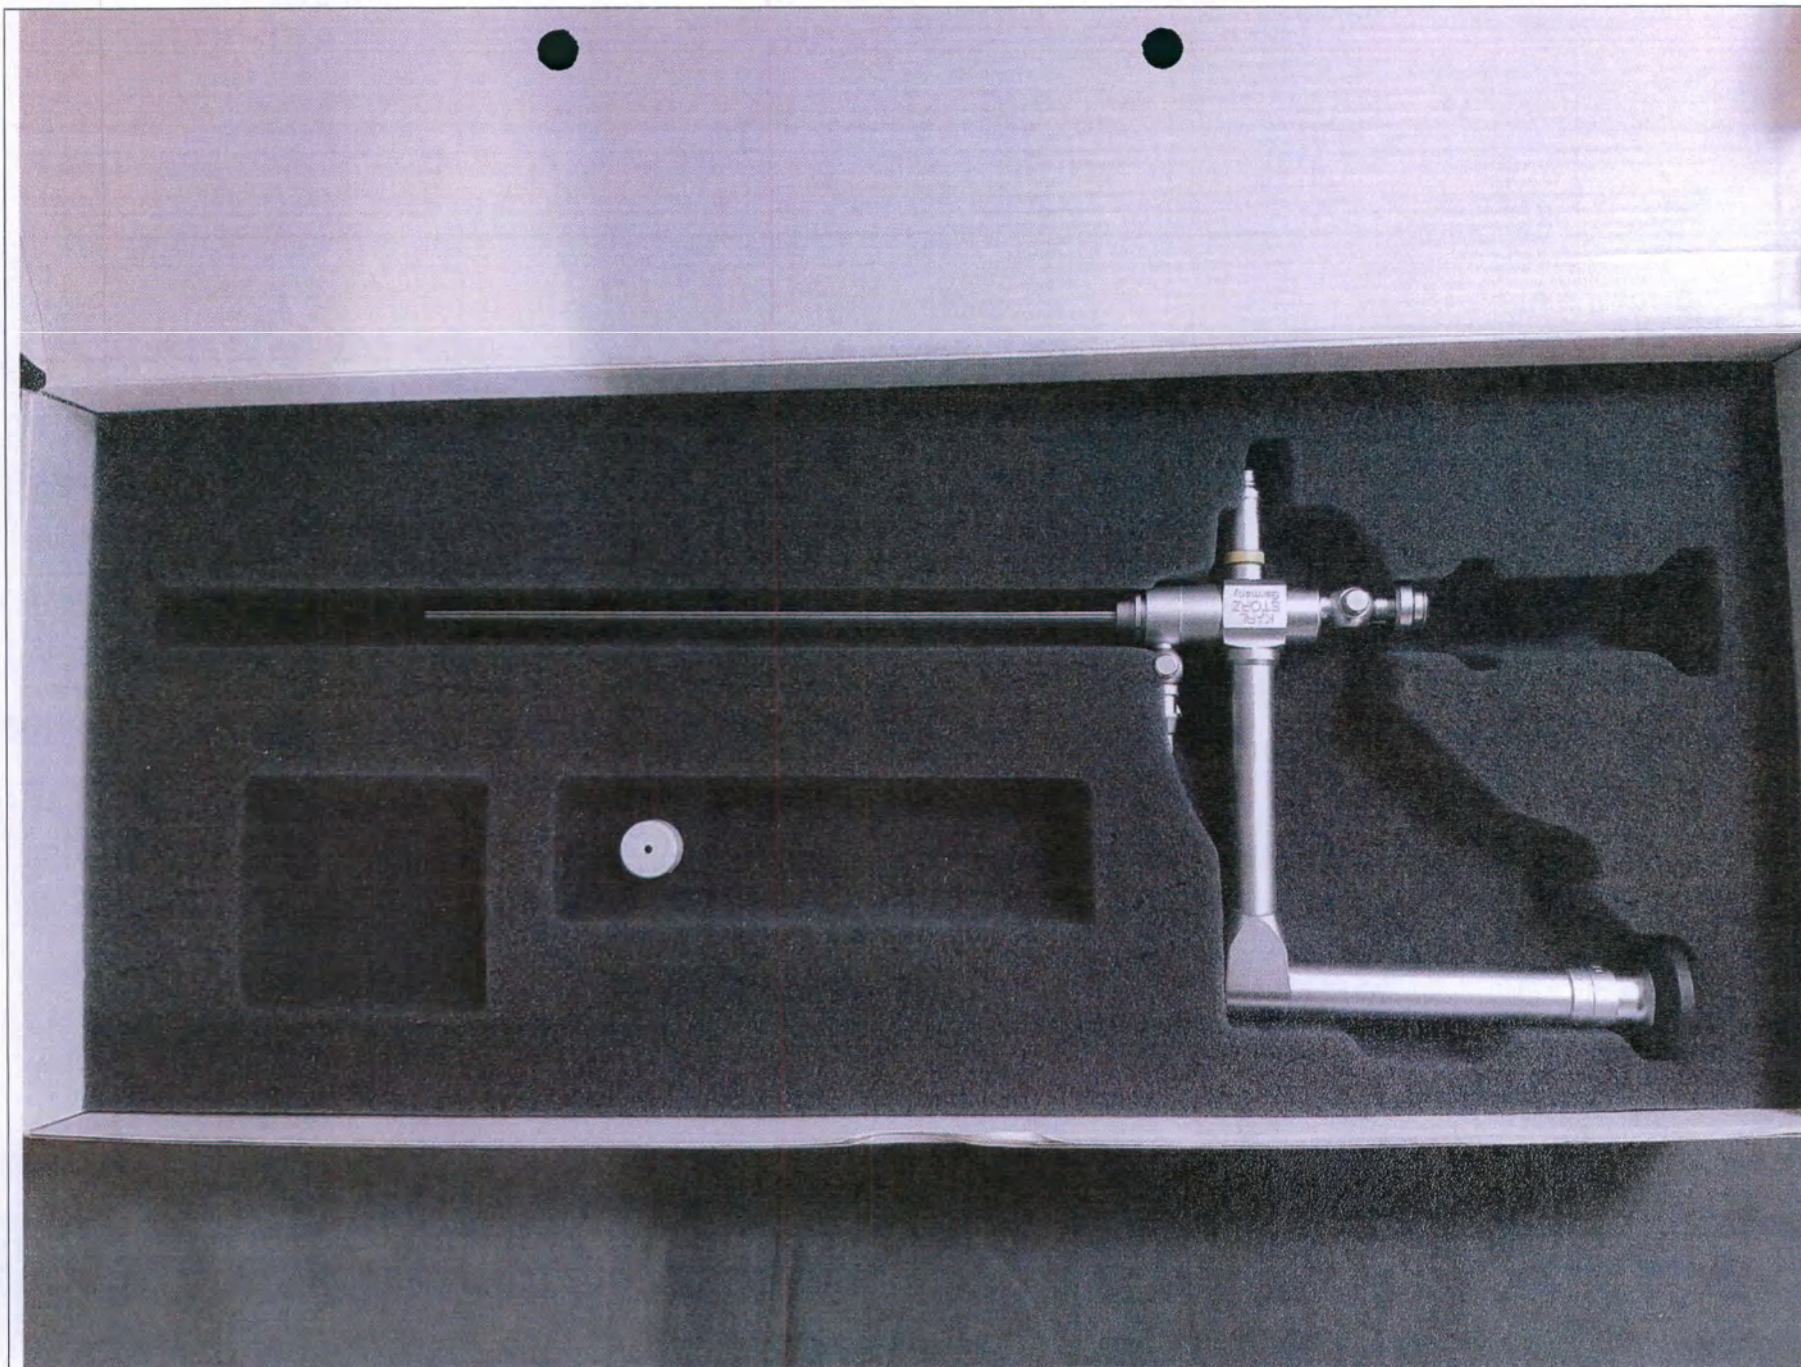


Рис. 39. Гистероскоп жесткий HOPKINS с параллельным окуляром, с инструментальным каналом, типоразмер: направление наблюдения 6°, диаметр 24 Шр, длина 20 см.

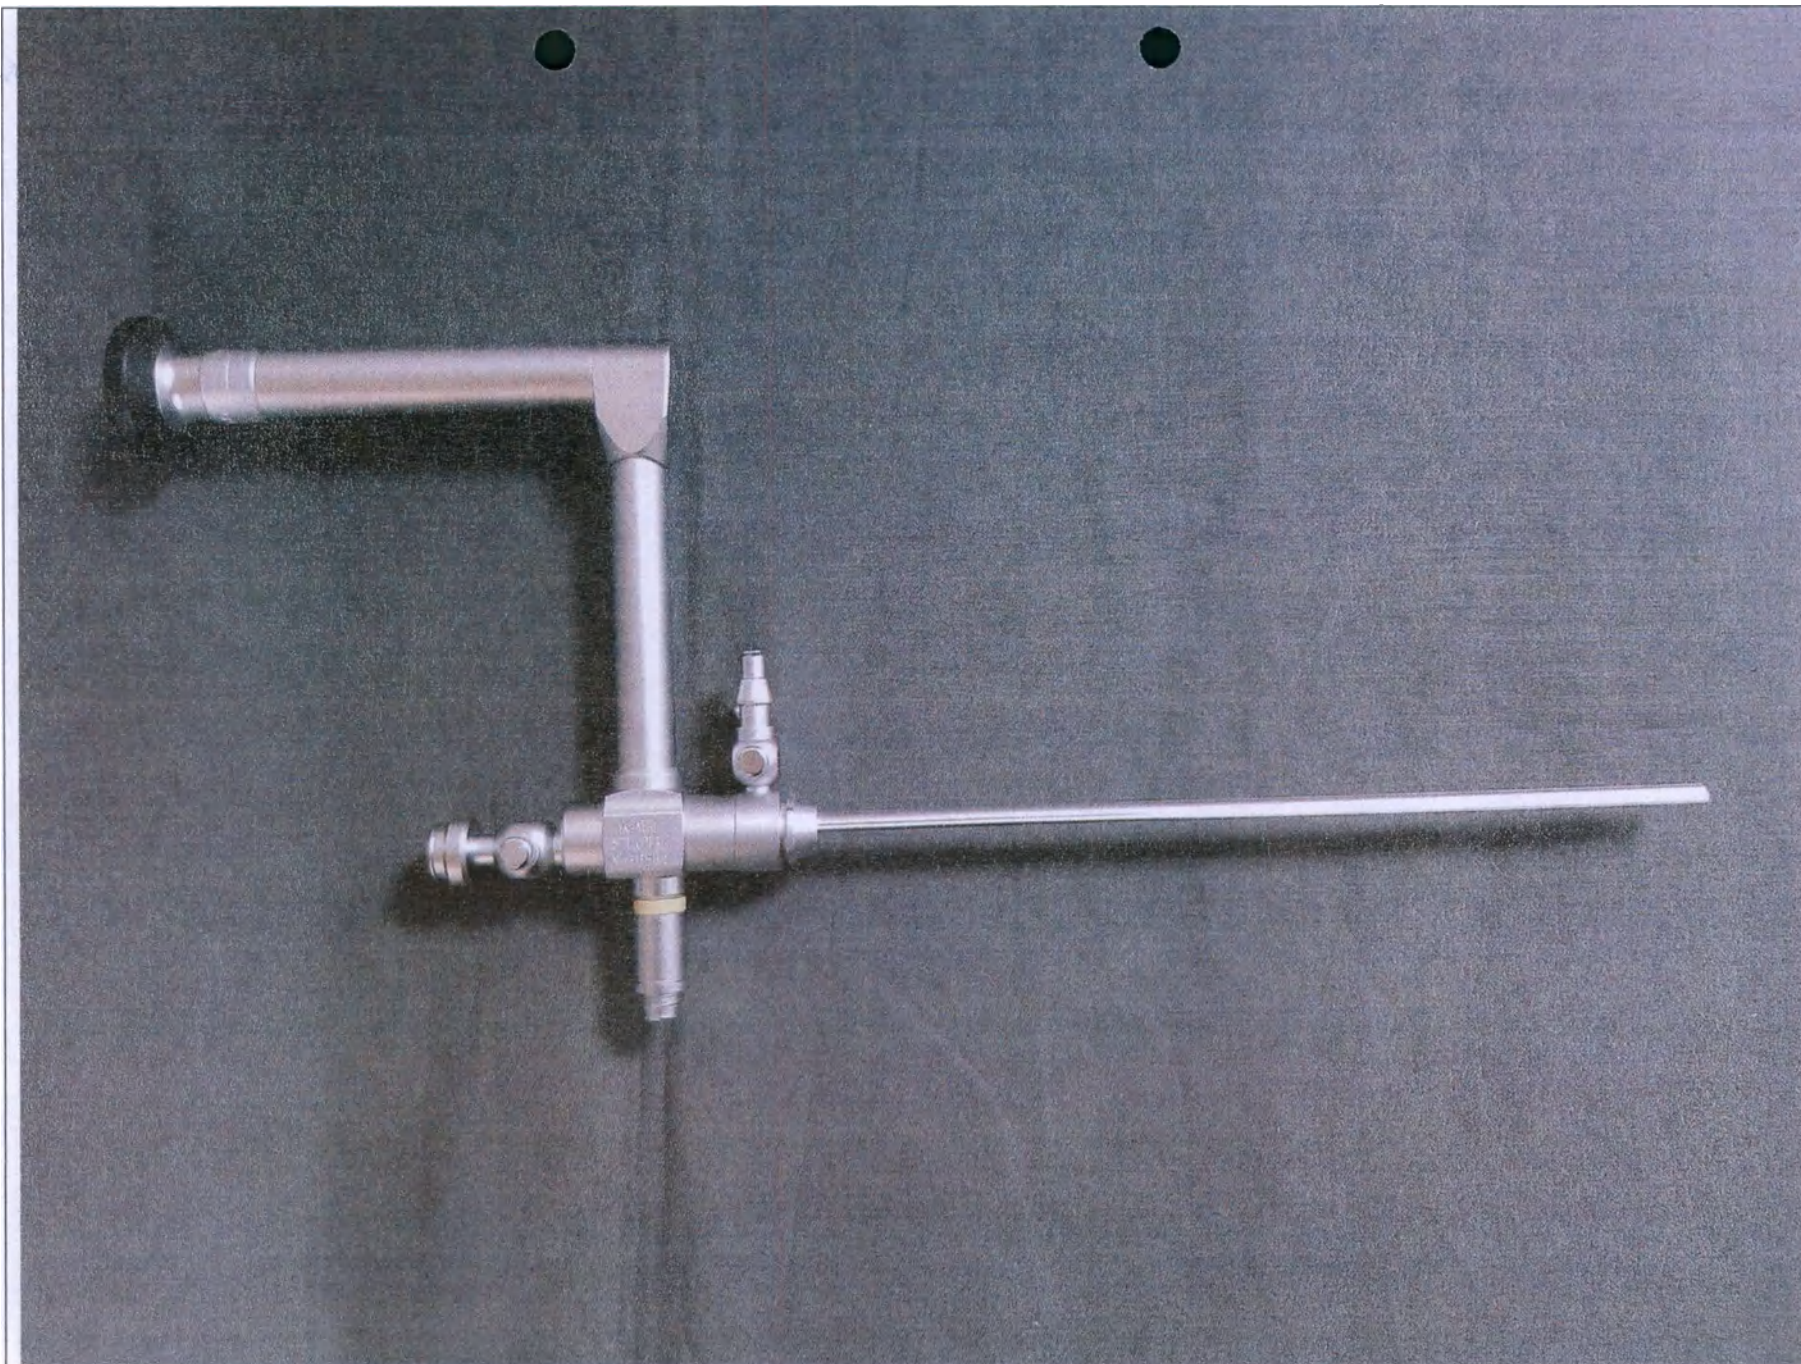


Рис. 40. Гистероскоп

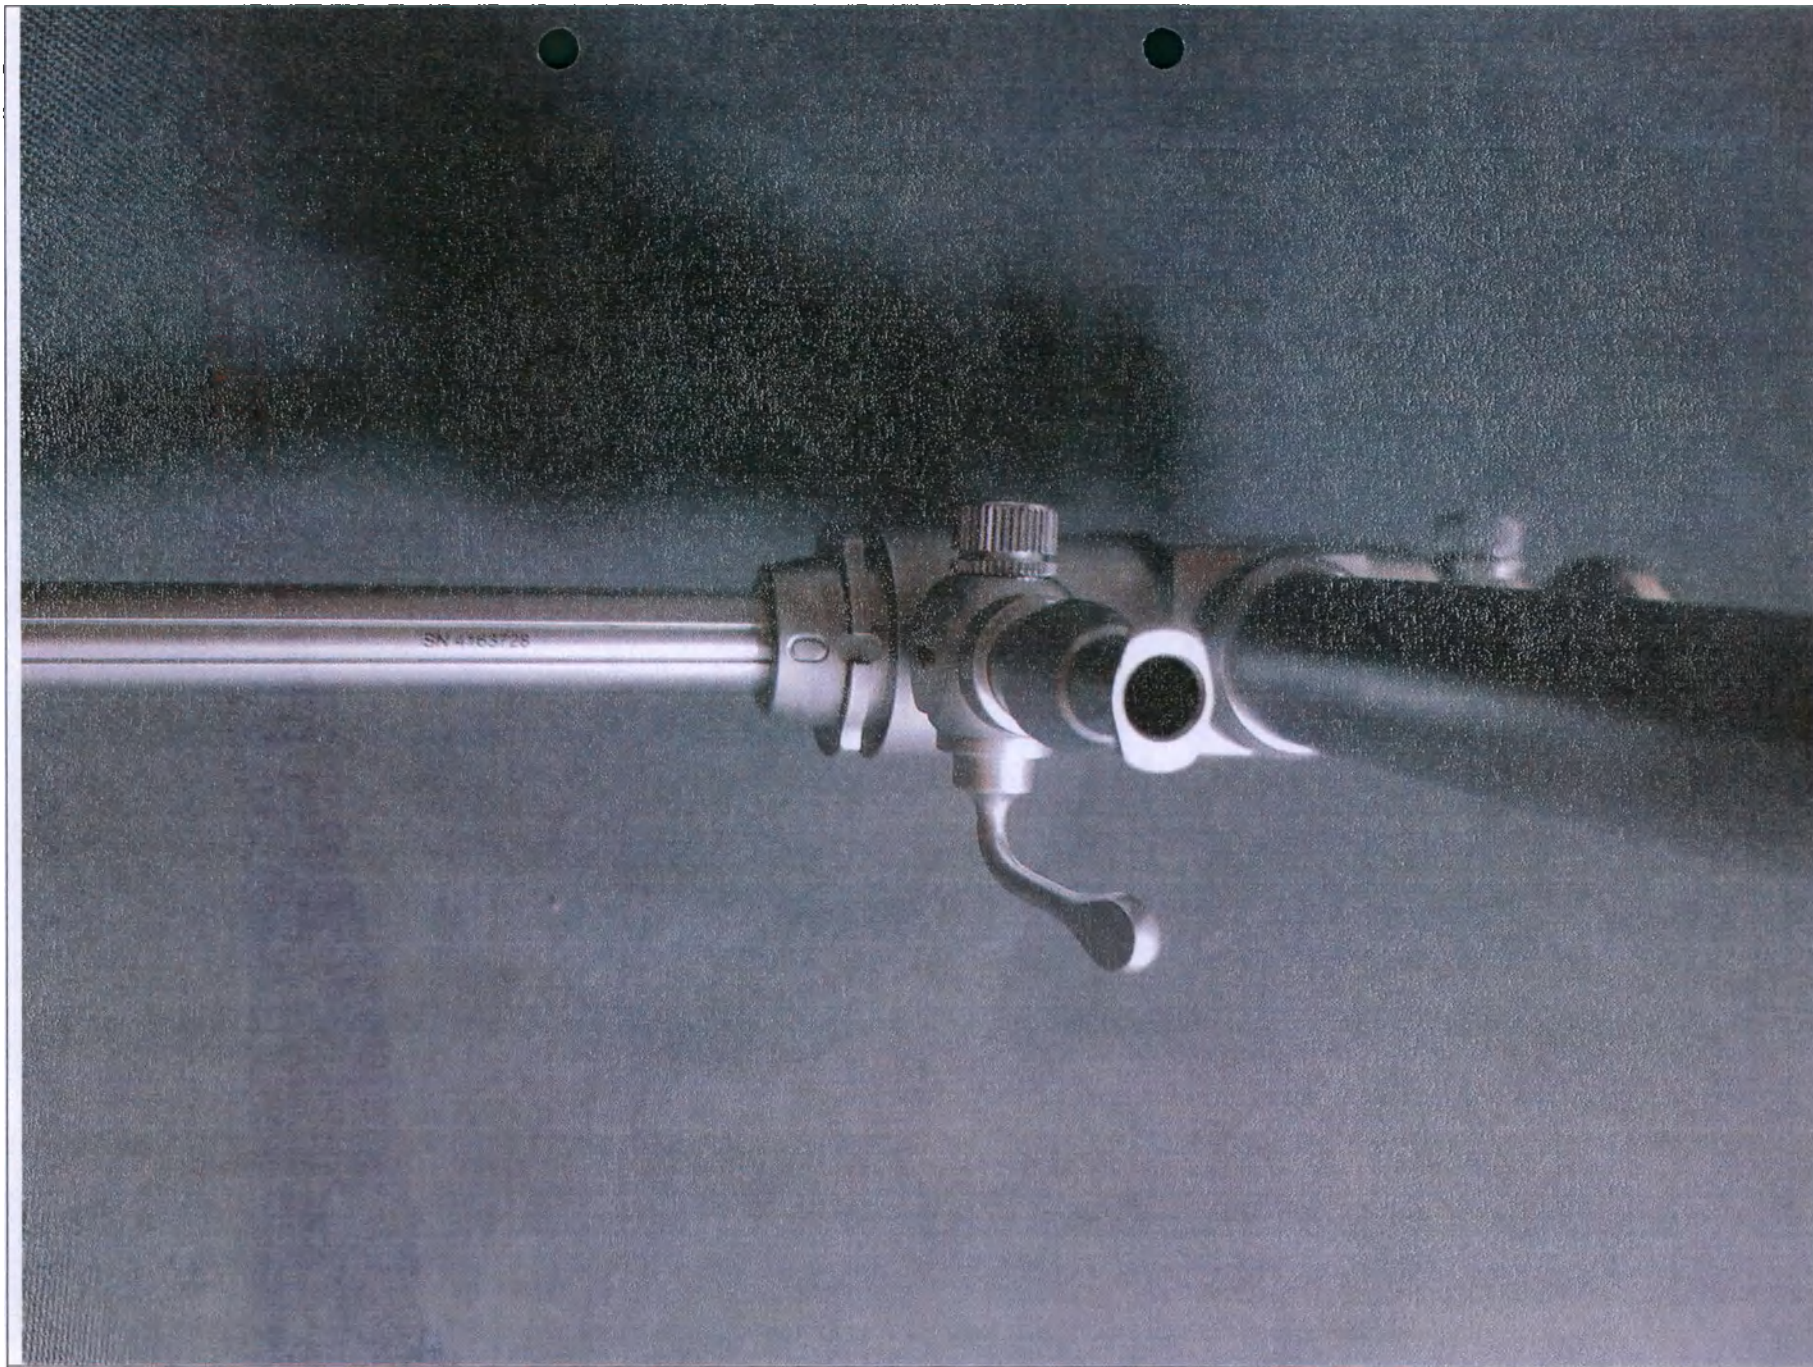


Рис. 41. Гистероскоп

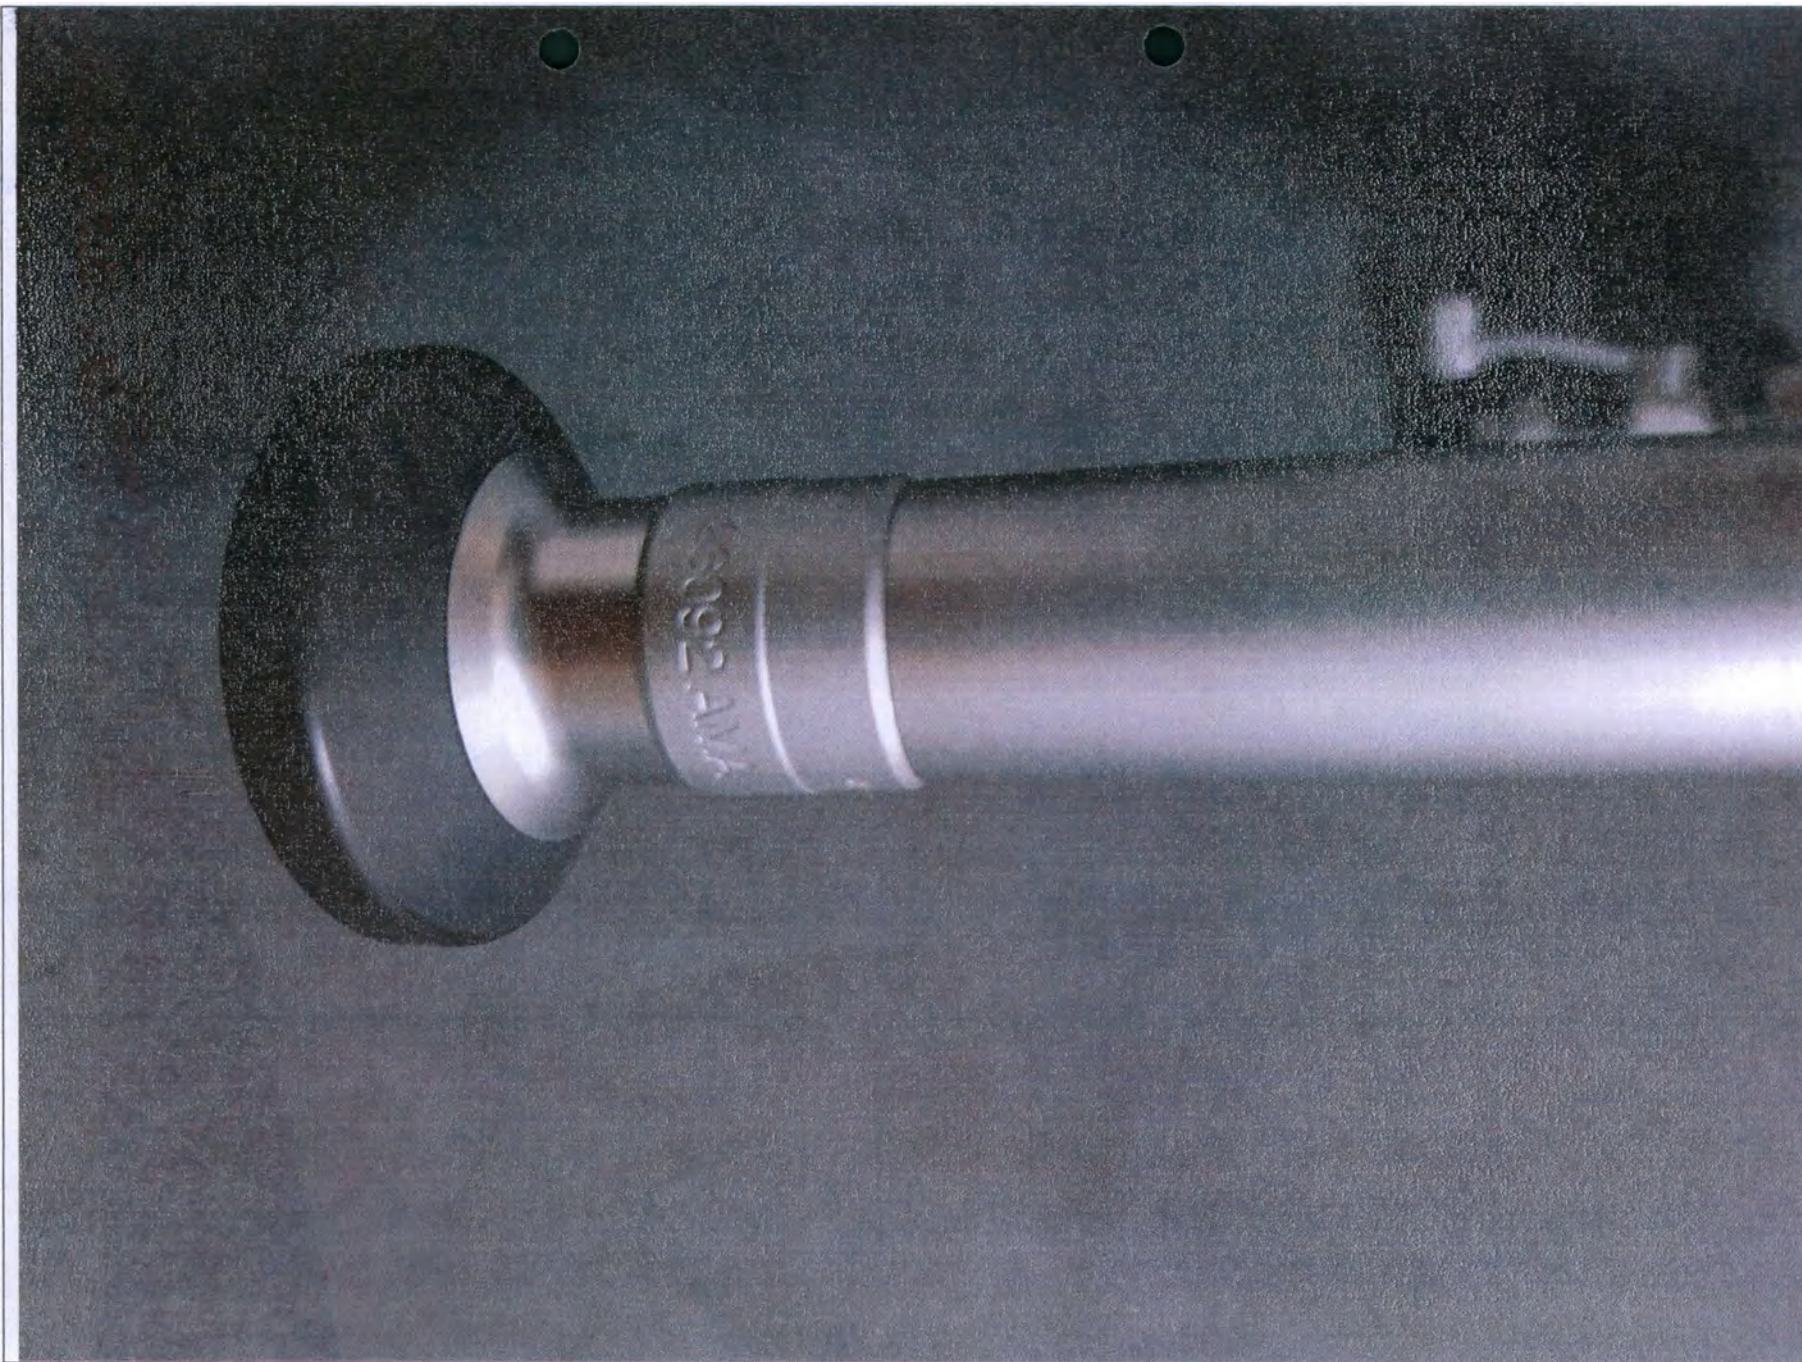


Рис. 42. Гистероскоп

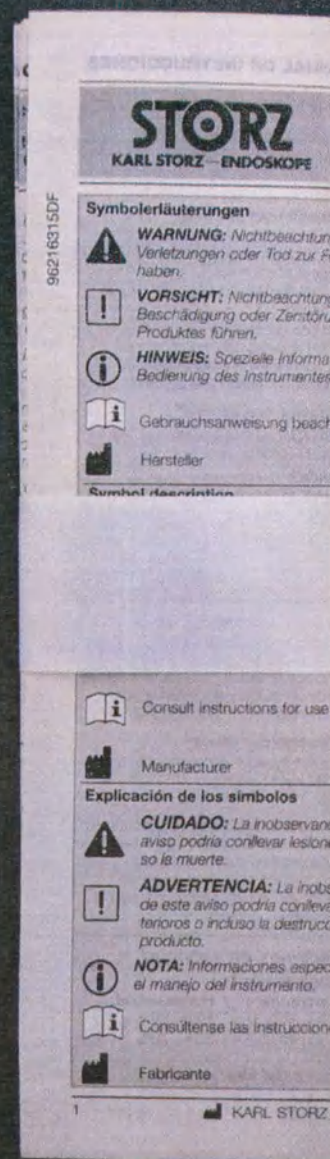


Рис. 43. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.

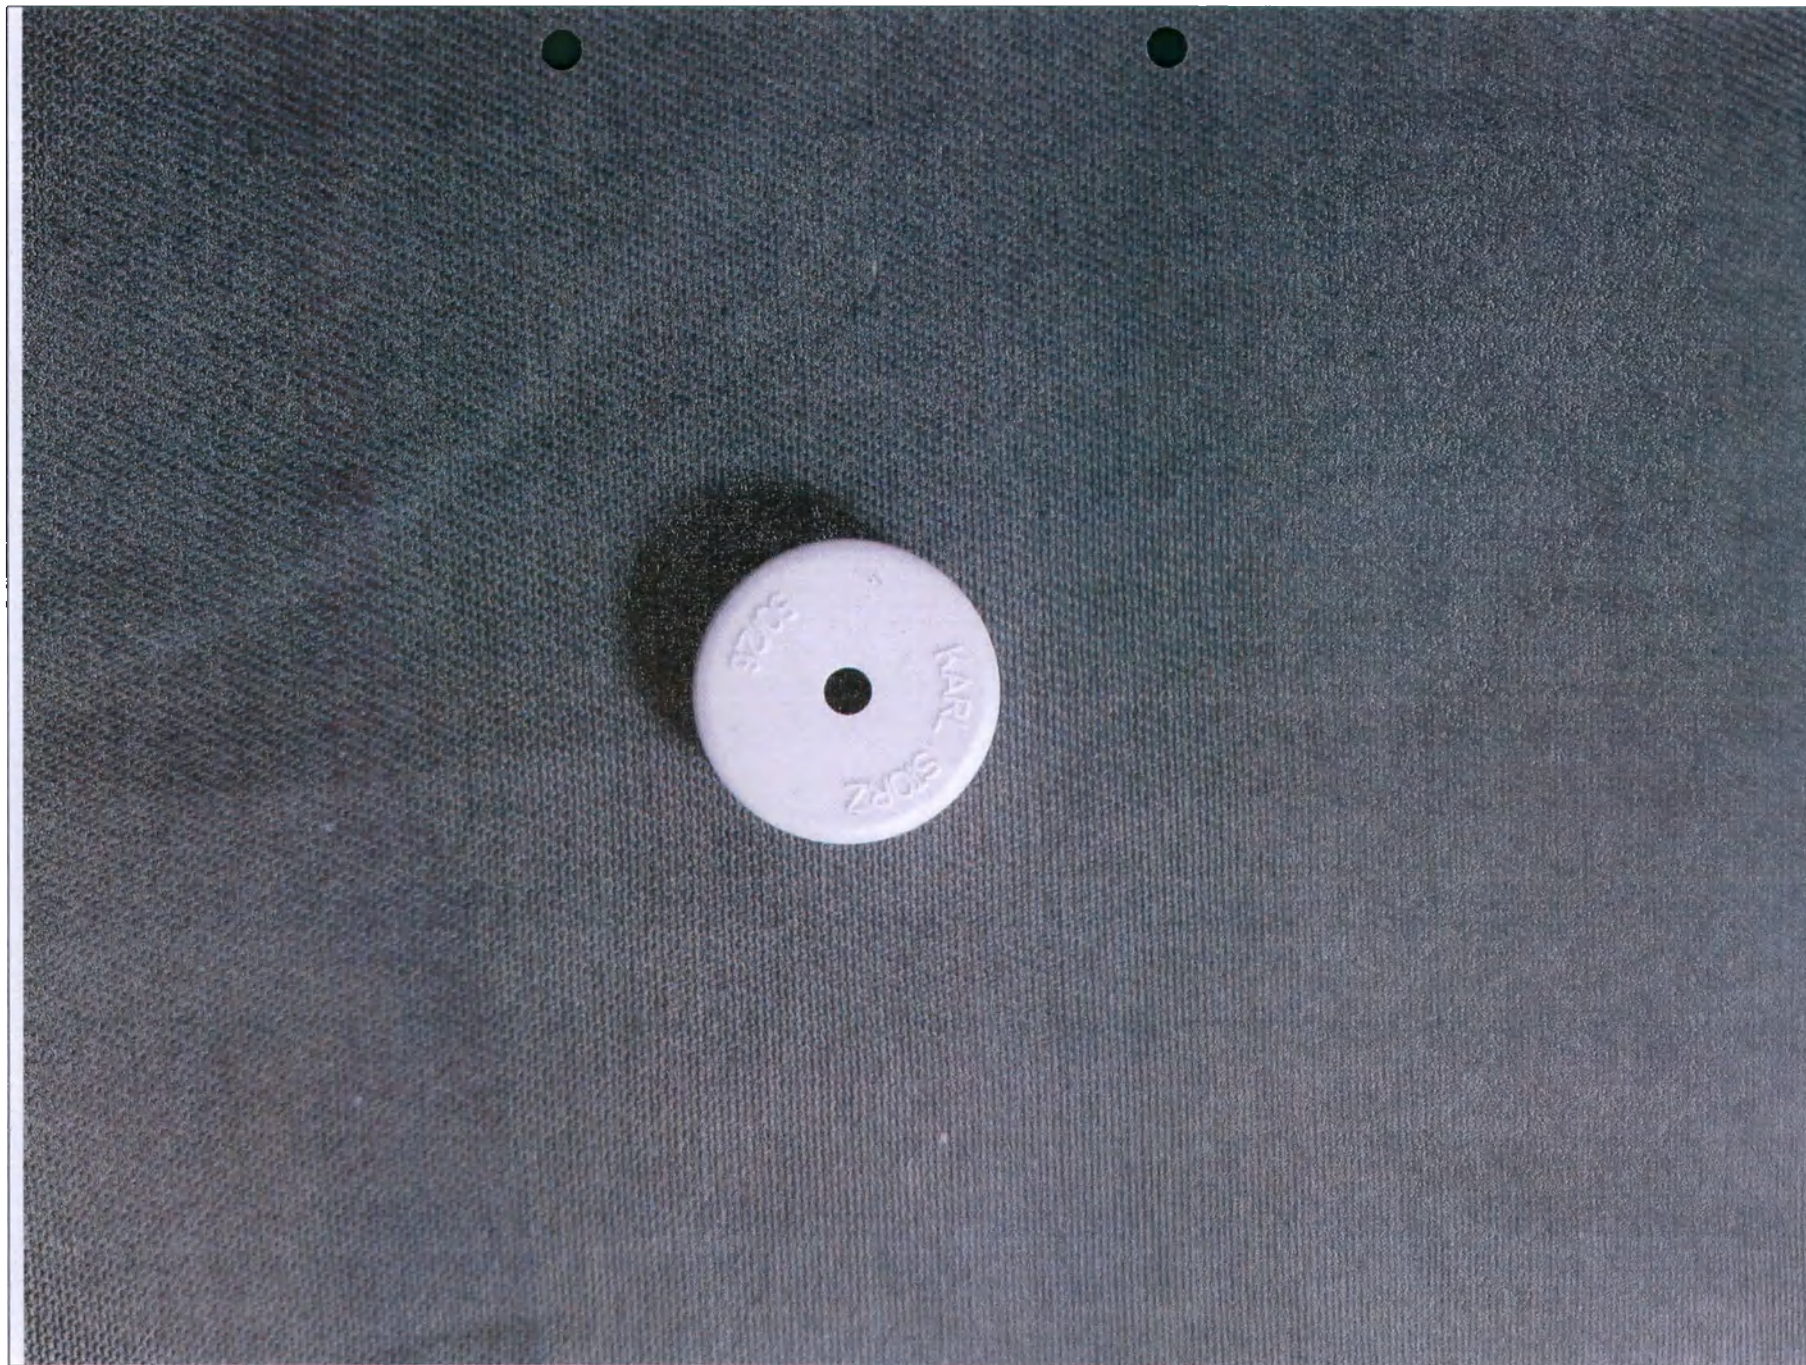


Рис. 44. Колпачок уплотнительный (50/2,6)

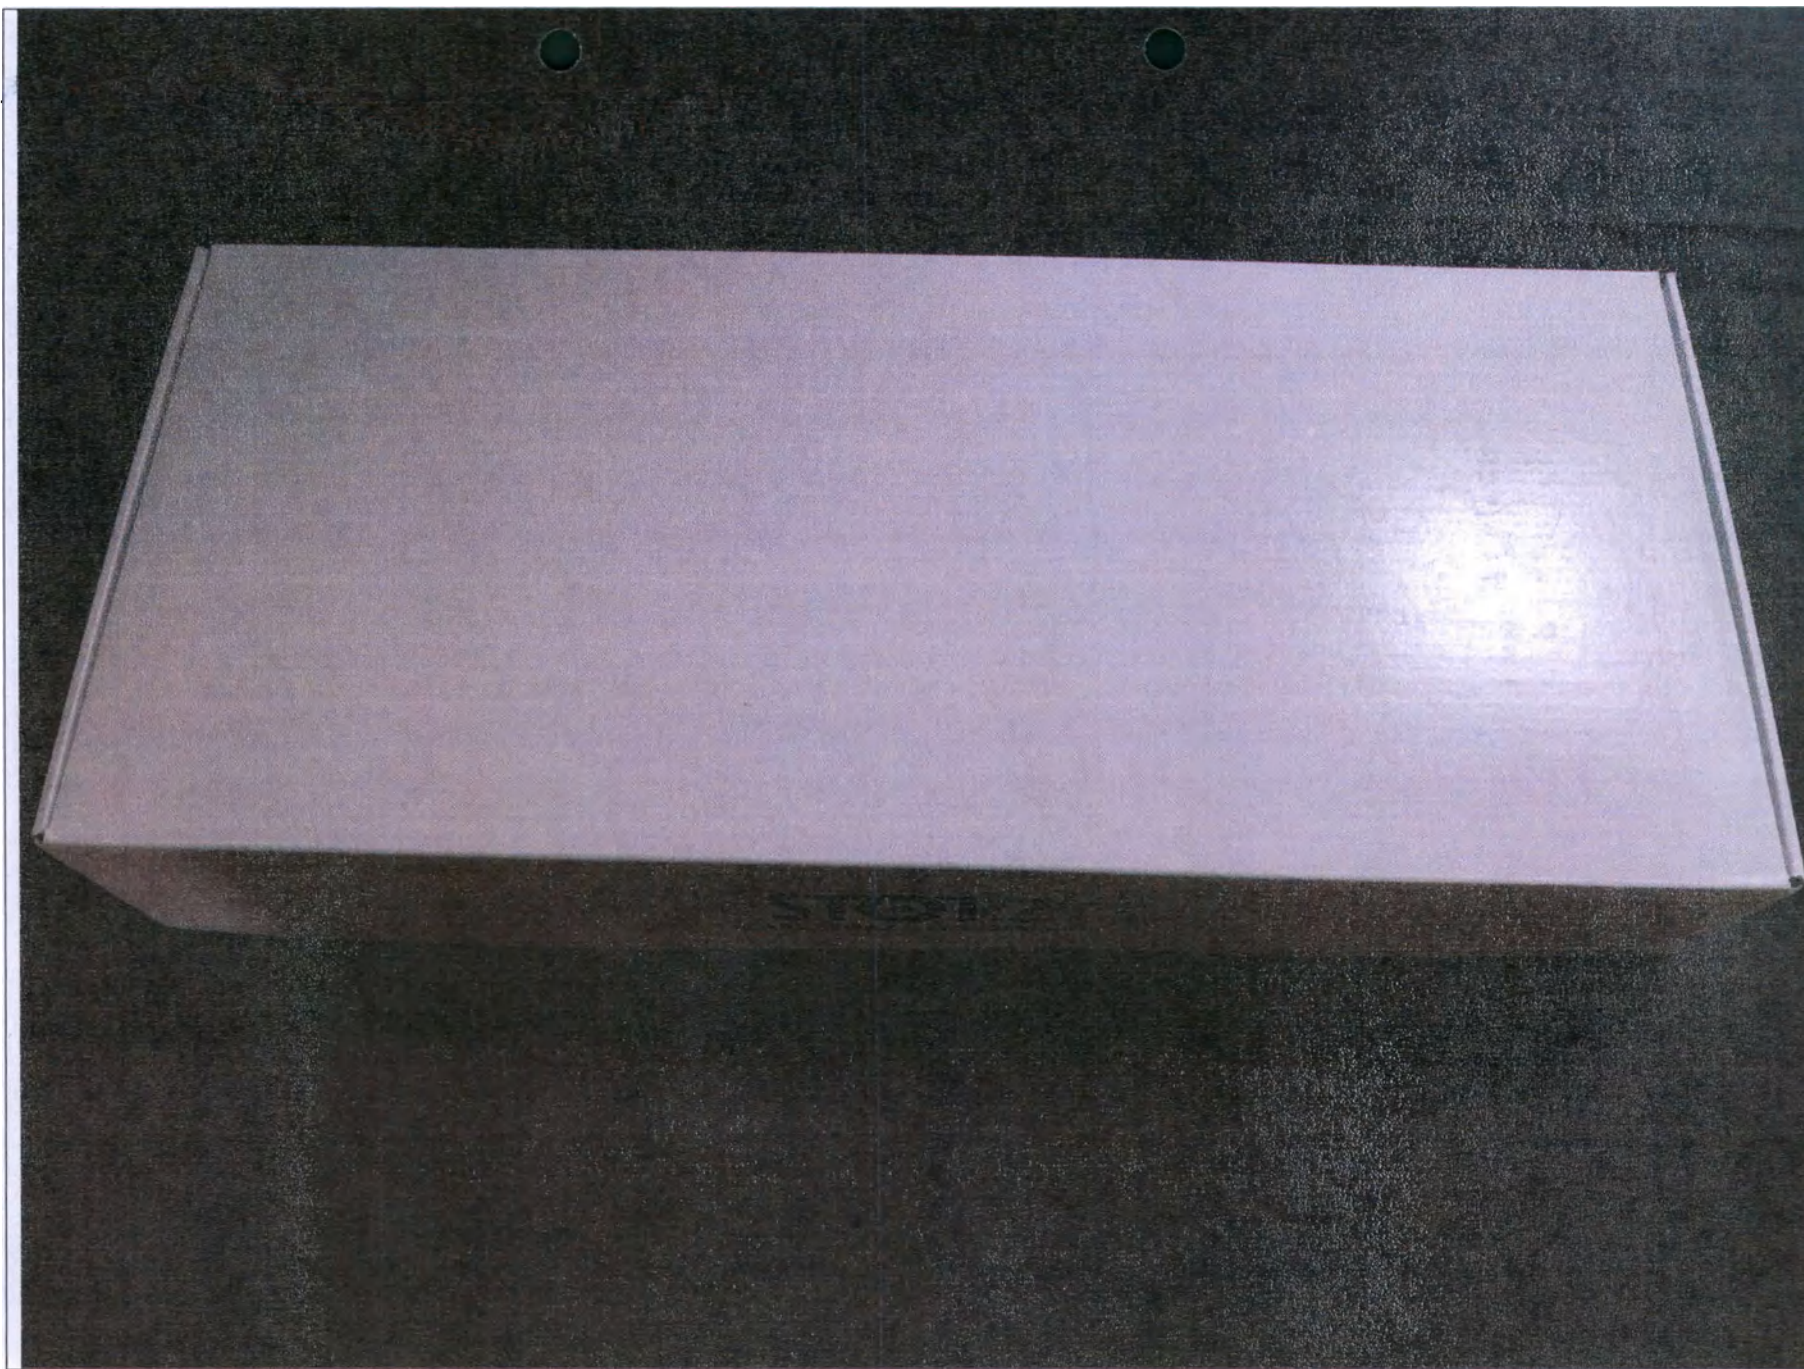


Рис. 45. Гистероскоп жесткий В.І.О.Н. по ВЕТТОСНІ, направление наблюдения 30°, диаметр 2 мм, длина 21 см. Упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSCOPE

SN 4160877

REF 26252BC

QTY 1

B.I.O.H.® Kompakthysteroskop, alleine
BETTOCCHI® B.I.O.H.® Compact Hysteroscope
Hystéroscope compact B.I.O.H.™, seul
Isteroscopio compatto B.I.O.H.®
Histeroscopio compacto B.I.O.H.®, solo
Histeroscópio compacto B.I.O.H.®, único



RxONLY

01104048551 27027 1240126252BC(21)4160877

CE 0123

Рис. 46. Гистероскоп жесткий В.І.О.Н. по ВЕТТОСНІ, направление наблюдения 30°, диаметр 2 мм, длина 21 см. Маркировка на упаковке.



Рис. 47. Гистероскоп жесткий В.І.О.Н. по ВЕТТОСНІ, направление наблюдения 30°, диаметр 2 мм, длина 21 см.

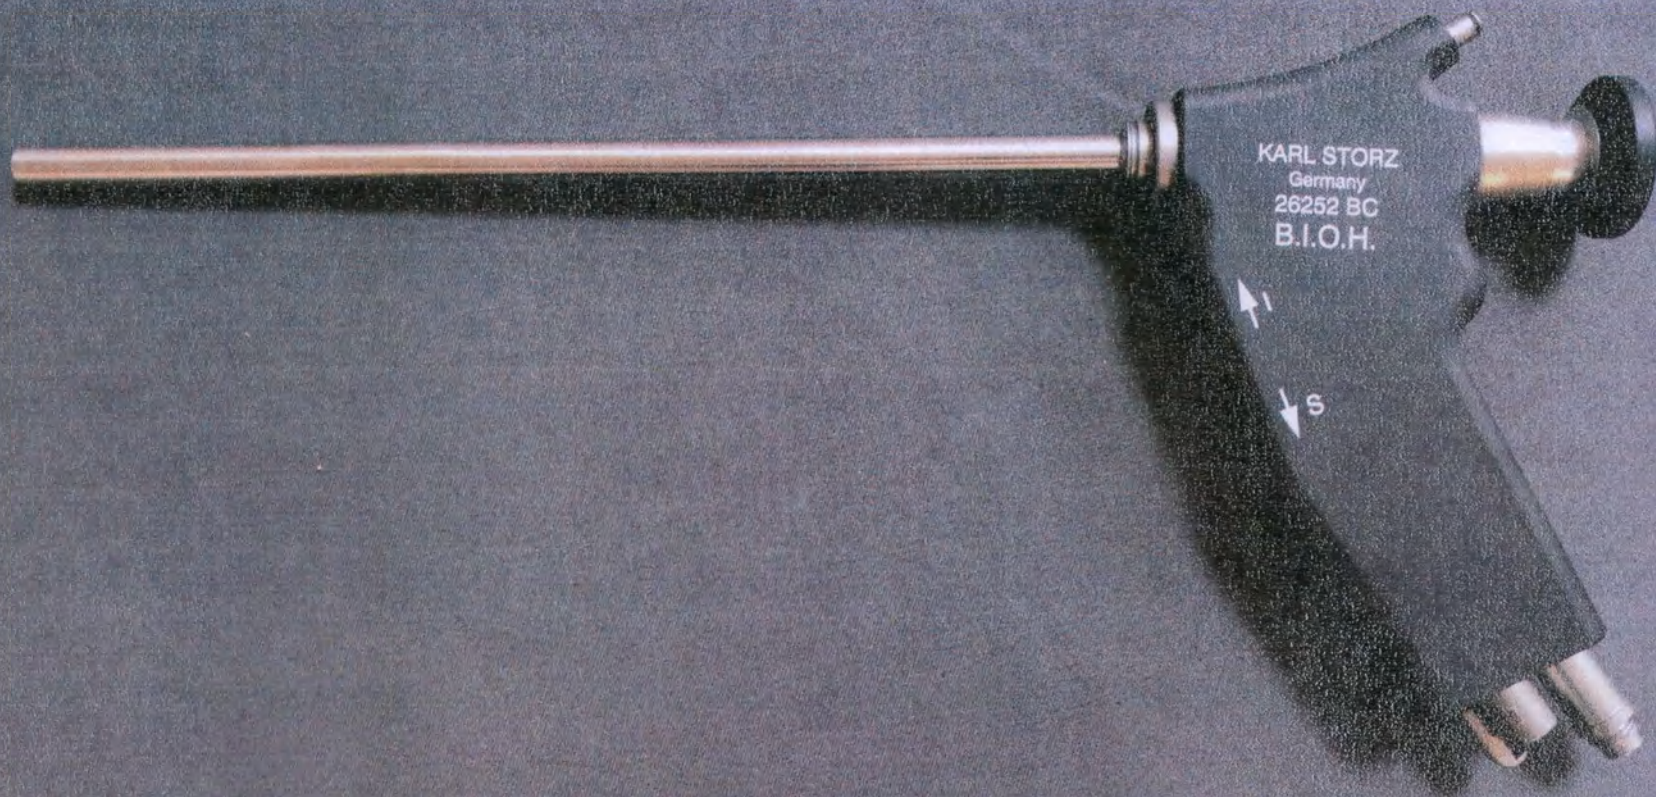


Рис. 48. Гистероскоп

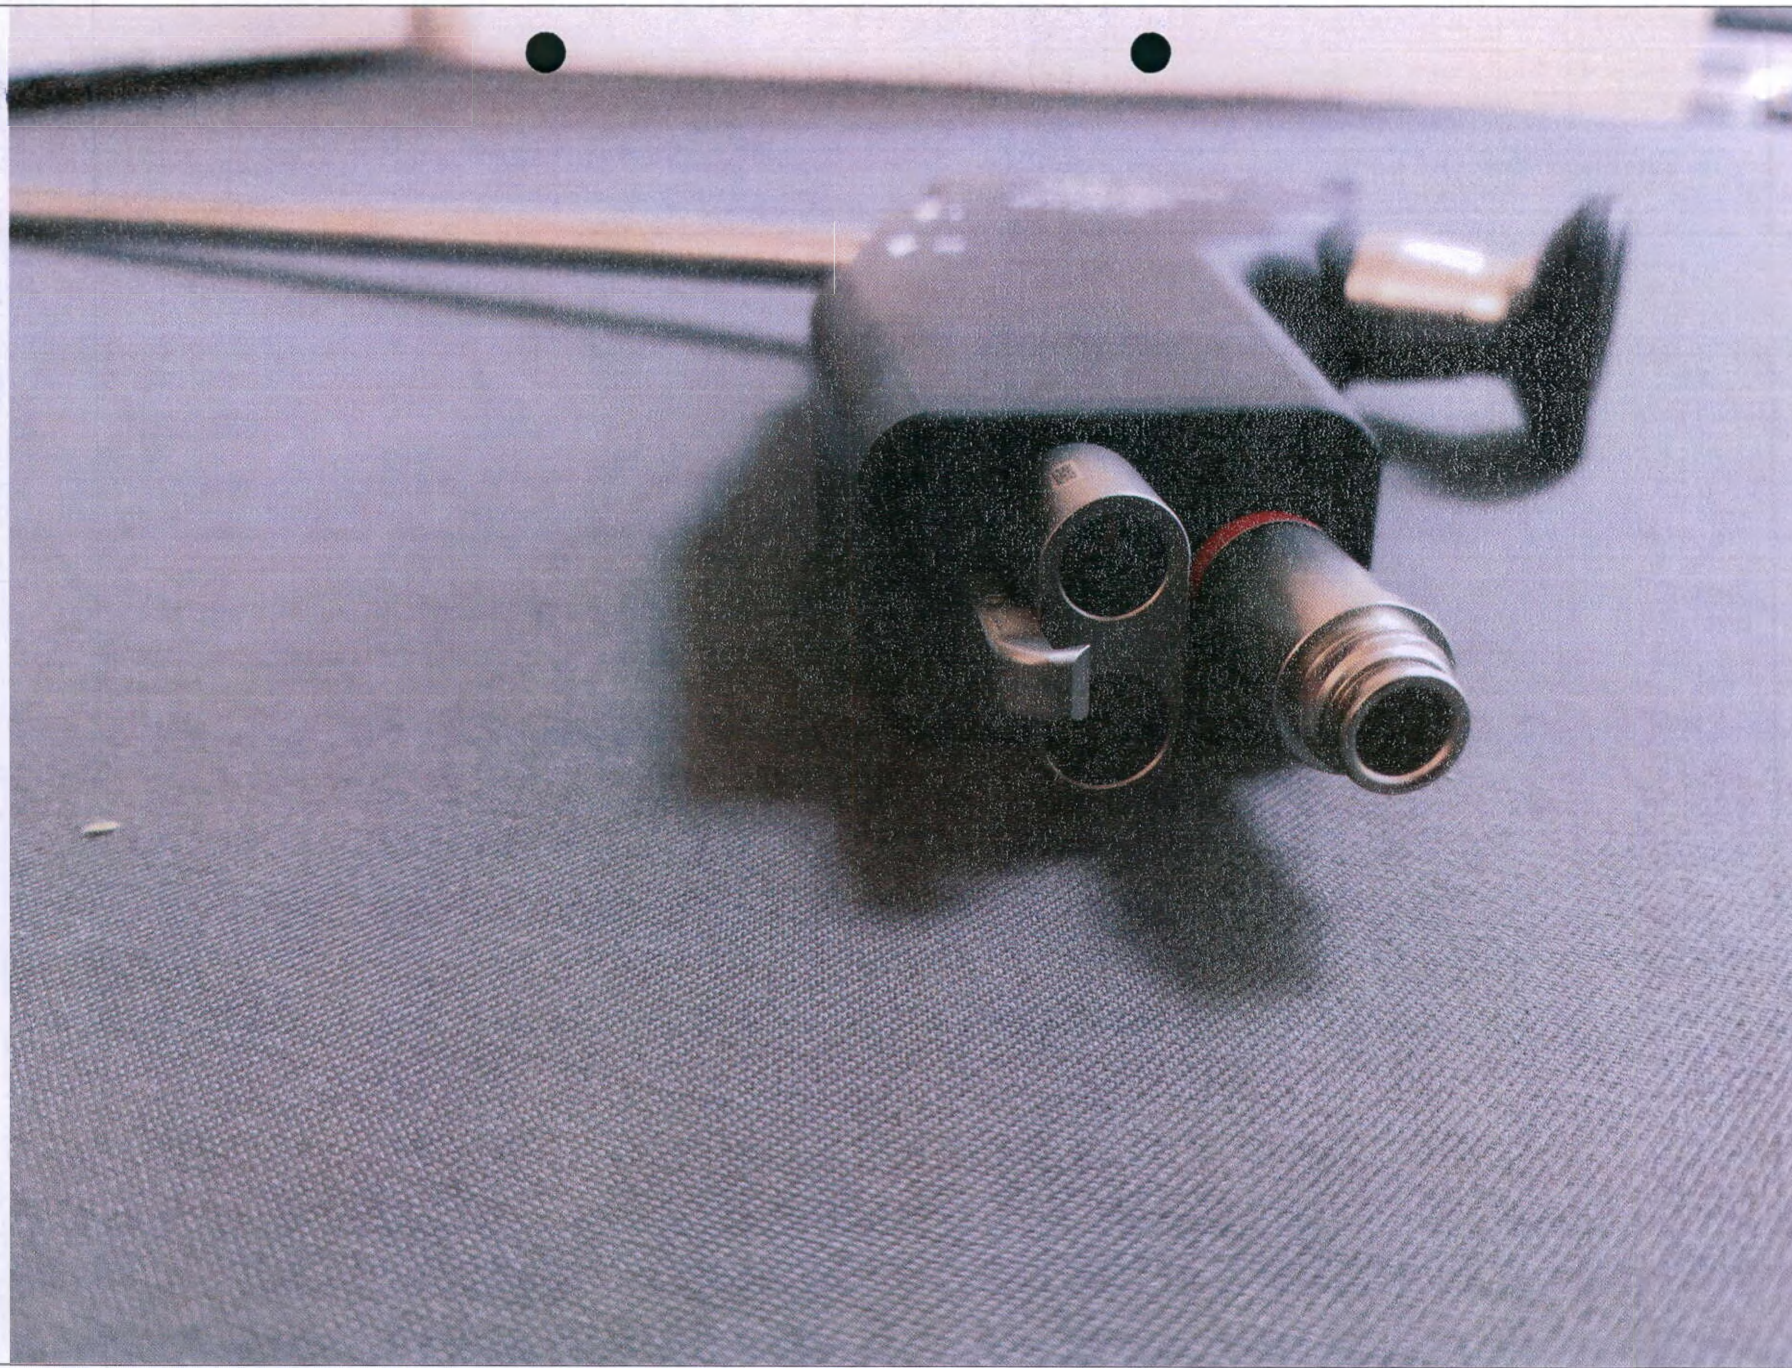


Рис. 49. Гистероскоп



Рис. 50. Гистероскоп

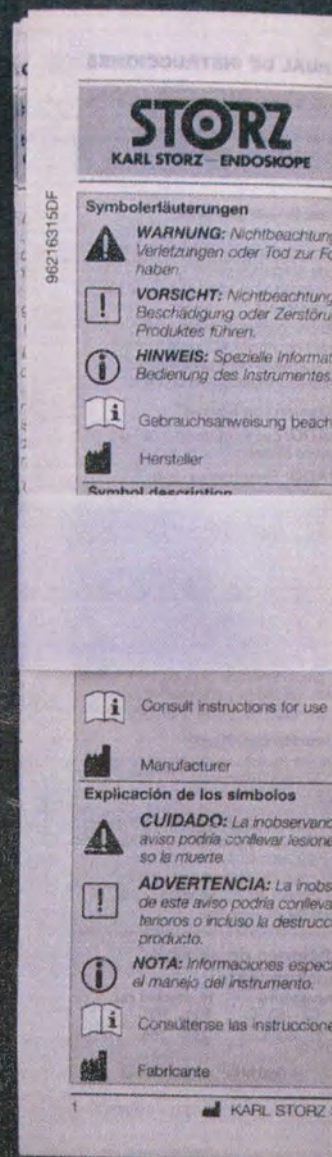


Рис. 51. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.

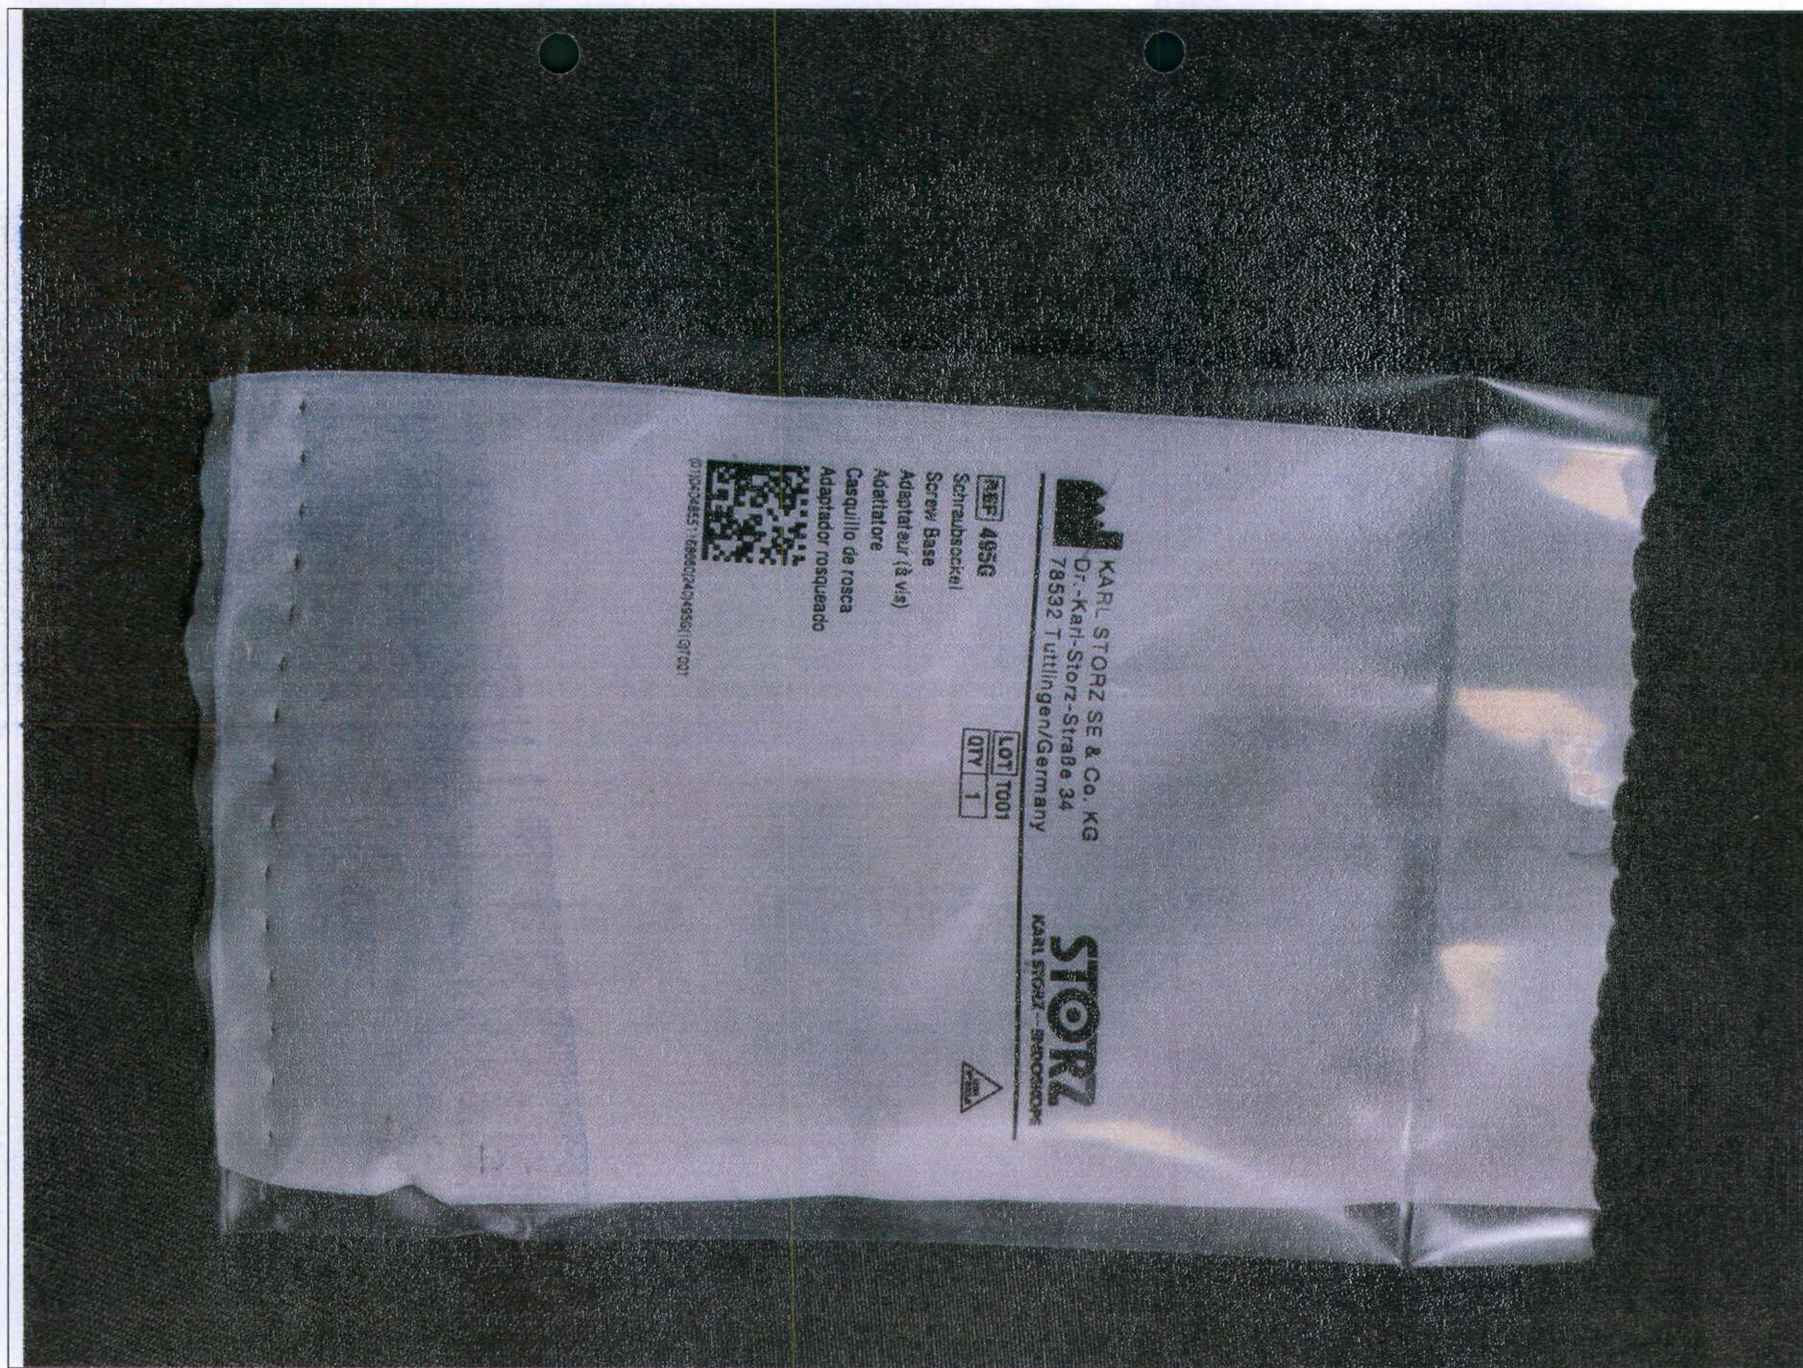


Рис. 52. Адаптер световодов KARL STORZ и Olympus. Первичная упаковка.



Рис. 53. Адаптер световодов KARL STORZ и Olympus.

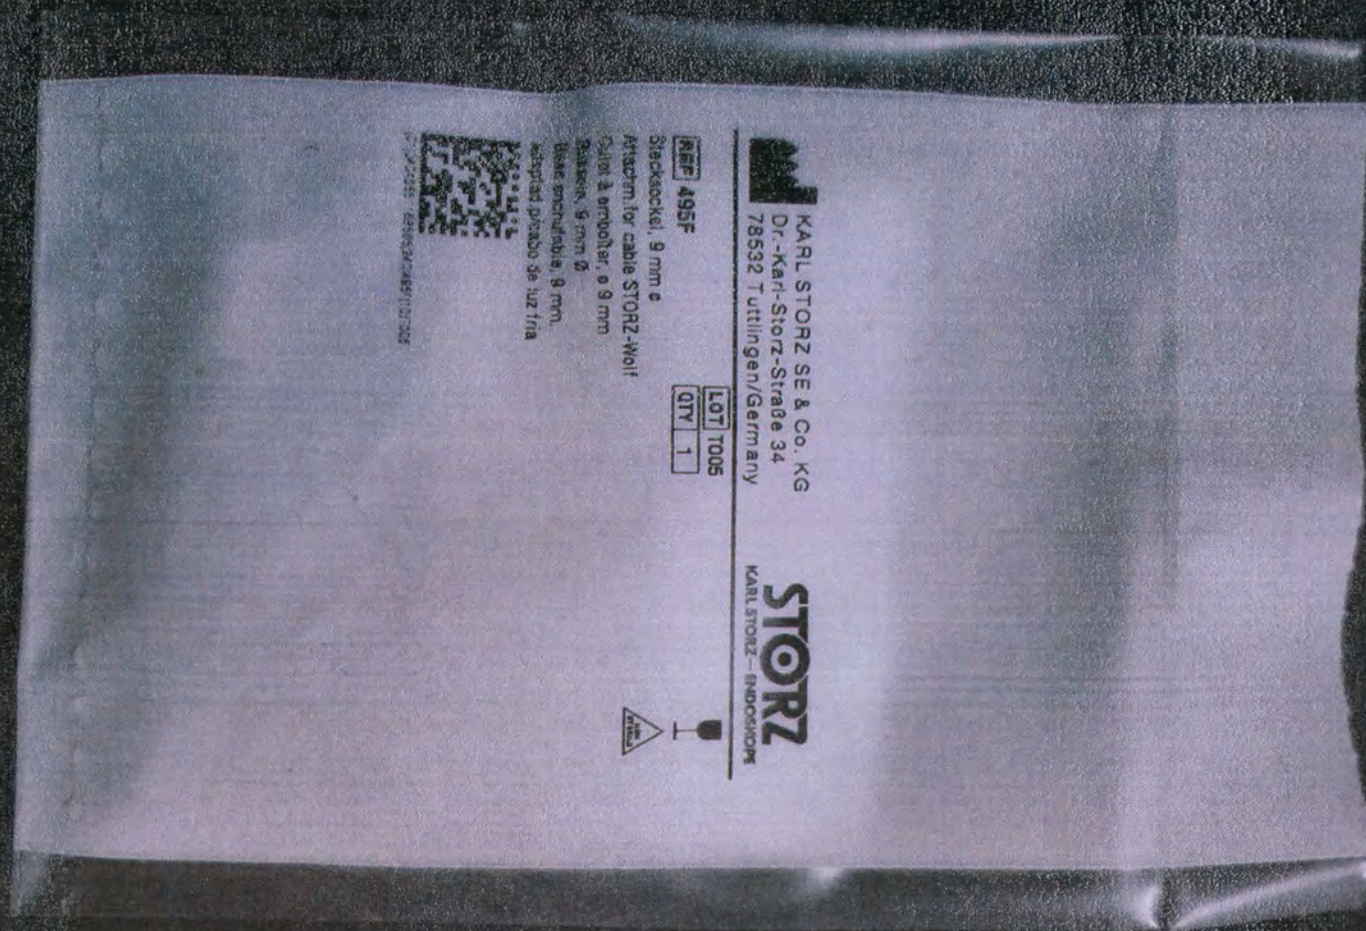


Рис. 54. Адаптер световодов Richard Wolf. Первичная упаковка.




Рис. 55. Адаптер световодов Richard Wolf



Рис. 56. Набор уплотнителей для гистероскопа В.І.О.Н. Упаковка.



Рис. 57. Набор уплотнителей для гистероскопа В.І.О.Н



Рис. 58. Набор уплотнителей для гистероскопа В.І.О.Н

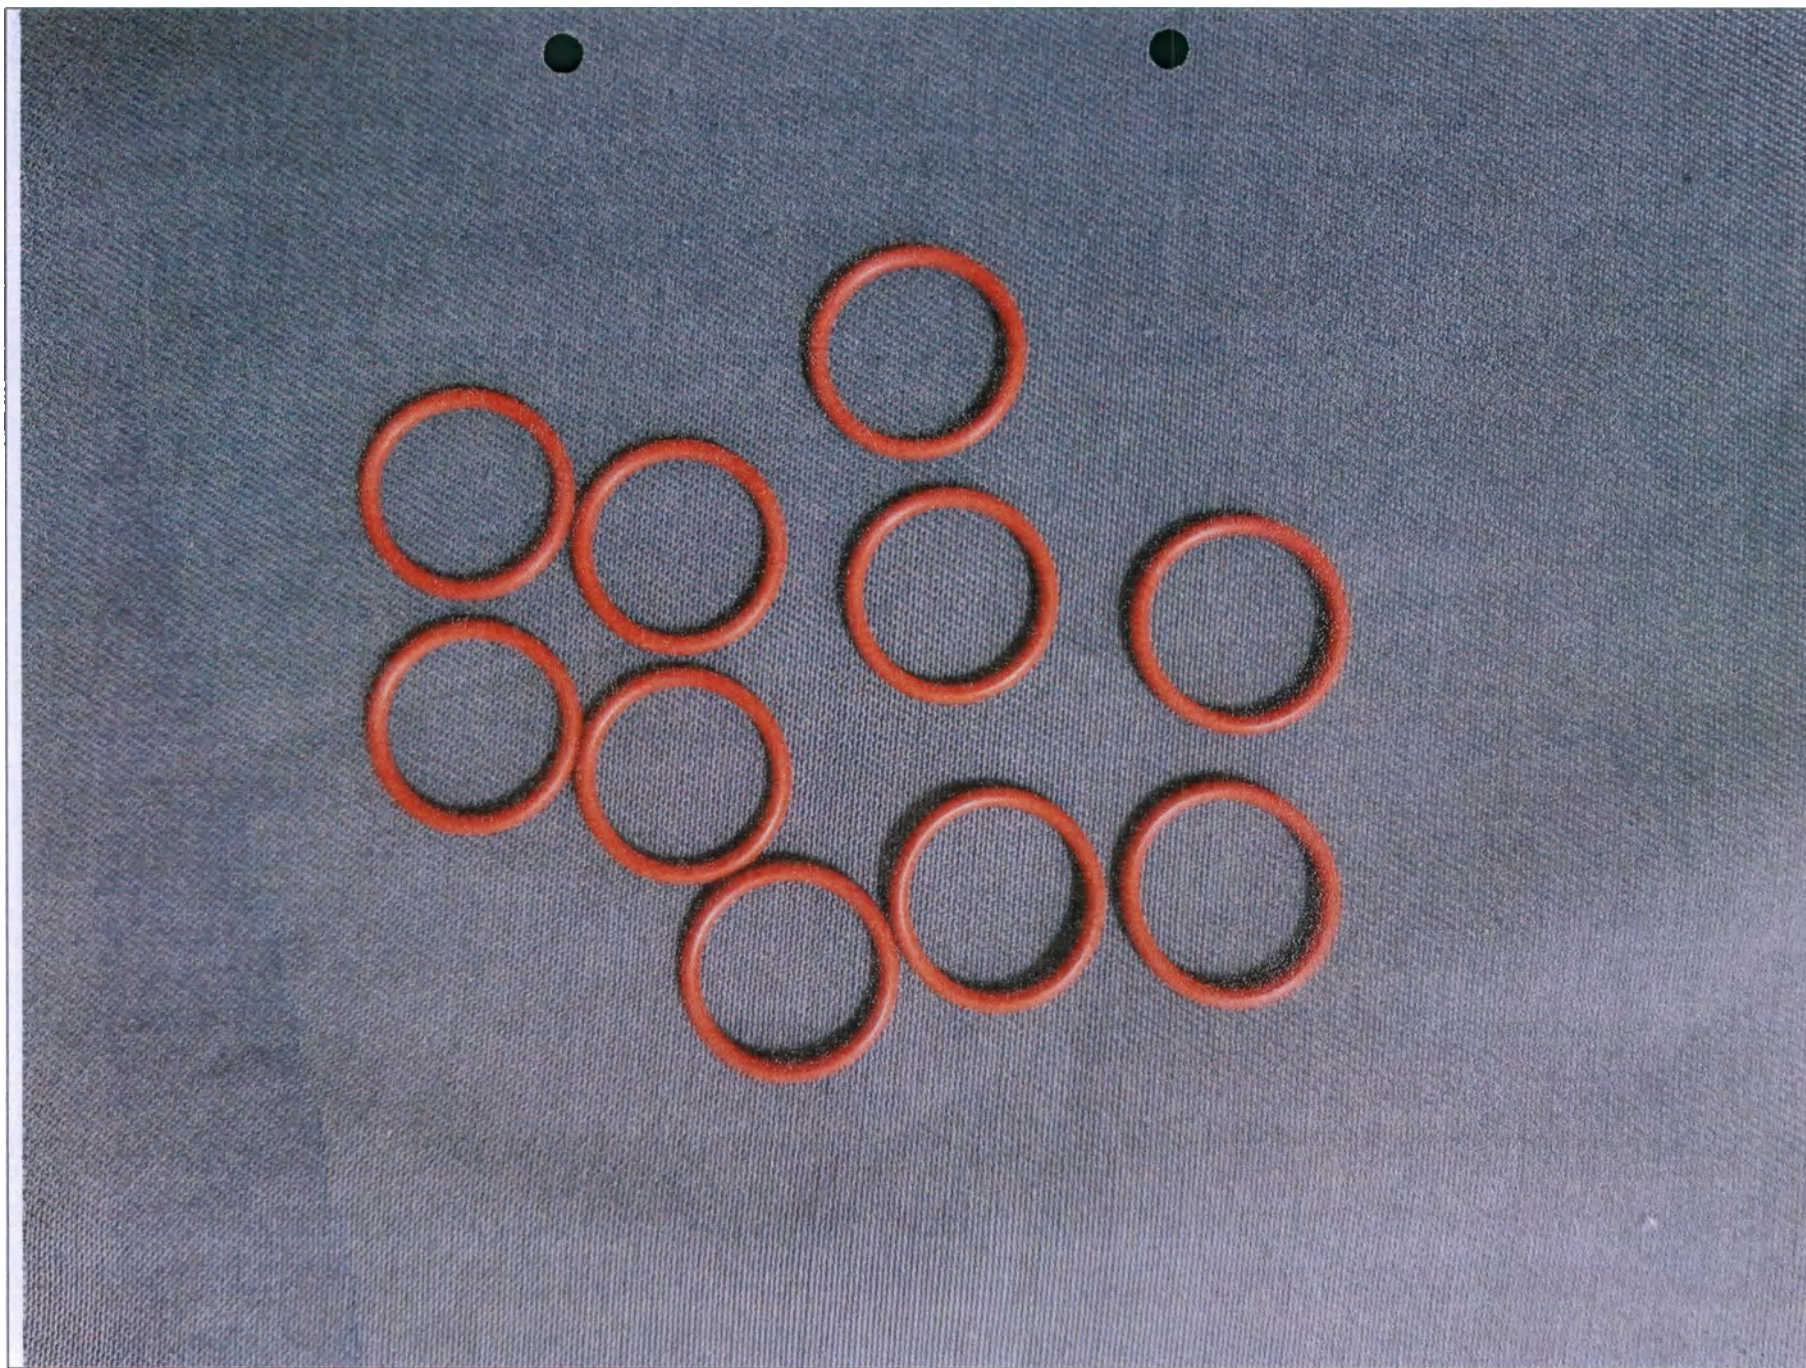


Рис. 59. Кольцо прокладочное, диаметр 10/12 мм, для клапана – 10 шт.

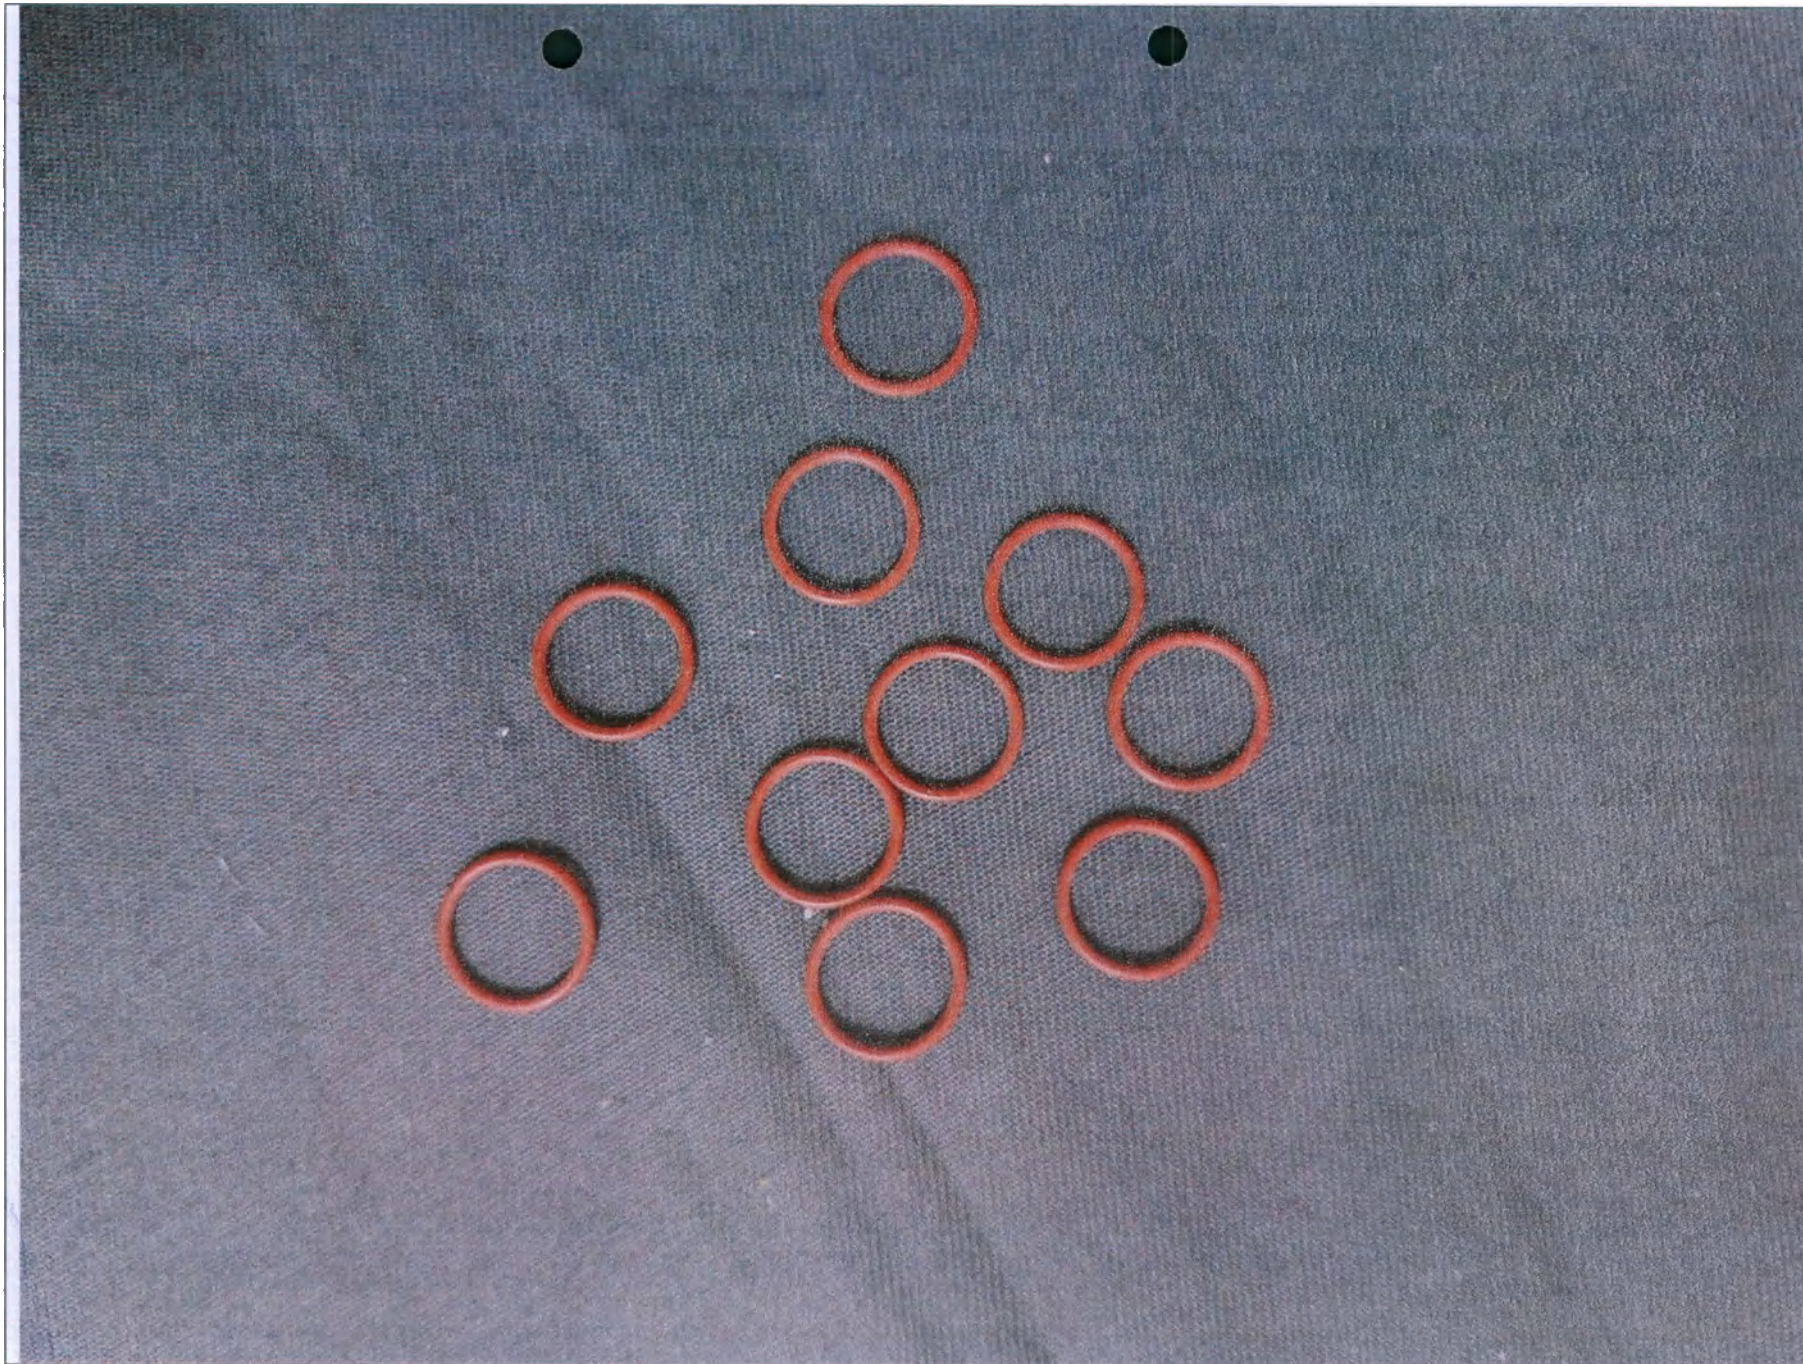


Рис. 60. Кольцо прокладочное, диаметр 10/5 мм, для клапана – 10 шт.

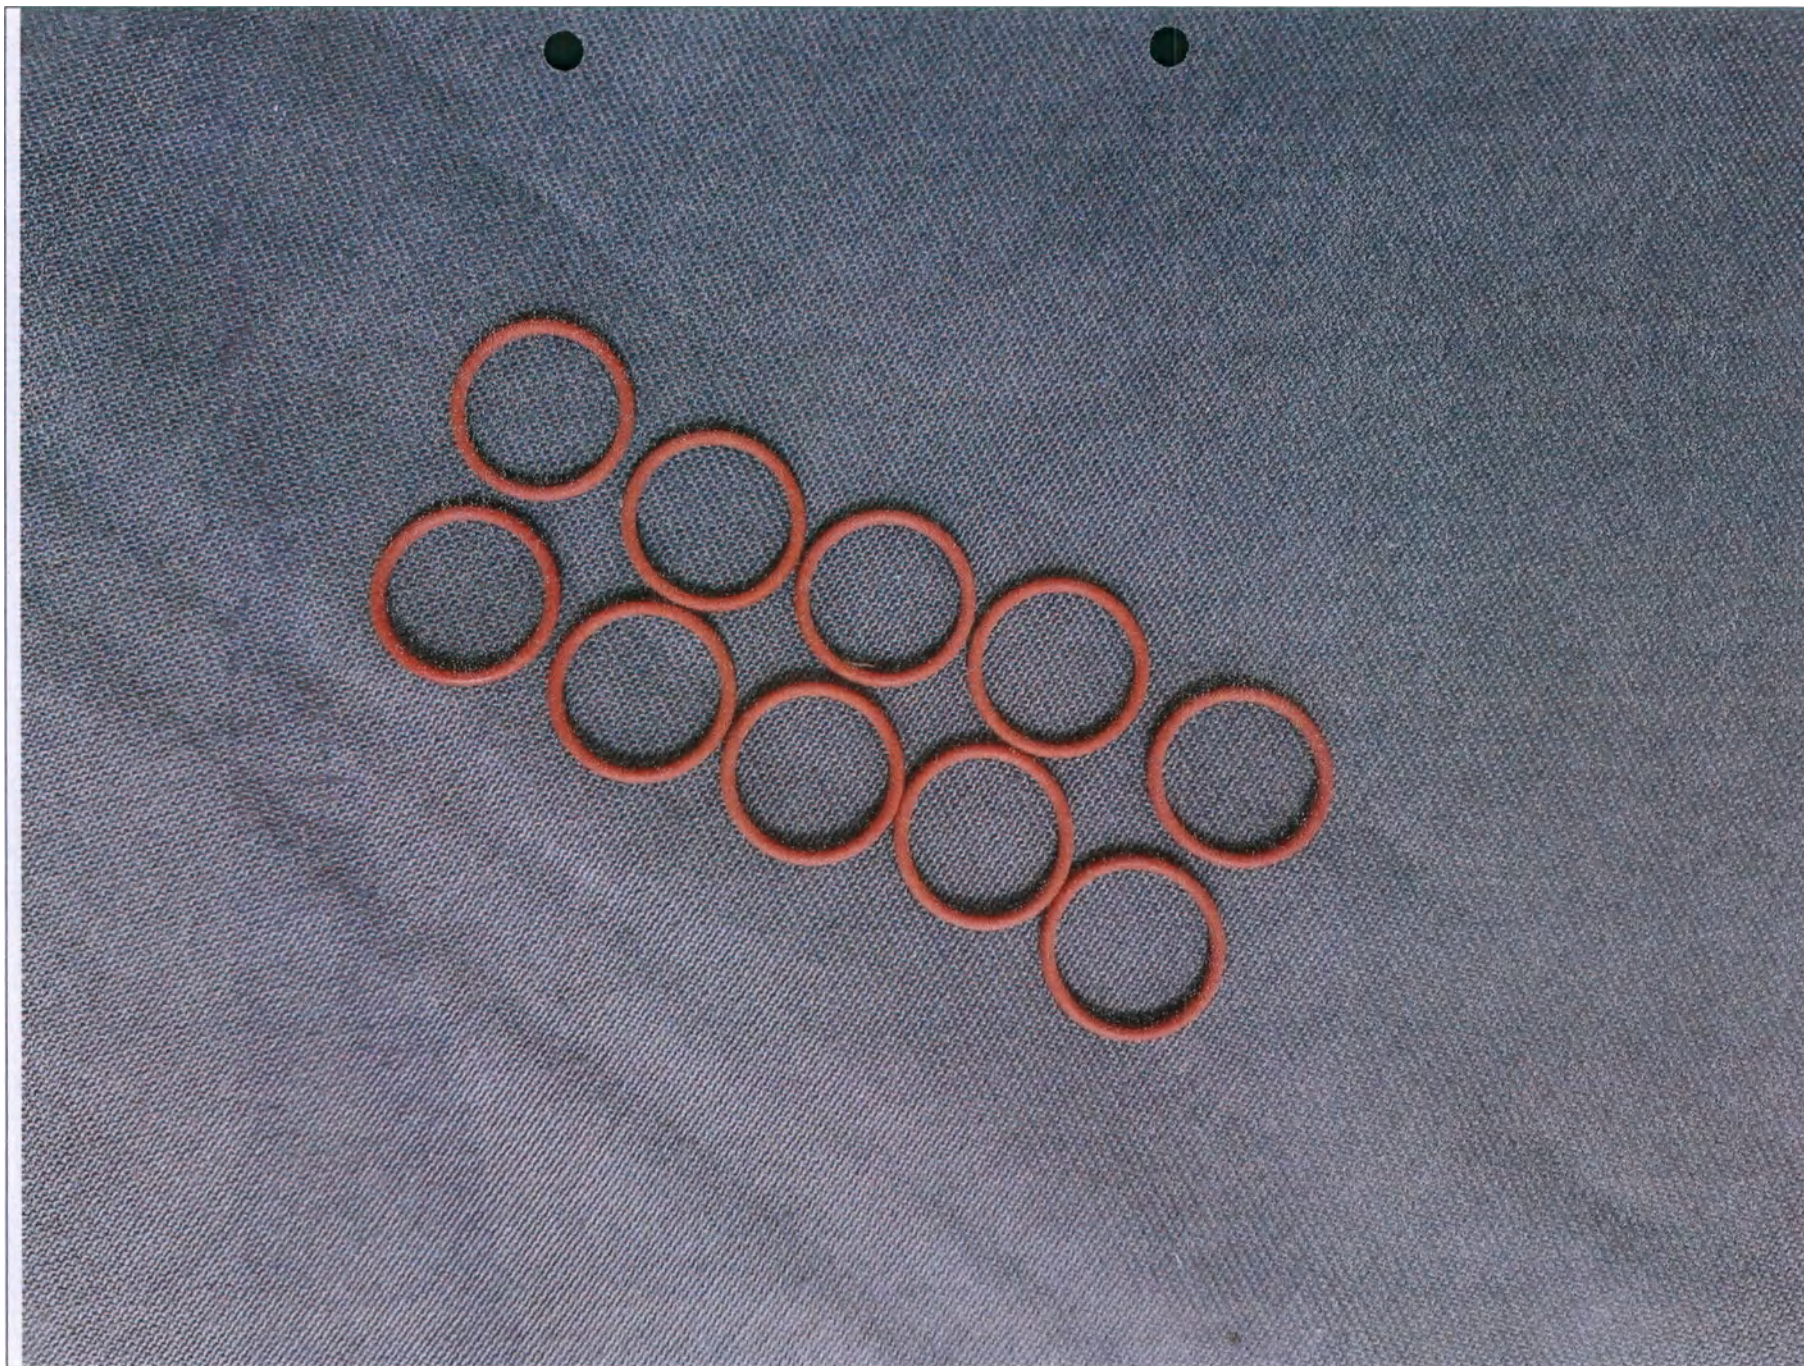


Рис. 61. Кольцо прокладочное, диаметр 14 мм, для клапана – 10 шт.



Рис. 62. Колпачок уплотняющий, для рабочего канала – 5 шт.

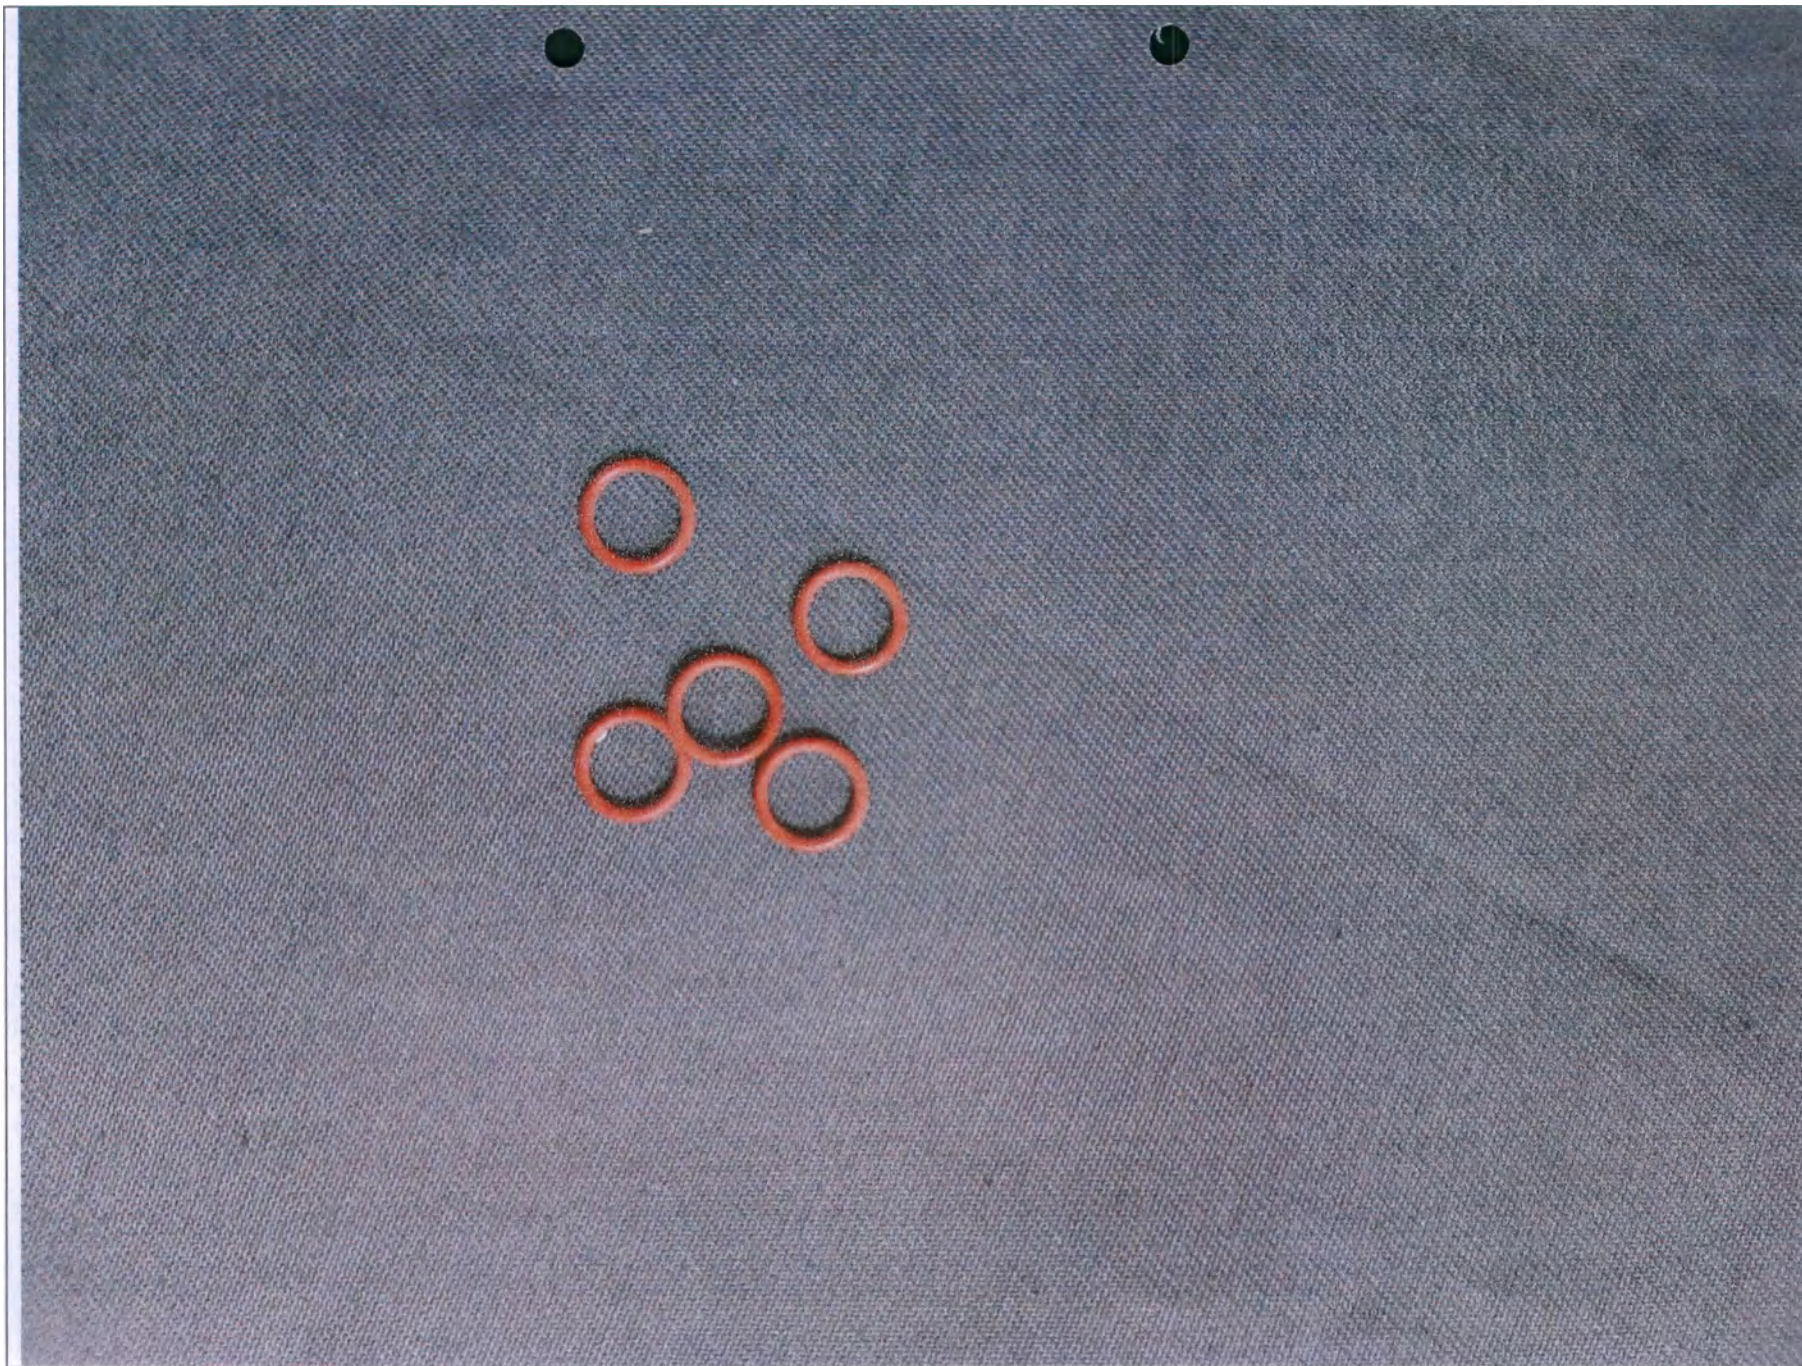


Рис. 63. Кольцо прокладочное для тубуса – 5 шт.



Рис. 64. Коробка для хранения набора



Рис. 65. Монтажное приспособление, для клапанов гистероскопа В.І.О.Н. Упаковка.


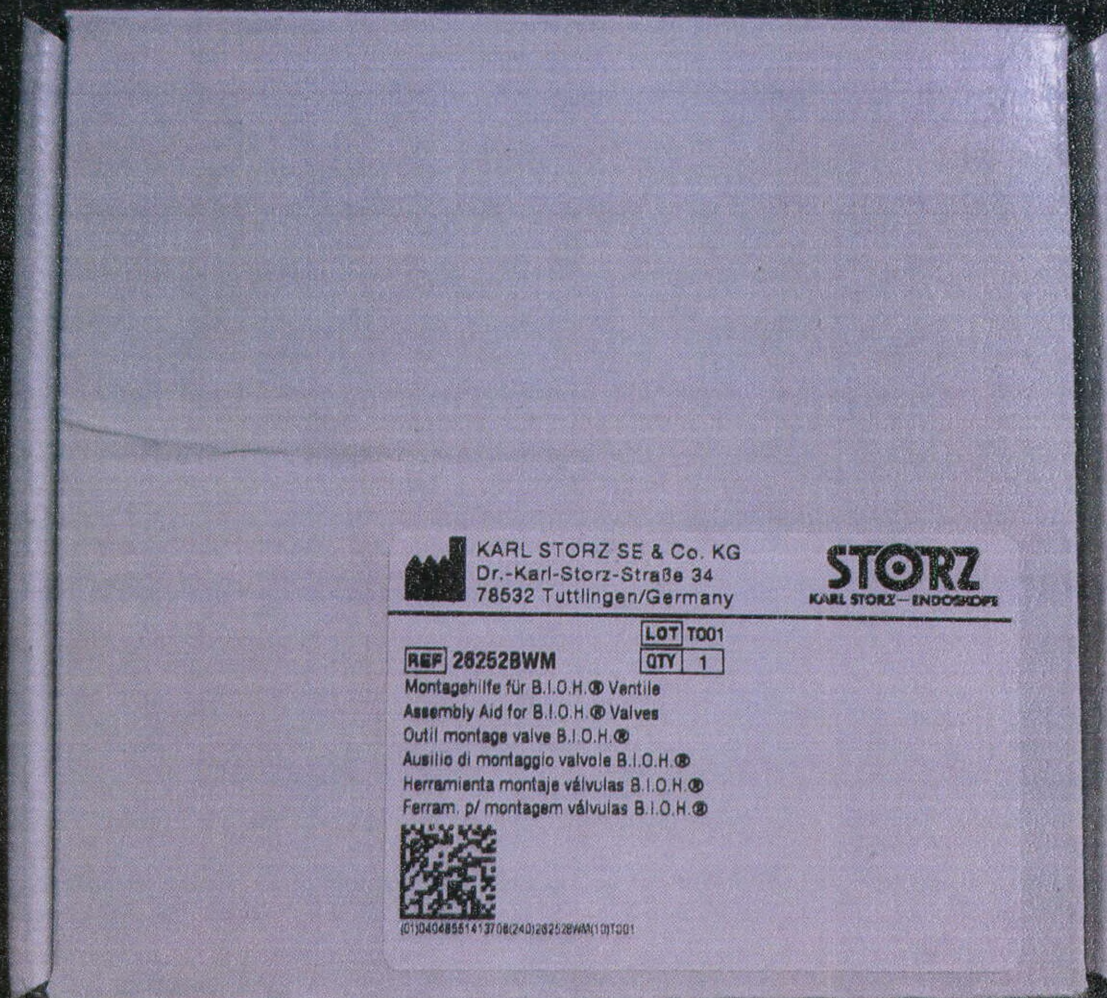


Рис. 66. Монтажное приспособление, для клапанов гистероскопа В.І.О.Н. Маркировка на упаковке.



STORZ
KARL STORZ — ENDOSCOPE

LOT T001

QTY	1
-----	---

REF 26252BWM

Montagehilfe für B.I.O.H.® Ventile
Assembly Aid for B.I.O.H.® Valves
Outil montage valve B.I.O.H.®
Ausilio di montaggio valvole B.I.O.H.®
Herramienta montaje válvulas B.I.O.H.®
Ferram. p/ montagem válvulas B.I.O.H.®



W 3474155 C 3733243 261529W Y 0702

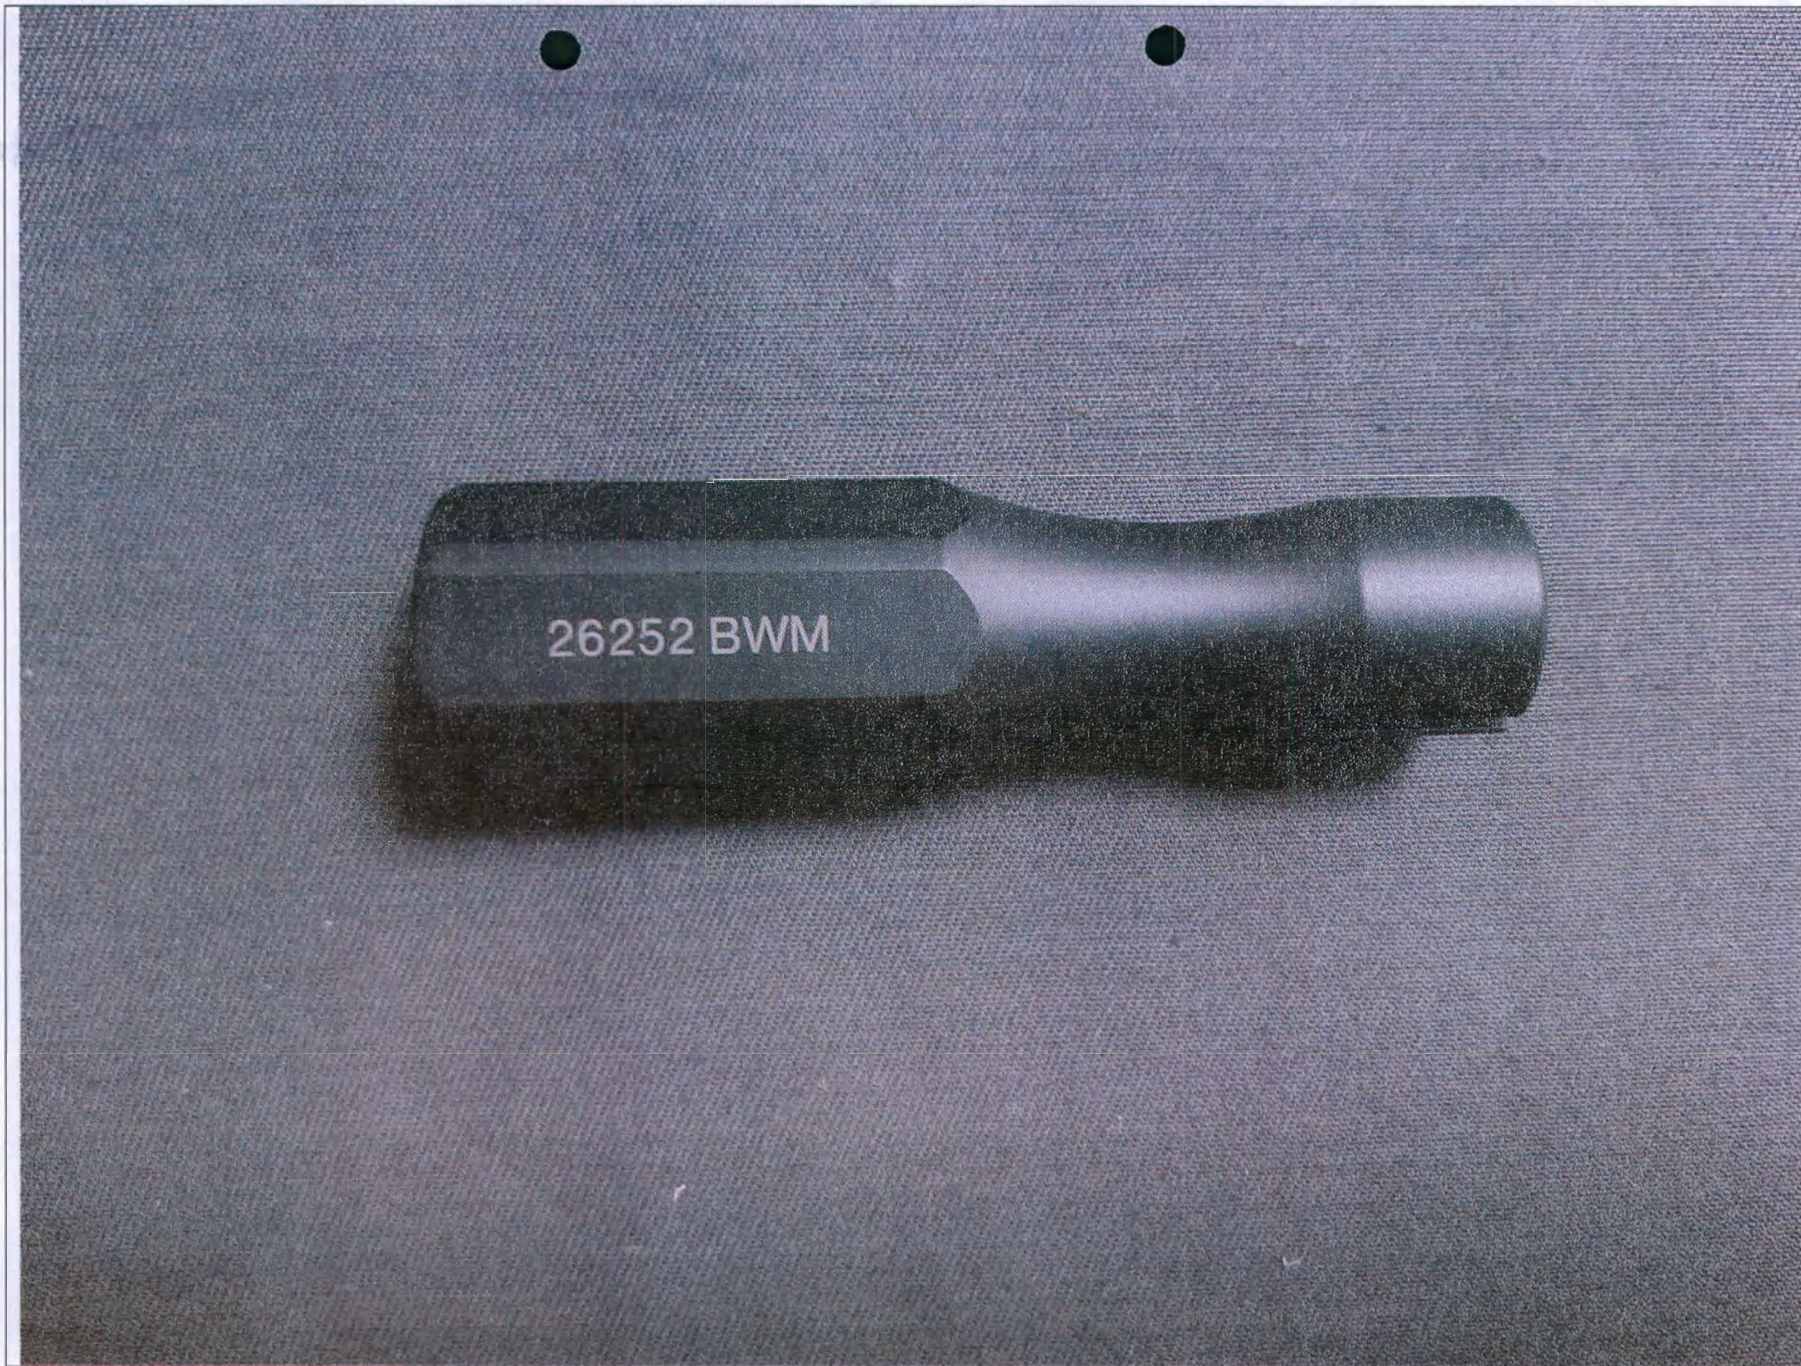


Рис. 68. Монтажное приспособление, для клапанов гистероскопа В.І.О.Н



Рис. 69. Адаптер-моноблок для гистероскопа В.І.О.Н. Упаковка.

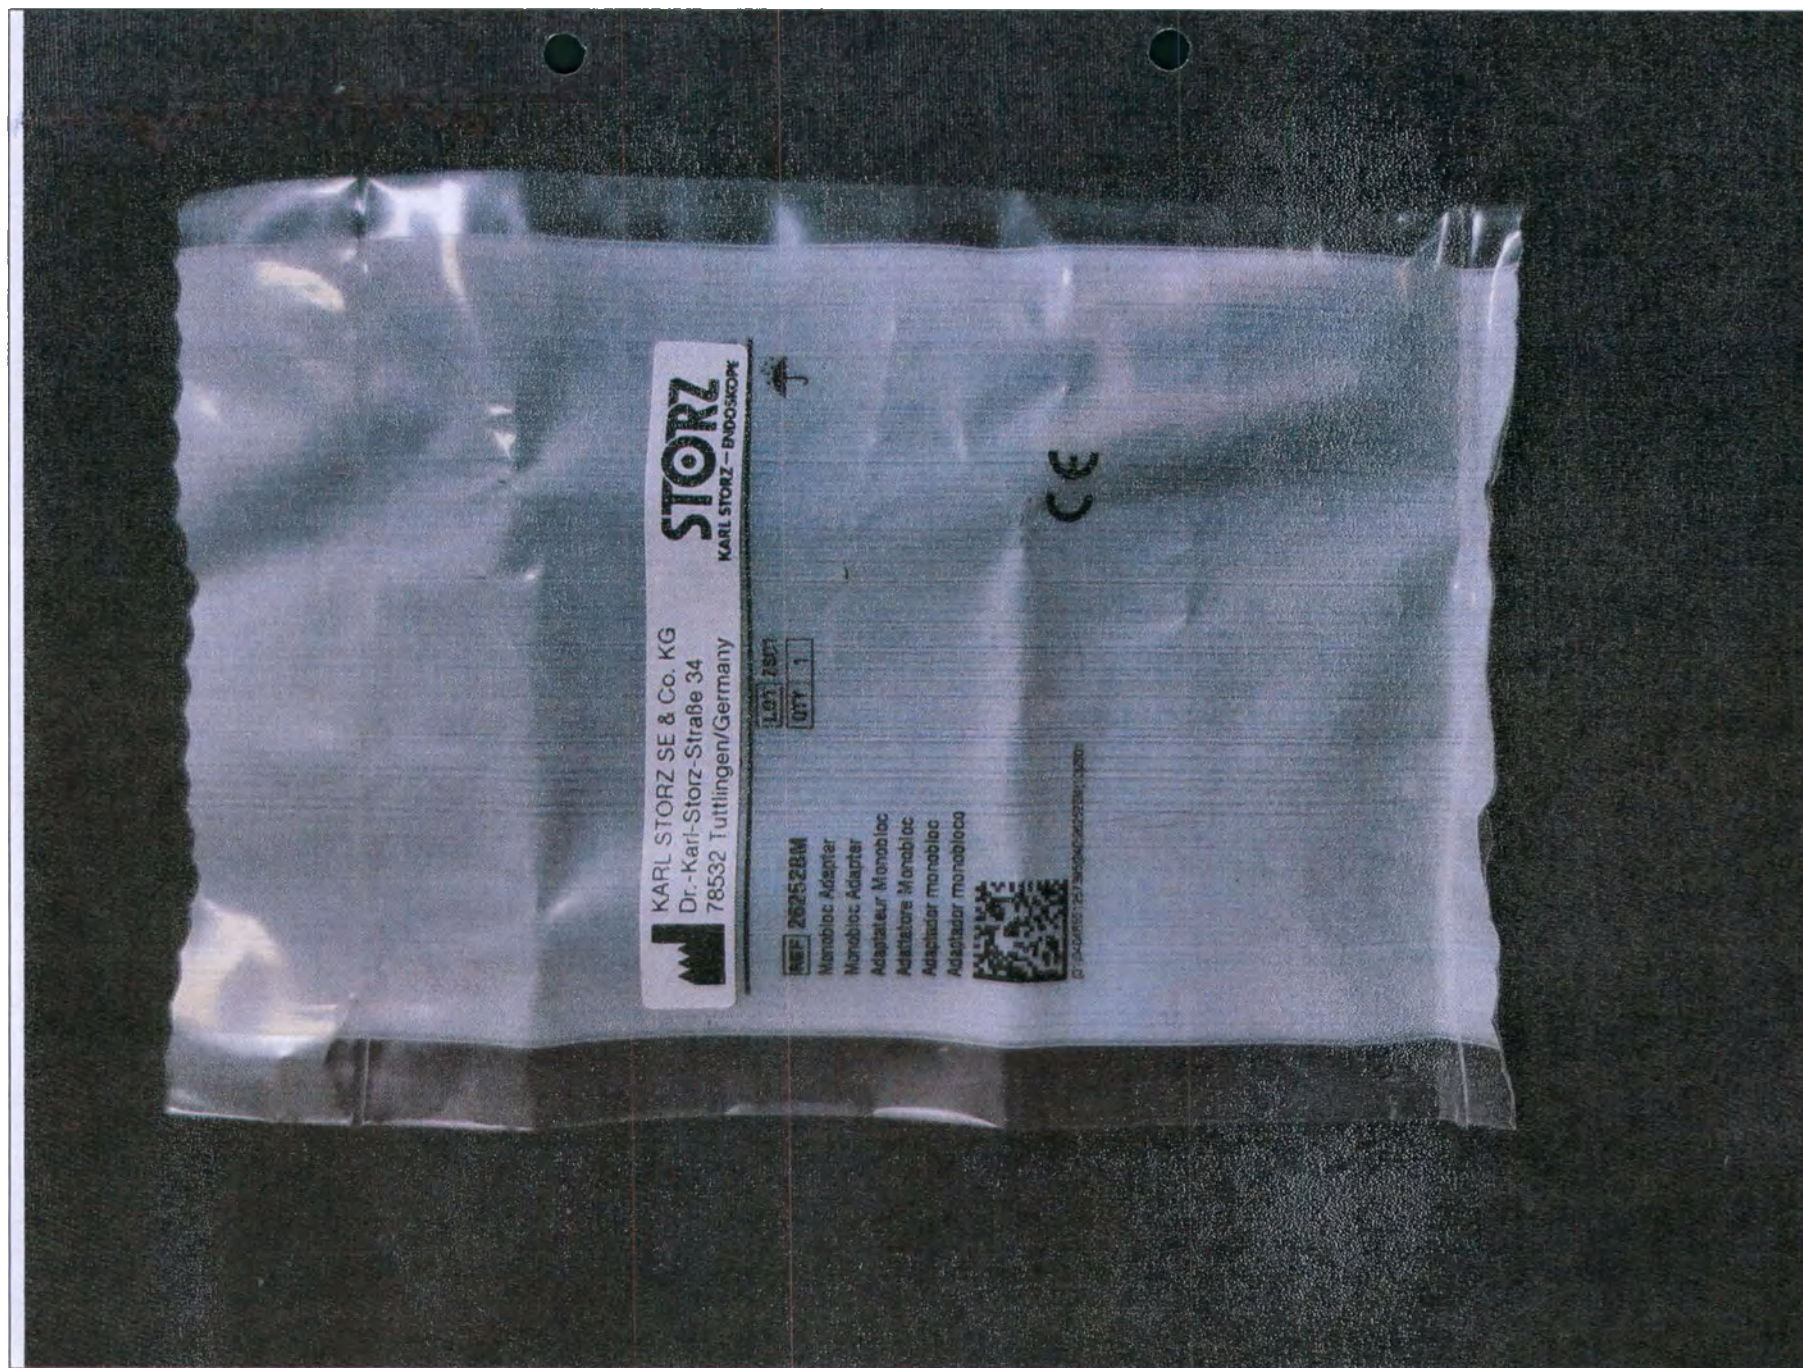


Рис. 70. Адаптер-моноблок для гистероскопа В.І.О.Н.

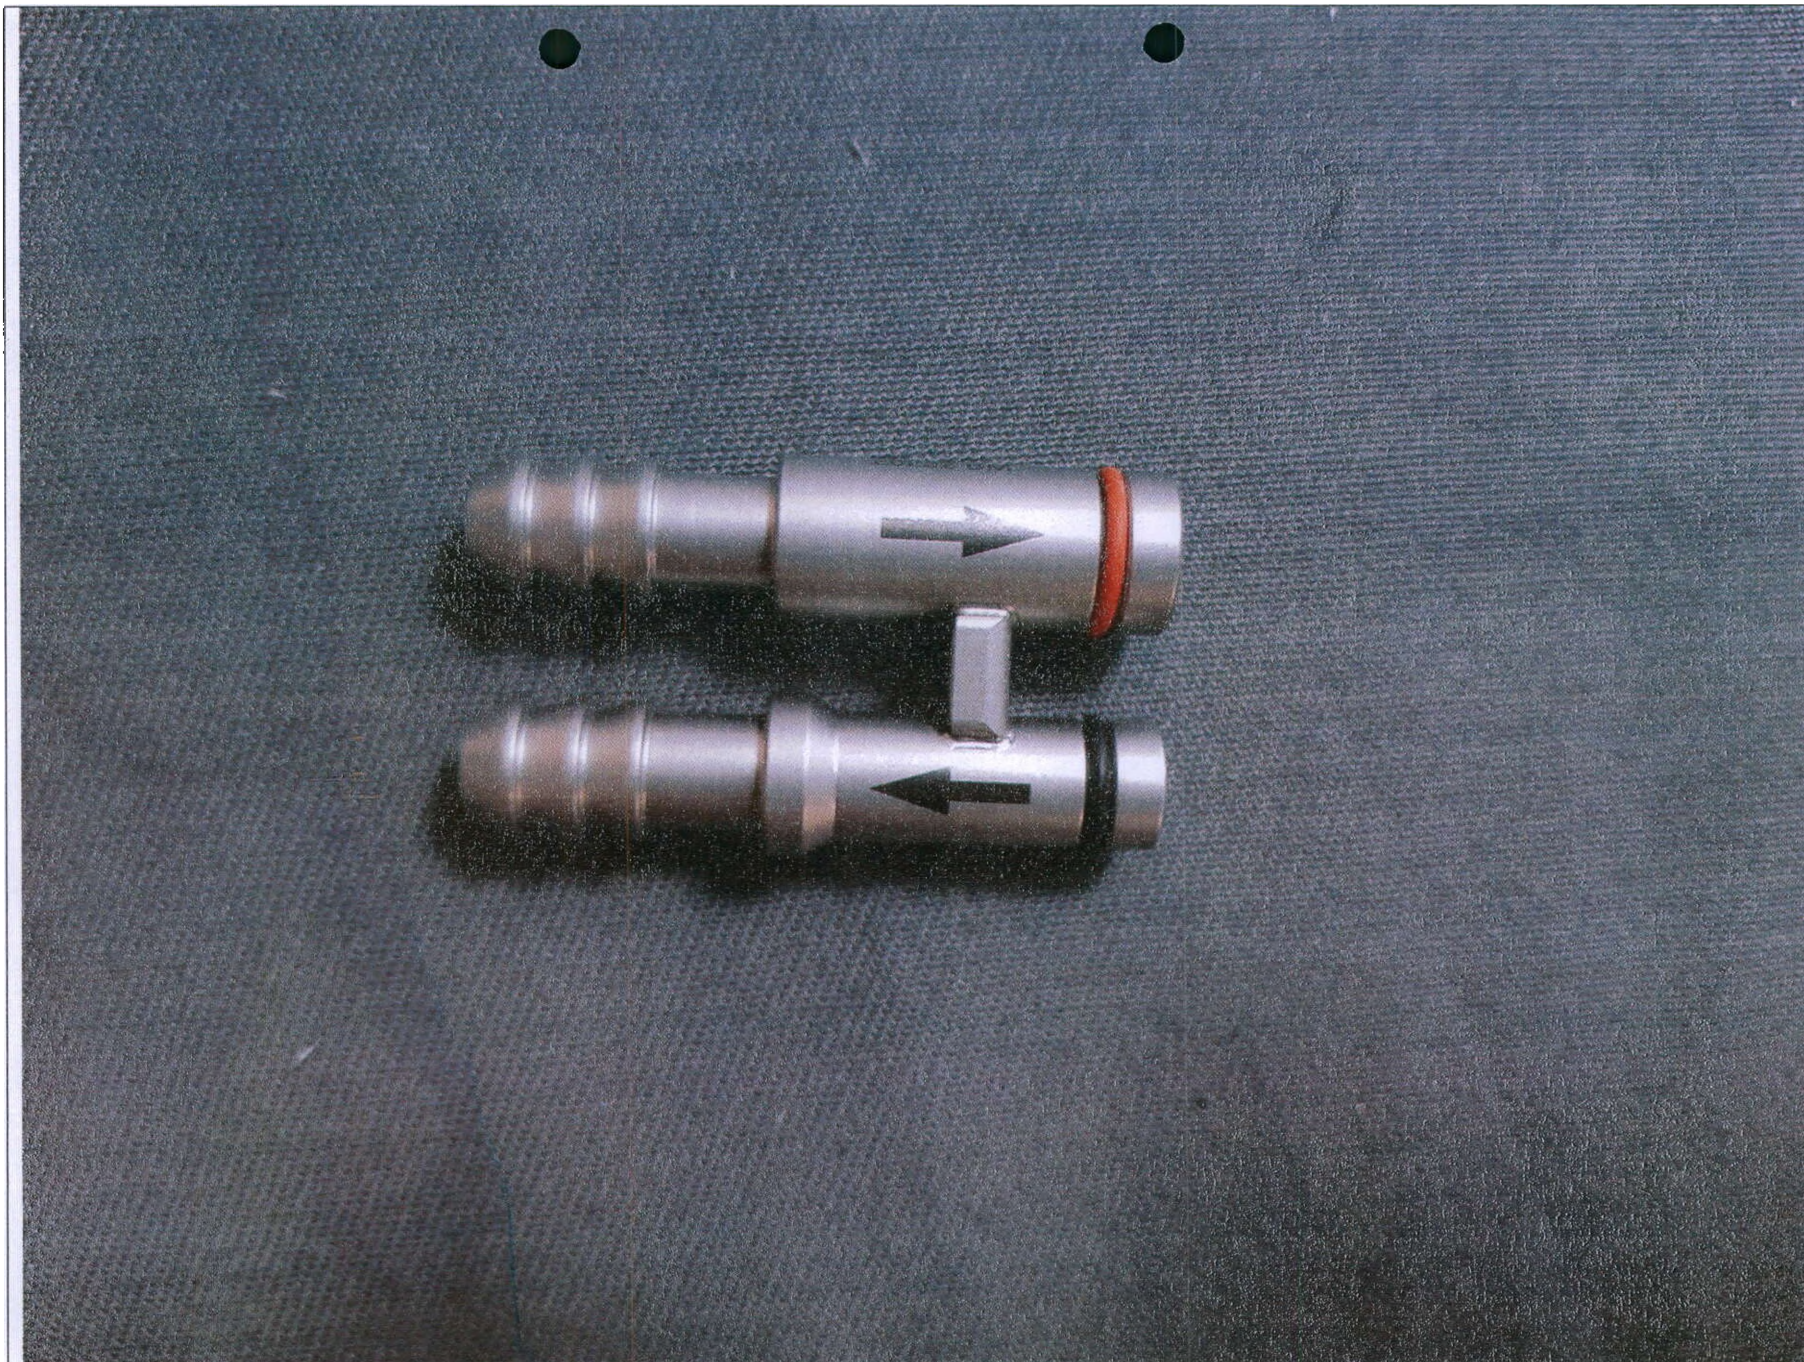


Рис. 71. Адаптер-моноблок для гистероскопа В.І.О.Н.

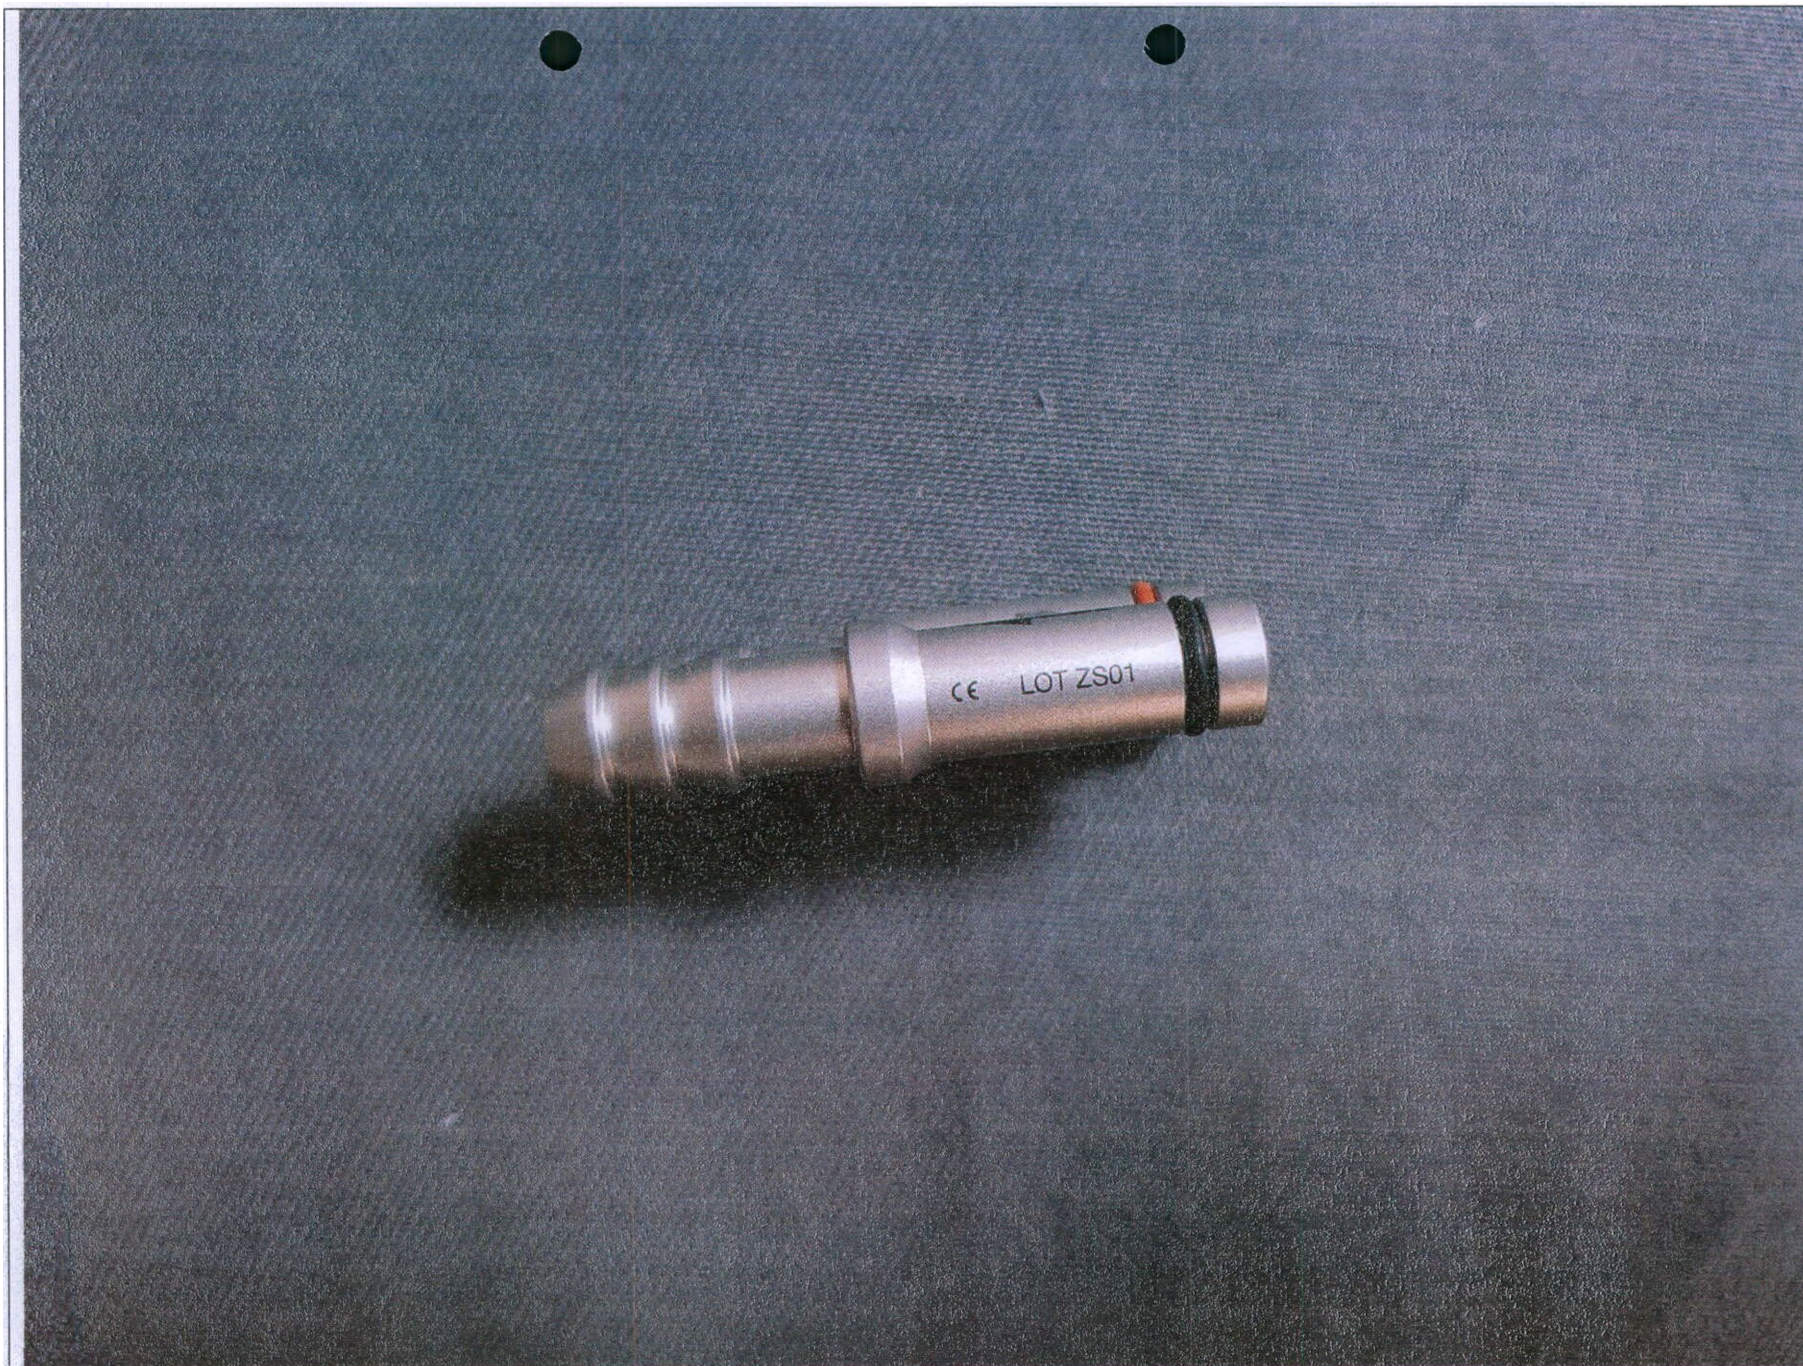


Рис. 72. Адаптер-моноблок для гистероскопа В.І.О.Н.

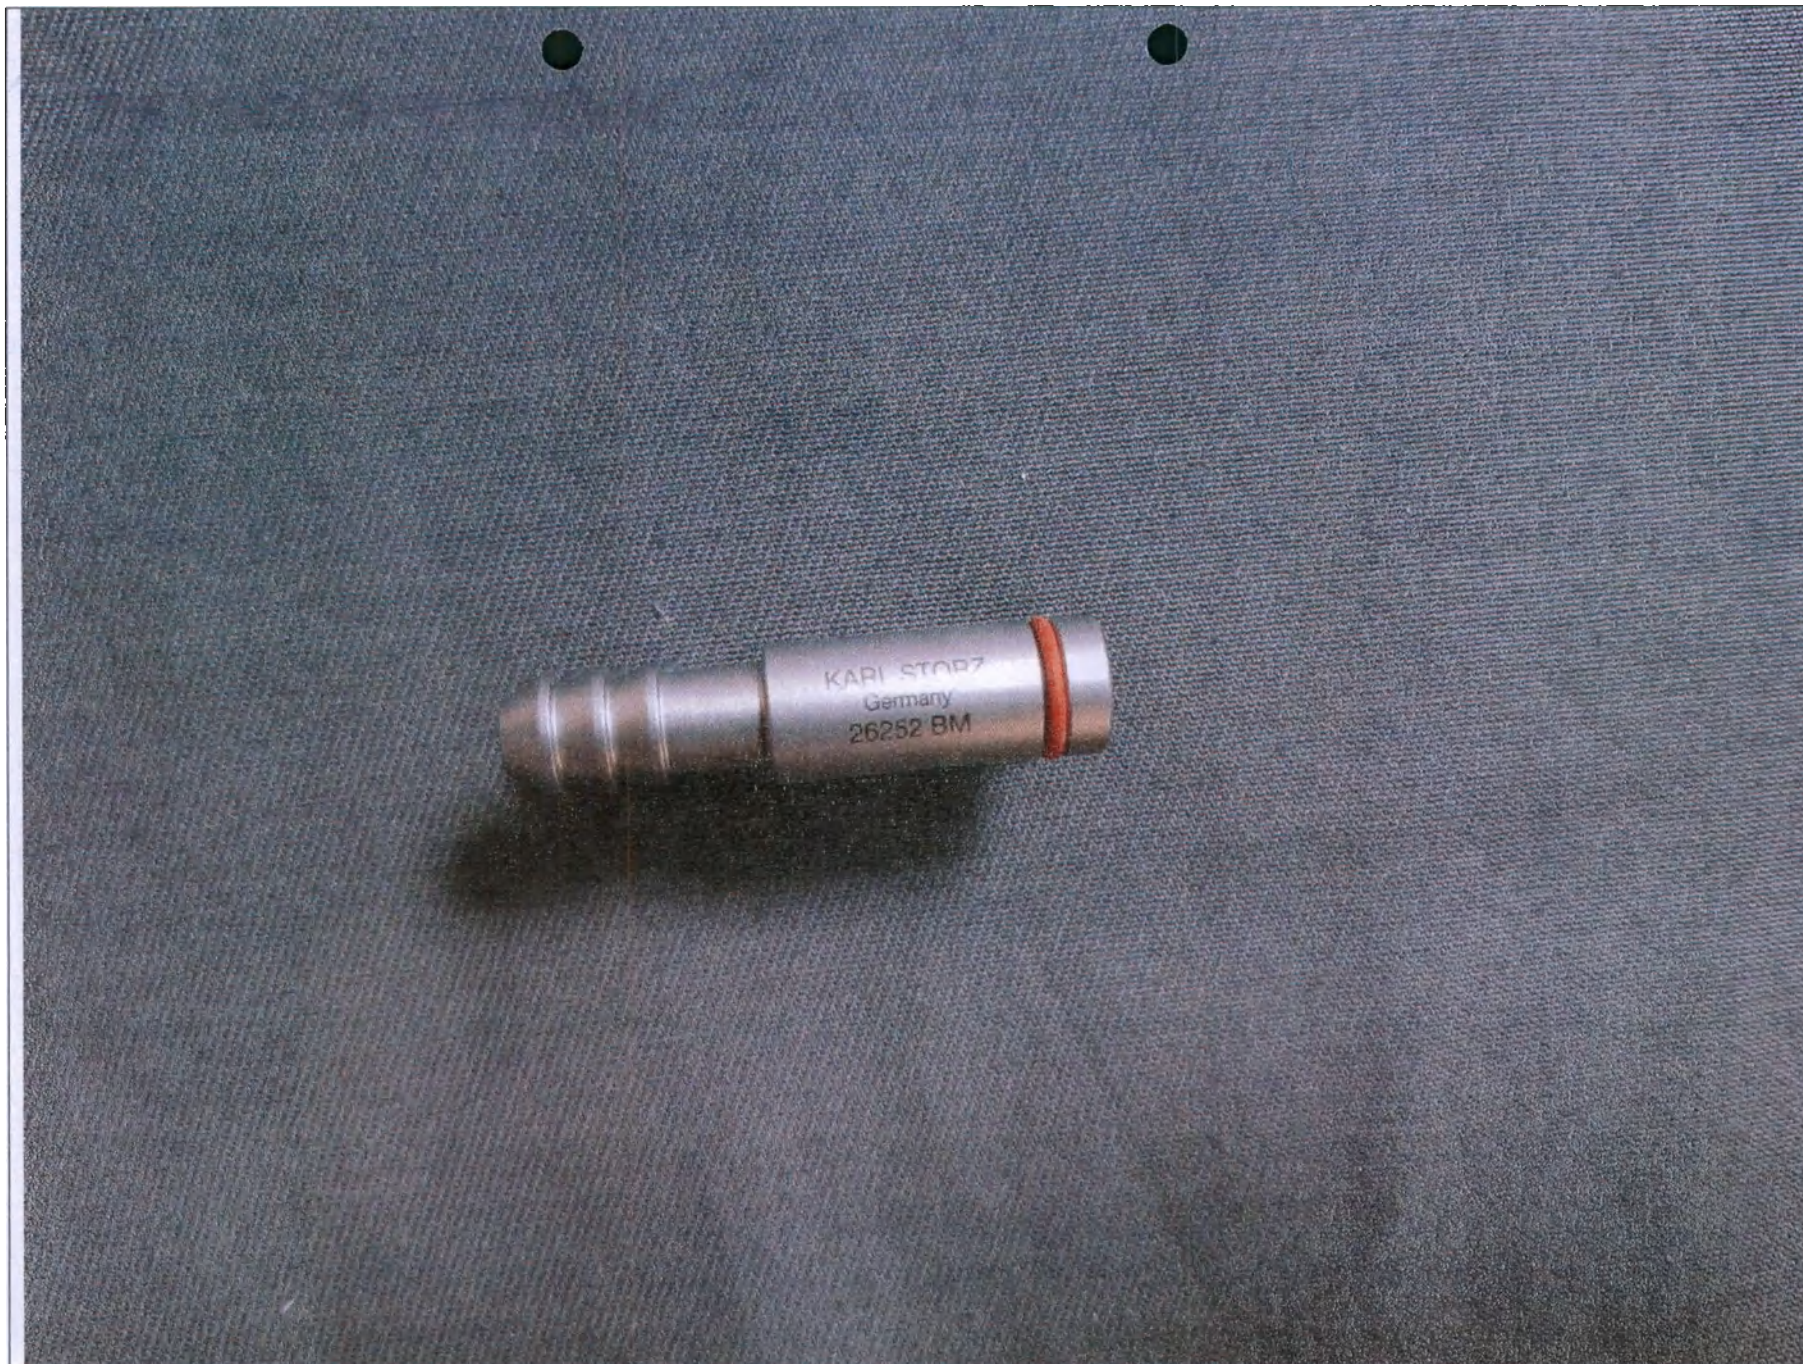


Рис. 73. Адаптер-моноблок для гистероскопа В.И.О.Н.

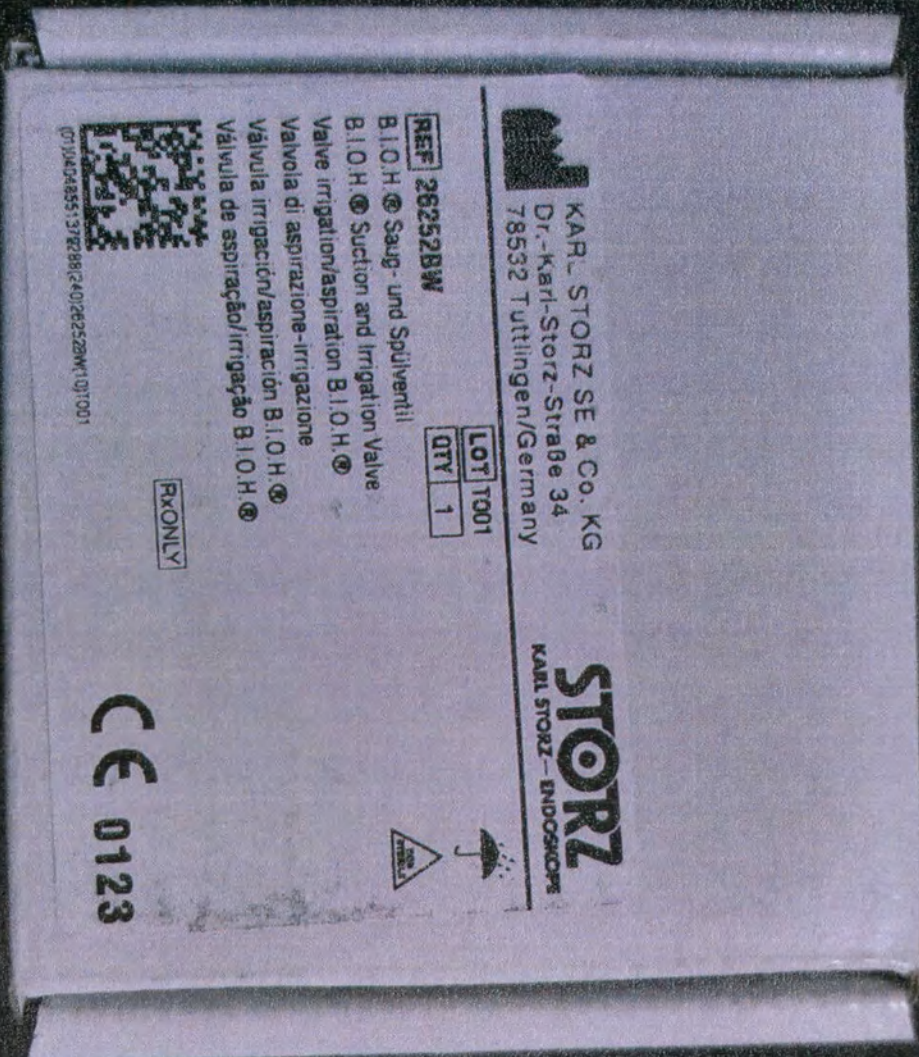


Рис. 74. Аспирационный и ирригационный клапан для гистероскопа В.І.О.Н. Упаковка.

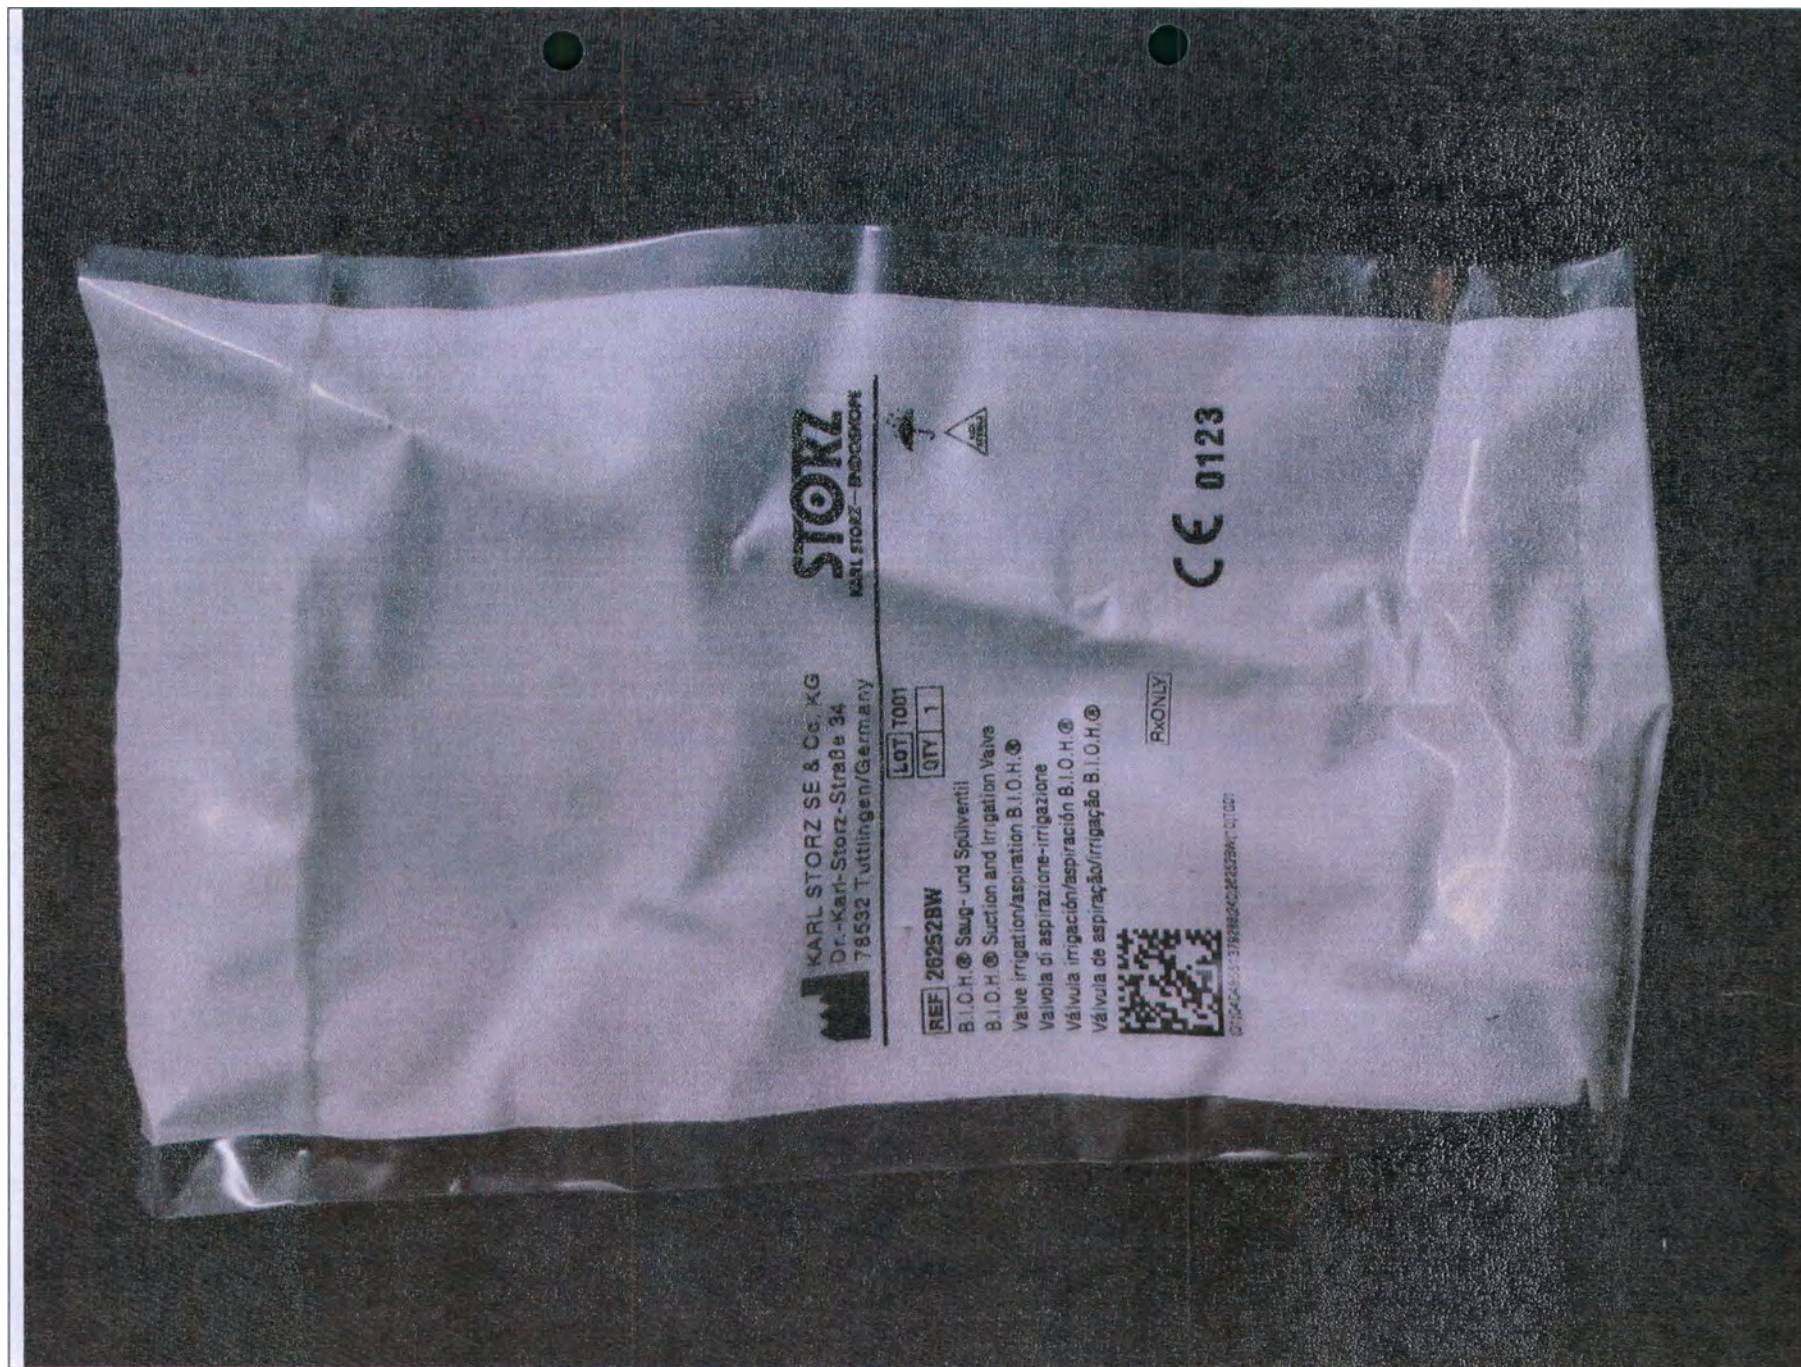


Рис. 75. Аспирационный и ирригационный клапан для гистероскопа В.І.О.Н

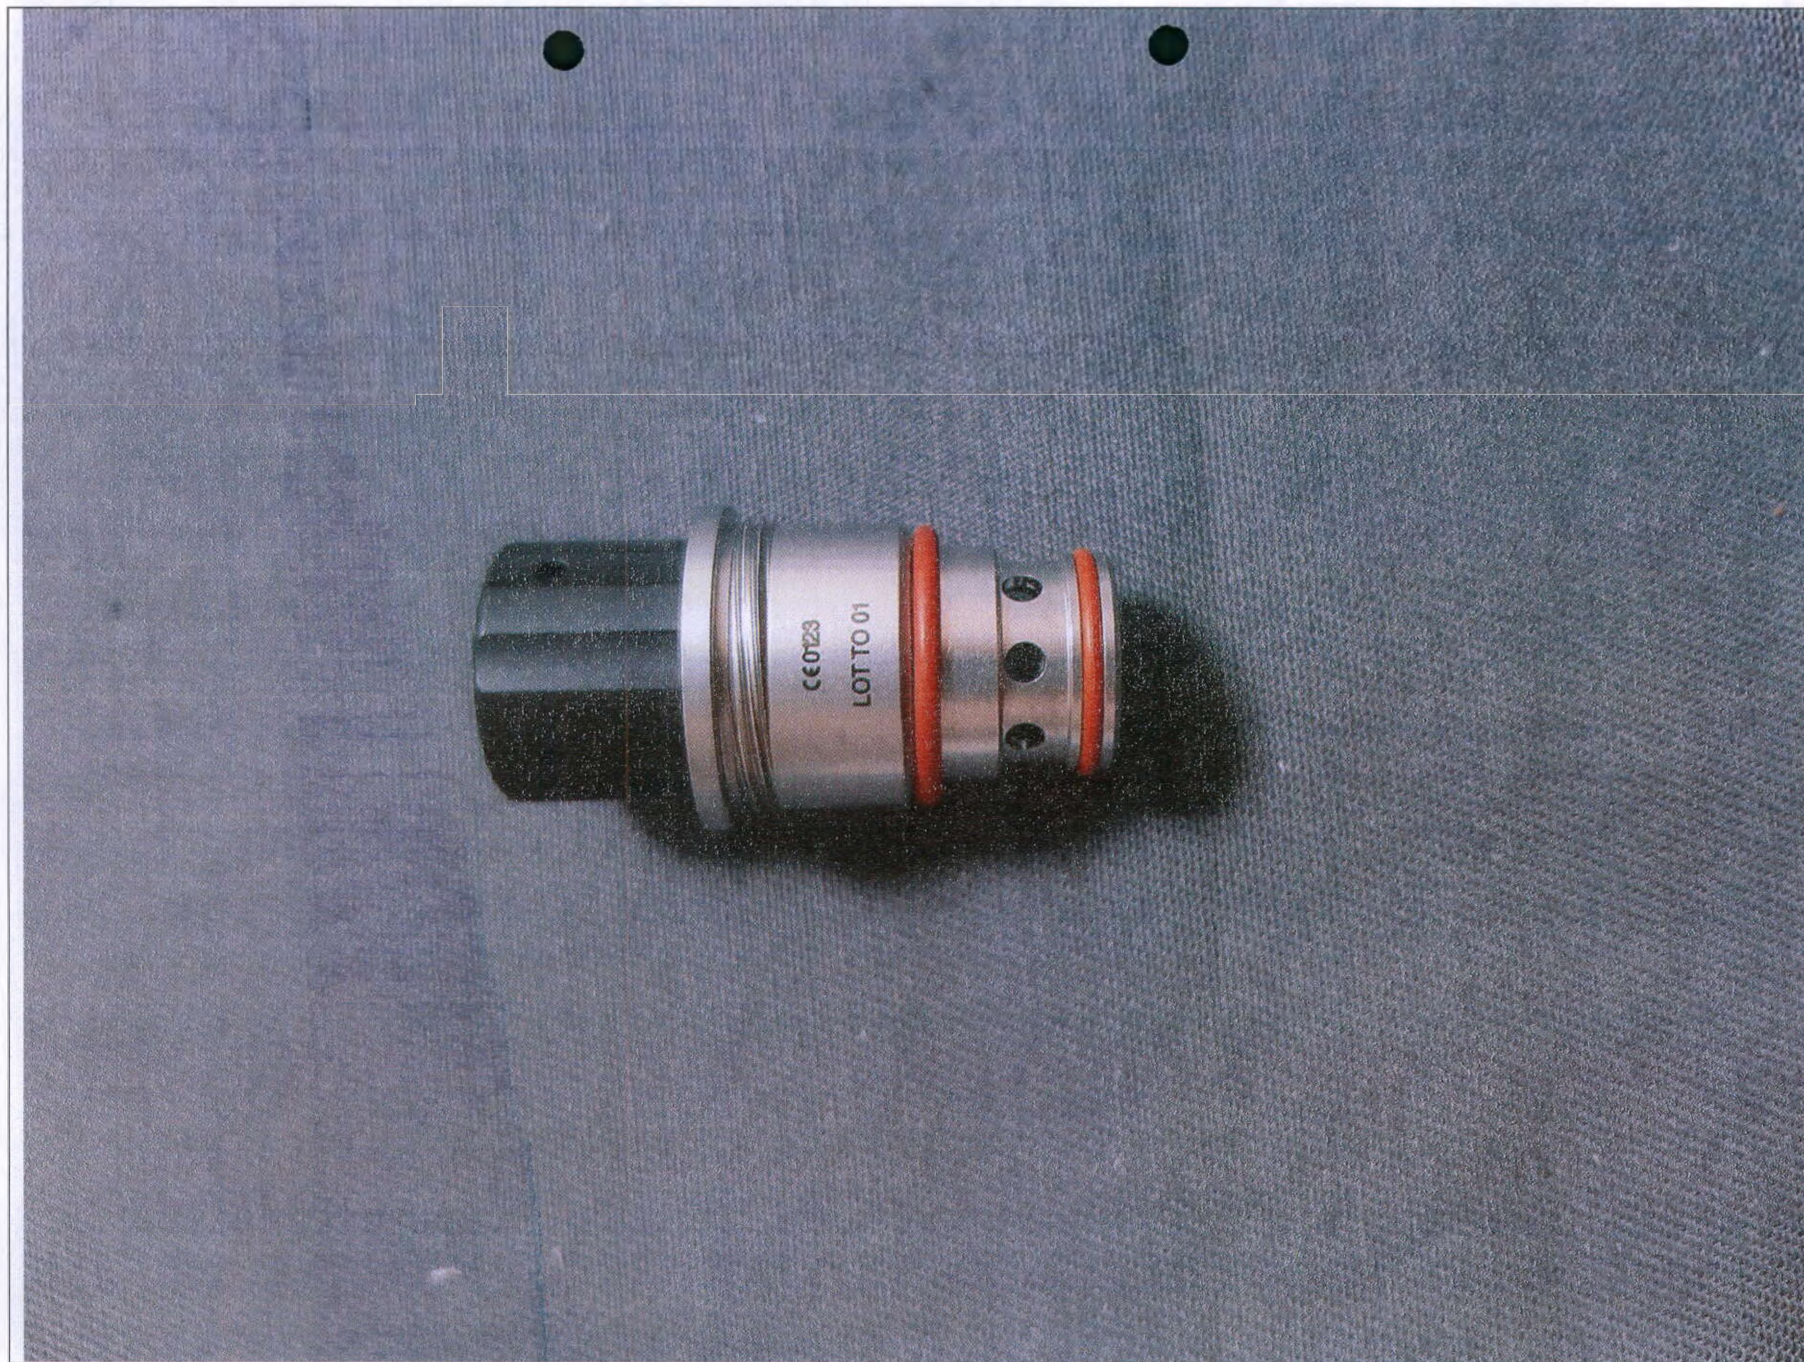


Рис. 76. Аспирационный и ирригационный клапан для гистероскопа В.І.О.Н

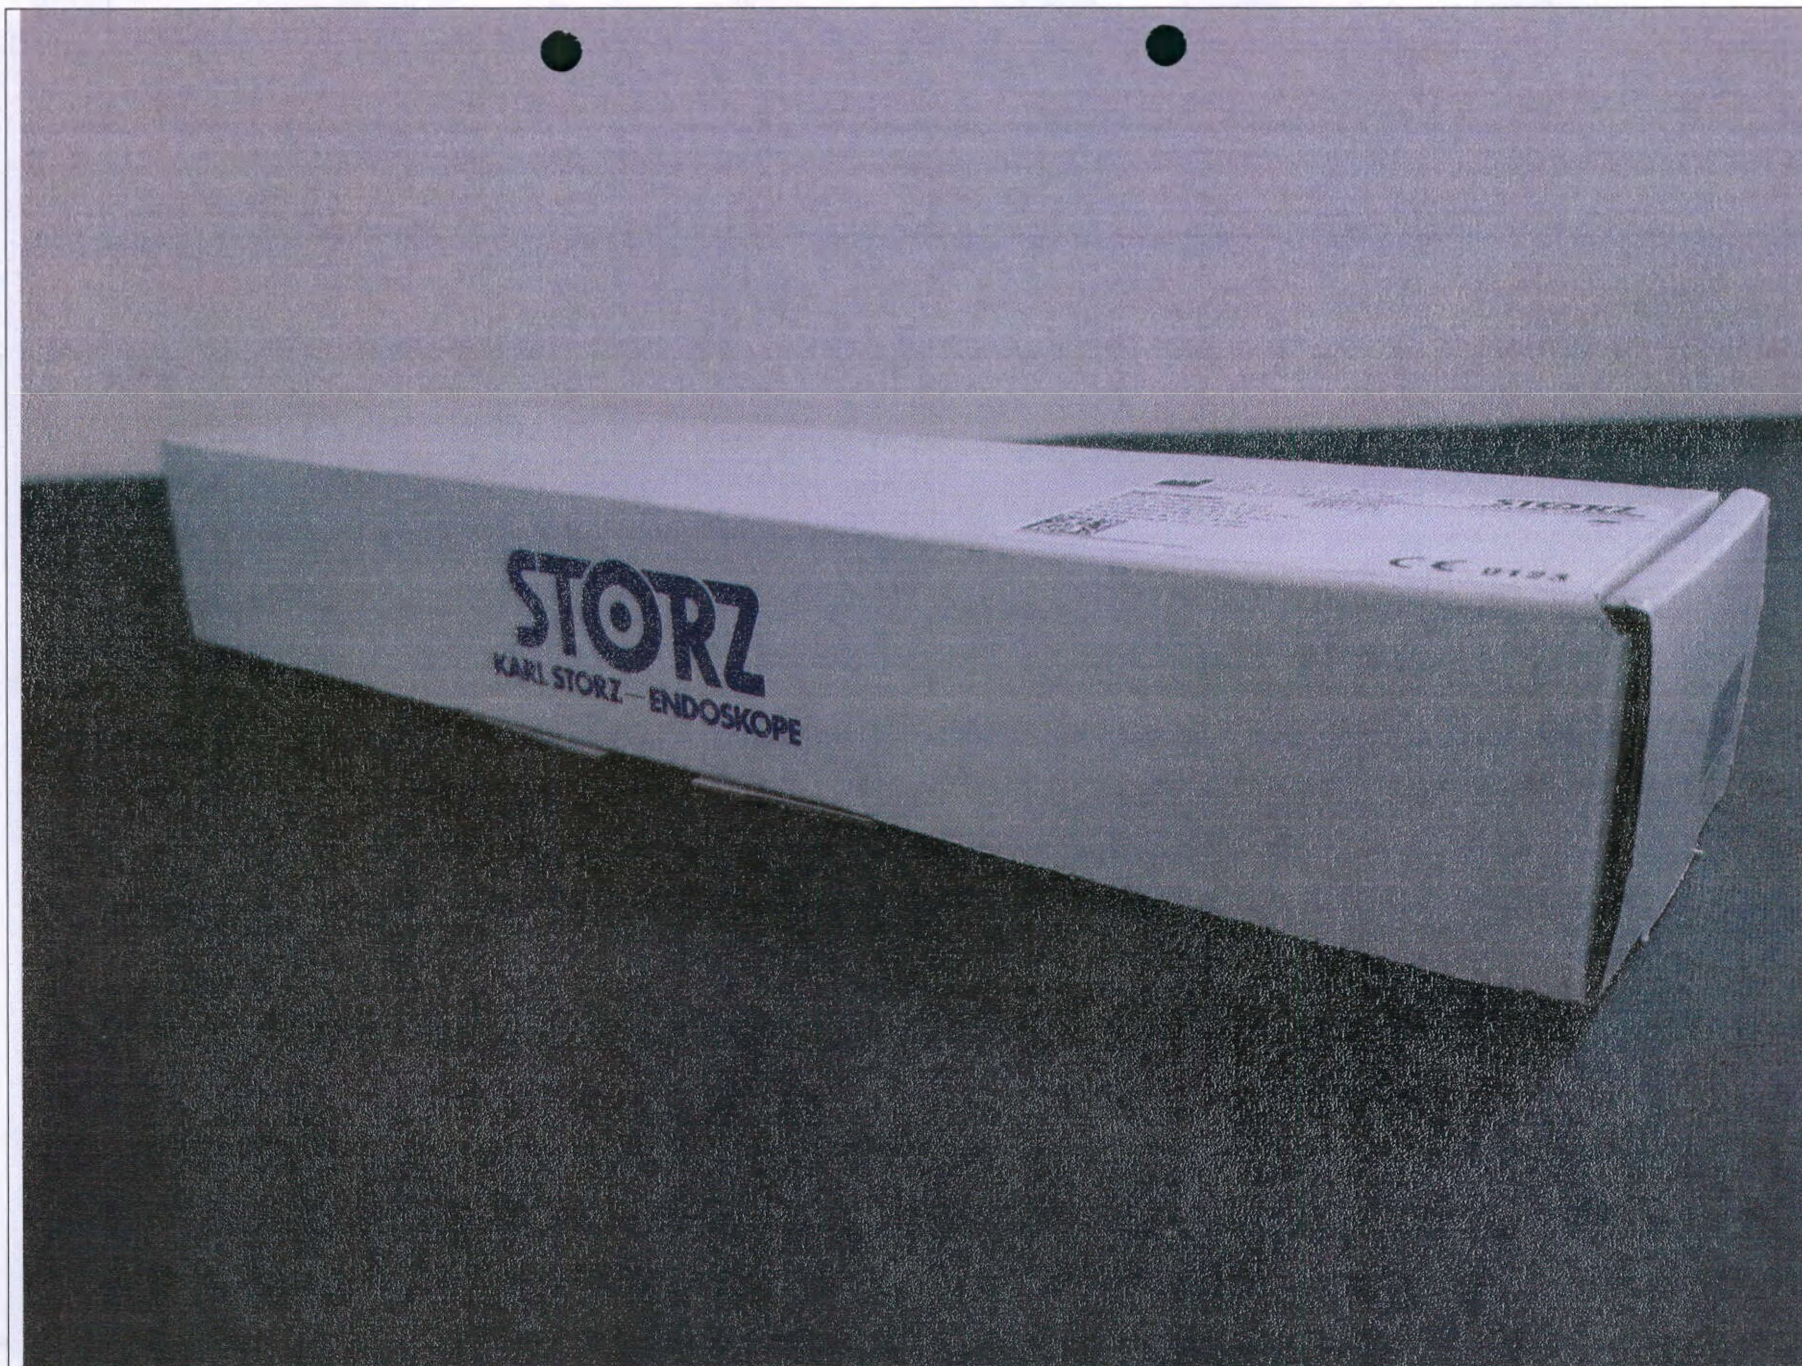


Рис. 77. Внешний тубус для гистероскопа В.І.О.Н. Упаковка.

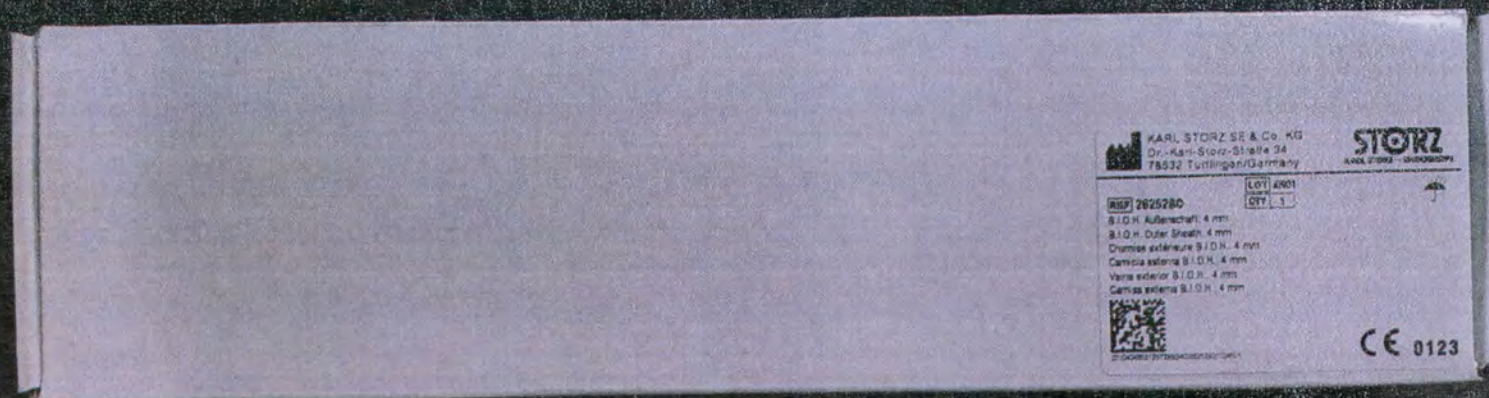


Рис. 78. Внешний тубус для гистероскопа B.I.O.H. Маркировка на упаковке.

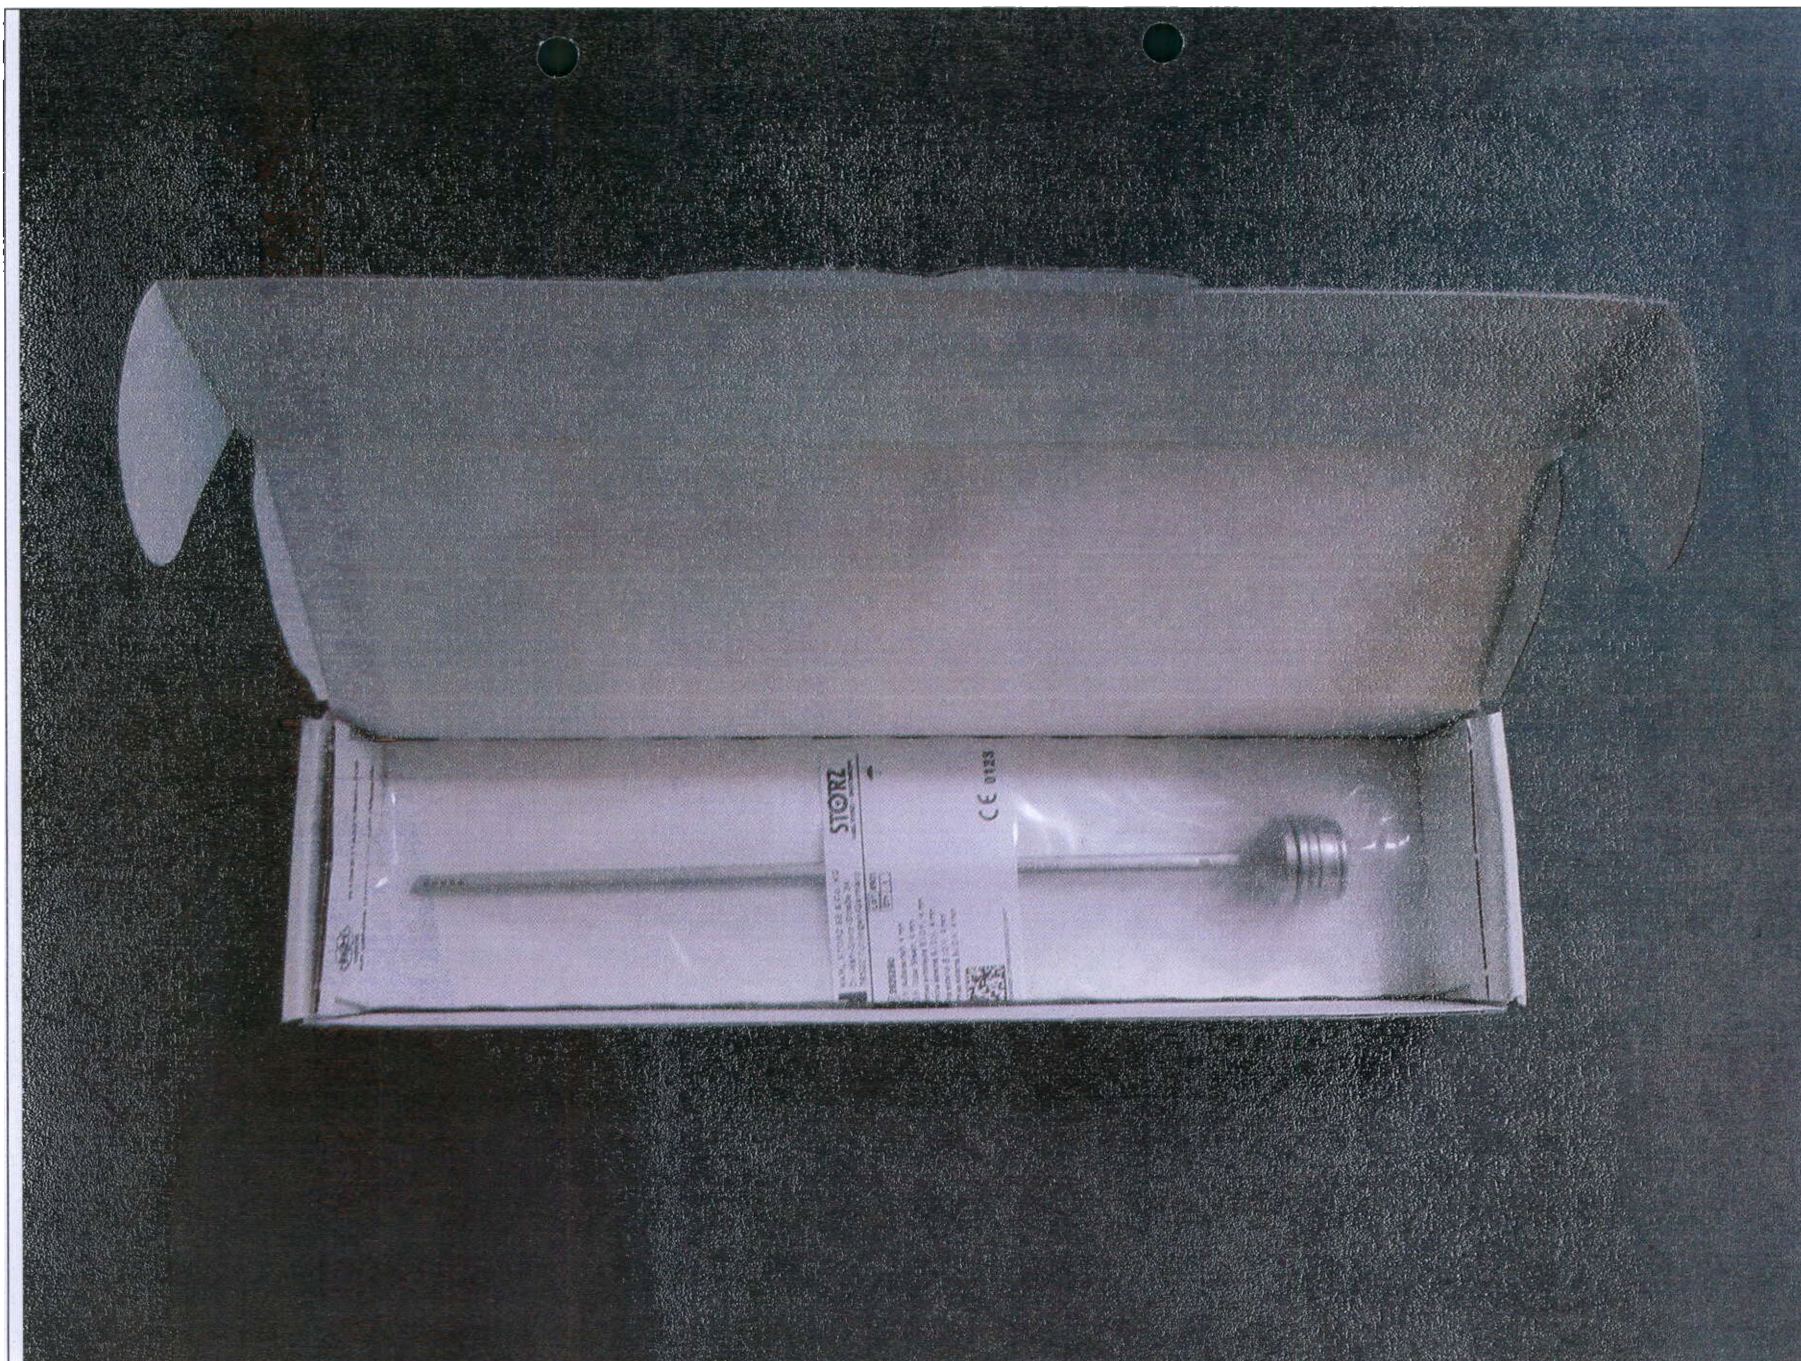


Рис. 79. Внешний тубус для гистероскопа В.І.О.Н



Рис. 80. Внешний тубус для гистероскопа В.І.О.Н

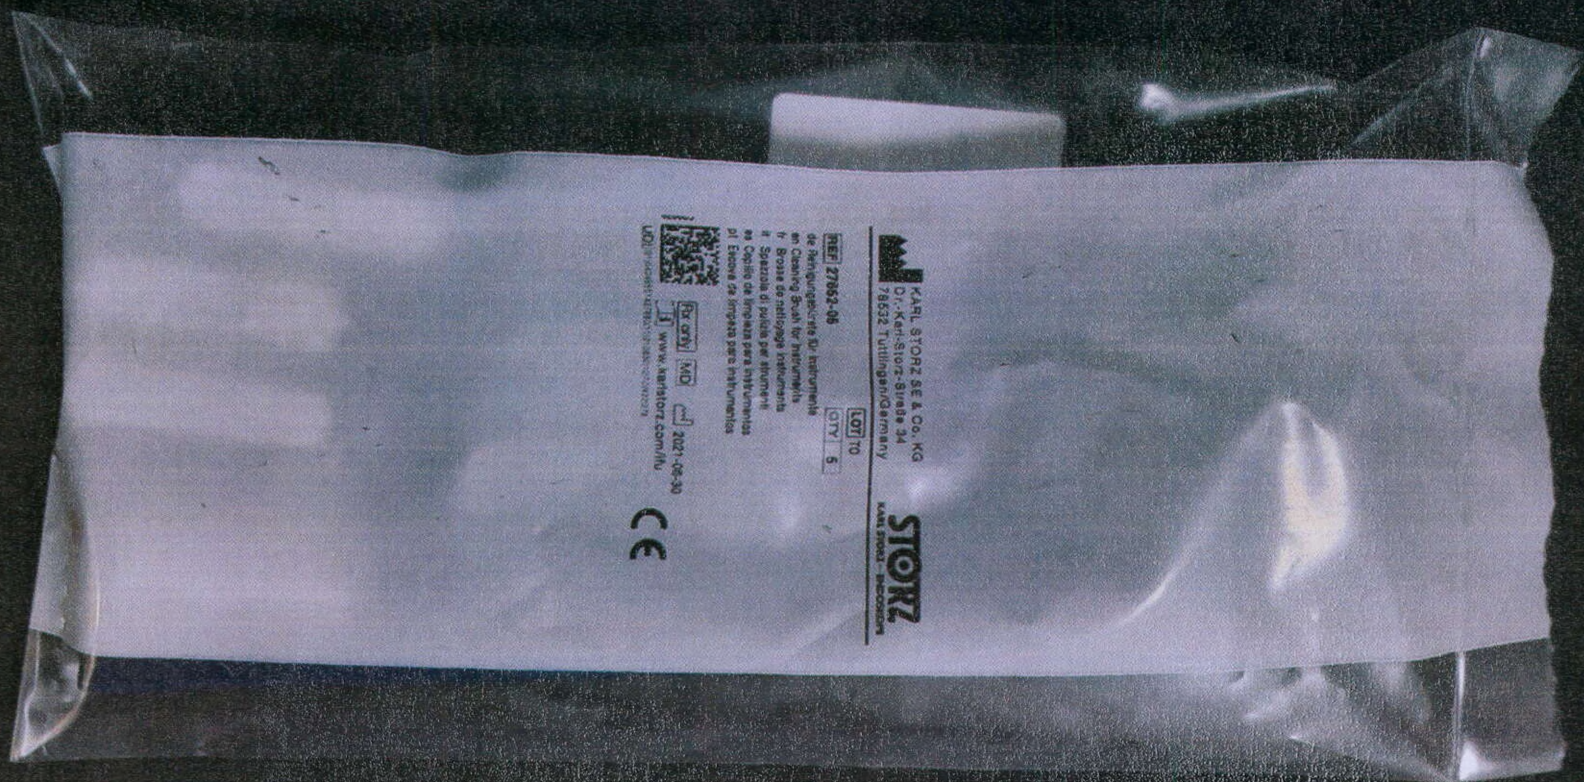


Рис. 81. Щетка плоская для очистки - 5 шт./уп. Первичная упаковка.

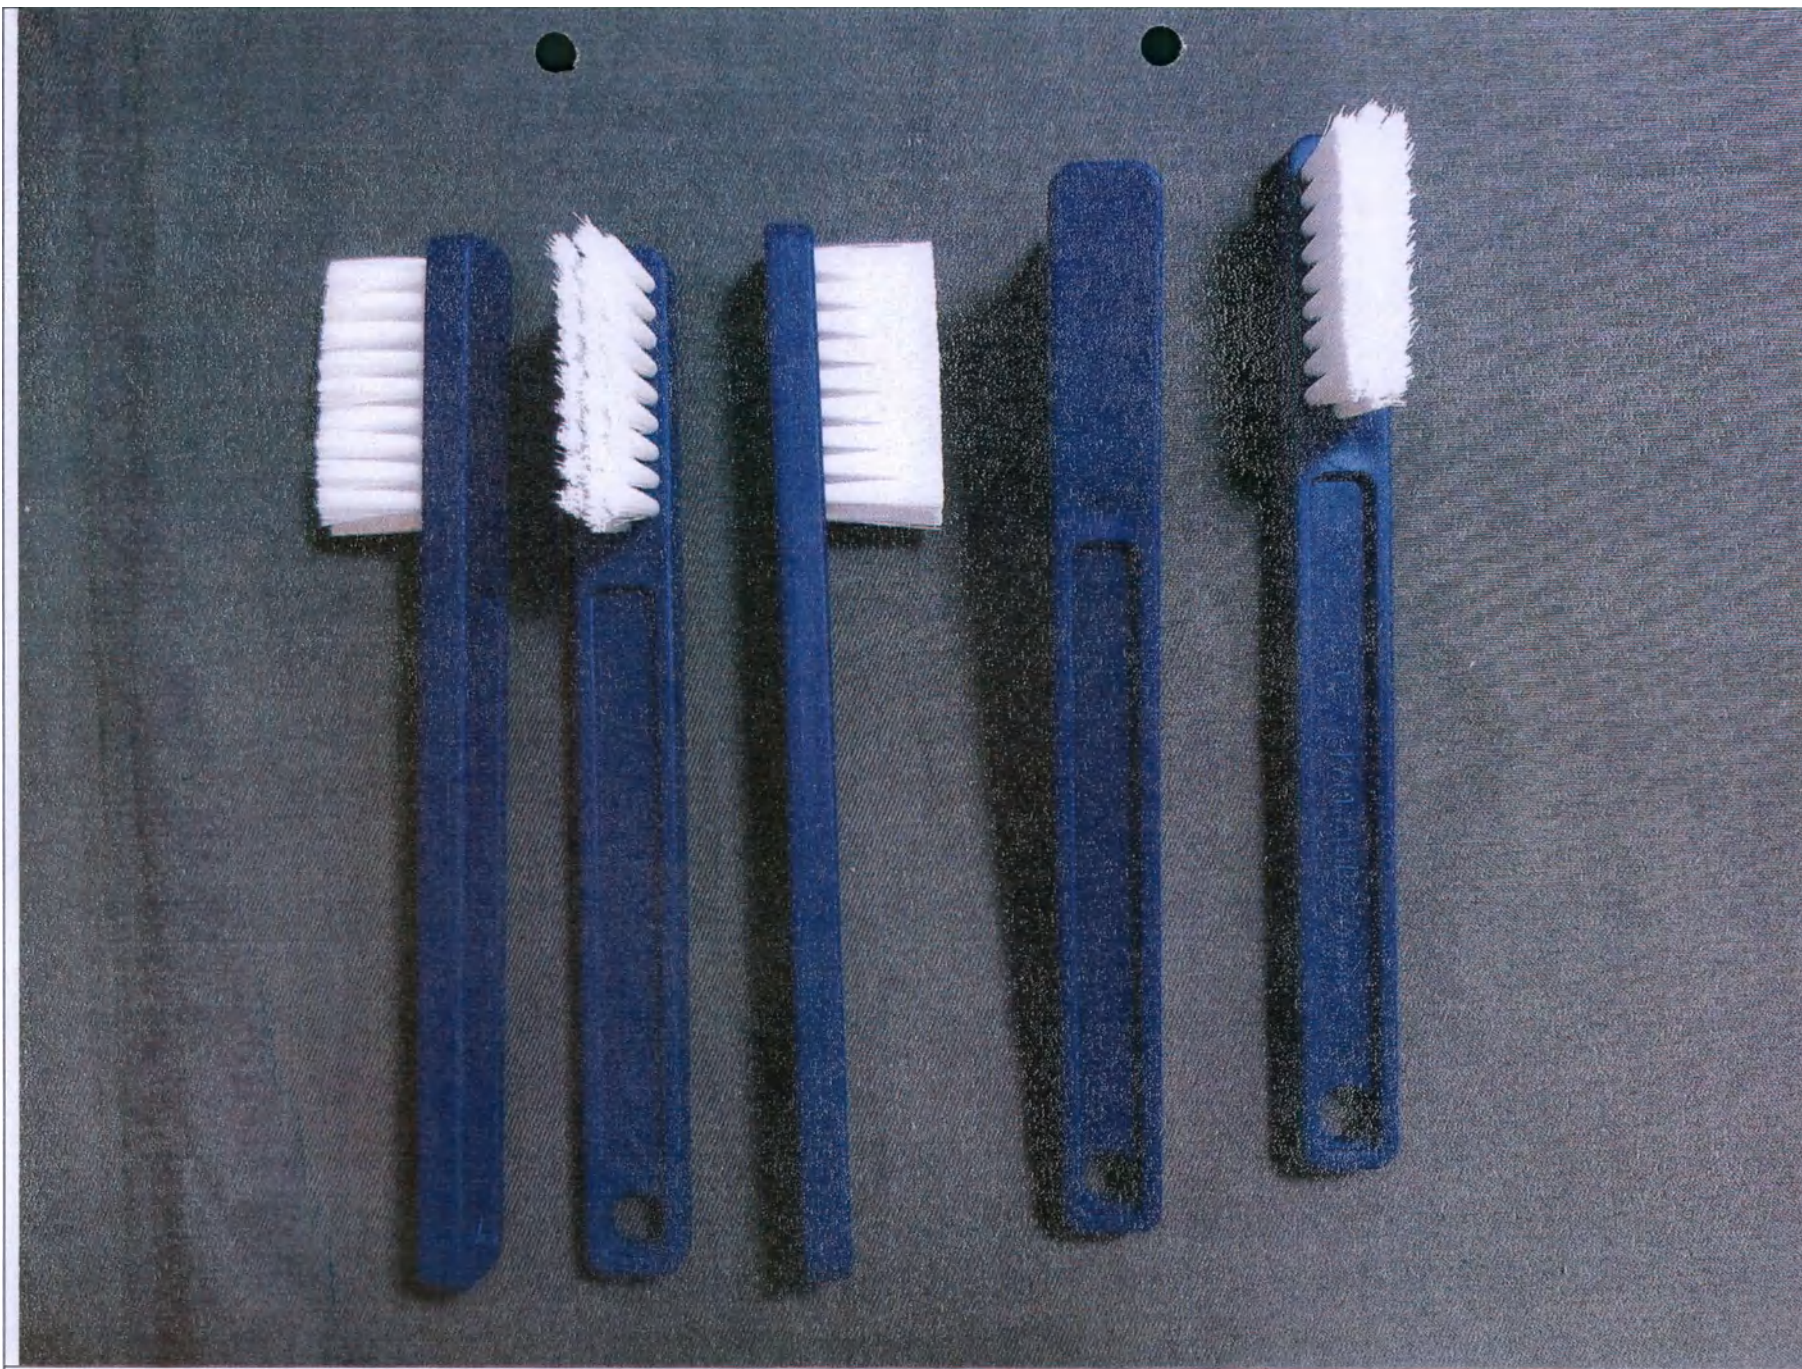


Рис. 82. Щетка плоская для очистки - 5 шт./уп

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE



Vertrieb durch/distributed by:
KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78582 Tuttlingen/Germany

EC REP

Shanghai International Trading Corp. (Shin)
Eimeng Road 80
204511 Shanghai/Germany



VDA
Karl Storz GmbH, Medizinische Instrumente, D-78582 Tuttlingen
Tel. +49 (0) 74 61 90-110, Fax +49 (0) 74 61 90-111
E-Mail: info@k.storz.de, www.k.storz.de

110932-50

REF AF-D1320MT

QTY 50 x 1: 110932-01

Reinigungsbürste, 200 cm
Cleaning Brush, 200 cm
Brosse de nettoyage, 200cm
Spazzola per pulizia, 200 cm
Escova de limpeza, 200 cm
Cepillo de limpieza, 200 cm
Für/ for/ pour/ per/ para:
Flexible endoscopes with working channels
ranging from diameter 1.2 - 1.5 mm



RxOnly



Do not sterilize



2021-04-02 LOT 210402



110932-50

Рис. 83. Щетка для очистки, одноразовая, длина 200 см (110932-50) – 50 шт./уп. Упаковка.

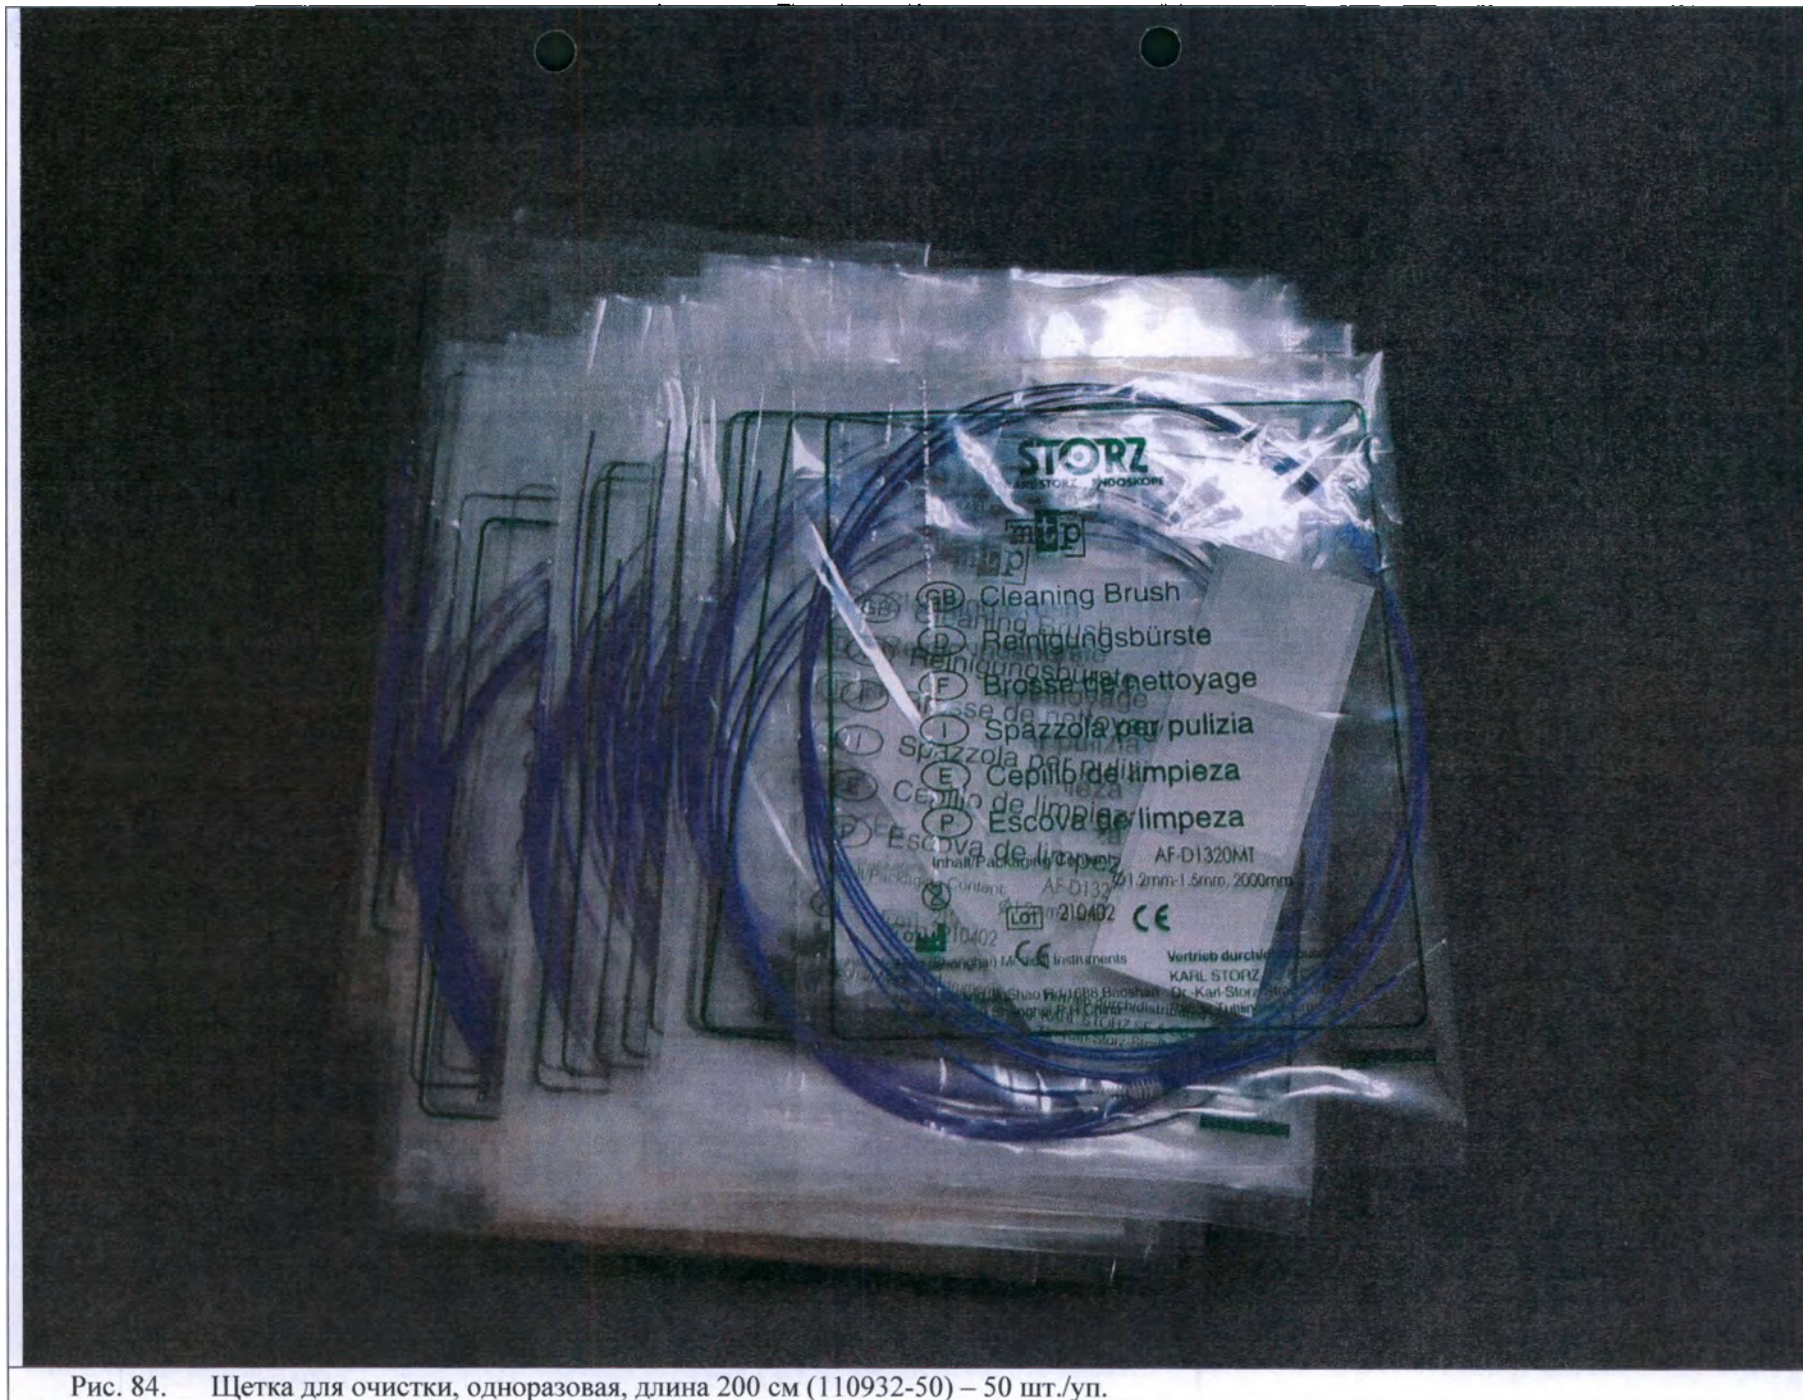


Рис. 84. Щетка для очистки, одноразовая, длина 200 см (110932-50) – 50 шт./уп.

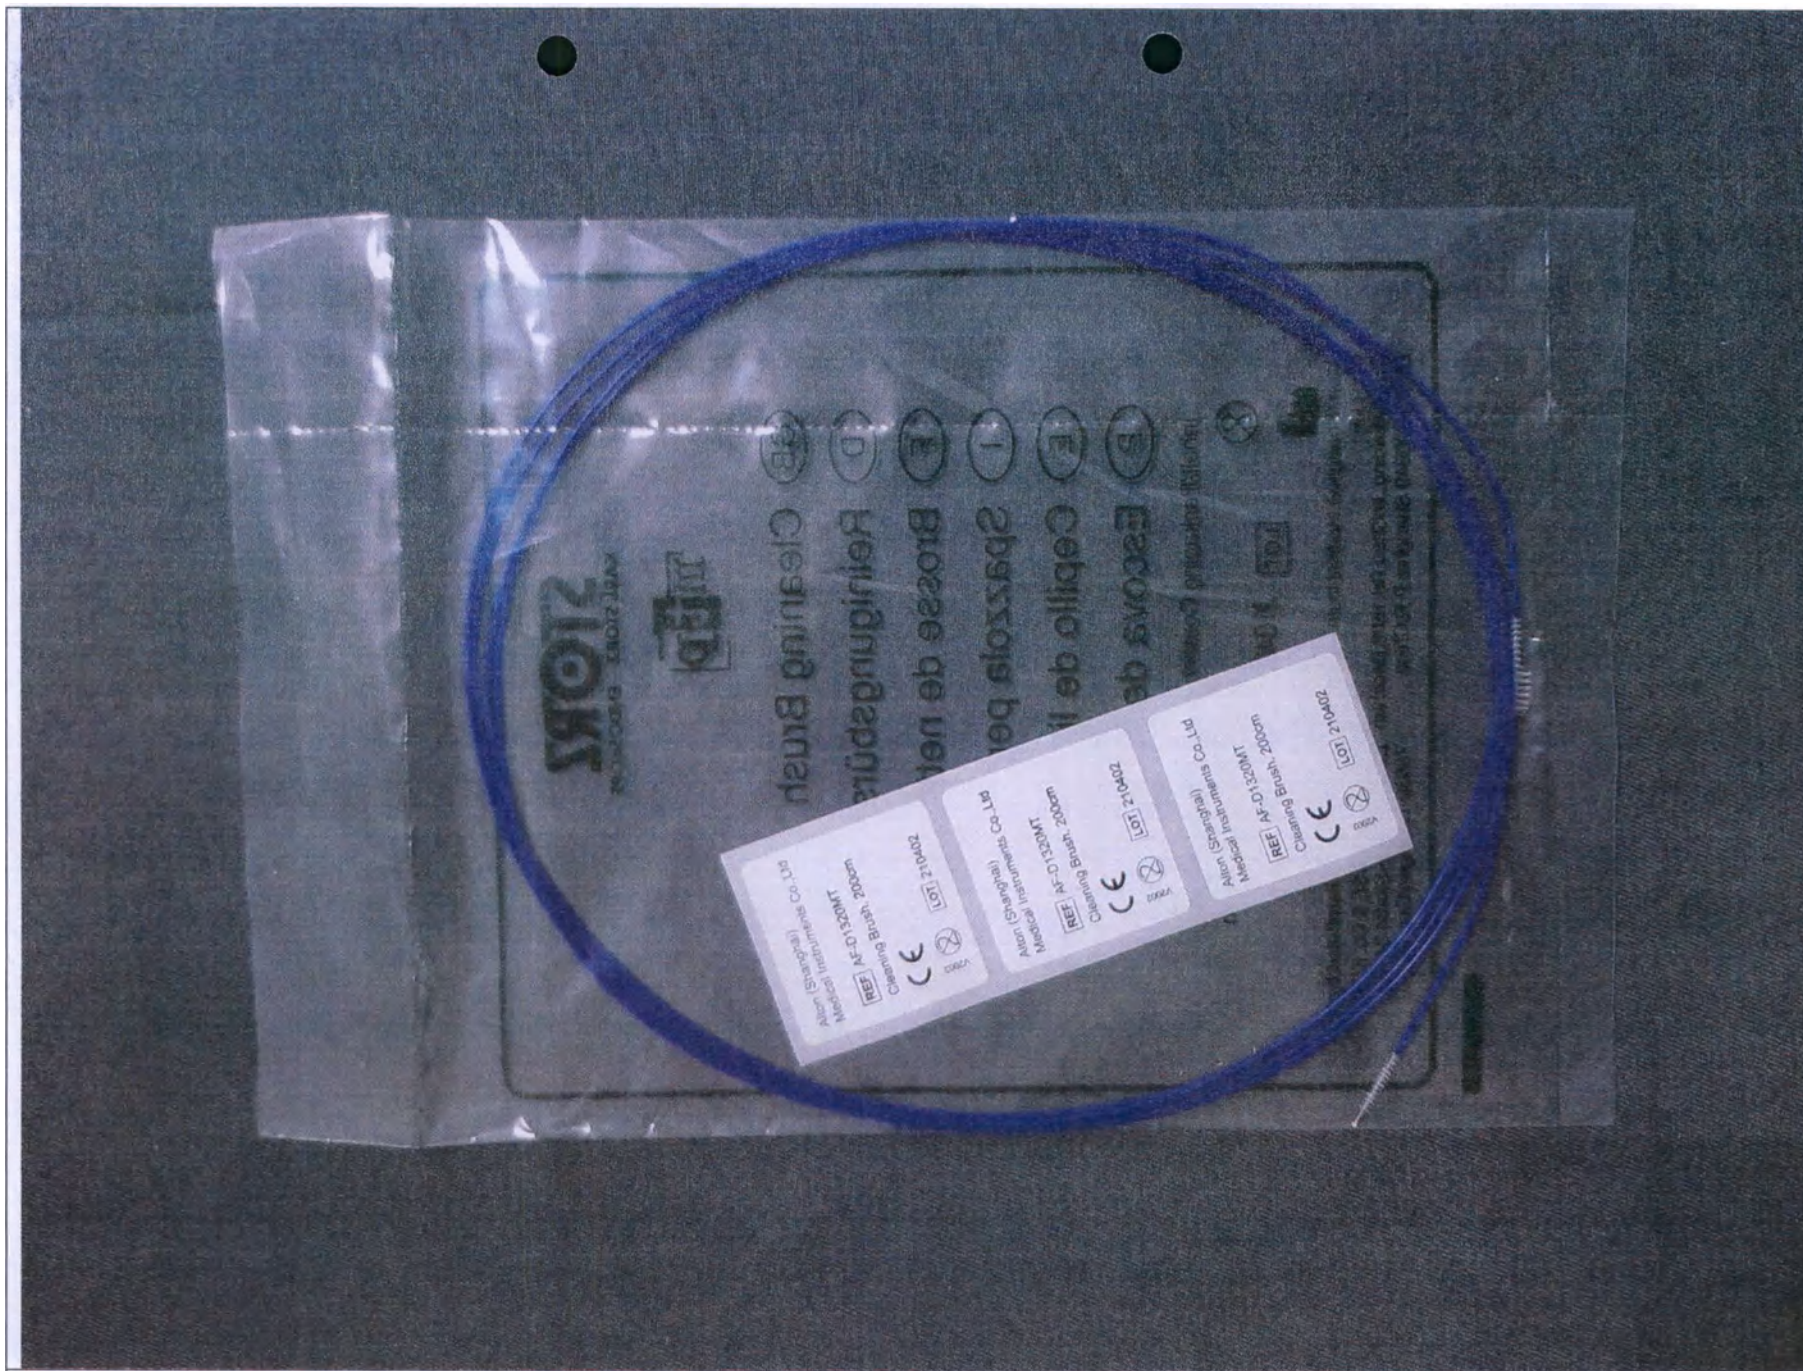


Рис. 85. Щетка для очистки, одноразовая, длина 200 см (110932-50) – 50 шт./уп.

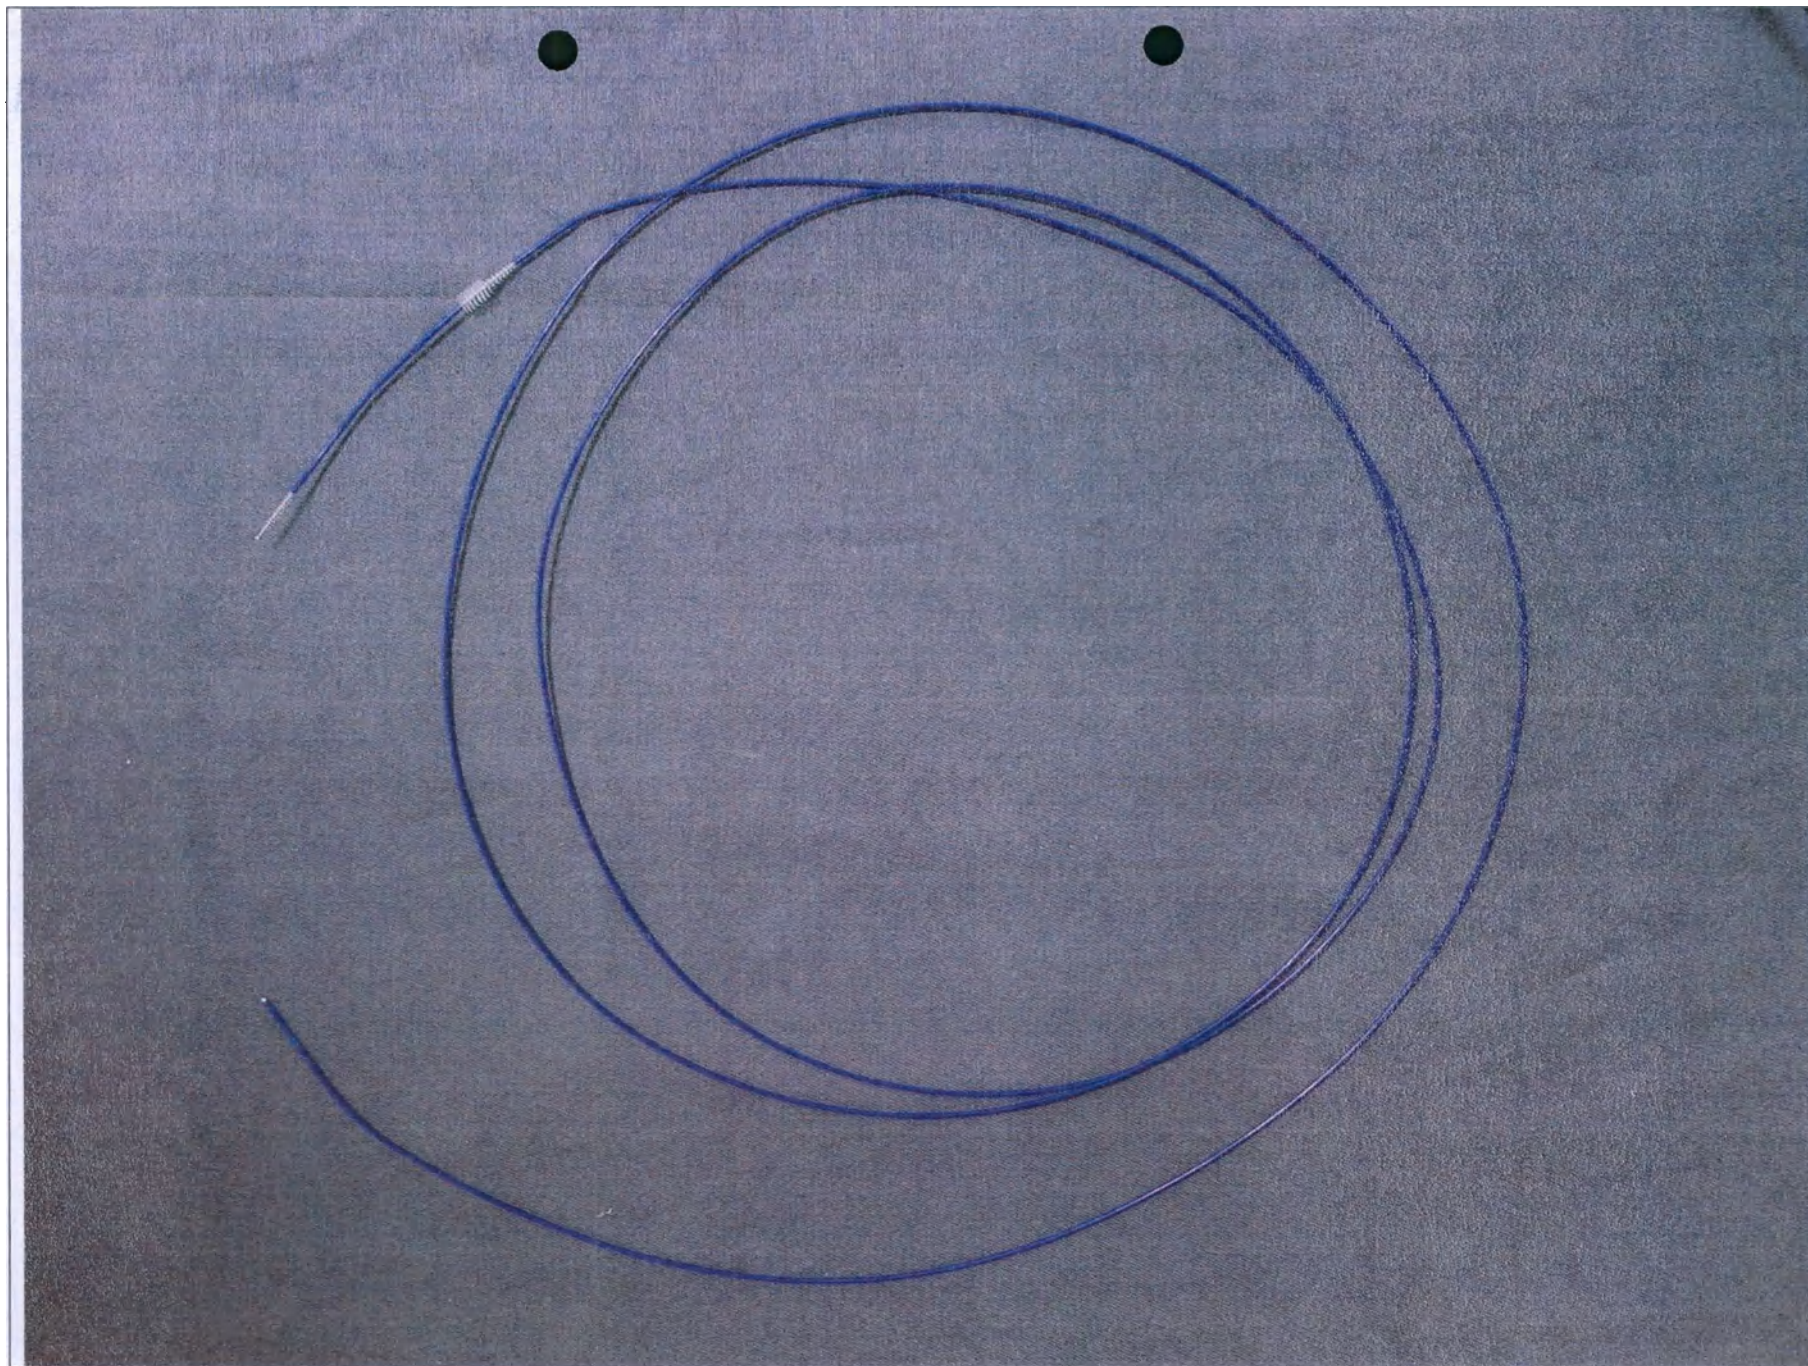


Рис. 86. Щетка для очистки, одноразовая, длина 200 см (110932-50) – 50 шт./уп.

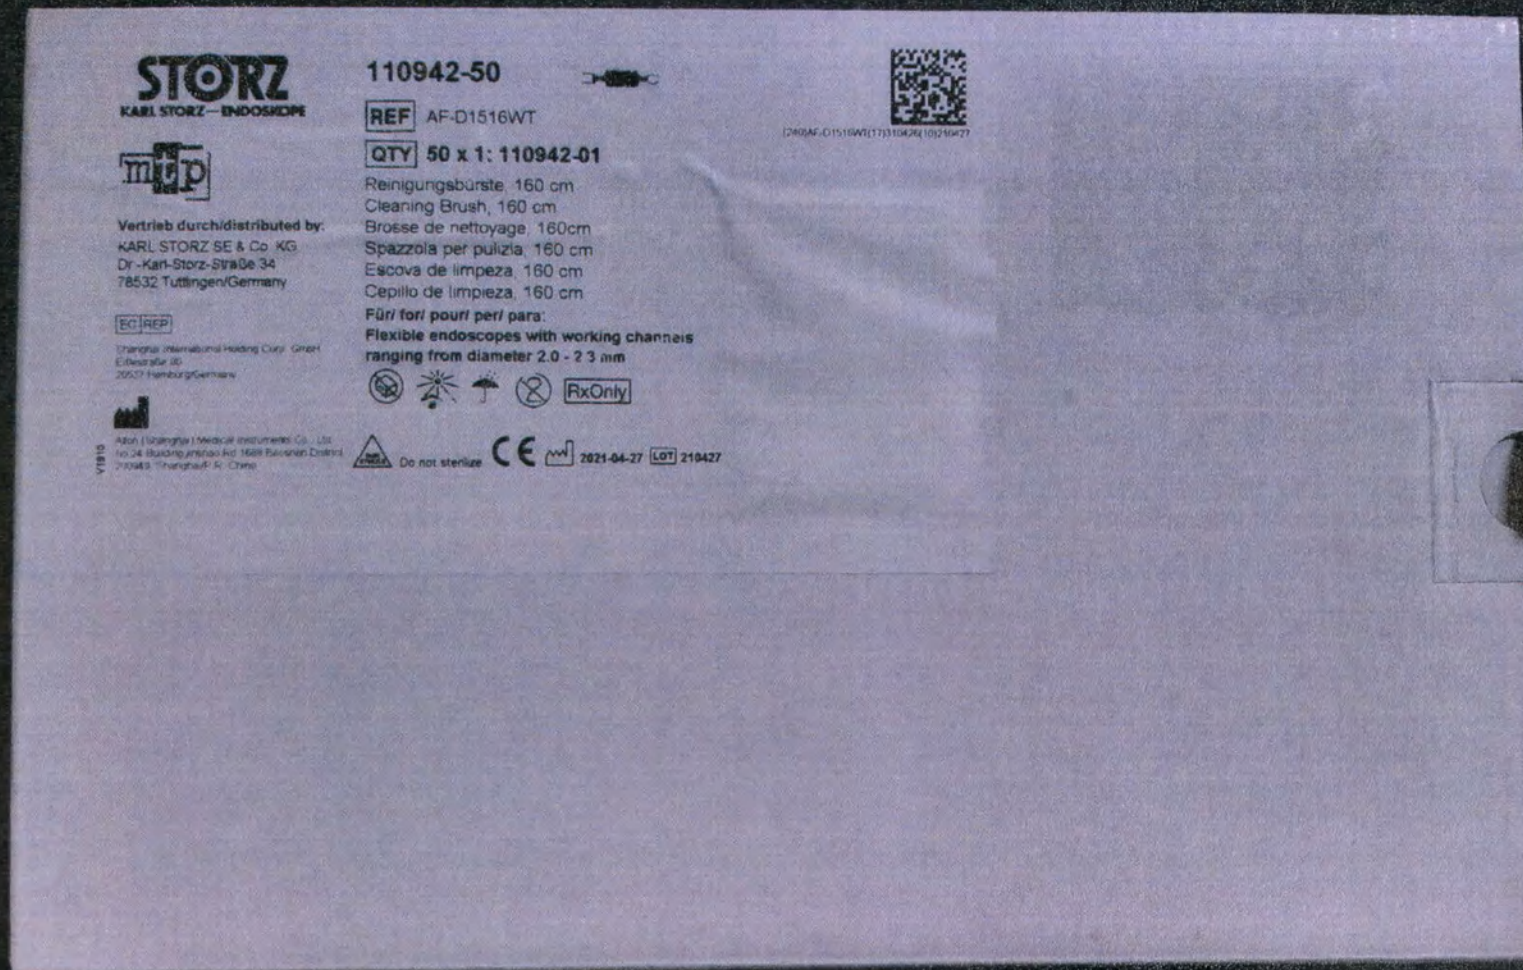


Рис. 87. Щетка для очистки, одноразовая, длина 160 см (110942-50) – 50 шт./уп. Упаковка.

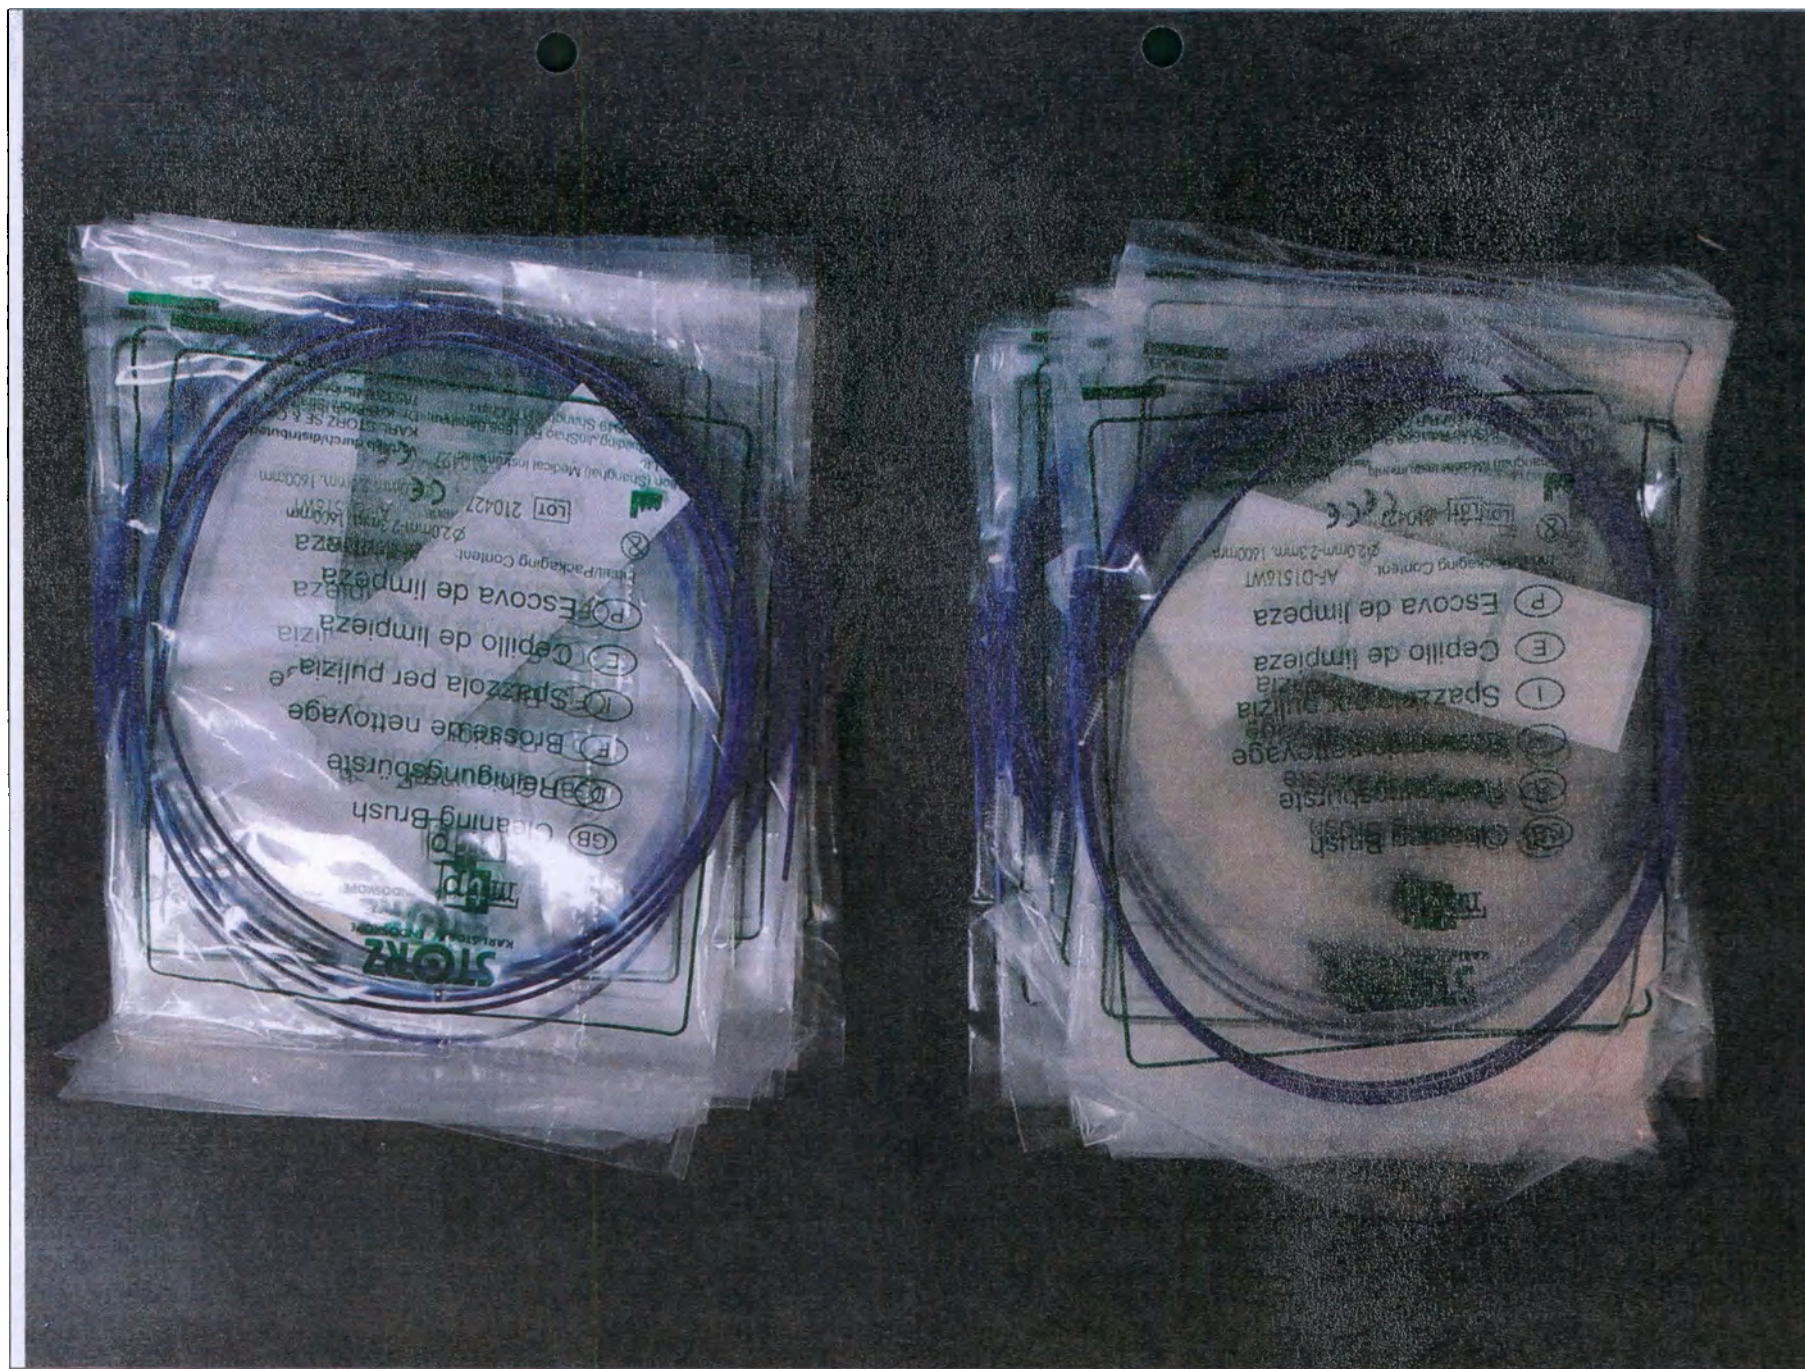


Рис. 88. Щетка для очистки, одноразовая, длина 160 см (110942-50) – 50 шт./уп.

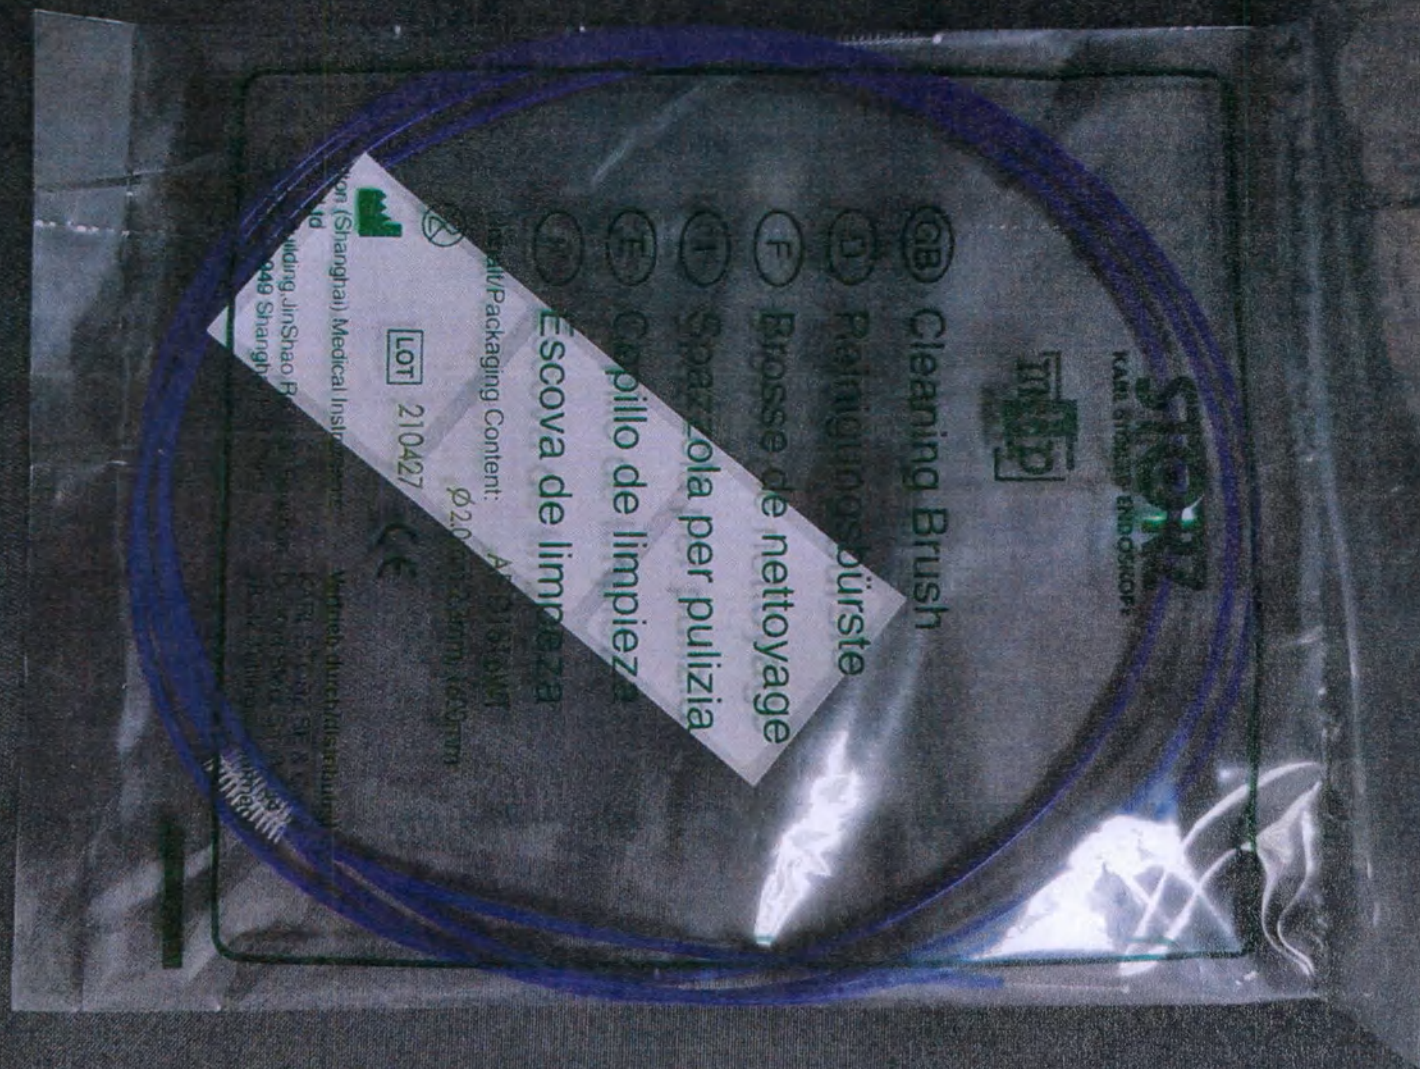


Рис. 89. Щетка для очистки, одноразовая, длина 160 см (110942-50) – 50 шт./уп.

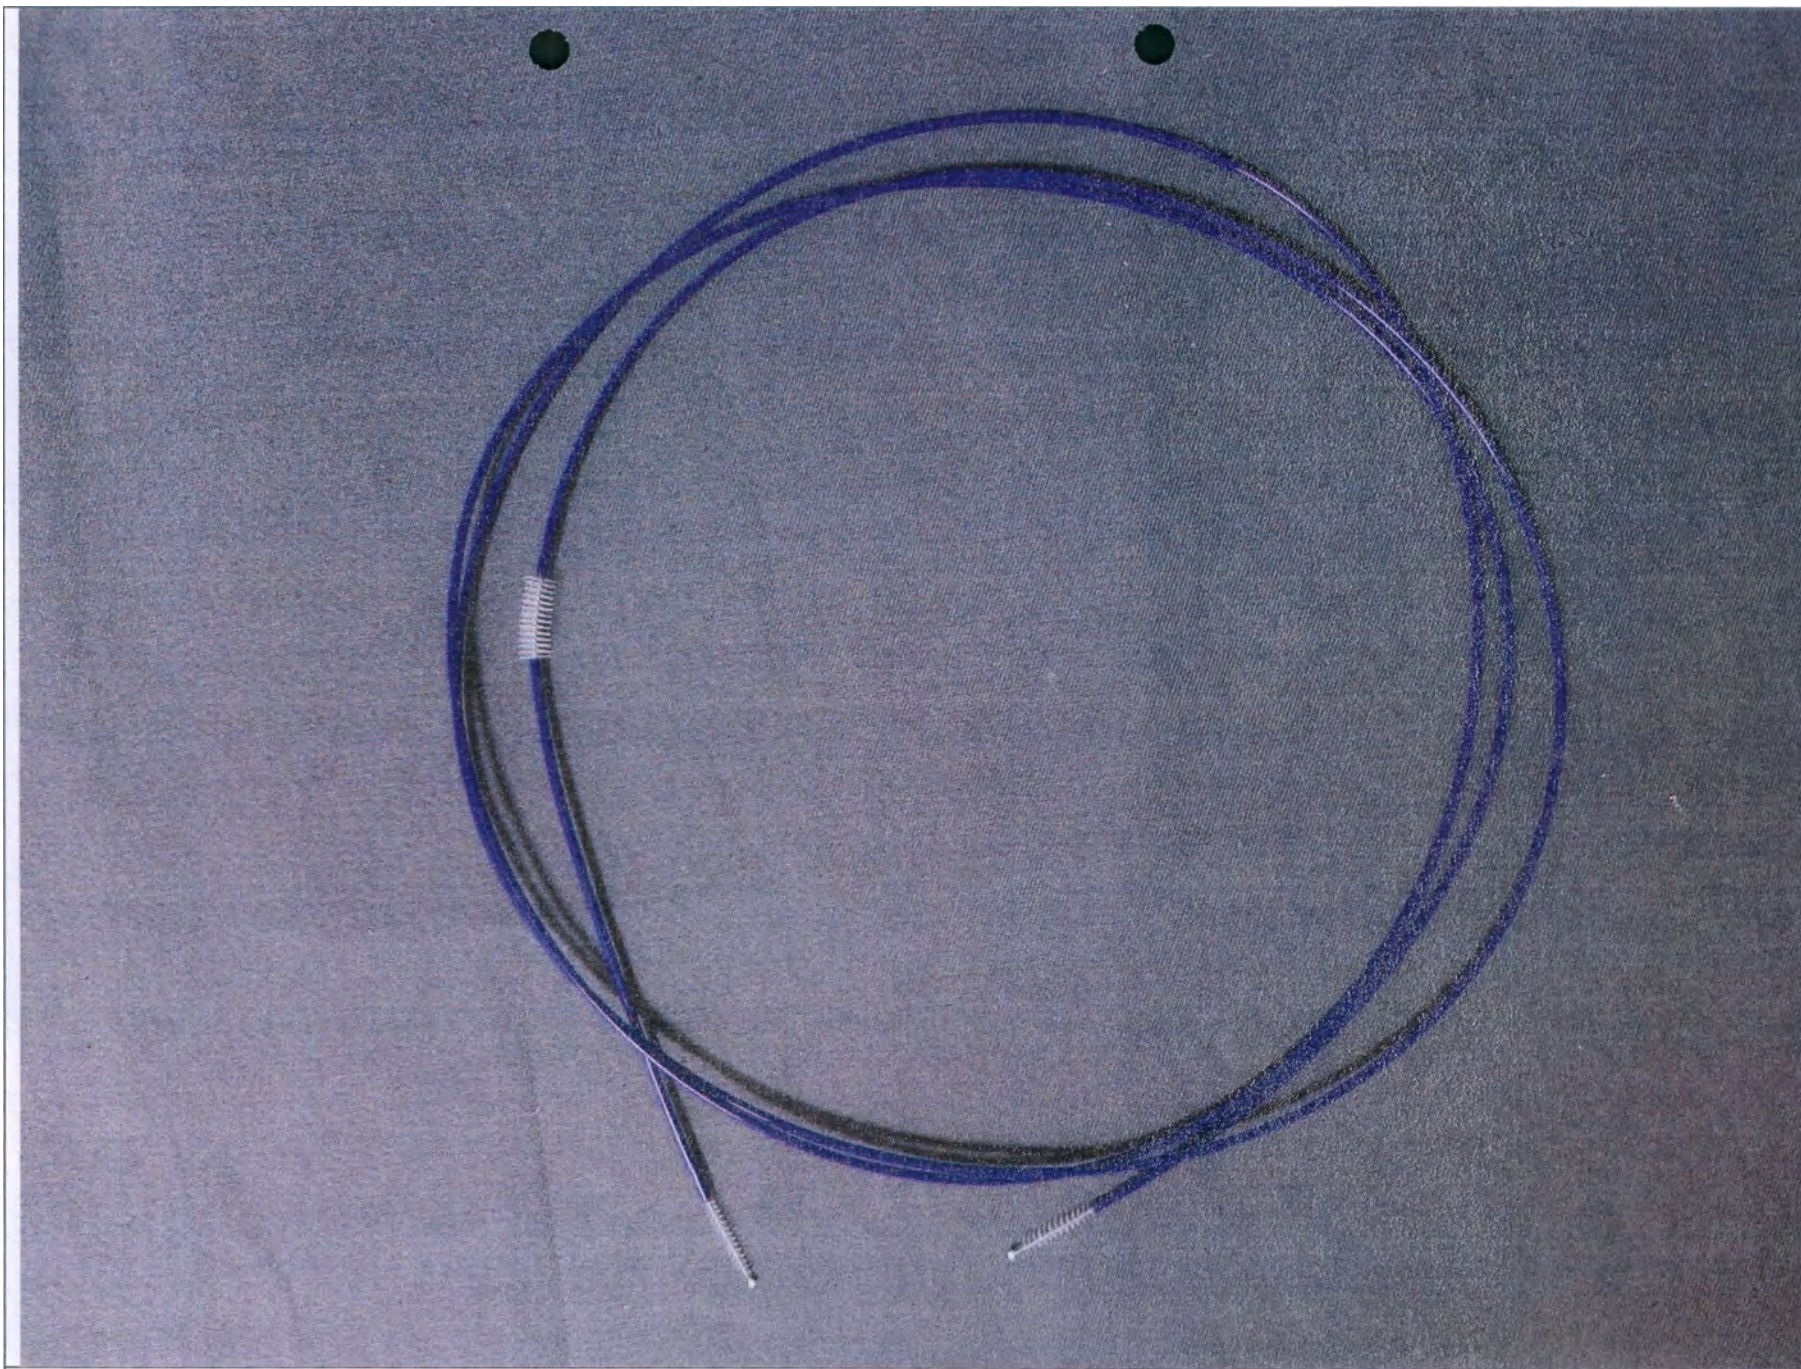


Рис. 90. Щетка для очистки, одноразовая, длина 160 см (110942-50) – 50 шт./уп.

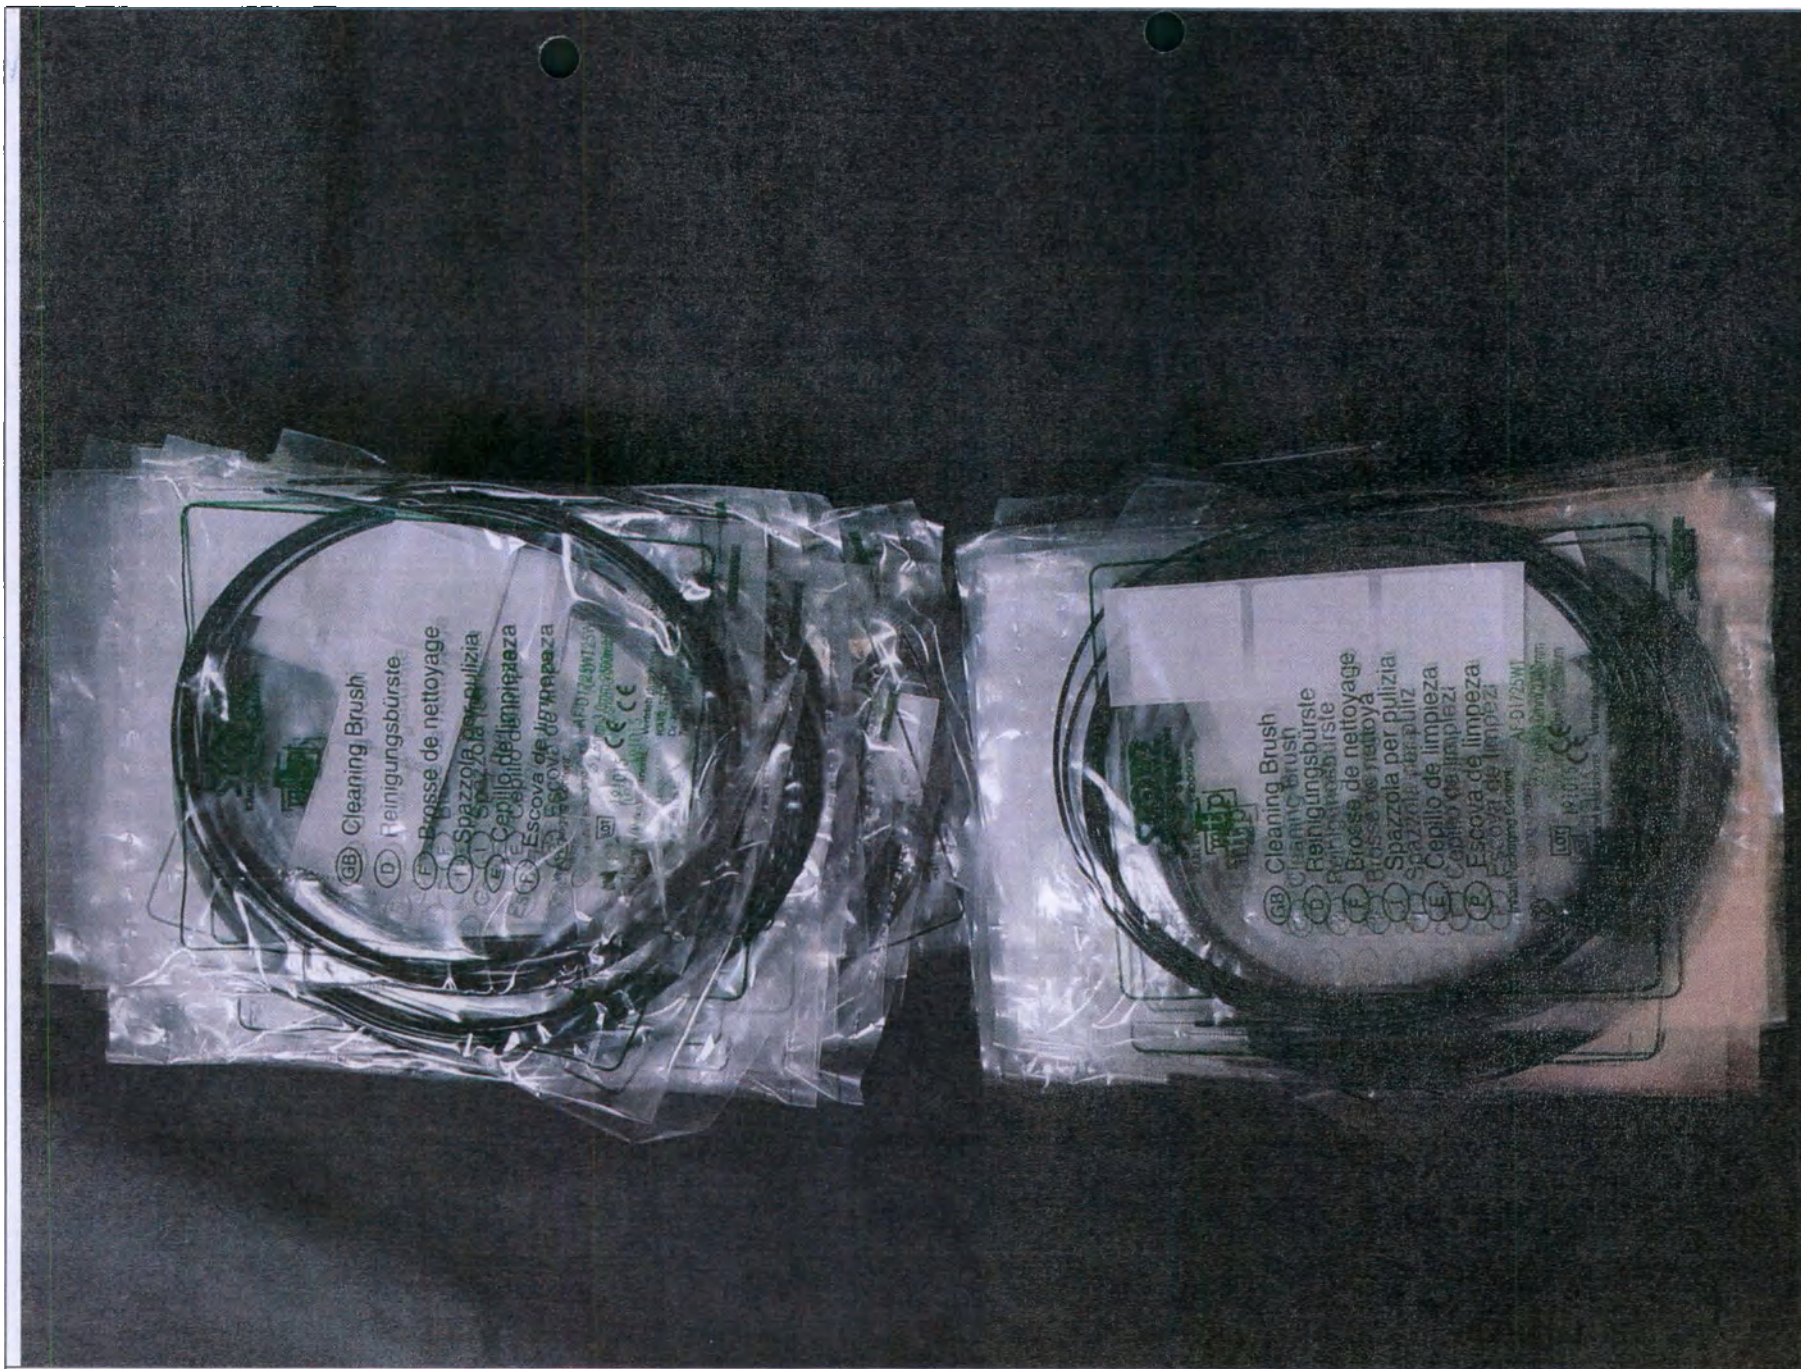


Рис. 92. Щетка для очистки, одноразовая, длина 250 см (110952-50) – 50 шт./уп.



Рис. 93. Щетка для очистки, одноразовая, длина 250 см (110952-50) – 50 шт./уп.

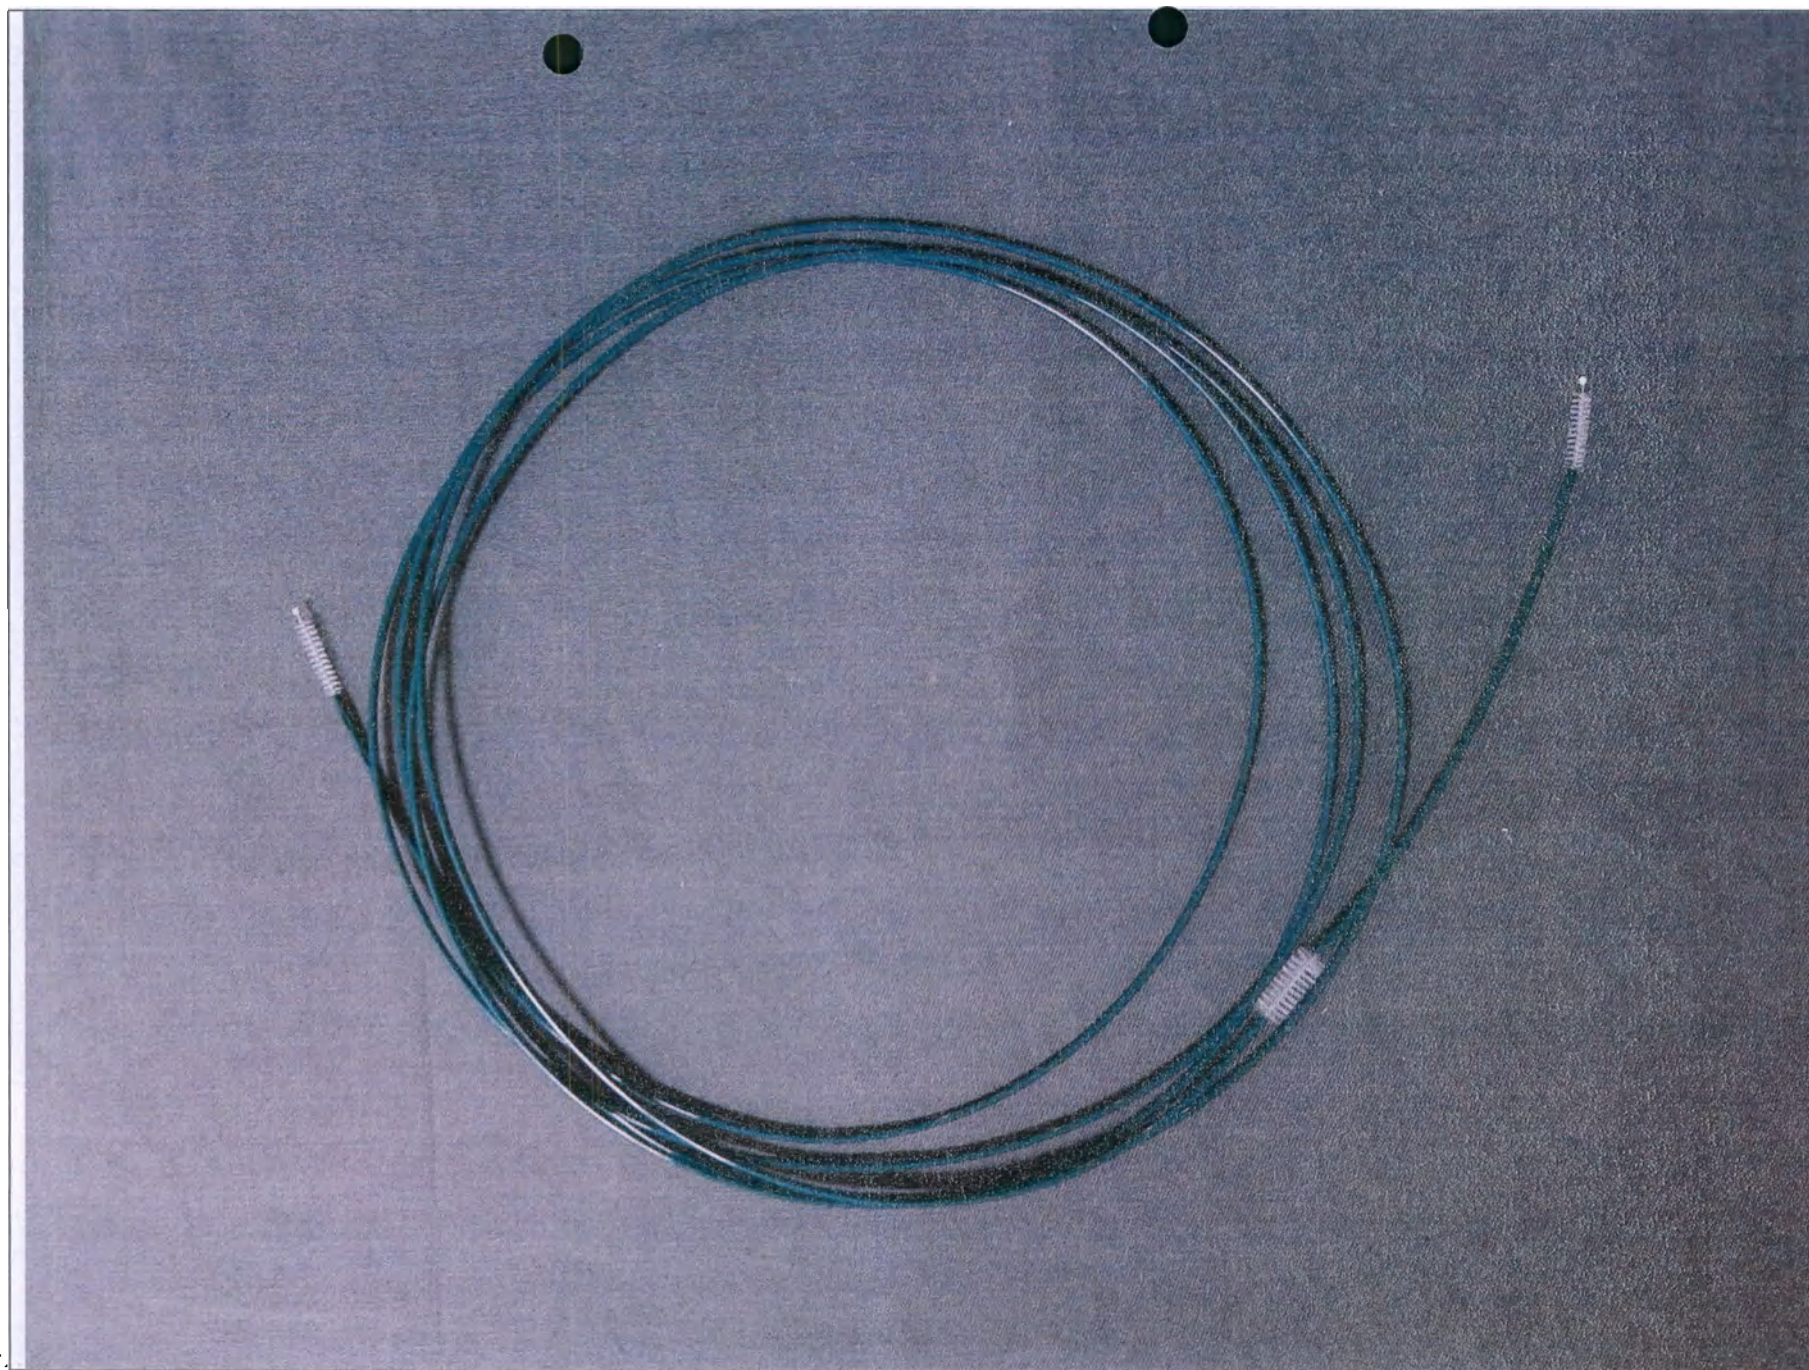


Рис. 94. Щетка для очистки, одноразовая, длина 250 см (110952-50) – 50 шт./уп.

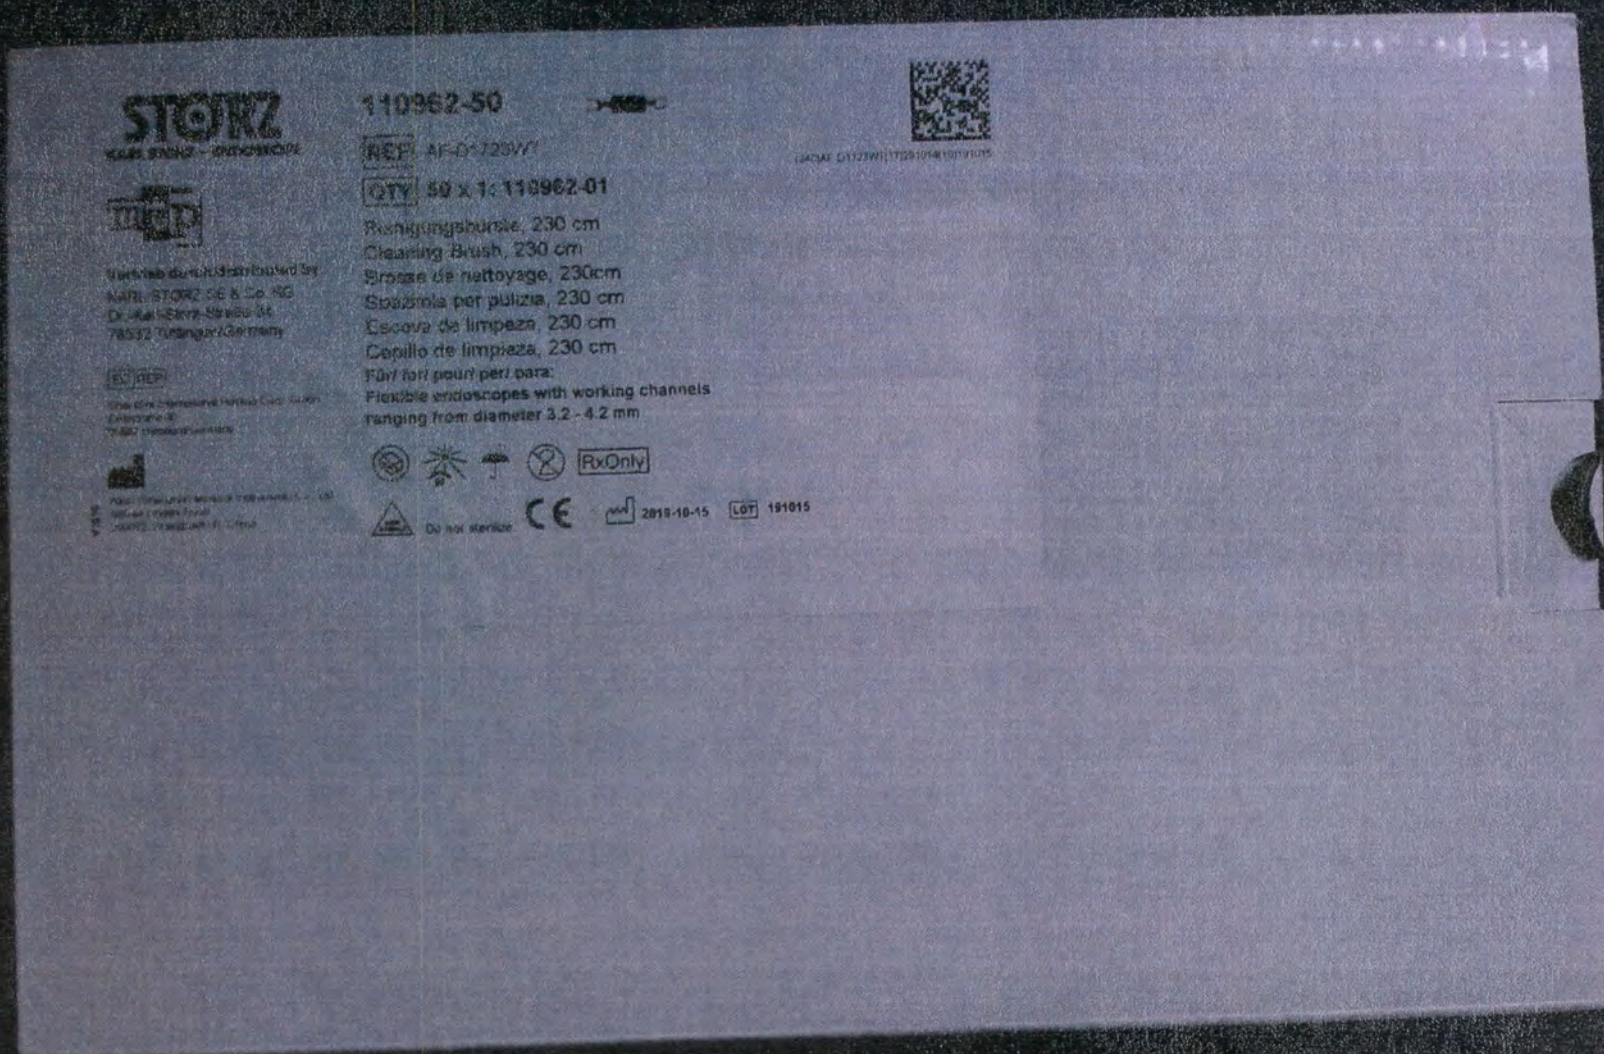


Рис. 95. Щетка для очистки, одноразовая, длина 230 см (110962-50) – 50 шт./уп. Упаковка.

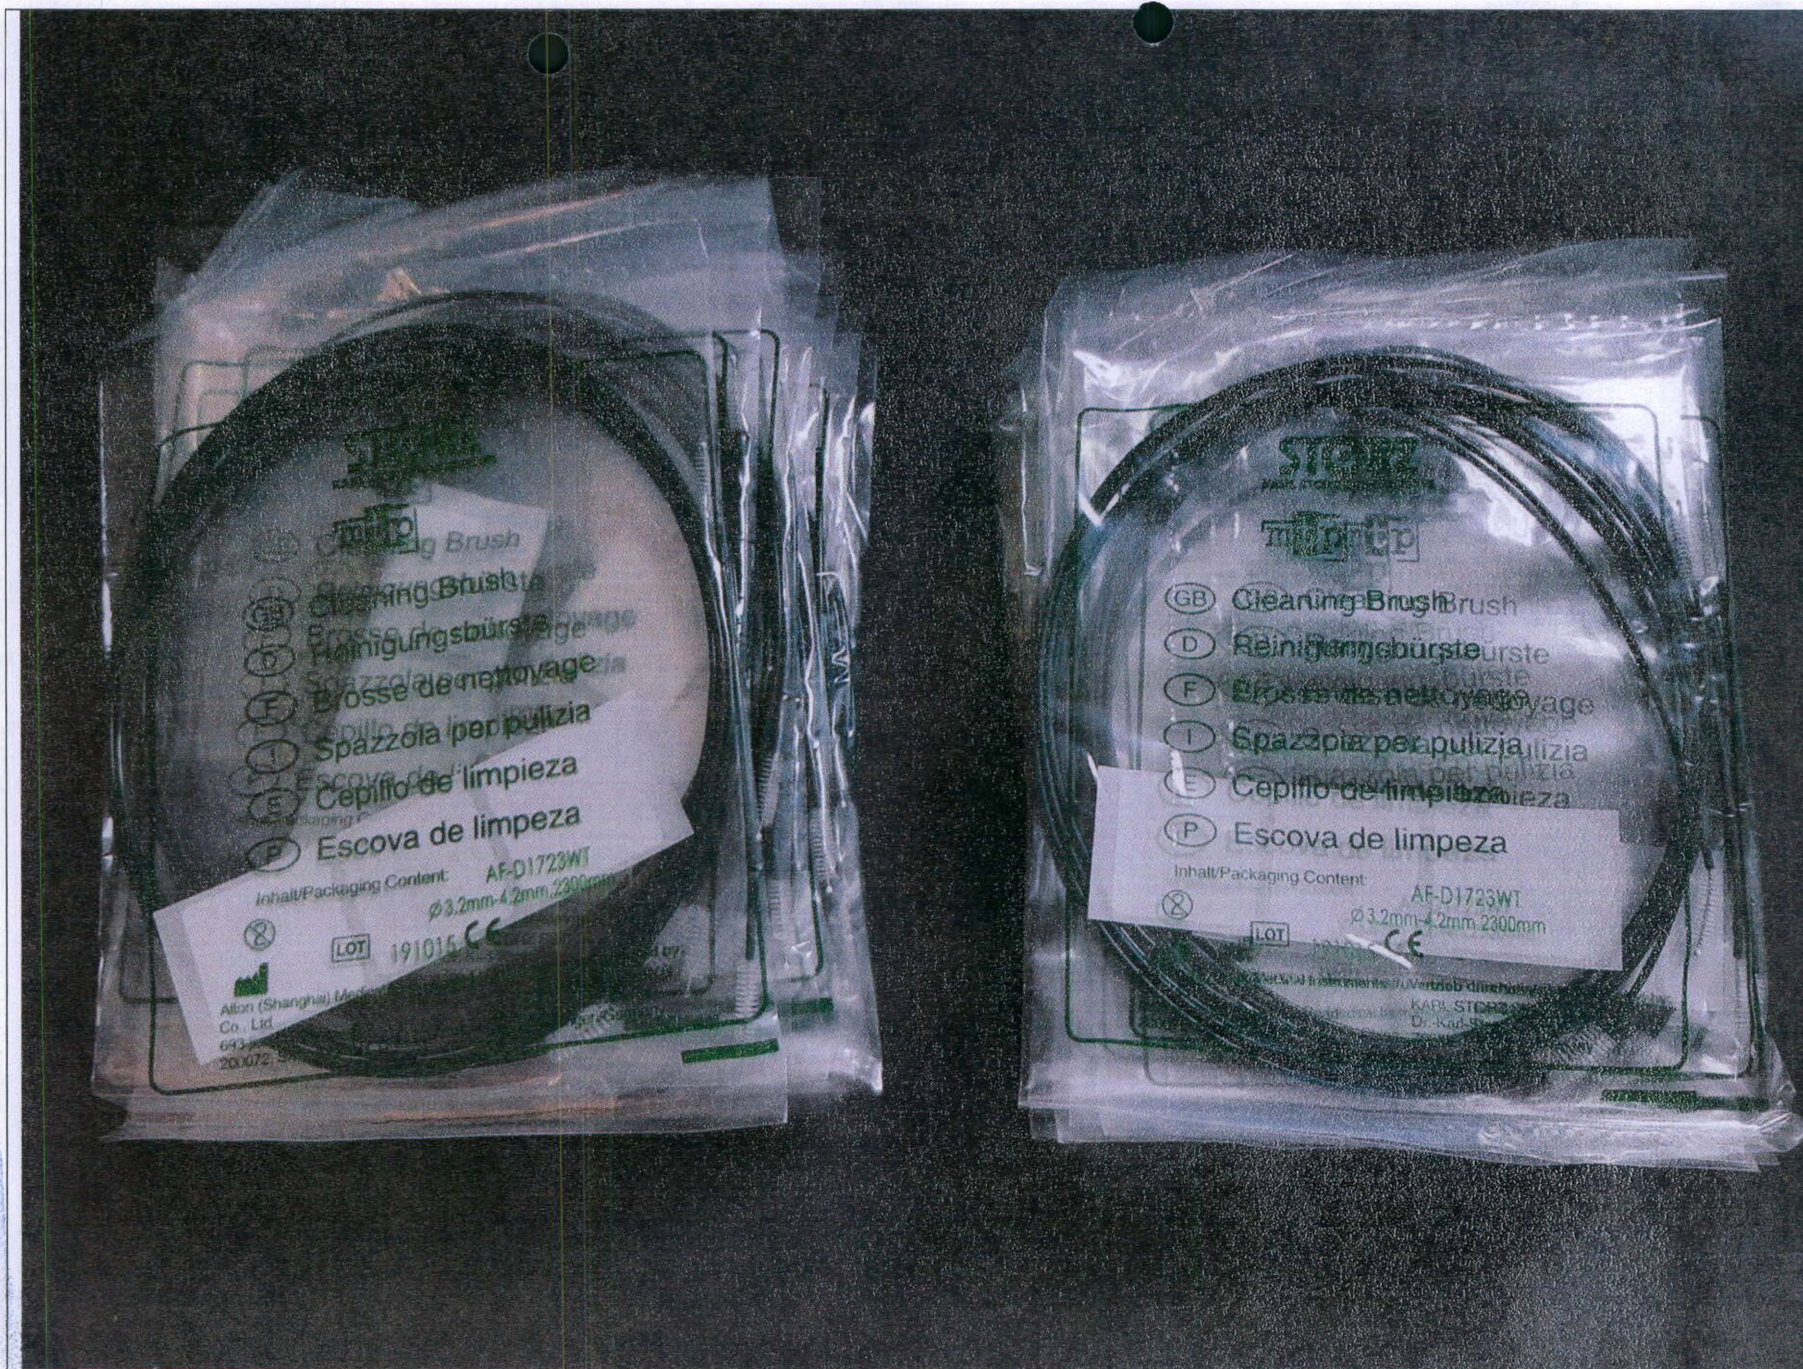


Рис. 96. Щетка для очистки, одноразовая, длина 230 см (110962-50) – 50 шт./уп.



Рис. 97. Щетка для очистки, одноразовая, длина 230 см (110962-50) – 50 шт./уп.

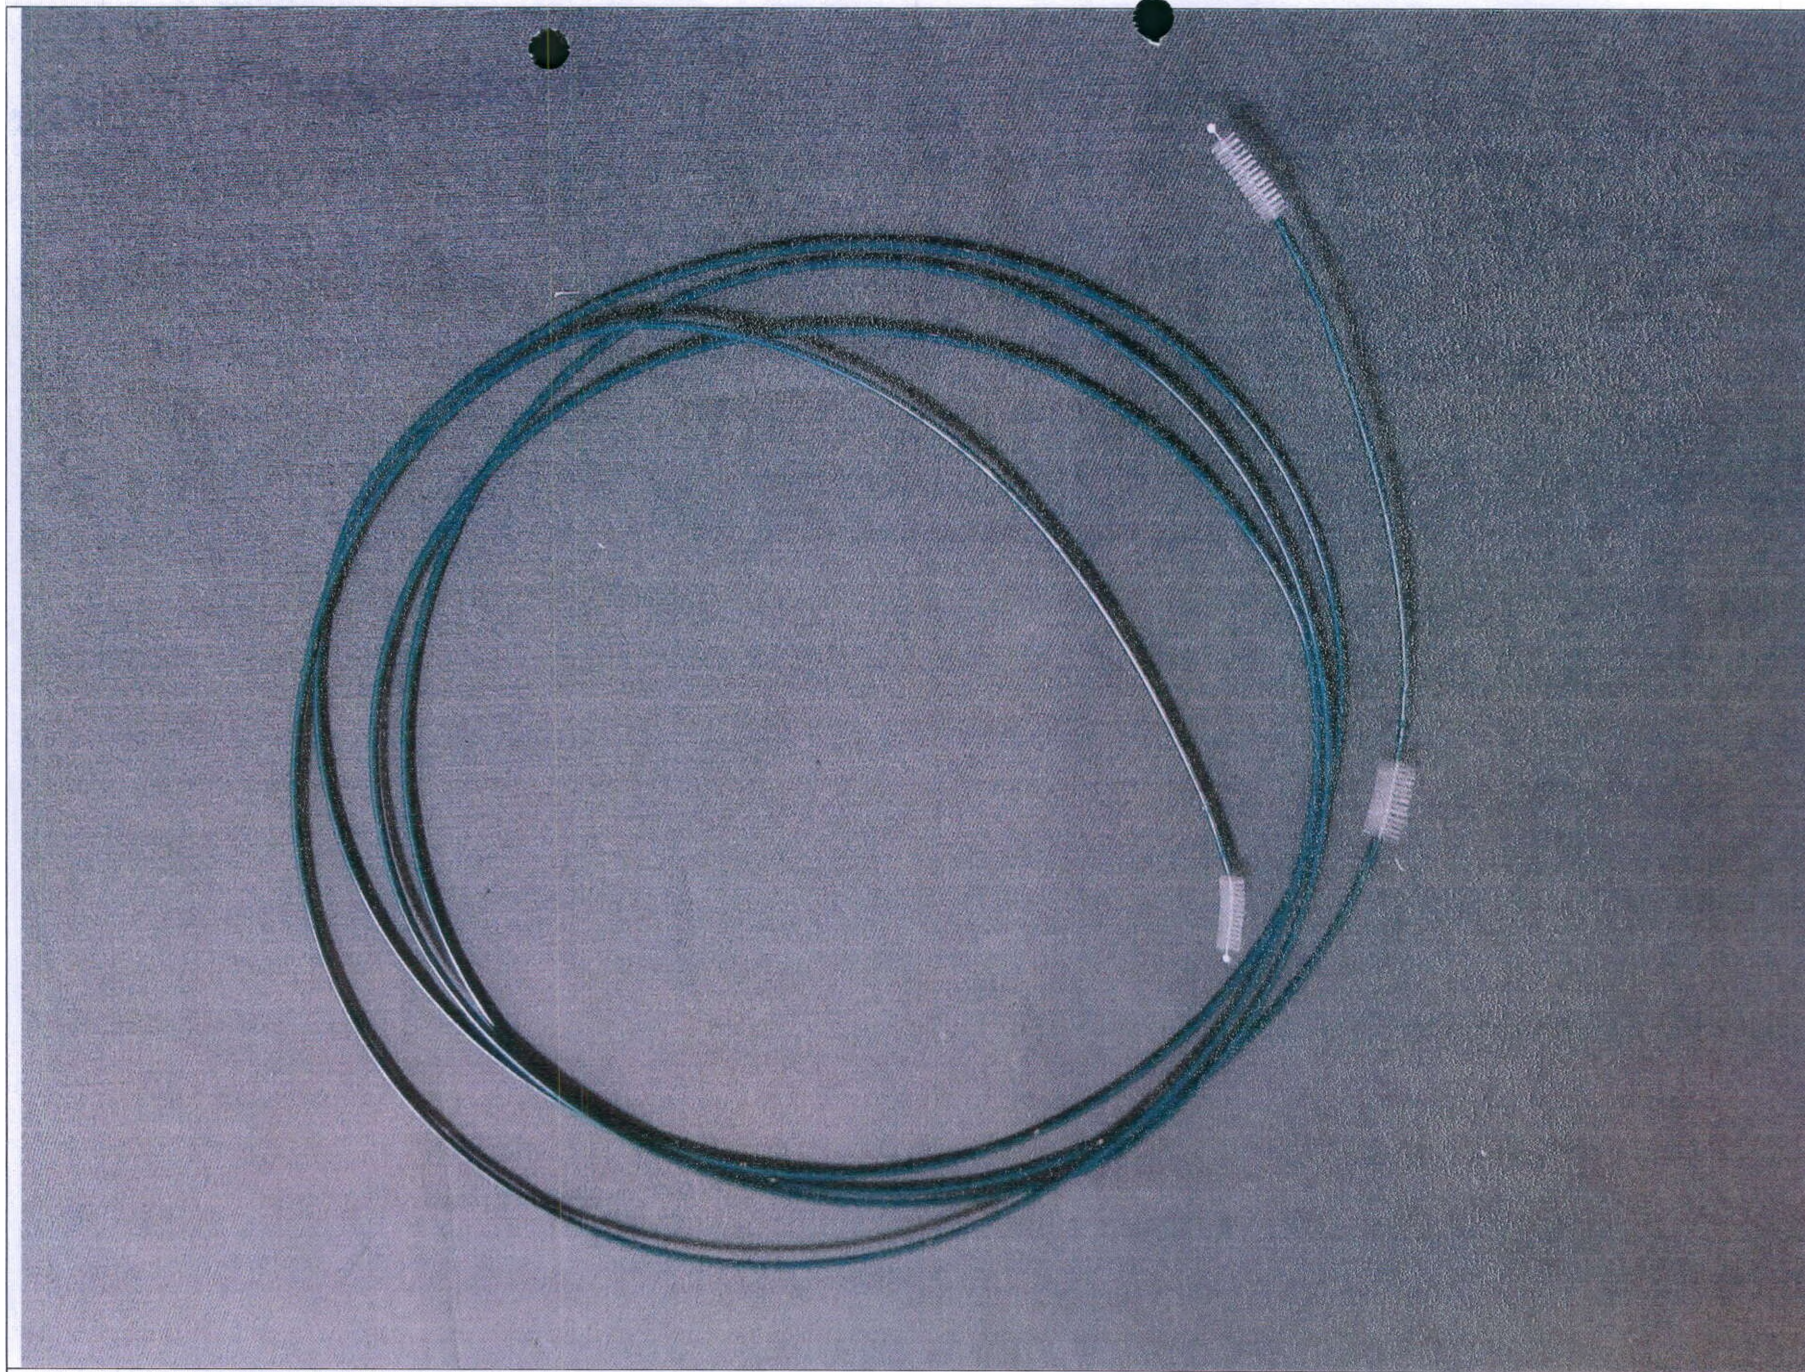


Рис. 98. Щетка для очистки, одноразовая, длина 230 см (110962-50) – 50 шт./уп.

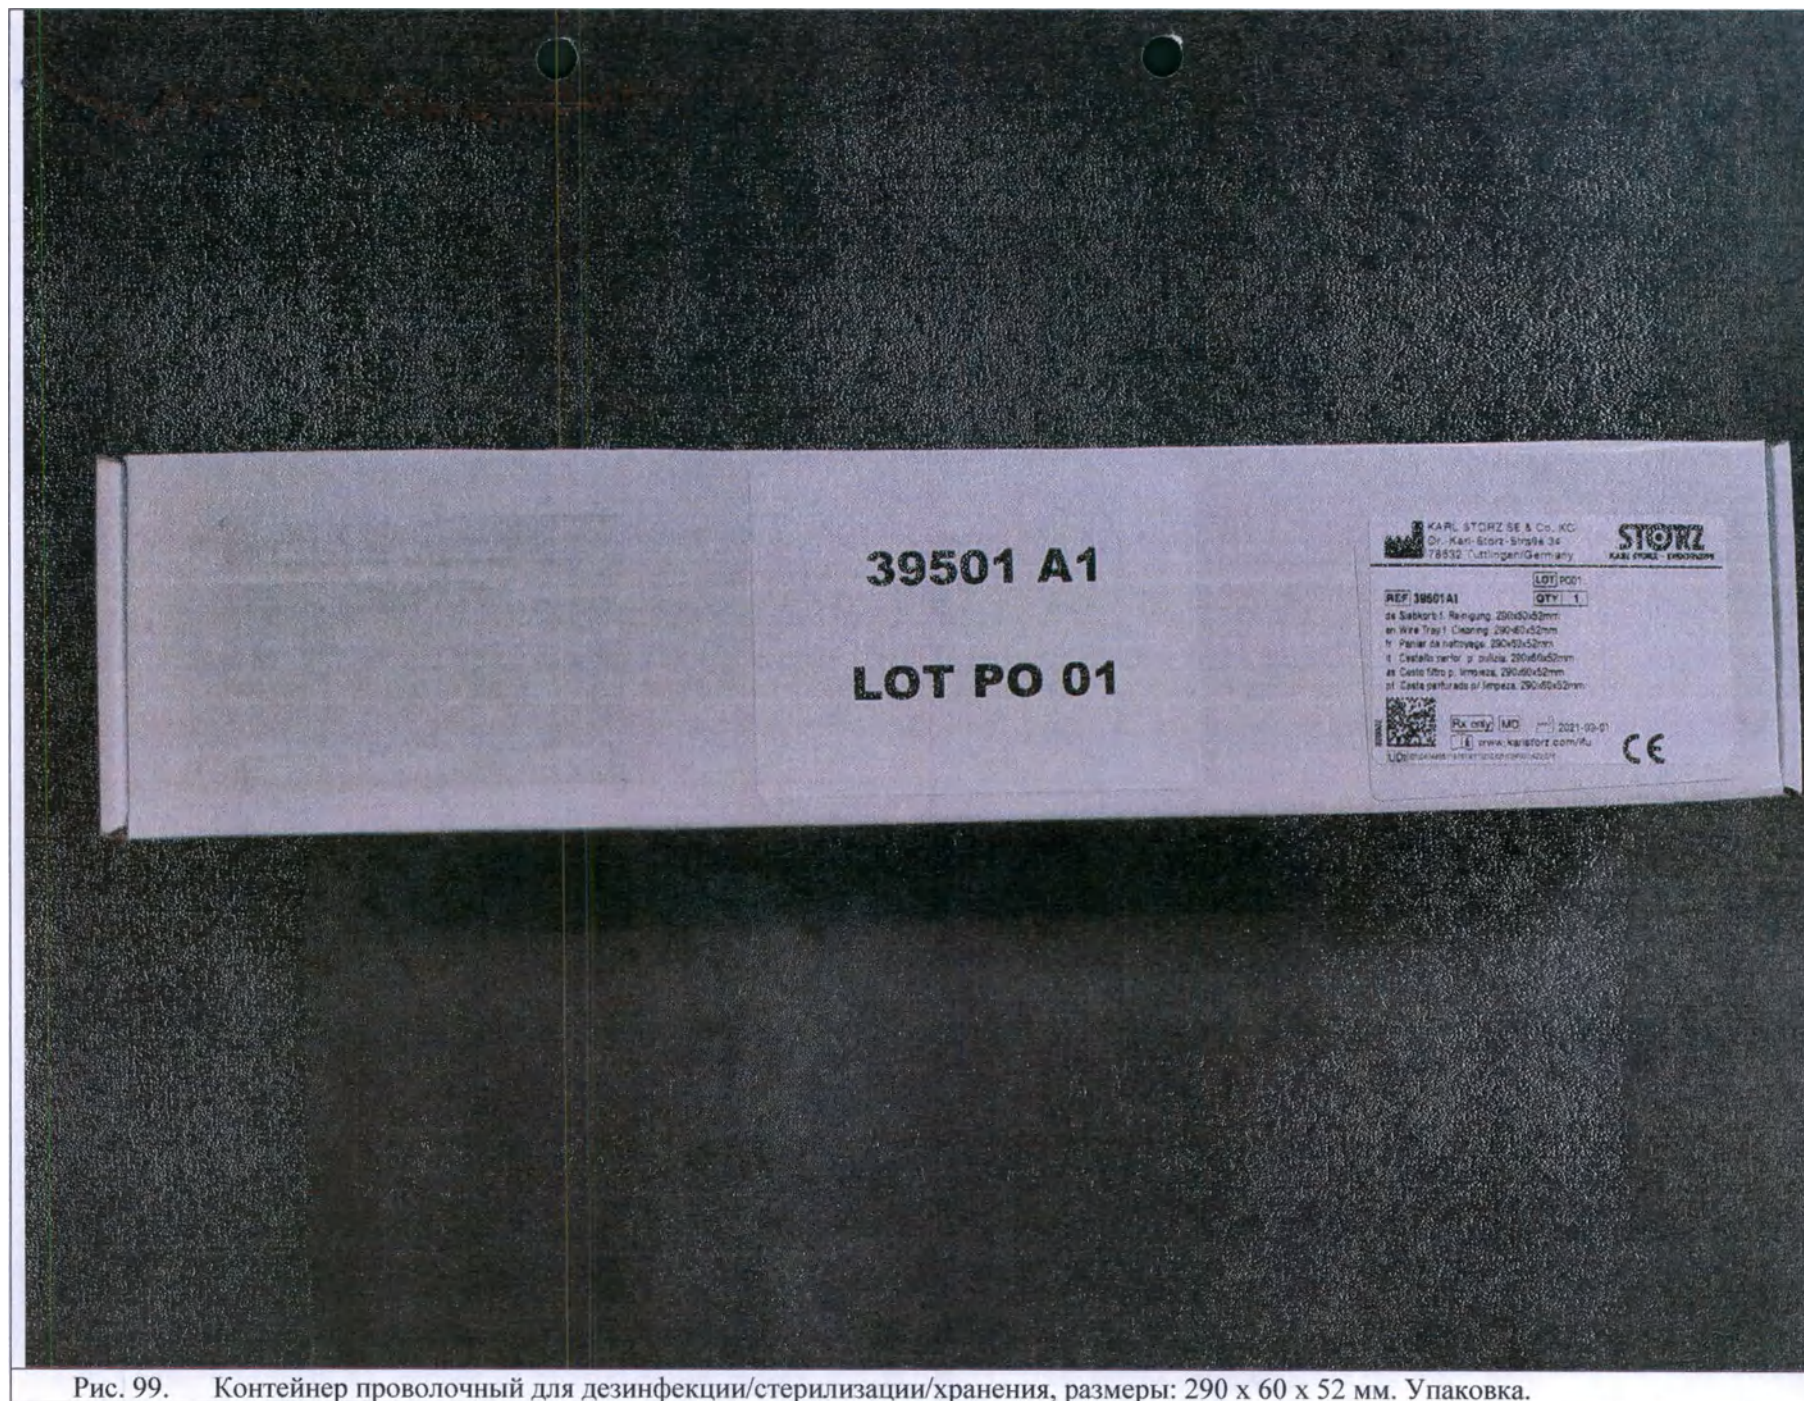


Рис. 99. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 290 x 60 x 52 мм. Упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSCOPE

LOT P001

REF 39501A1

QTY 1

de Siebkorb f. Reinigung, 290x60x52mm
en Wire Tray f. Cleaning, 290x60x52mm
fr Panier de nettoyage, 290x60x52mm
it Cestello perfor. p. pulizia, 290x60x52mm
es Cesto filtro p. limpieza, 290x60x52mm
pt Cesta perfurada p/ limpeza, 290x60x52mm



020002

Rx only MD

2021-03-01



www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)04048561167619(11)210301(10)PC01(422)276



Рис. 100. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 290 x 60 x 52 мм. Маркировка на упаковке.

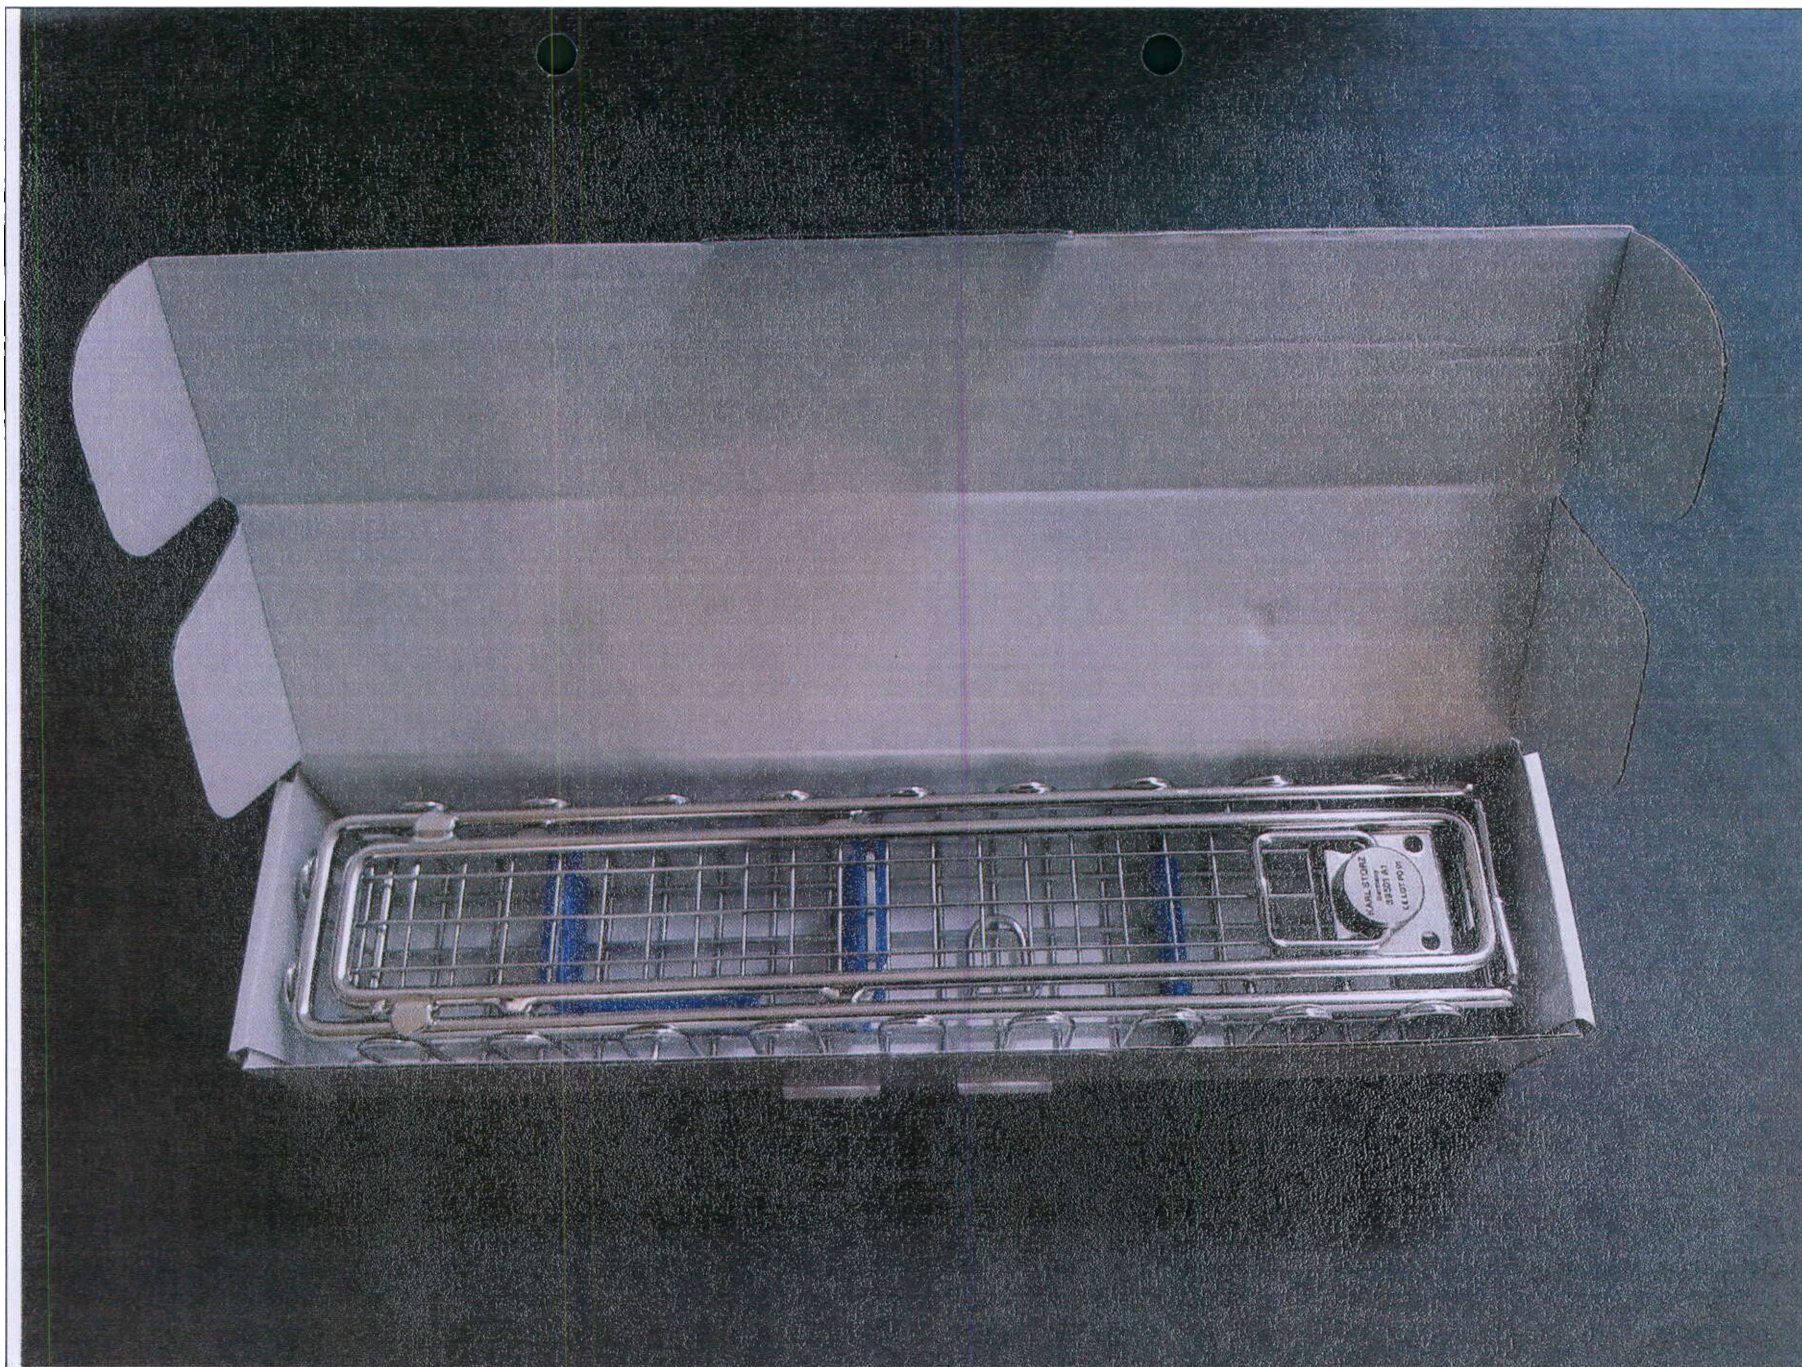


Рис. 101. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 290 x 60 x 52 мм.



Рис. 102. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 290 x 60 x 52 мм.



Рис. 103. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 290 x 60 x 52 мм.

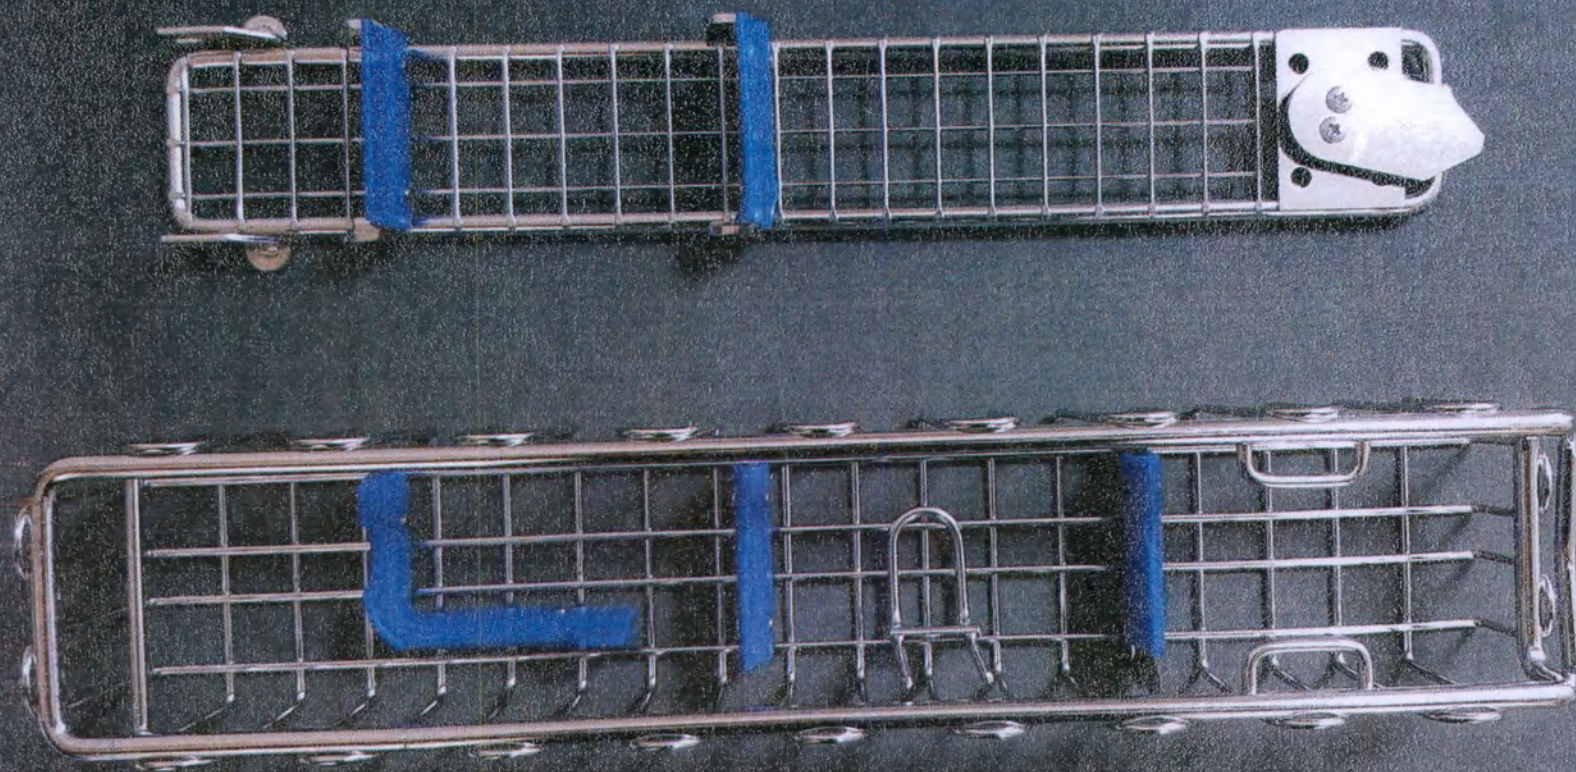


Рис. 104. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 290 x 60 x 52 мм.

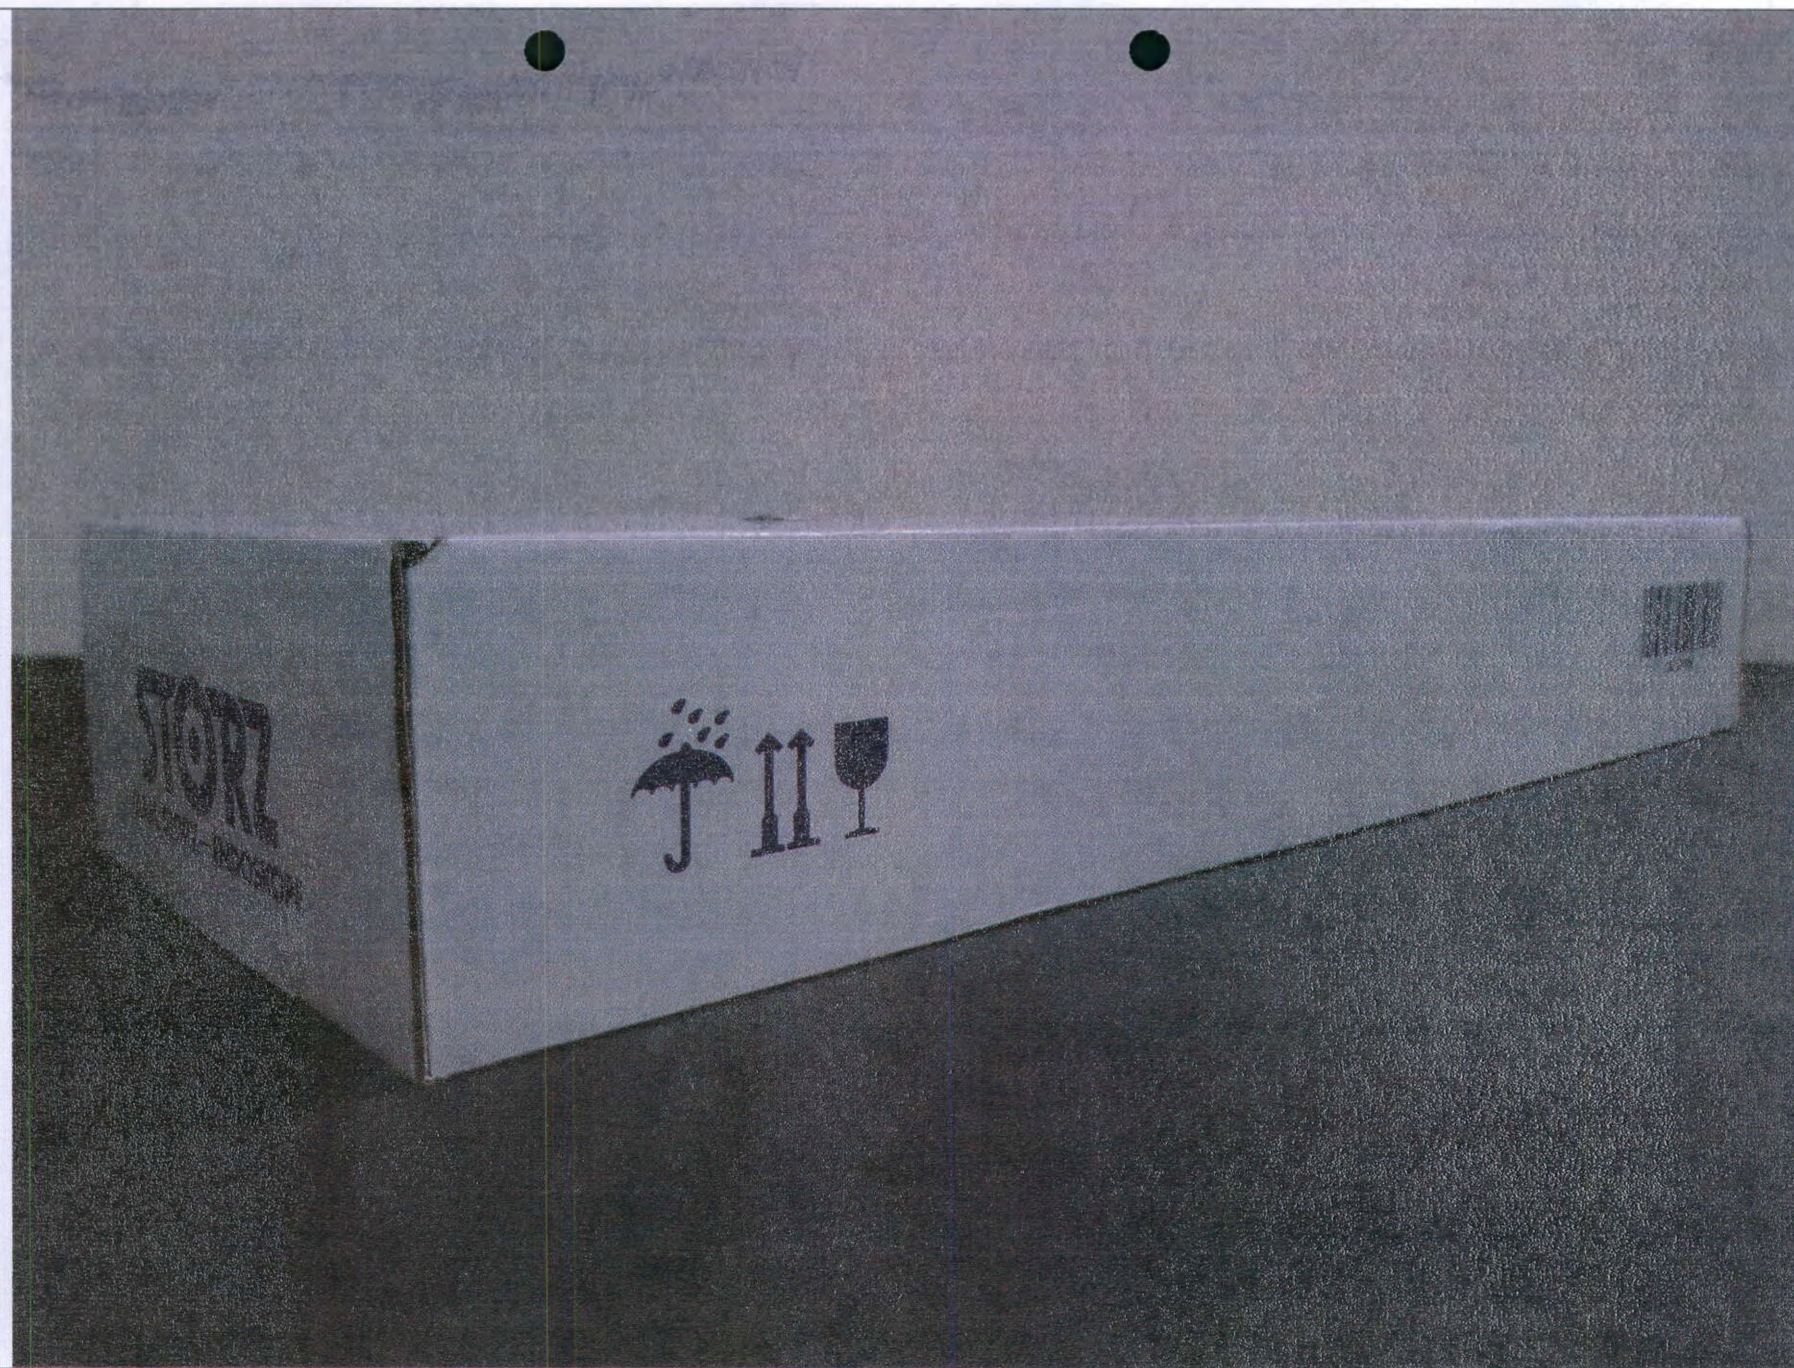


Рис. 105. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 352 x 125 x 54 мм. Упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSCOPE

LOT T002

REF 39501A2

QTY 1

de Siebkorb f. Reinigung, 352x125x54 mm
en Wire Tray f. Cleaning, 352 x 125 x 54 mm
fr Panier nettoyage, 352x125x54 mm
it Cestello per pulizia, 352x125x54 mm
es Bandeja quirúr. limpieza, 352x125x54 mm
pt Cesto aramado p/ limpeza, 352x125x54 mm



020002

Rx only

MD



2021-06-30



www.karlstorz.com/ifu

UDI (C1)04048551157626(11)210630(10)T002(422)276



Рис. 106. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 352 x 125 x 54 мм. Маркировка на упаковке.

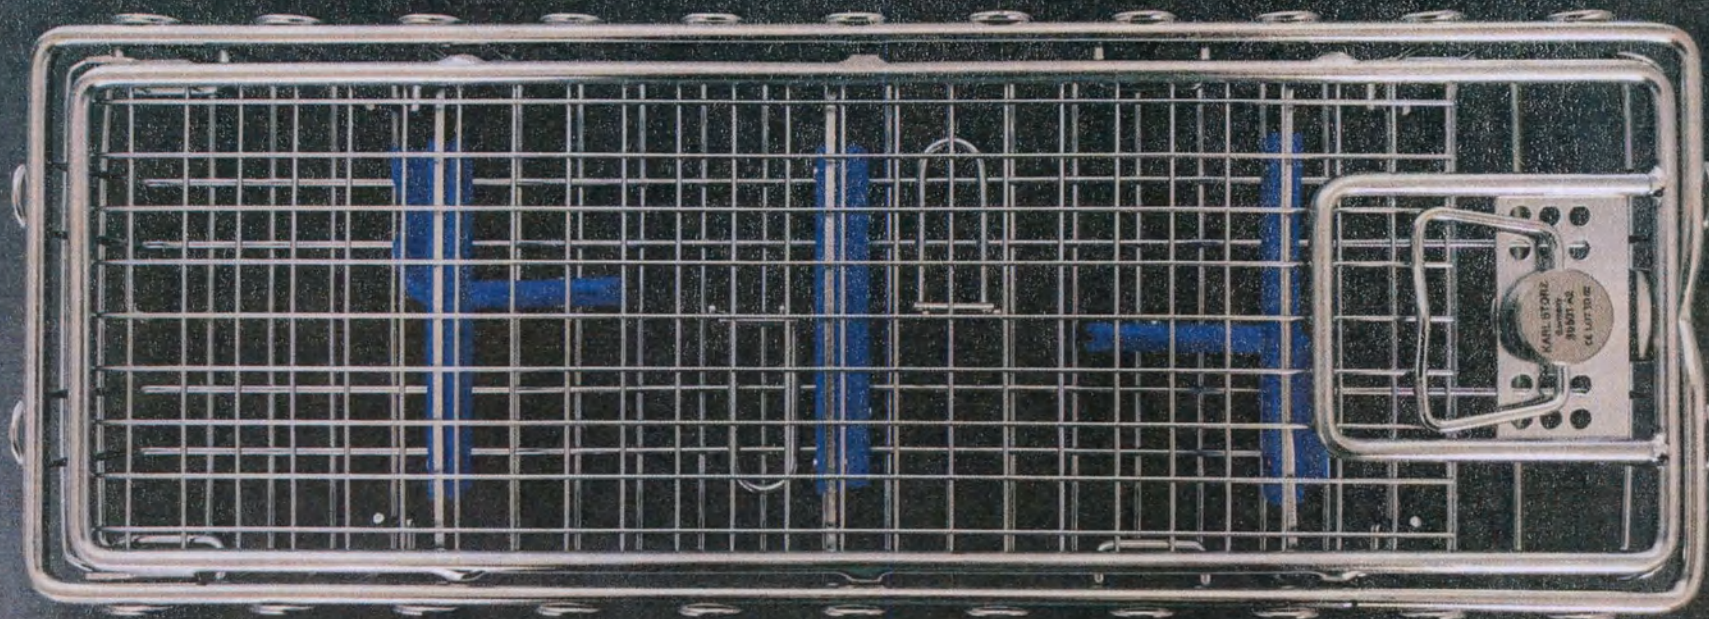


Рис. 107. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 352 x 125 x 54 мм.

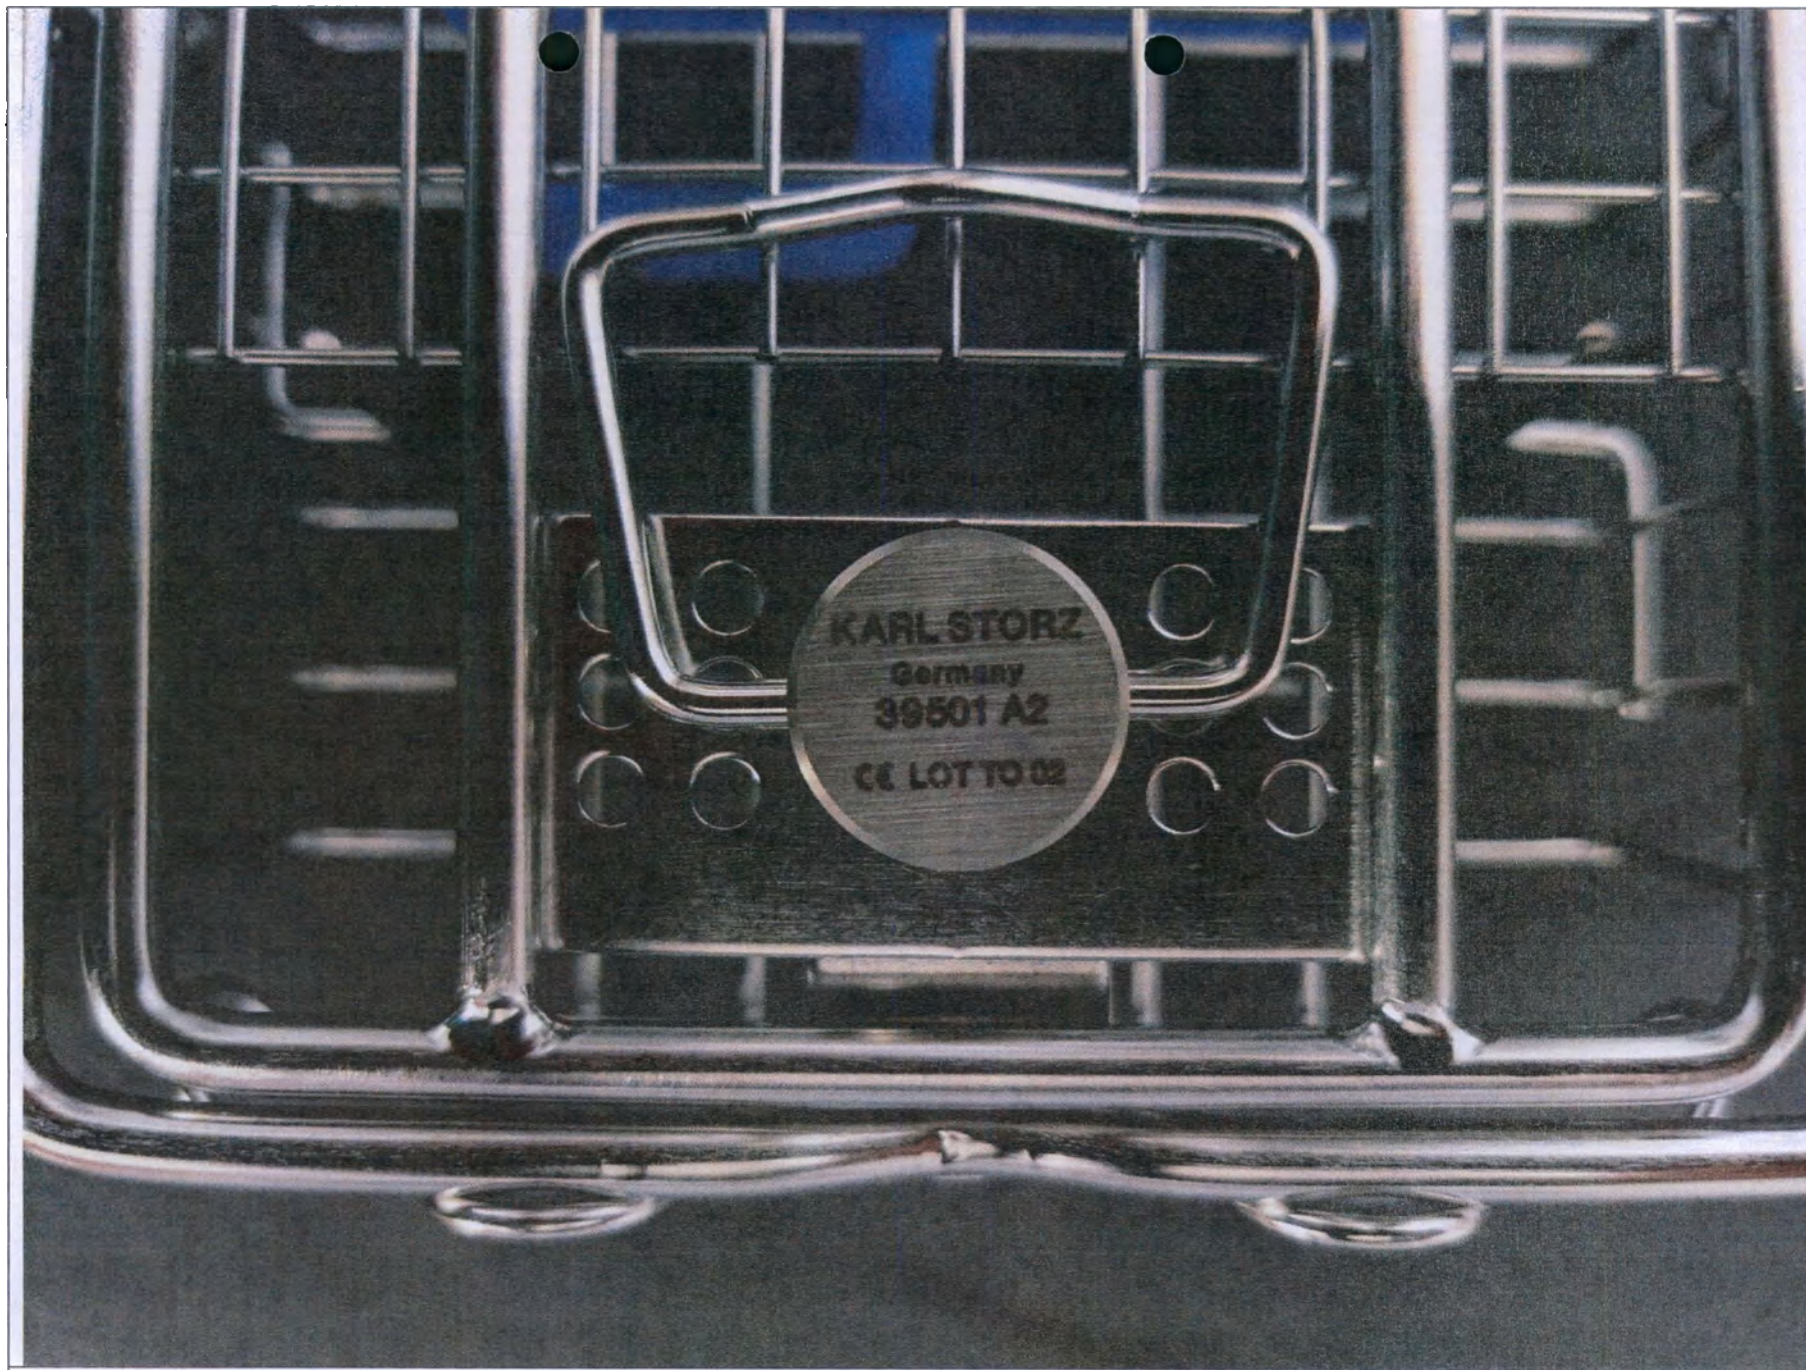


Рис. 108. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 352 x 125 x 54 мм.

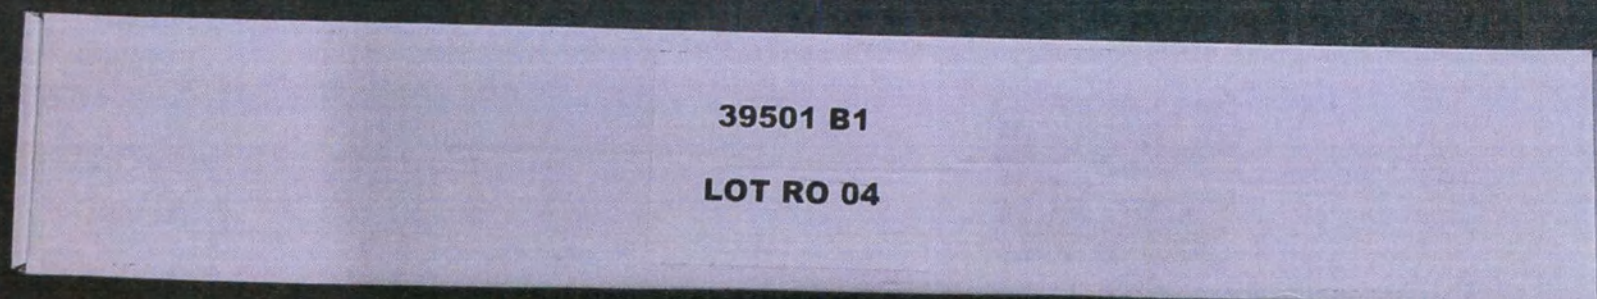


Рис. 109. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 430 х 65 х 52 мм. Упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSCOPE

LOT R004

REF 39501B1

QTY 1

de Siebkorb f. Reinigung, 430x65x52mm
en Wire Tray f. Cleaning, 430x65x52mm
fr Panier de nettoyage, 430x65x52mm
it Cestello perfor. p. pulizia, 430x65x52mm
es Cesto filtro p. limpieza, 430x65x52mm
pt Cesta perfurada p/ limpeza, 430x65x52mm



020002

Rx only

MD



2021-04-30



www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)04048551157640(11)210430(10)R004(422)276

CE

Рис. 110. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 430 x 65 x 52 мм. Маркировка на упаковке

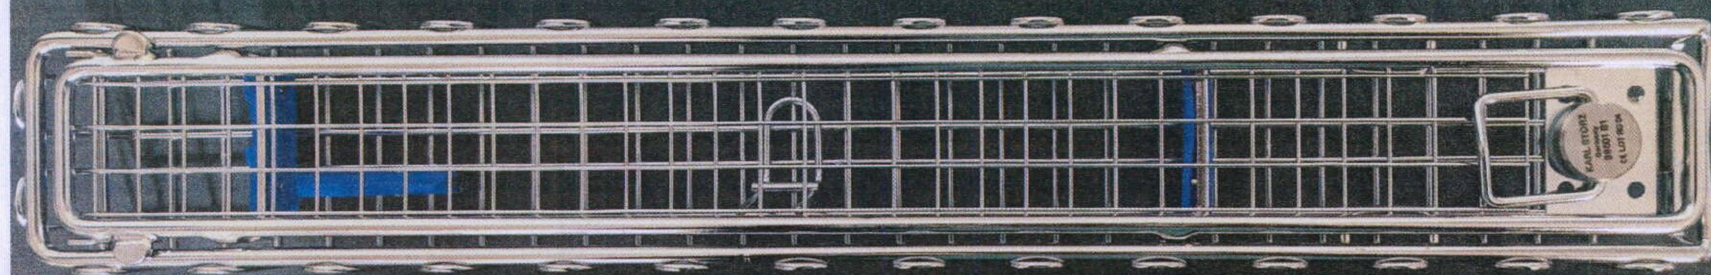


Рис. 111. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 430 x 65 x 52 мм.



Рис. 112. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 430 x 65 x 52 мм.

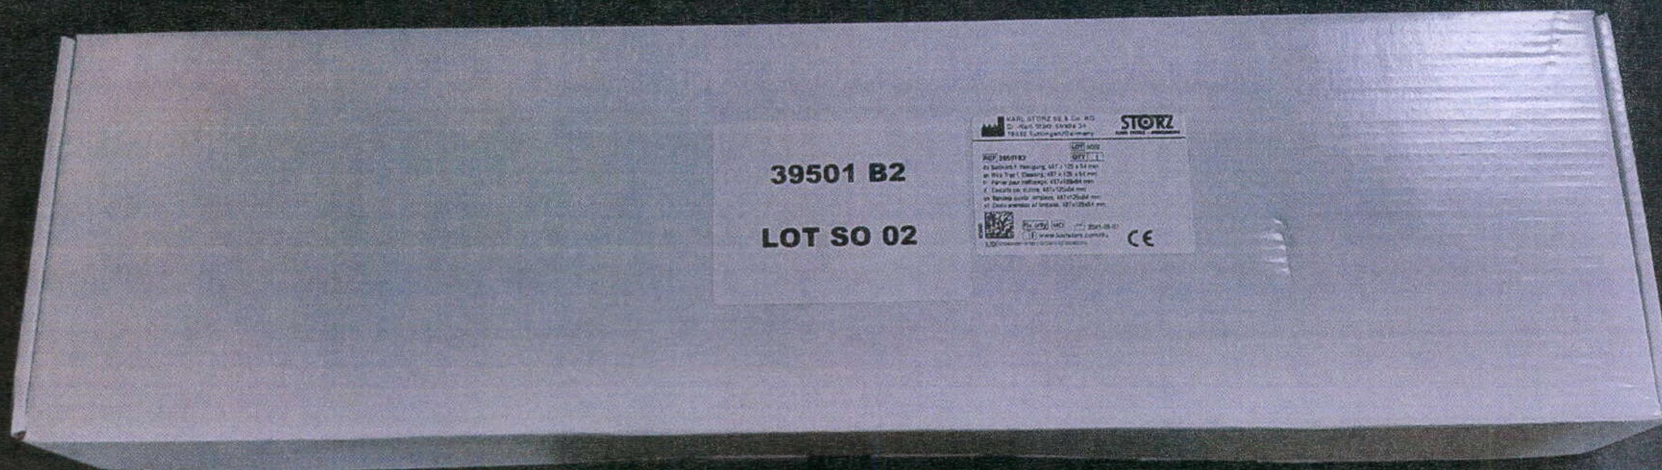


Рис. 113. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 487 x 125 x 54 мм. Упаковка.

39501 B2

LOT SO 02



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSCOPE

LOT S002

REF 39501B2

QTY 1

de Siebkorb f. Reinigung, 487 x 125 x 54 mm
en Wire Tray f. Cleaning, 487 x 125 x 54 mm
fr Panier pour nettoyage, 487x125x54 mm
it Cestello per pulizia, 487x125x54 mm
es Bandeja quirúr. limpieza, 487x125x54 mm
pt Cesto aramado p/ limpeza, 487x125x54 mm



020002

Rx only

MD



2021-05-01



www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)040#8551157657(11)210501(10)6002(42)278

CE

Рис. 114. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 487 x 125 x 54 мм. Маркировка на упаковке.



Рис. 115. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 487 x 125 x 54 мм.



Рис. 116. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 487 x 125 x 54 мм.

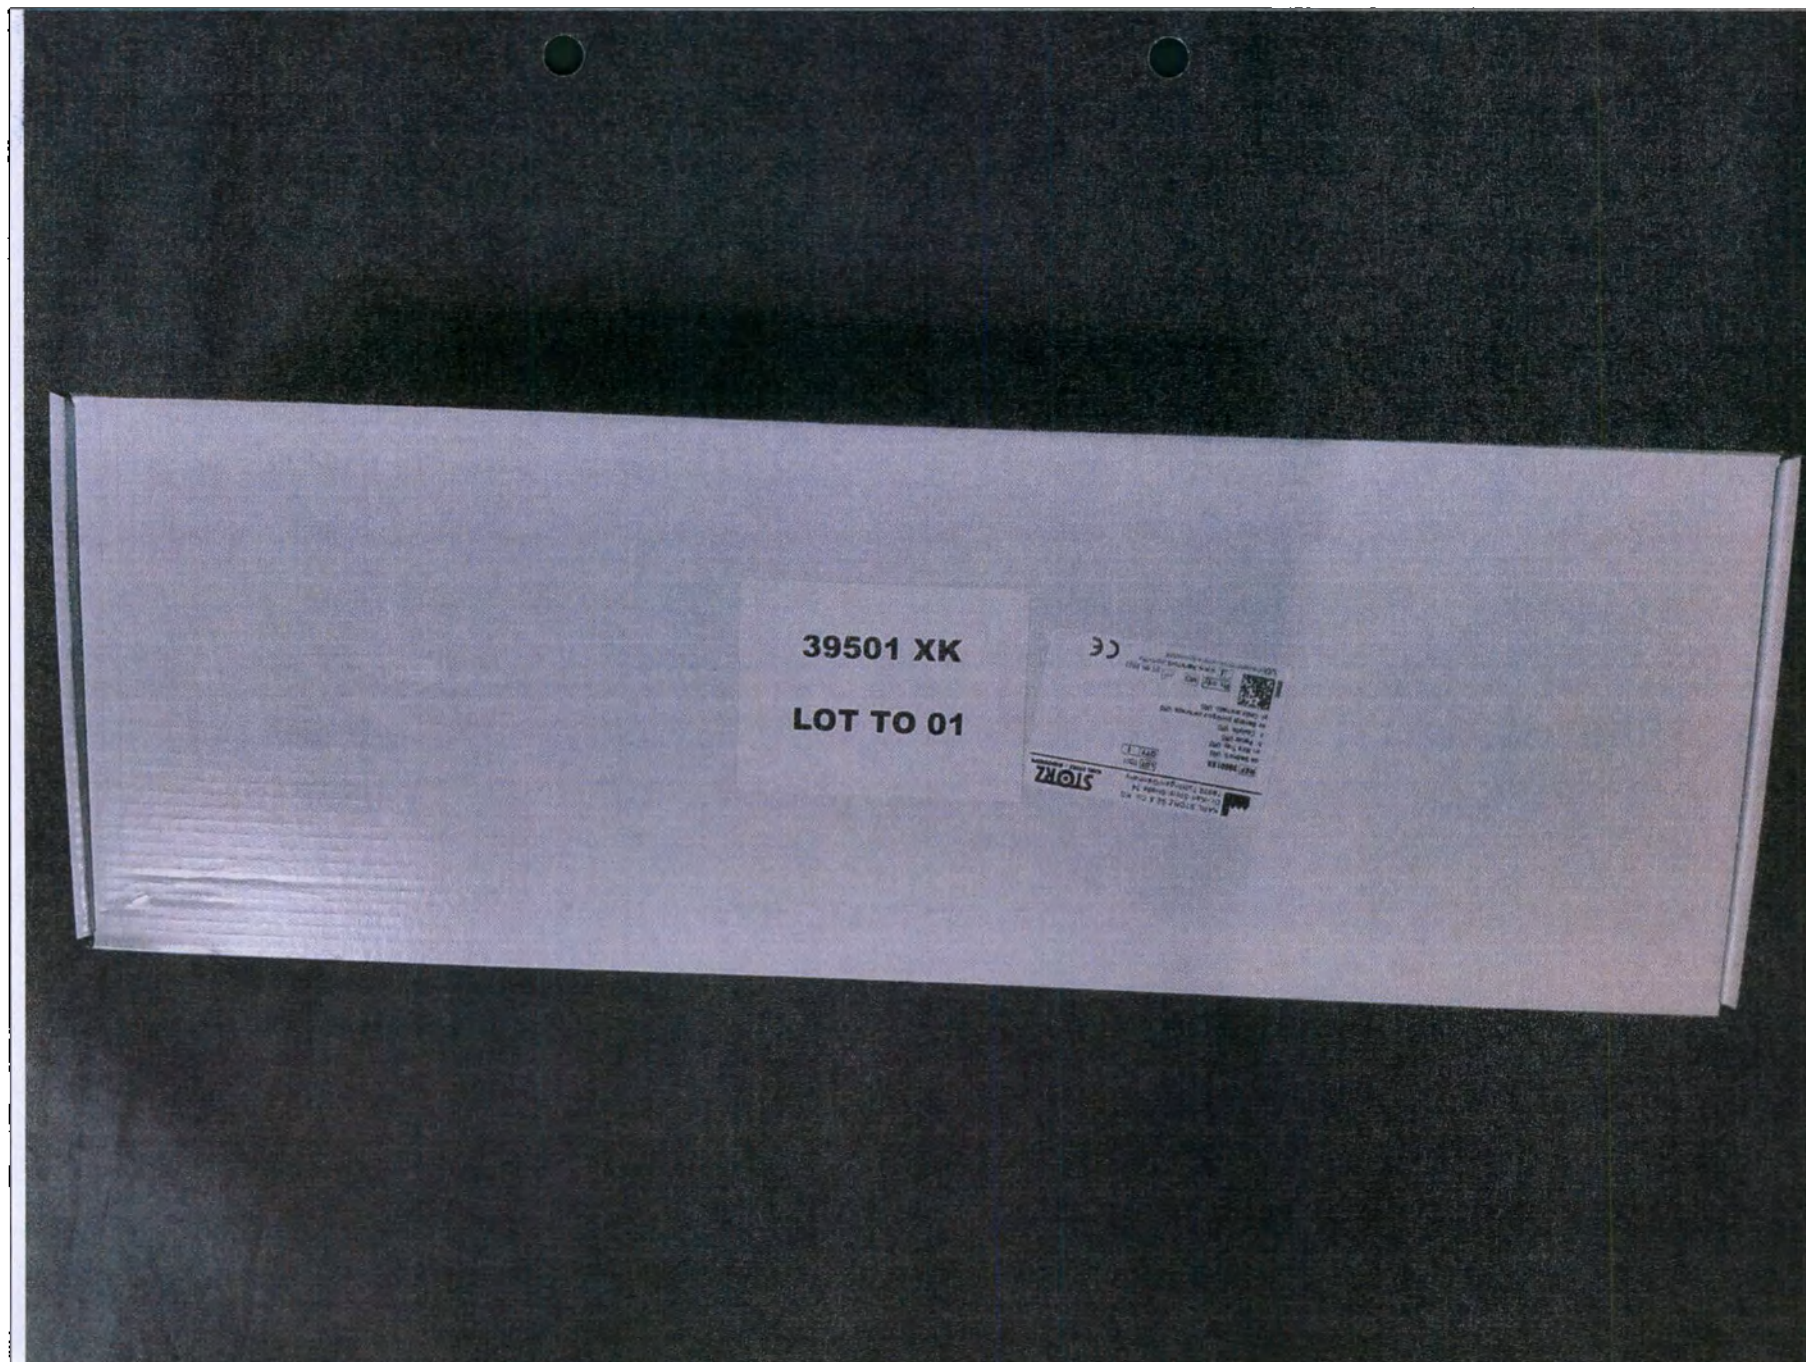


Рис. 117. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения с ячейкой для мелких деталей, размеры: 460 x 150 x 80 мм. Упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany


STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

REF 39501XK

LOT T001

QTY 1

de Siebkorb, URS
en Wire Tray, URS
fr Panier URS
it Cestello, URS
es Bandeja quirúrgica perforada, URS
pt Cesto aramado, URS



029002

Rx only

MD



01.06.2021



www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)04048551157763(11)210614(10)T001(422)276



Рис. 118. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения с ячейкой для мелких деталей, размеры: 460 x 150 x 80 мм.
Маркировка на упаковке.



Рис. 119. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения с ячейкой для мелких деталей, размеры: 460 x 150 x 80 мм.



Рис. 120. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения с ячейкой для мелких деталей, размеры: 460 x 150 x 80 мм.



Рис. 121. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения с ячейкой для мелких деталей, размеры: 460 x 150 x 80 мм.

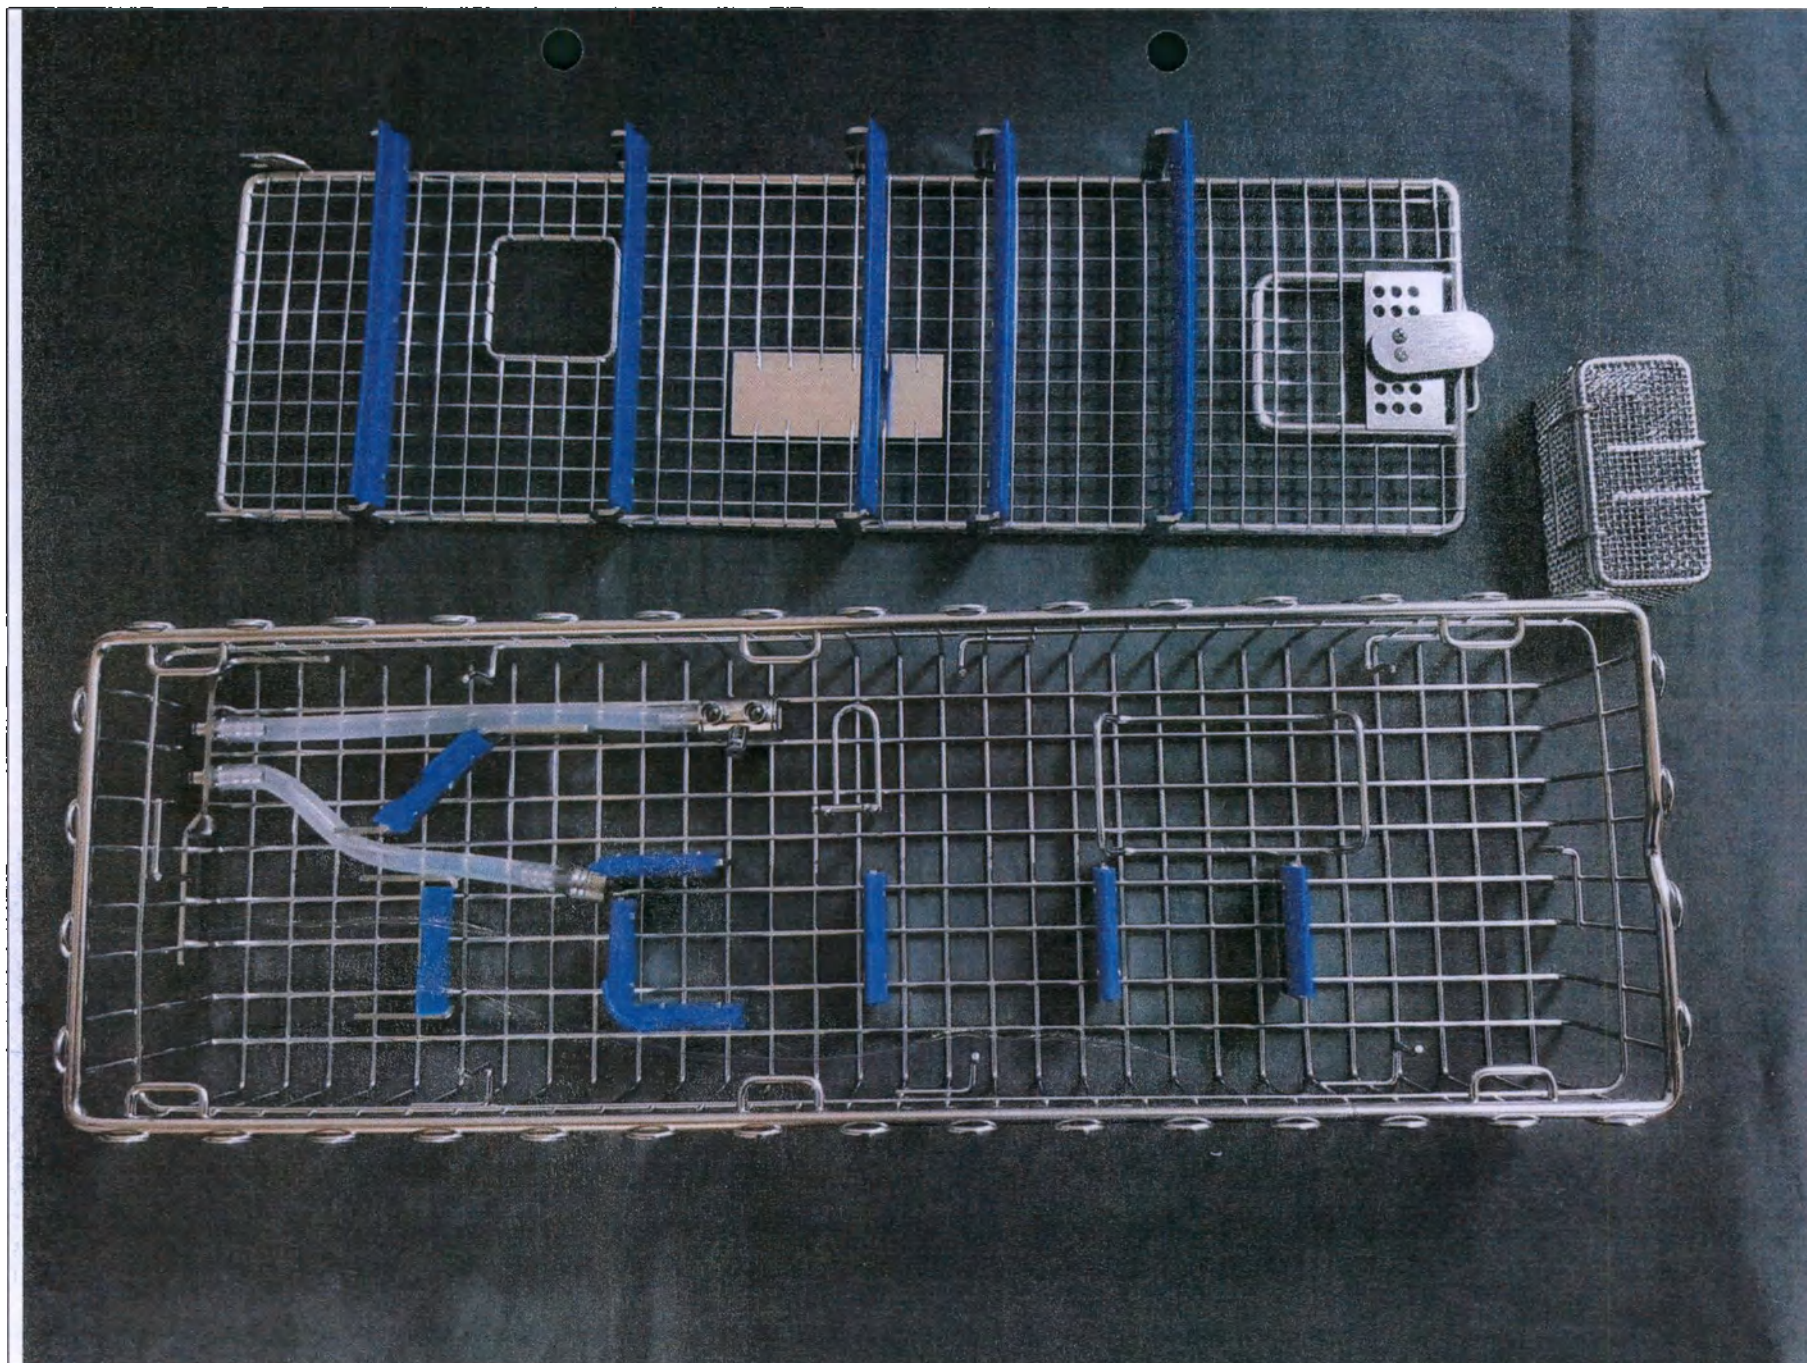


Рис. 122. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения с ячейкой для мелких деталей, размеры: 460 x 150 x 80 мм.

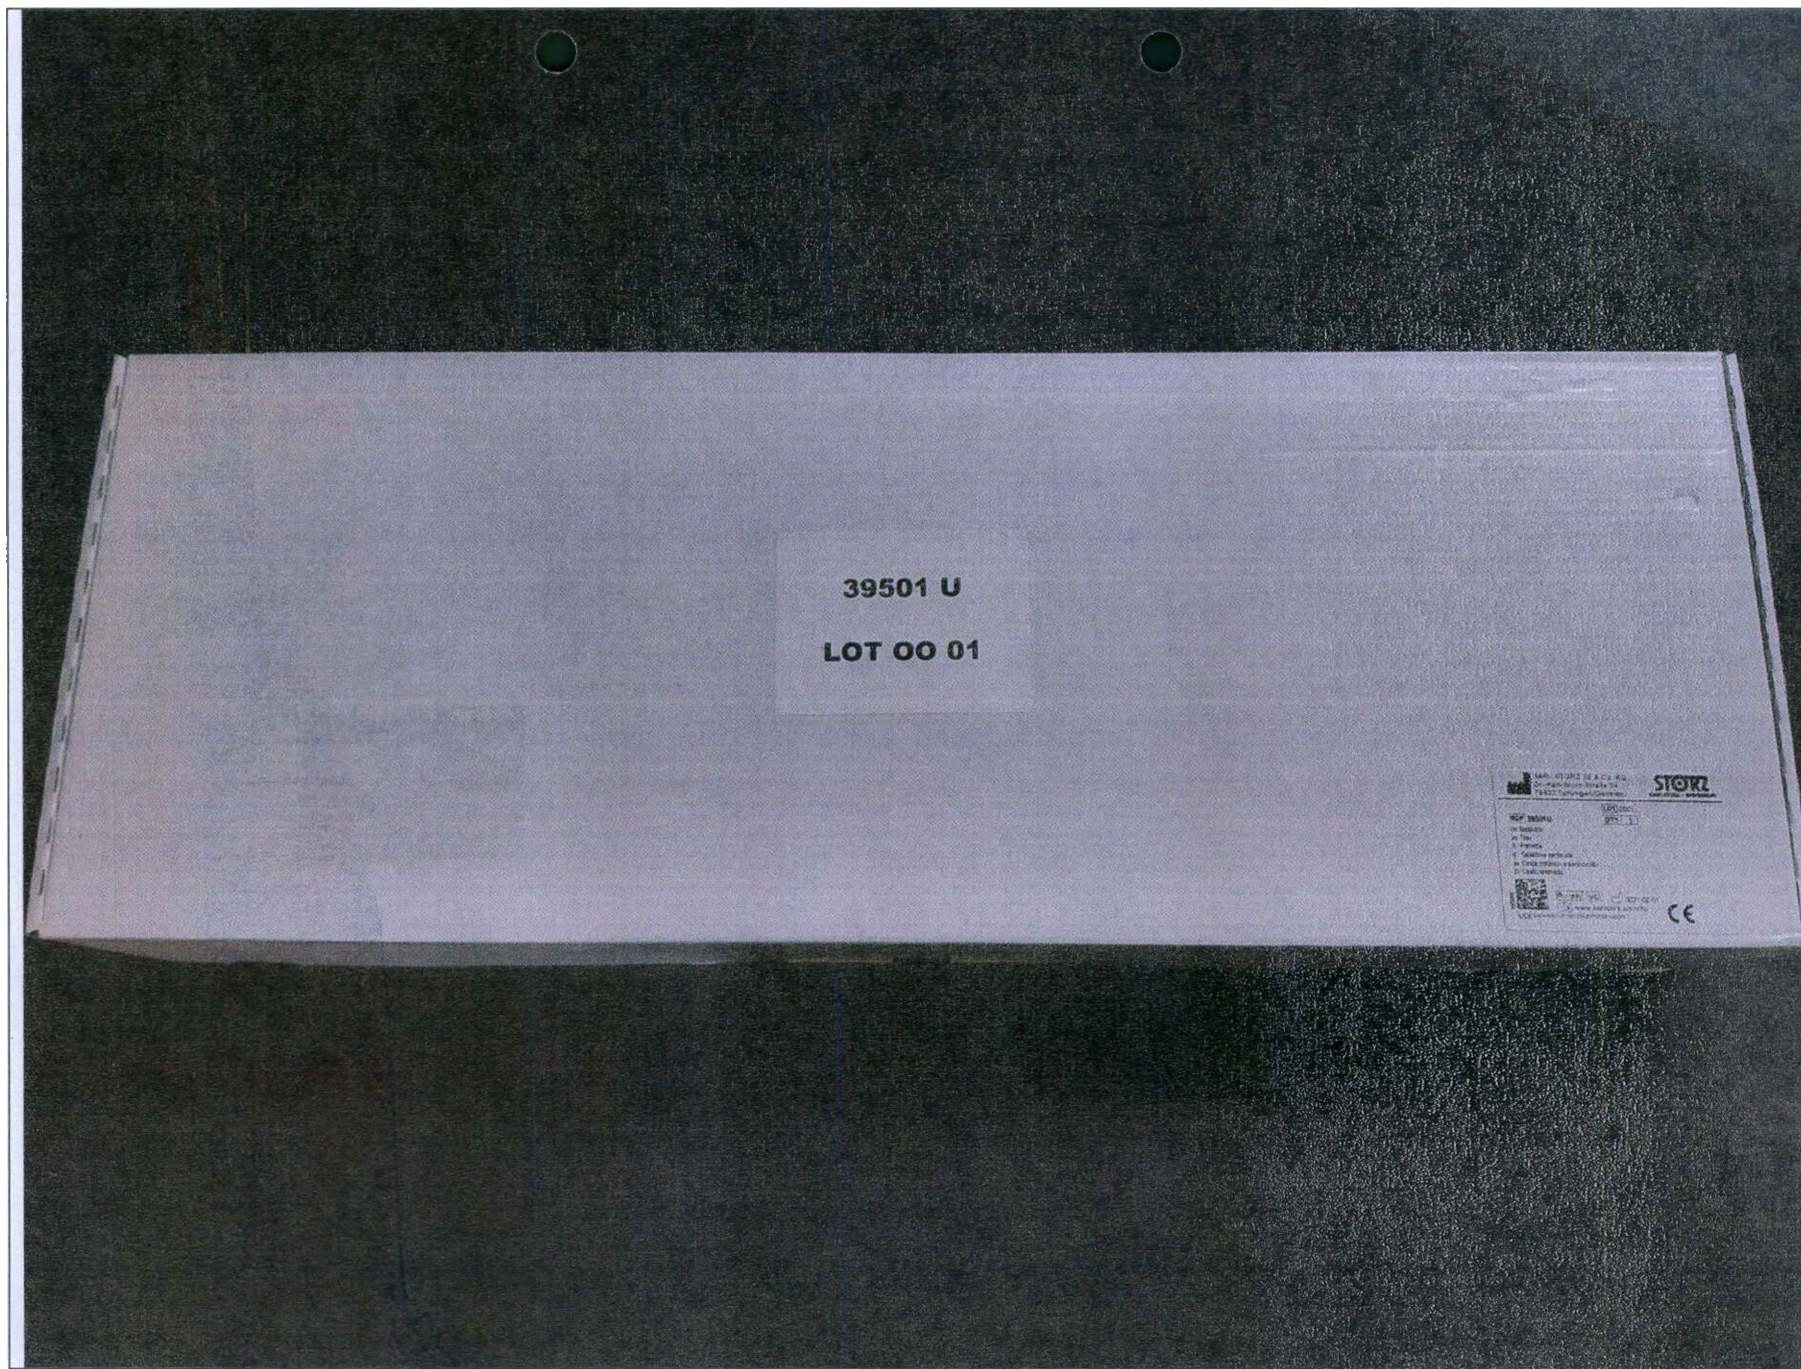


Рис. 123. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 510 x 185 x 82 мм. Упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

LOT 0001

REF 39501U

QTY 1

de Siebkorb
en Tray
fr Paniette
it Collettore perforato
es Cesta metálica esterilización
pt Cesto aramado

020002



Rx only

MD



2021-02-01



www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)04048551157718(11)210201(10)0001(422)276

CE

Рис. 124. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 510 x 185 x 82 мм. Маркировка на упаковке.

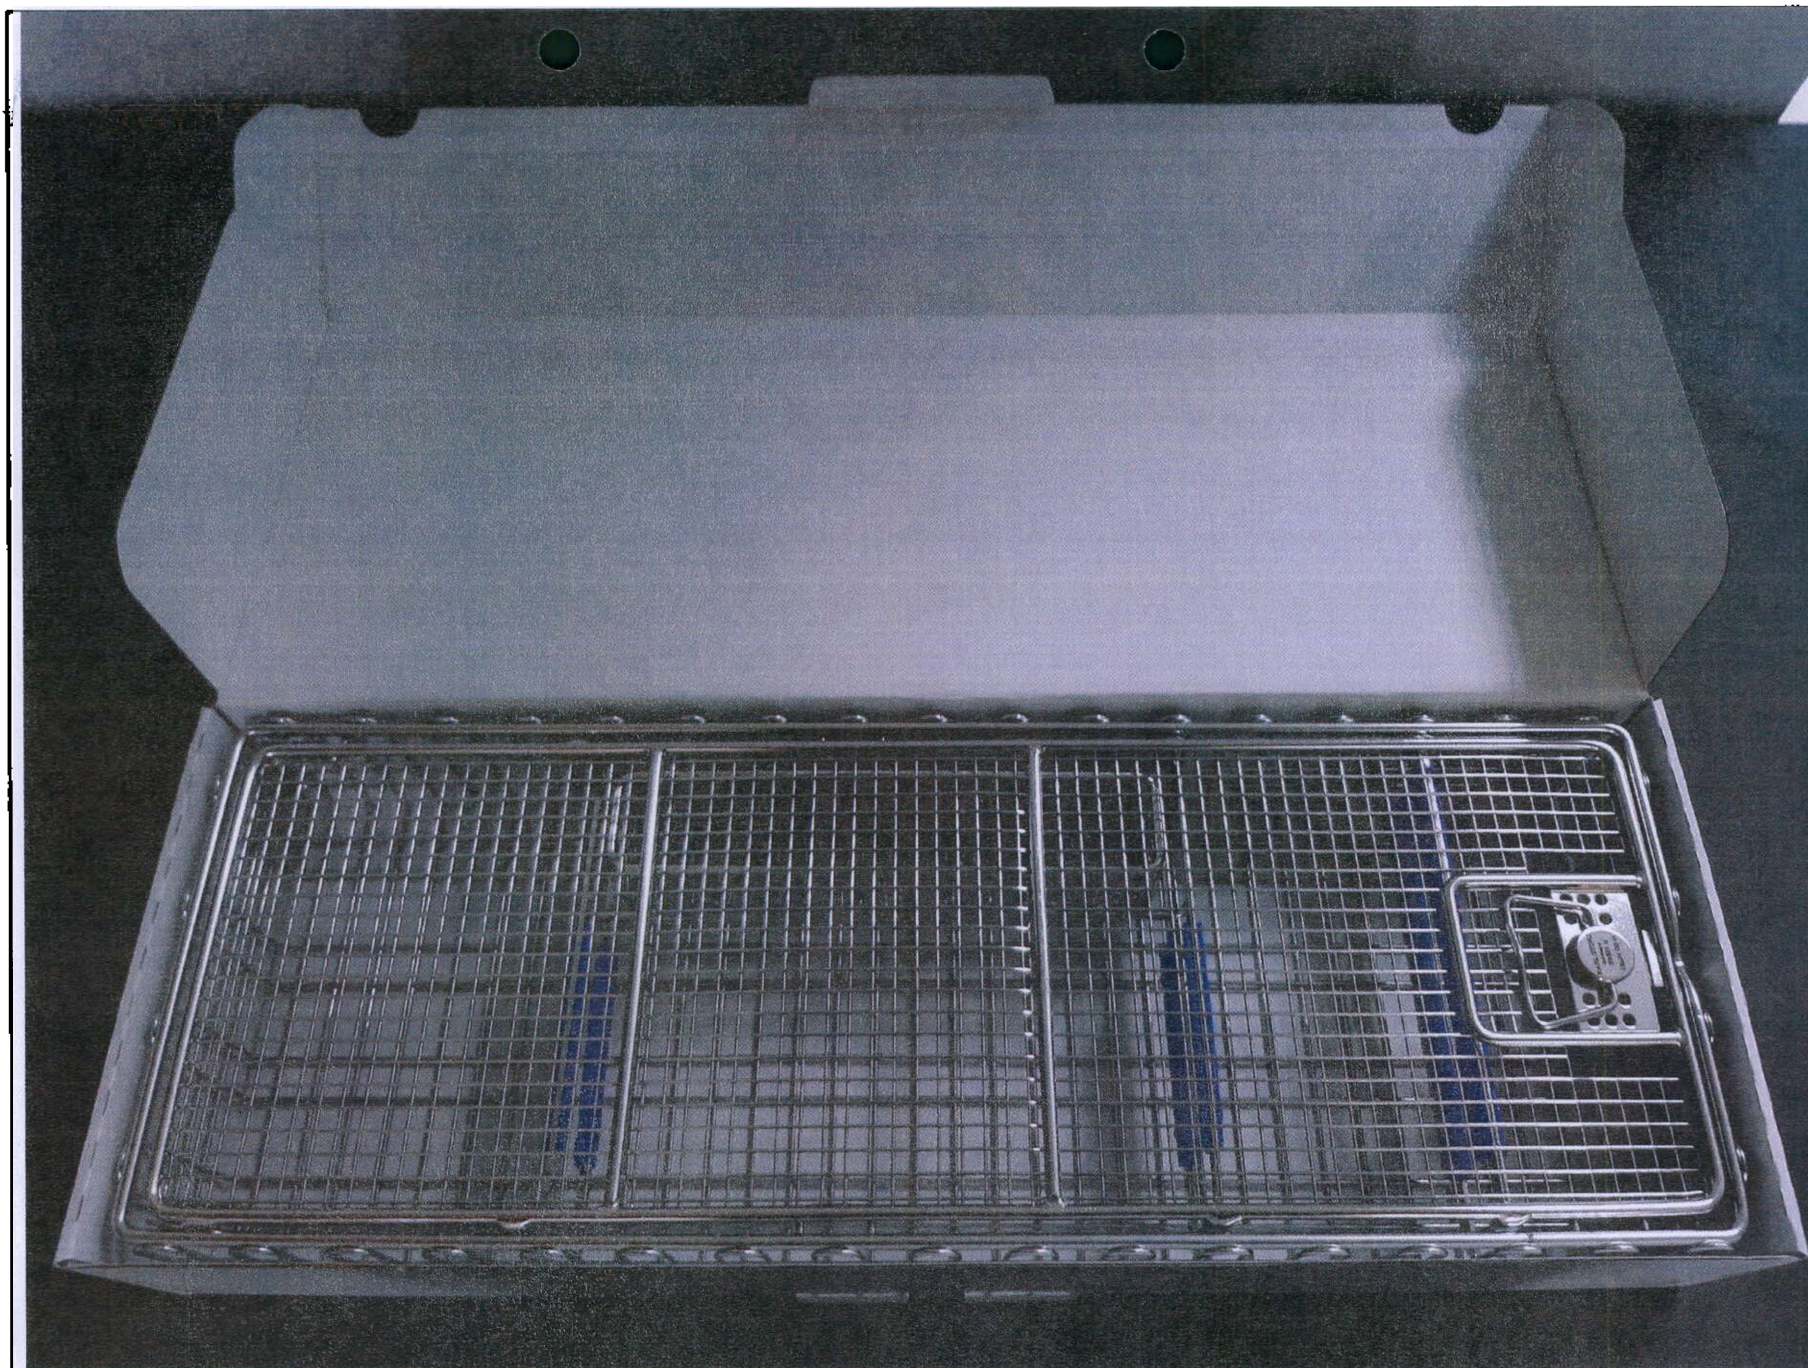


Рис. 125. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 510 x 185 x 82 мм.



Рис. 126. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 510 x 185 x 82 мм.

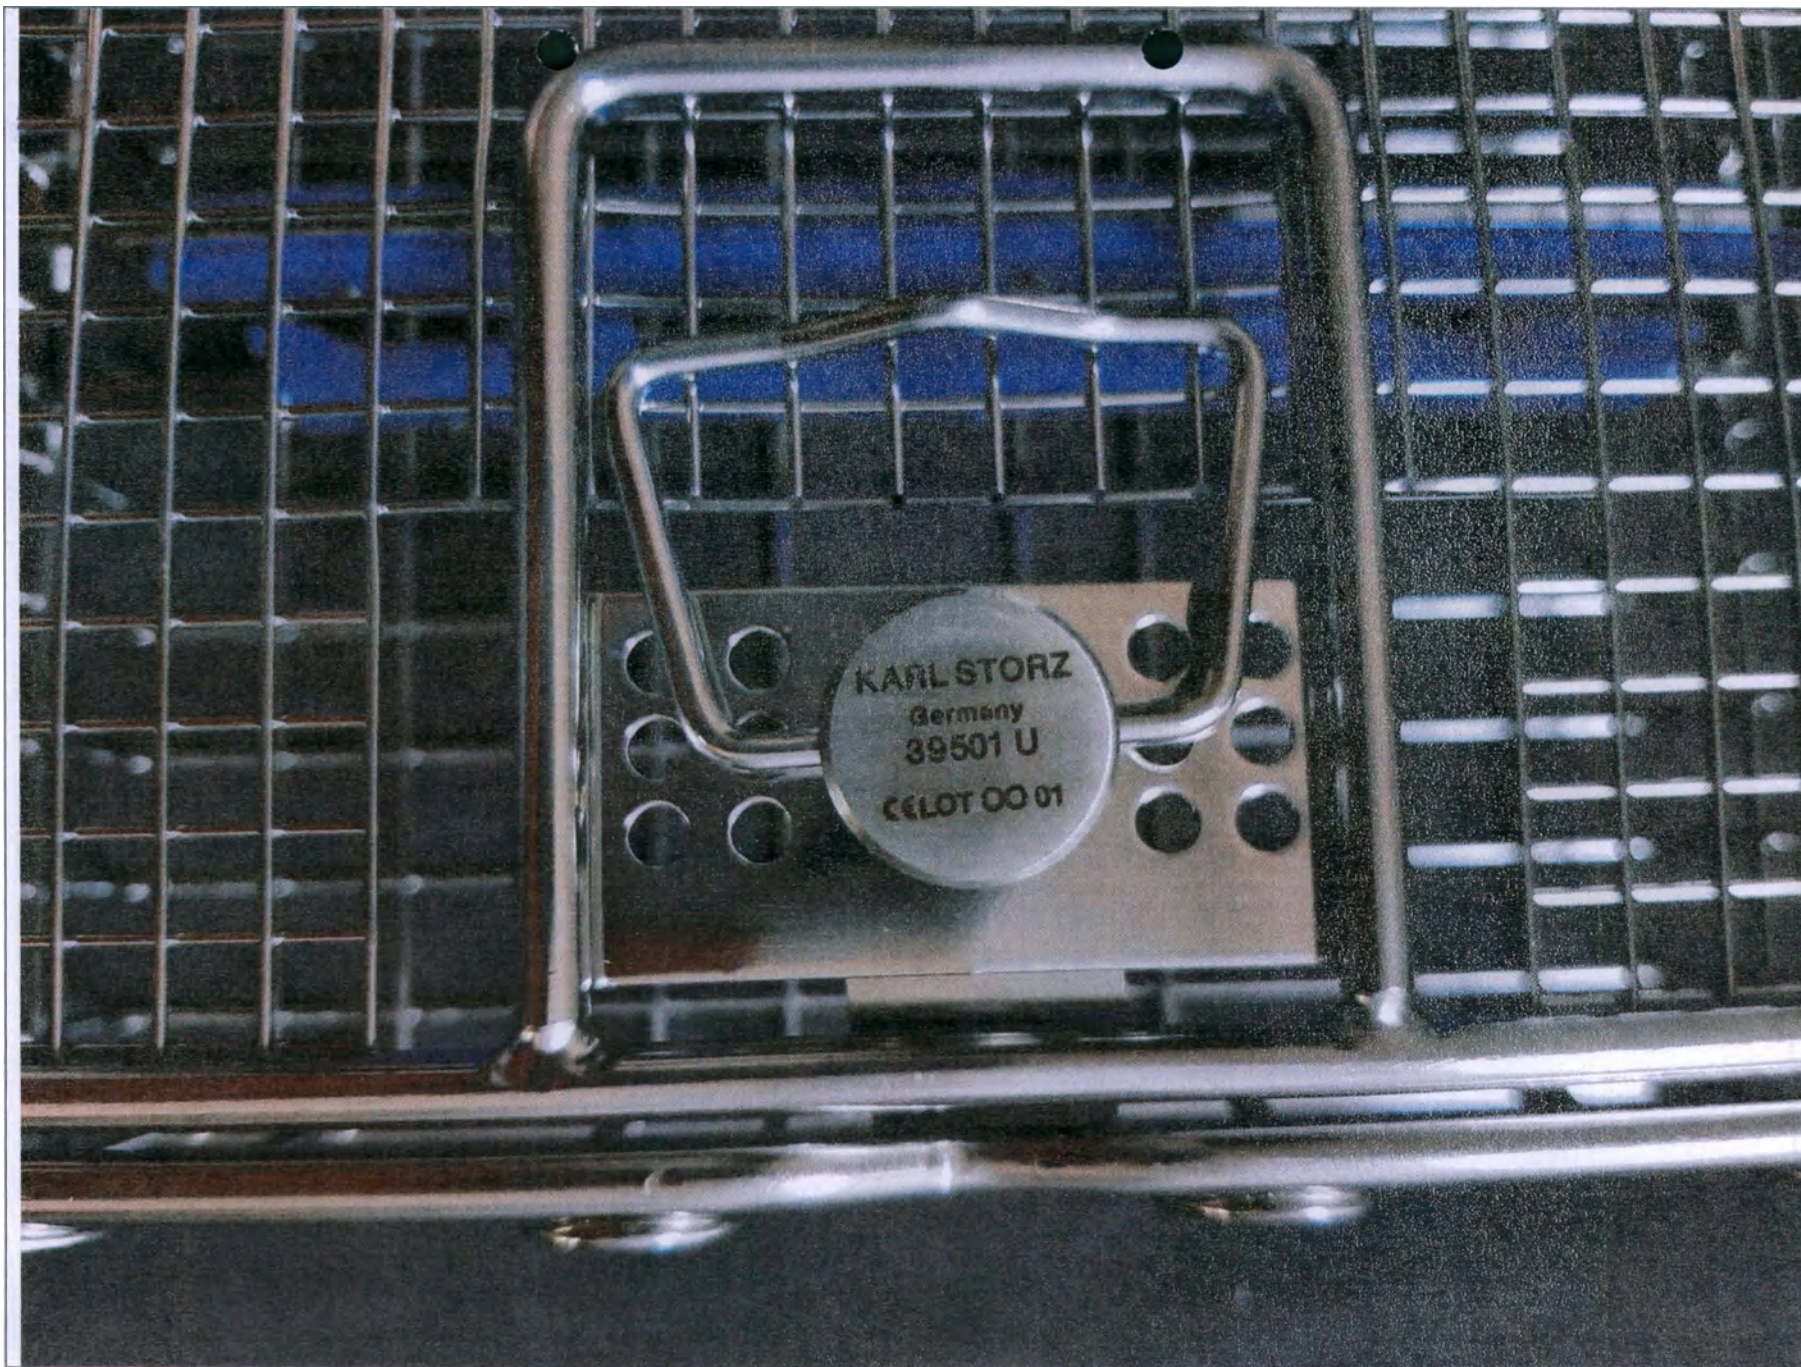


Рис. 127. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 510 x 185 x 82 мм.

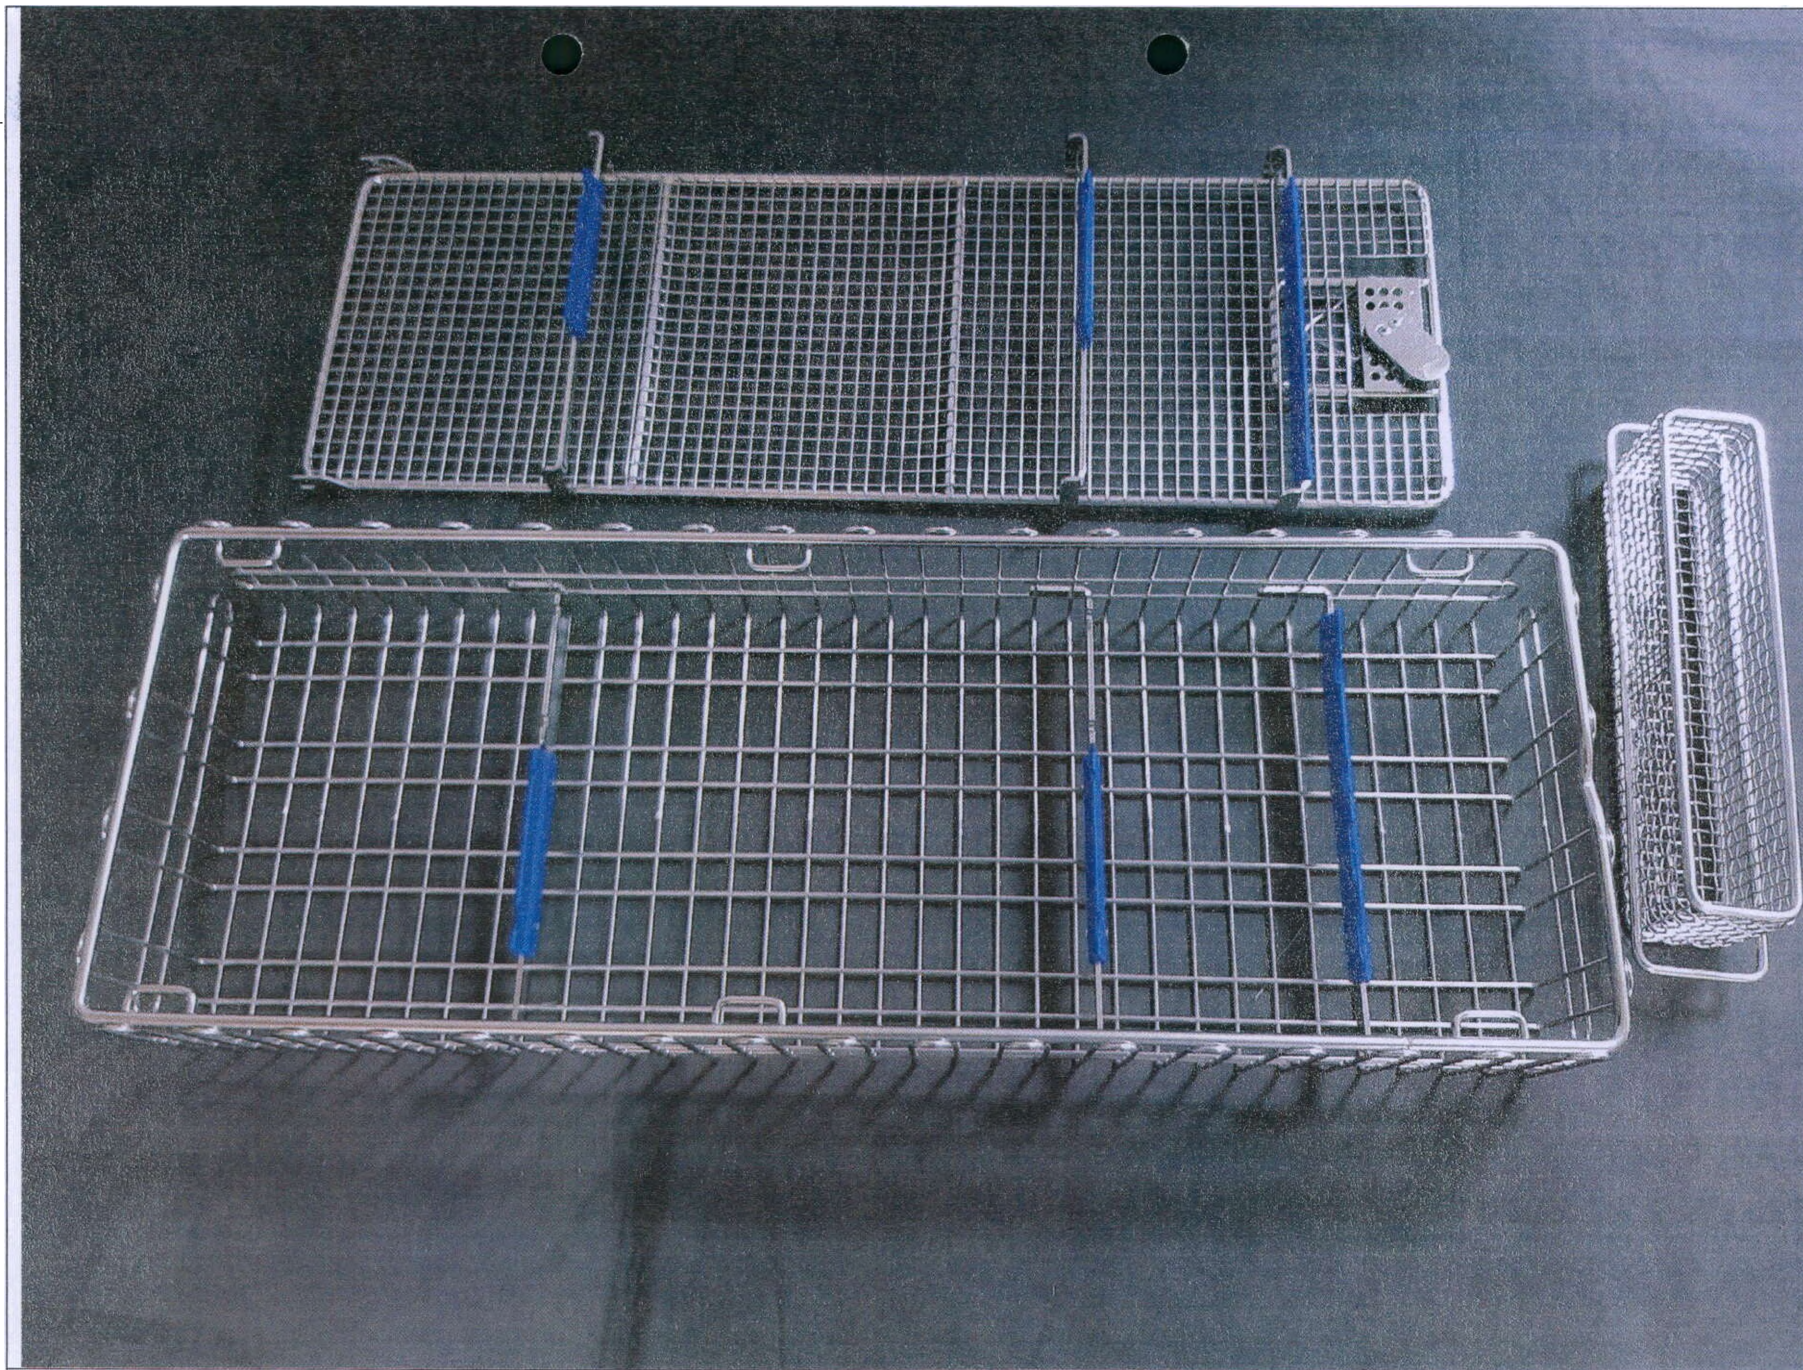


Рис. 128. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 510 x 185 x 82 мм.

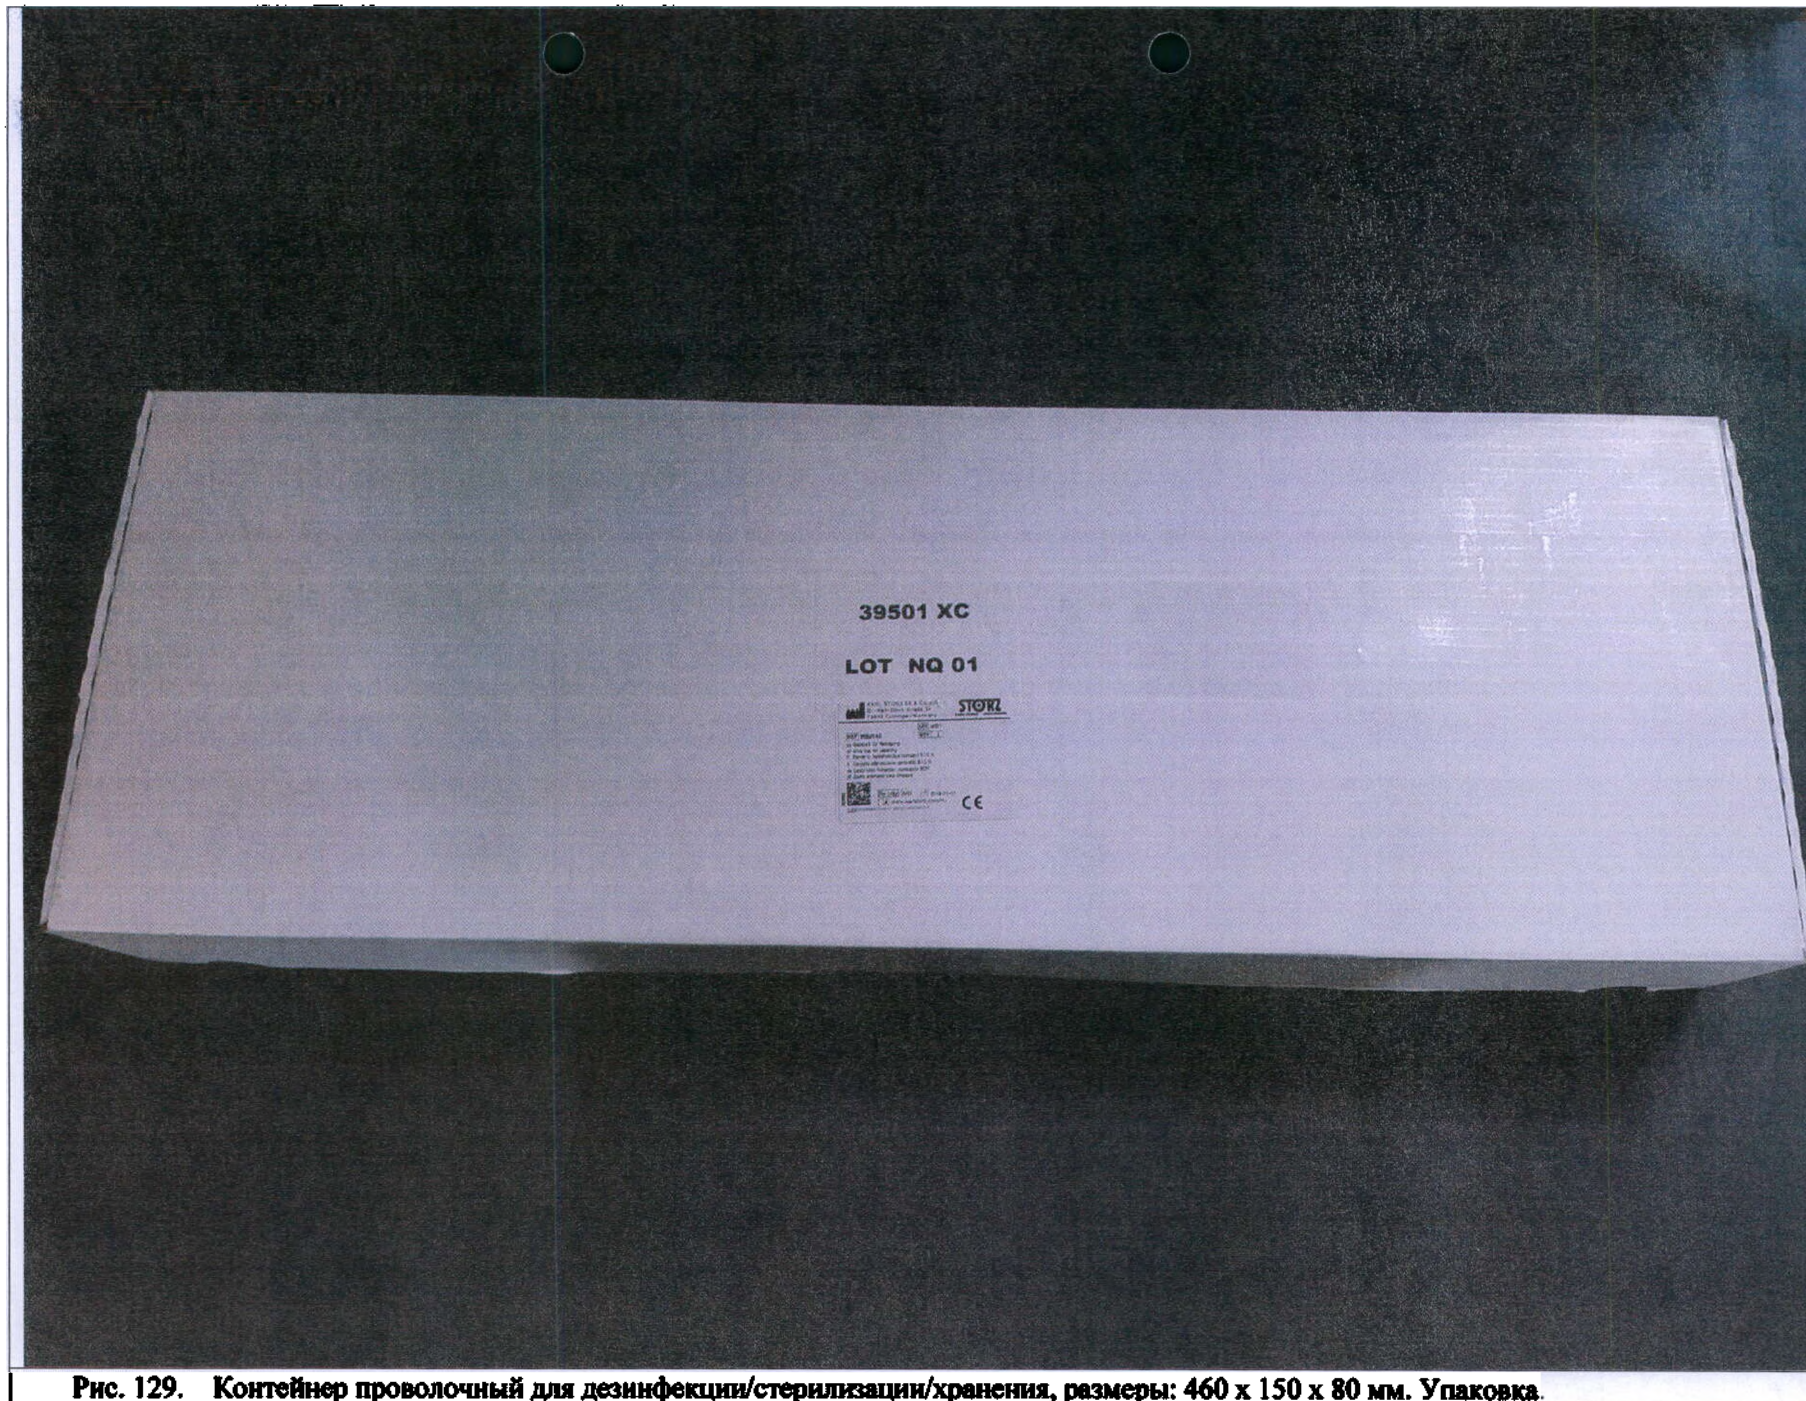


Рис. 129. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 460 x 150 x 80 мм. Упаковка.

39501 XC

LOT NQ 01



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSCOPE

LOT NQ01

QTY 1

REF 39501XC

de Siebkorb für Reinigung
en Wire tray for cleaning
fr Panier p. hystéroscope compact B.I.O.H.
it Cestello isteroscopio compatto B.I.O.H.
es Cesto filtro histerosc. compacto BIOH
pt Cesto aramado para limpeza

020002



Rx only MD 2019-01-01

www.karlstorz.com/ifu

UDI 01/0404855125414111119016100/A00Y422276



Рис. 130. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 460 x 150 x 80 мм. Маркировка на упаковке.

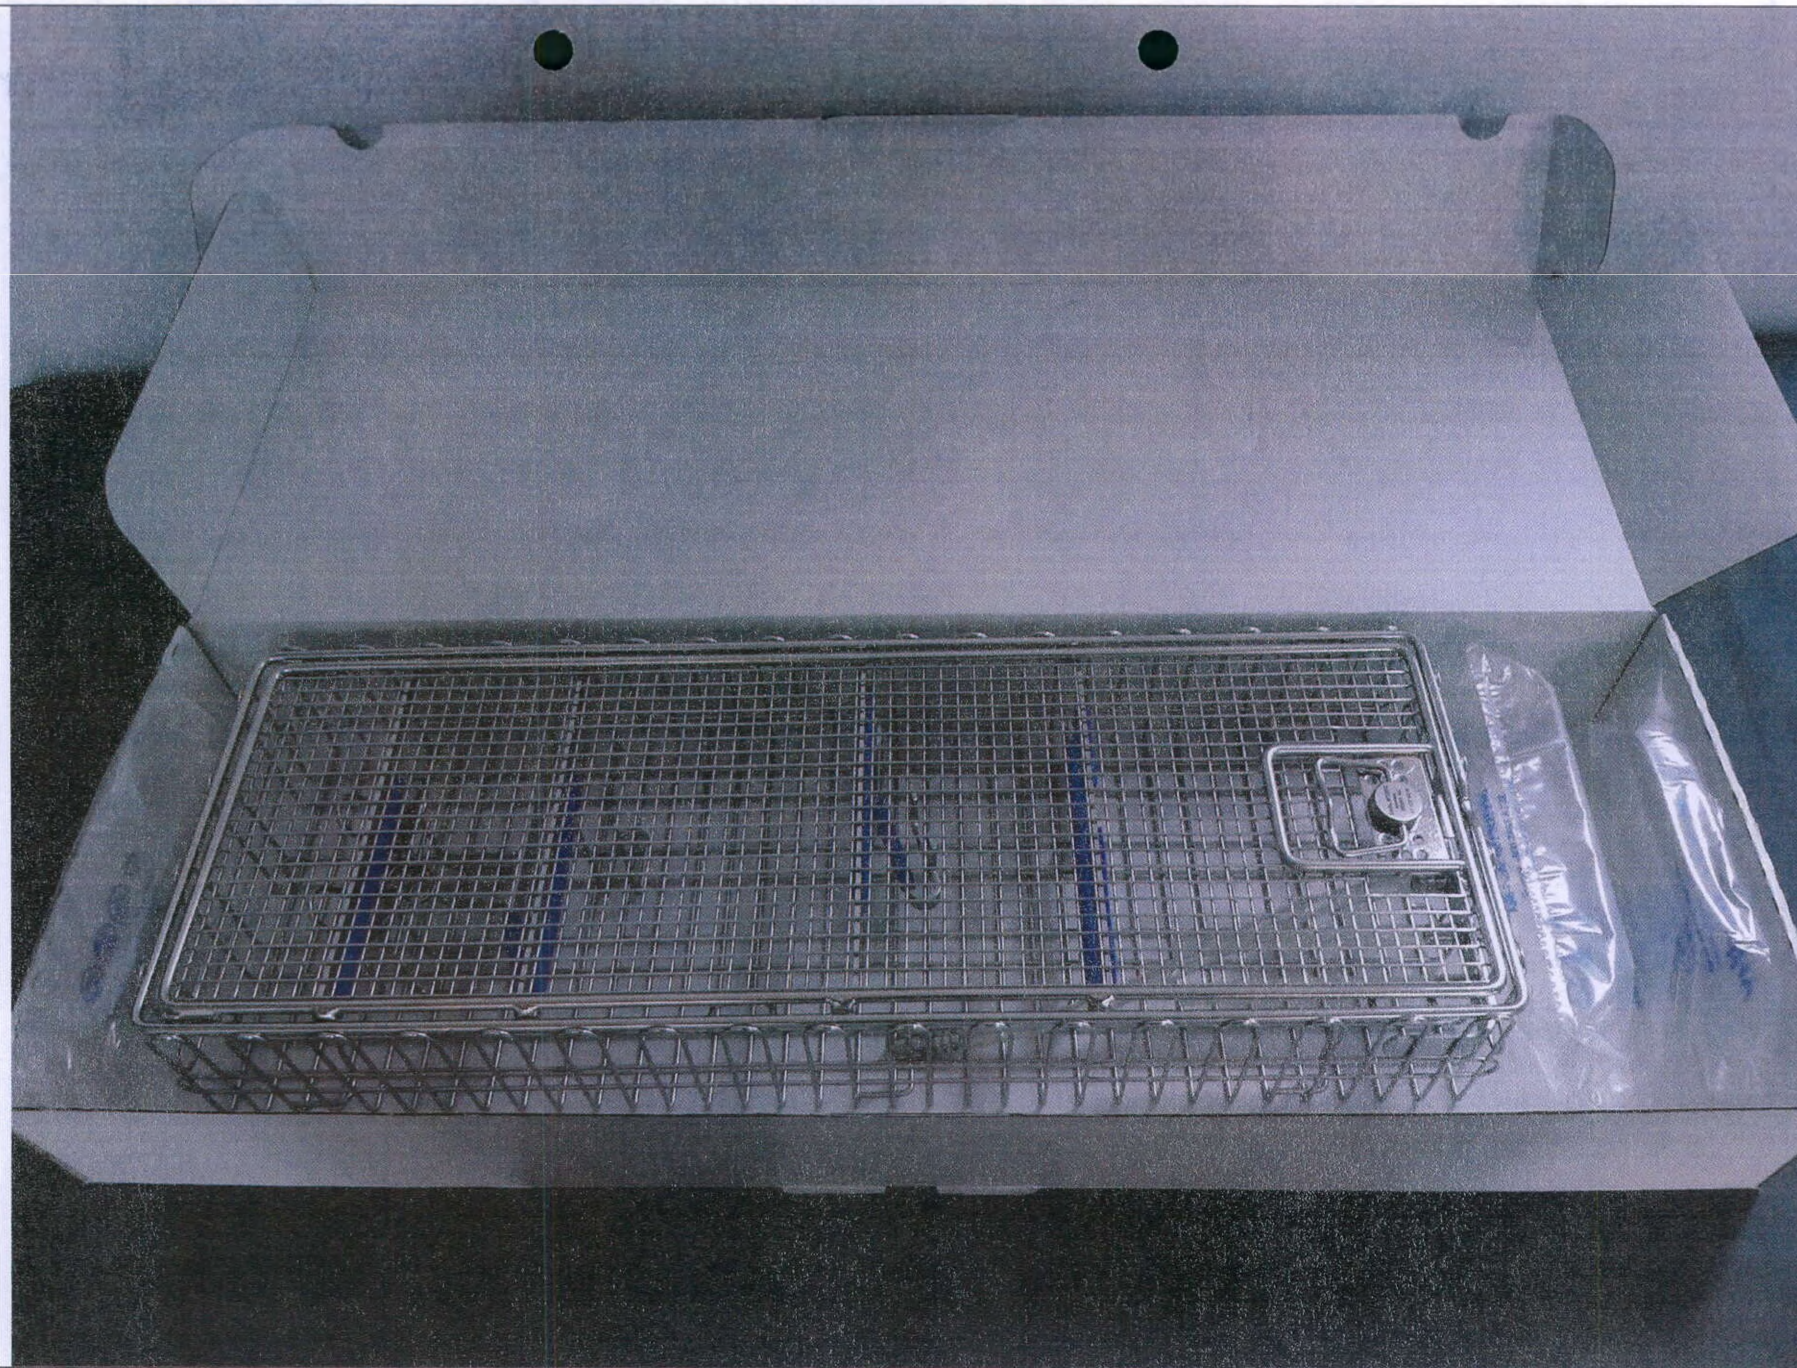


Рис. 131. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 460 x 150 x 80 мм.

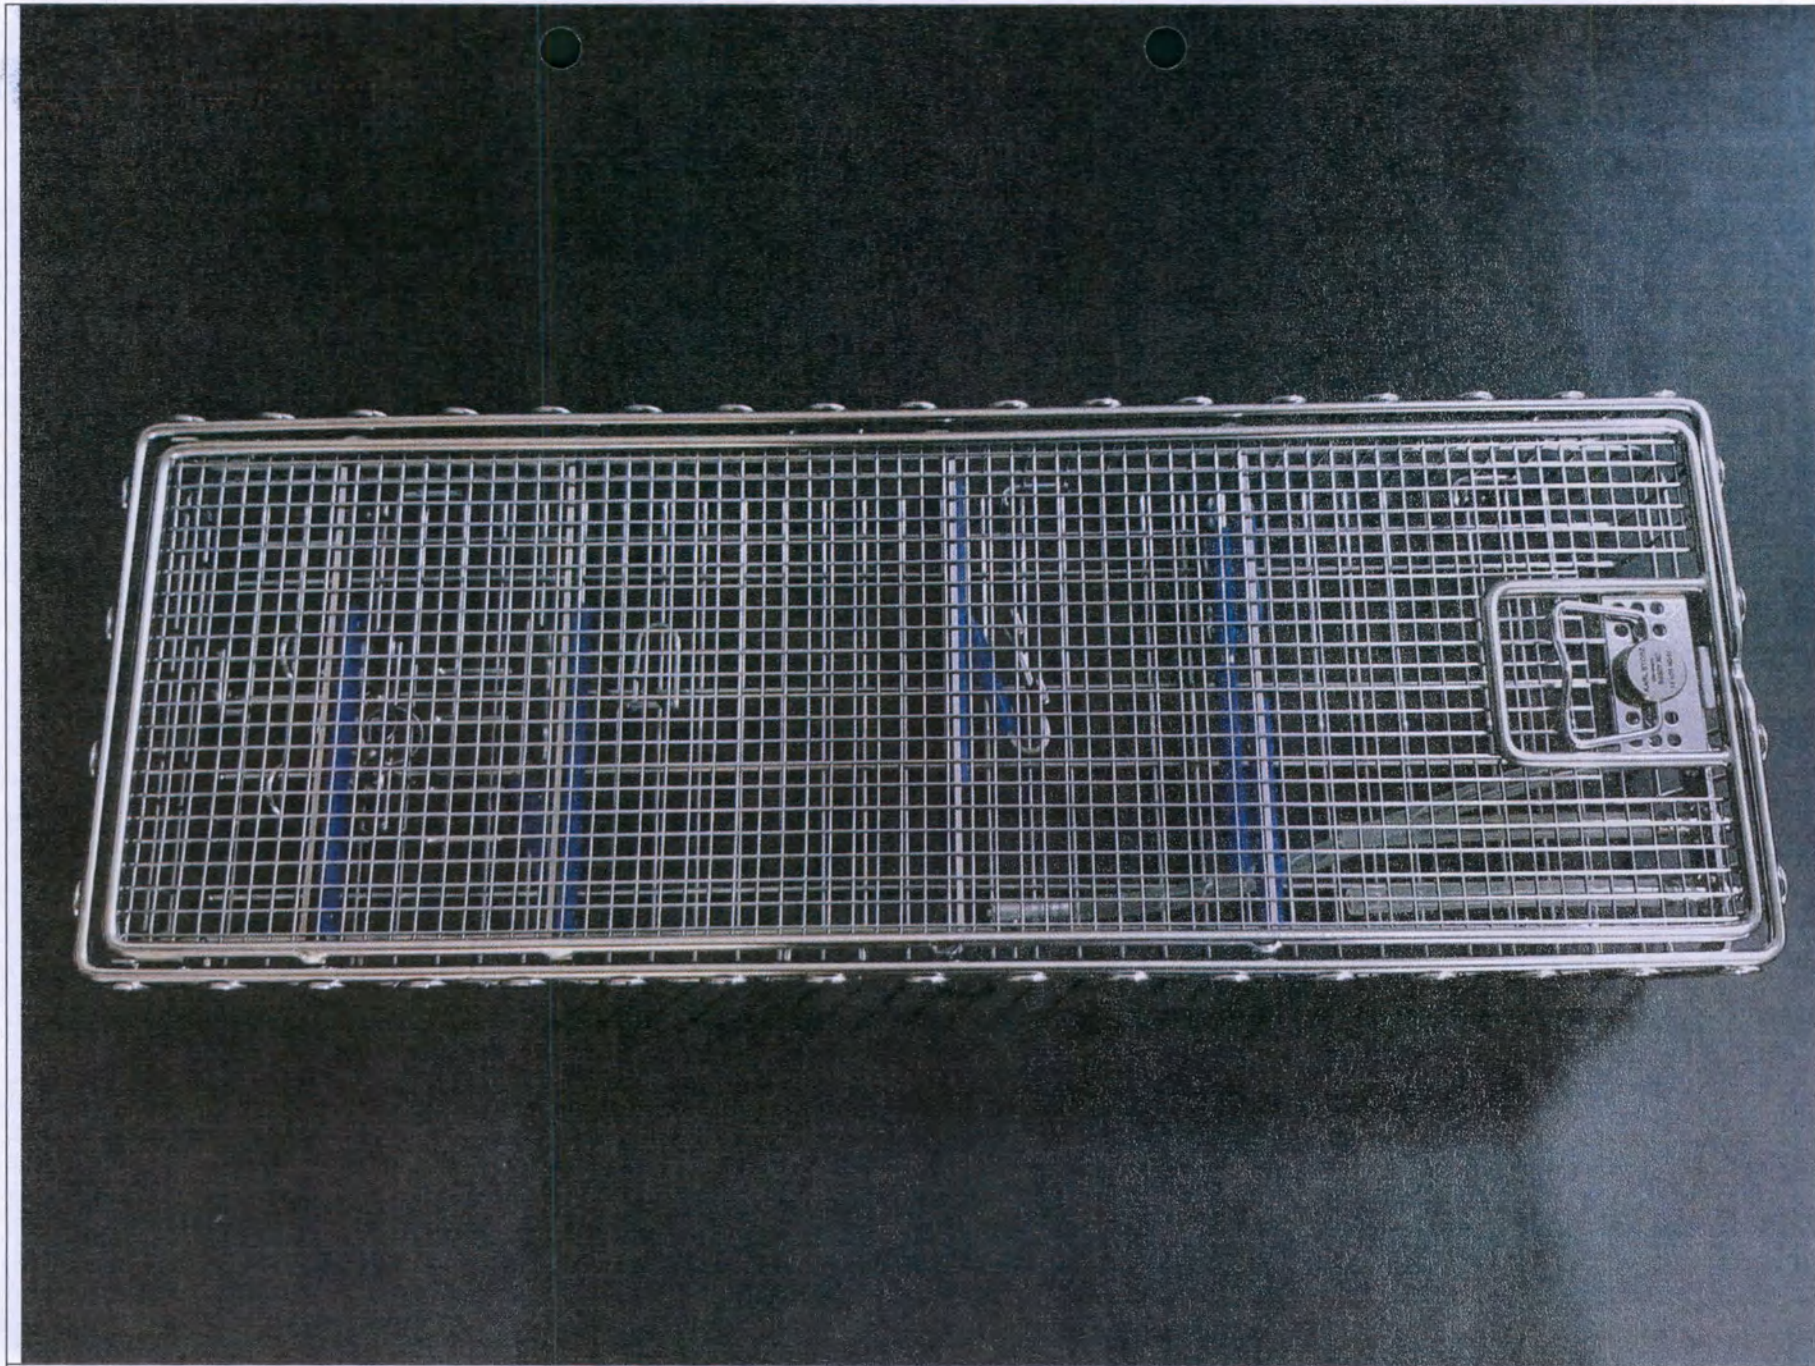


Рис. 132. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 460 x 150 x 80 мм.

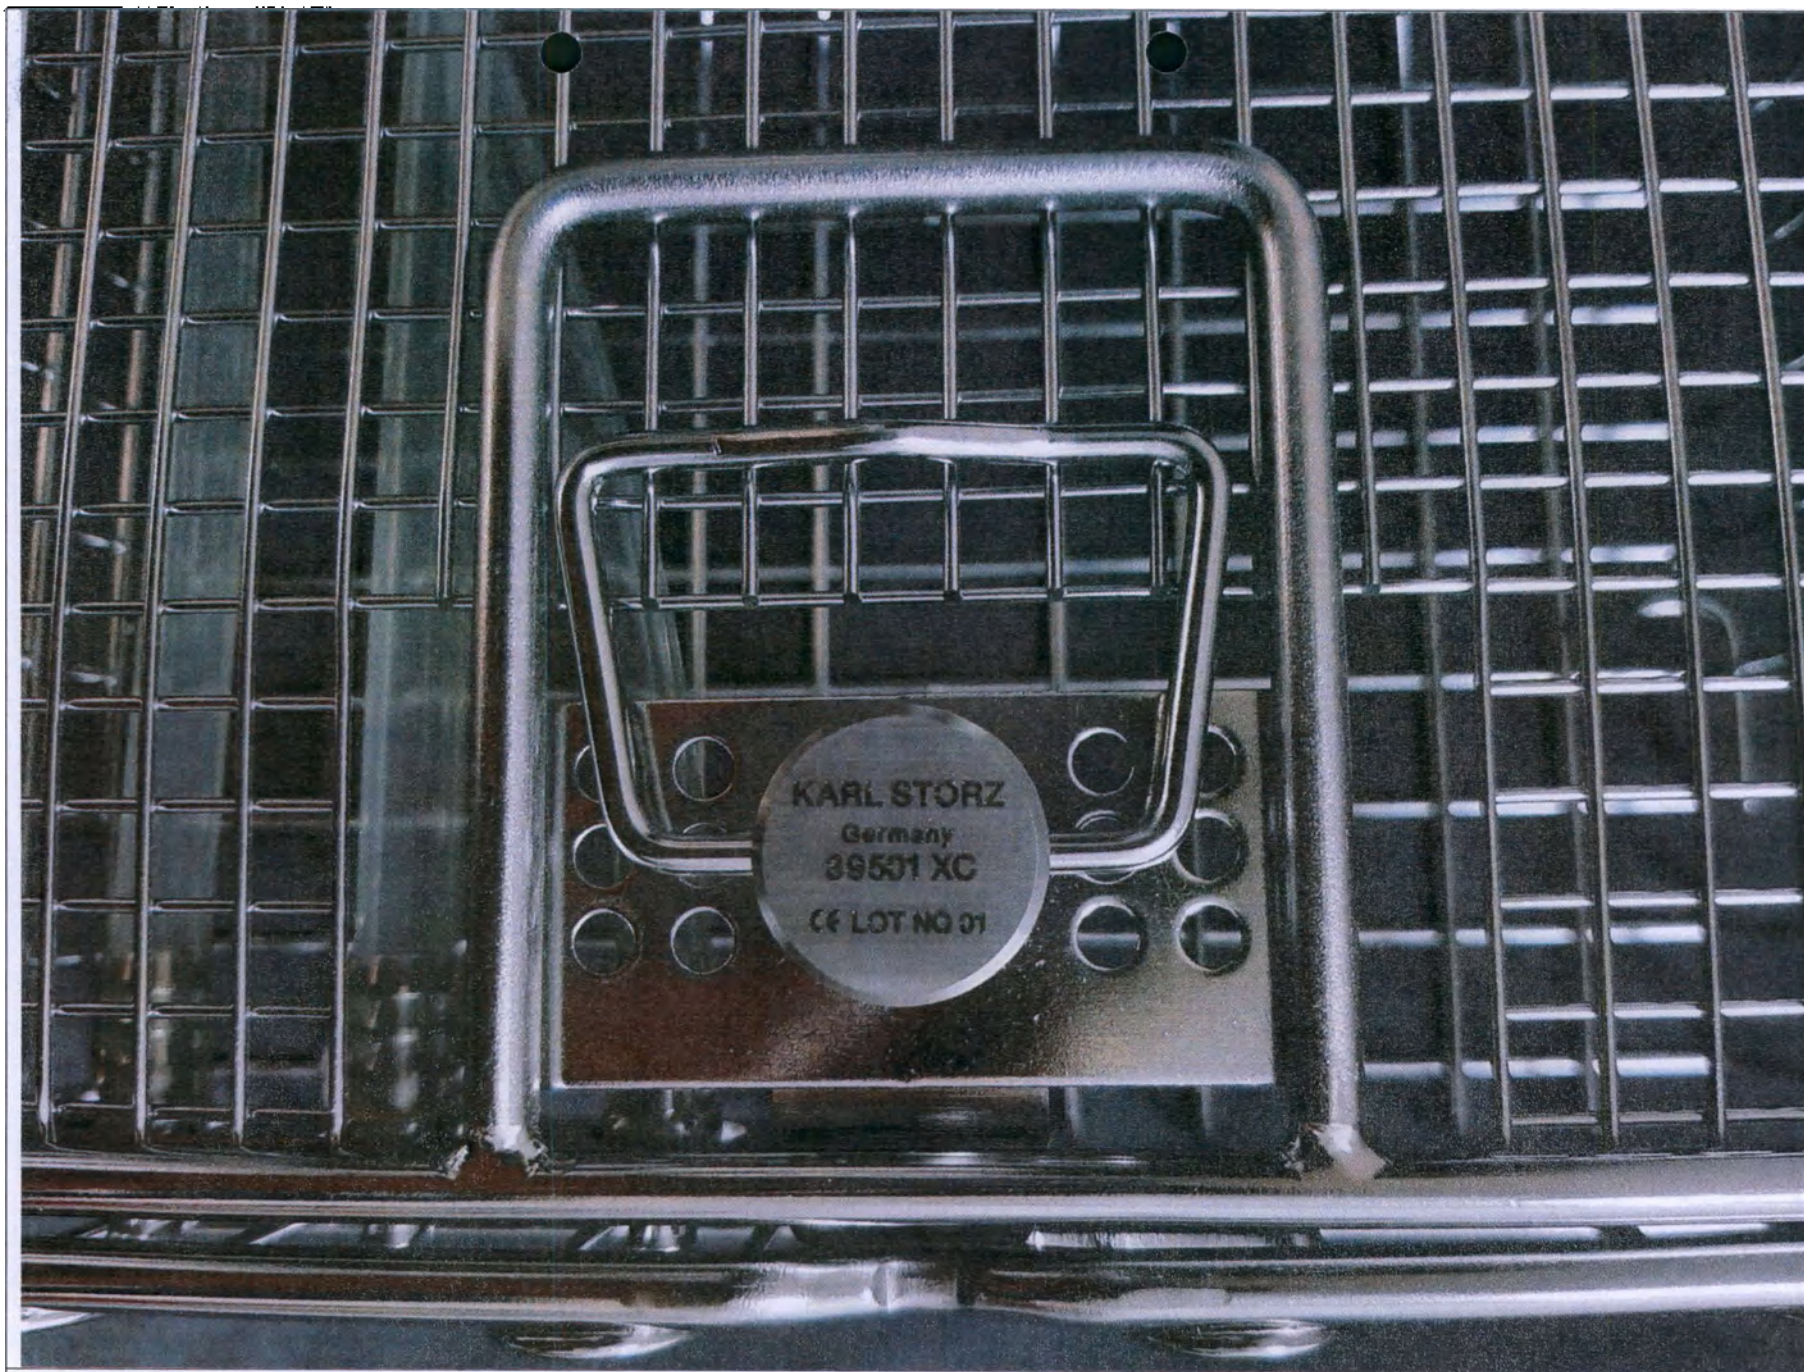


Рис. 133. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 460 x 150 x 80 мм.



Рис. 134. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 460 x 150 x 80 мм.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ ENDOSKOPE

Эндоскоп жесткий для гинекологических манипуляций в
вариантах исполнения с принадлежностями:
Эндоскоп жесткий HOPKINS для фертилоскопии, направление
наблюдения 30°, диаметр 2,9 мм, длина 30 см, в составе:

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Рис. 135. Пример русскоязычной маркировки на упаковке, на примере варианта исполнения: Эндоскоп жесткий HOPKINS для фертилоскопии, направление наблюдения 30°, диаметр 2,9 мм, длина 30 см.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

Производитель	Karl Storz SE & Co.KG Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Germany (Германия)
Уполномоченный представитель на территории РФ	Общество с ограниченной ответственностью Карл Шторц – Эндоскопы Восток (ООО КШТЭ ВОСТОК) Россия, 115114, Москва, Дербеневская набережная, 7, стр. 4
Информация о сроке службы	– см. инструкцию по эксплуатации
Сайт	https://www.karlstorz.com/de/ru/index.htm
Сделано в:	Германия

Рис. 136. Пример русскоязычной маркировки на упаковке, на примере варианта исполнения: Эндоскоп жесткий HOPKINS для фертилоскопии, направление наблюдения 30°, диаметр 2,9 мм, длина 30 см.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на _____
137 _____ листах

