

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

«30» июня 2022 г.






ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987783

КУСАЙЛО Р. В.

Фотографические изображения изделия:

**Набор реагентов для количественного определения эстрадиола
электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro
(Estradiol (Electrochemiluminescence Immunoassay) / E2)**


Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.
(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай

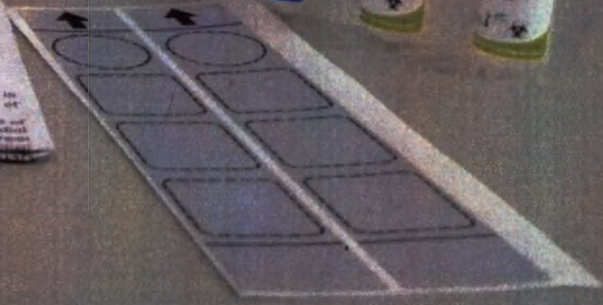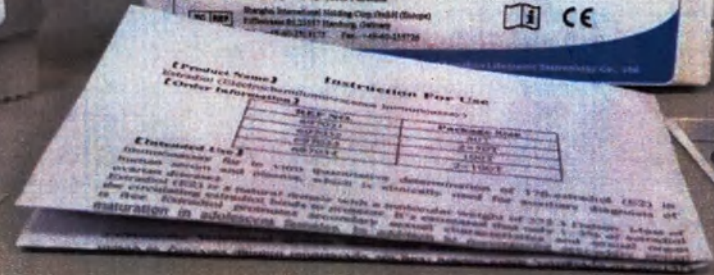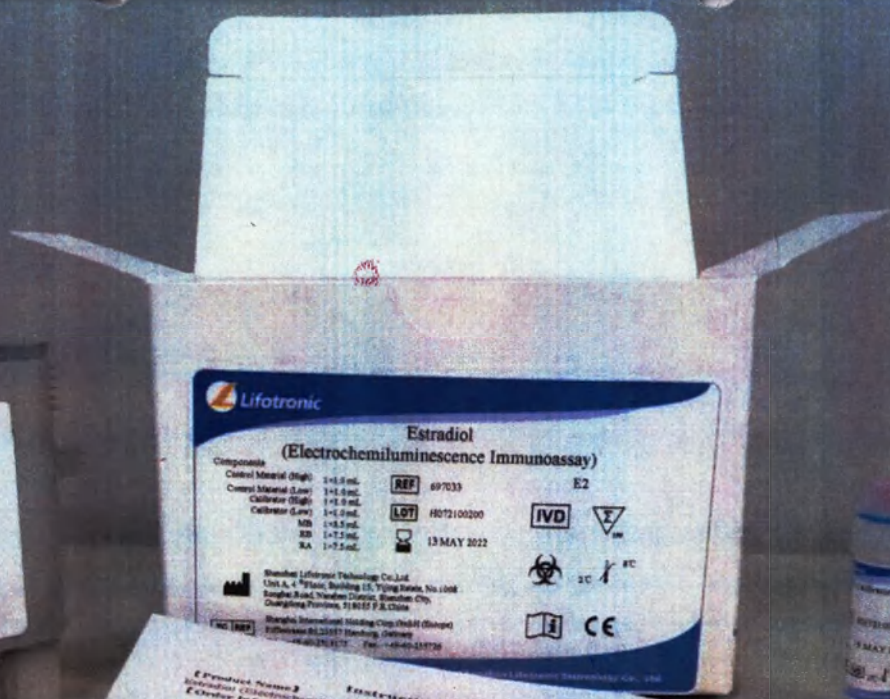




Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения эстрадиола электрохемилюминесцентным методом в анализаторах ECL для диагностики in vitro (Estradiol (Electrochemiluminescence Immunoassay) / E2))



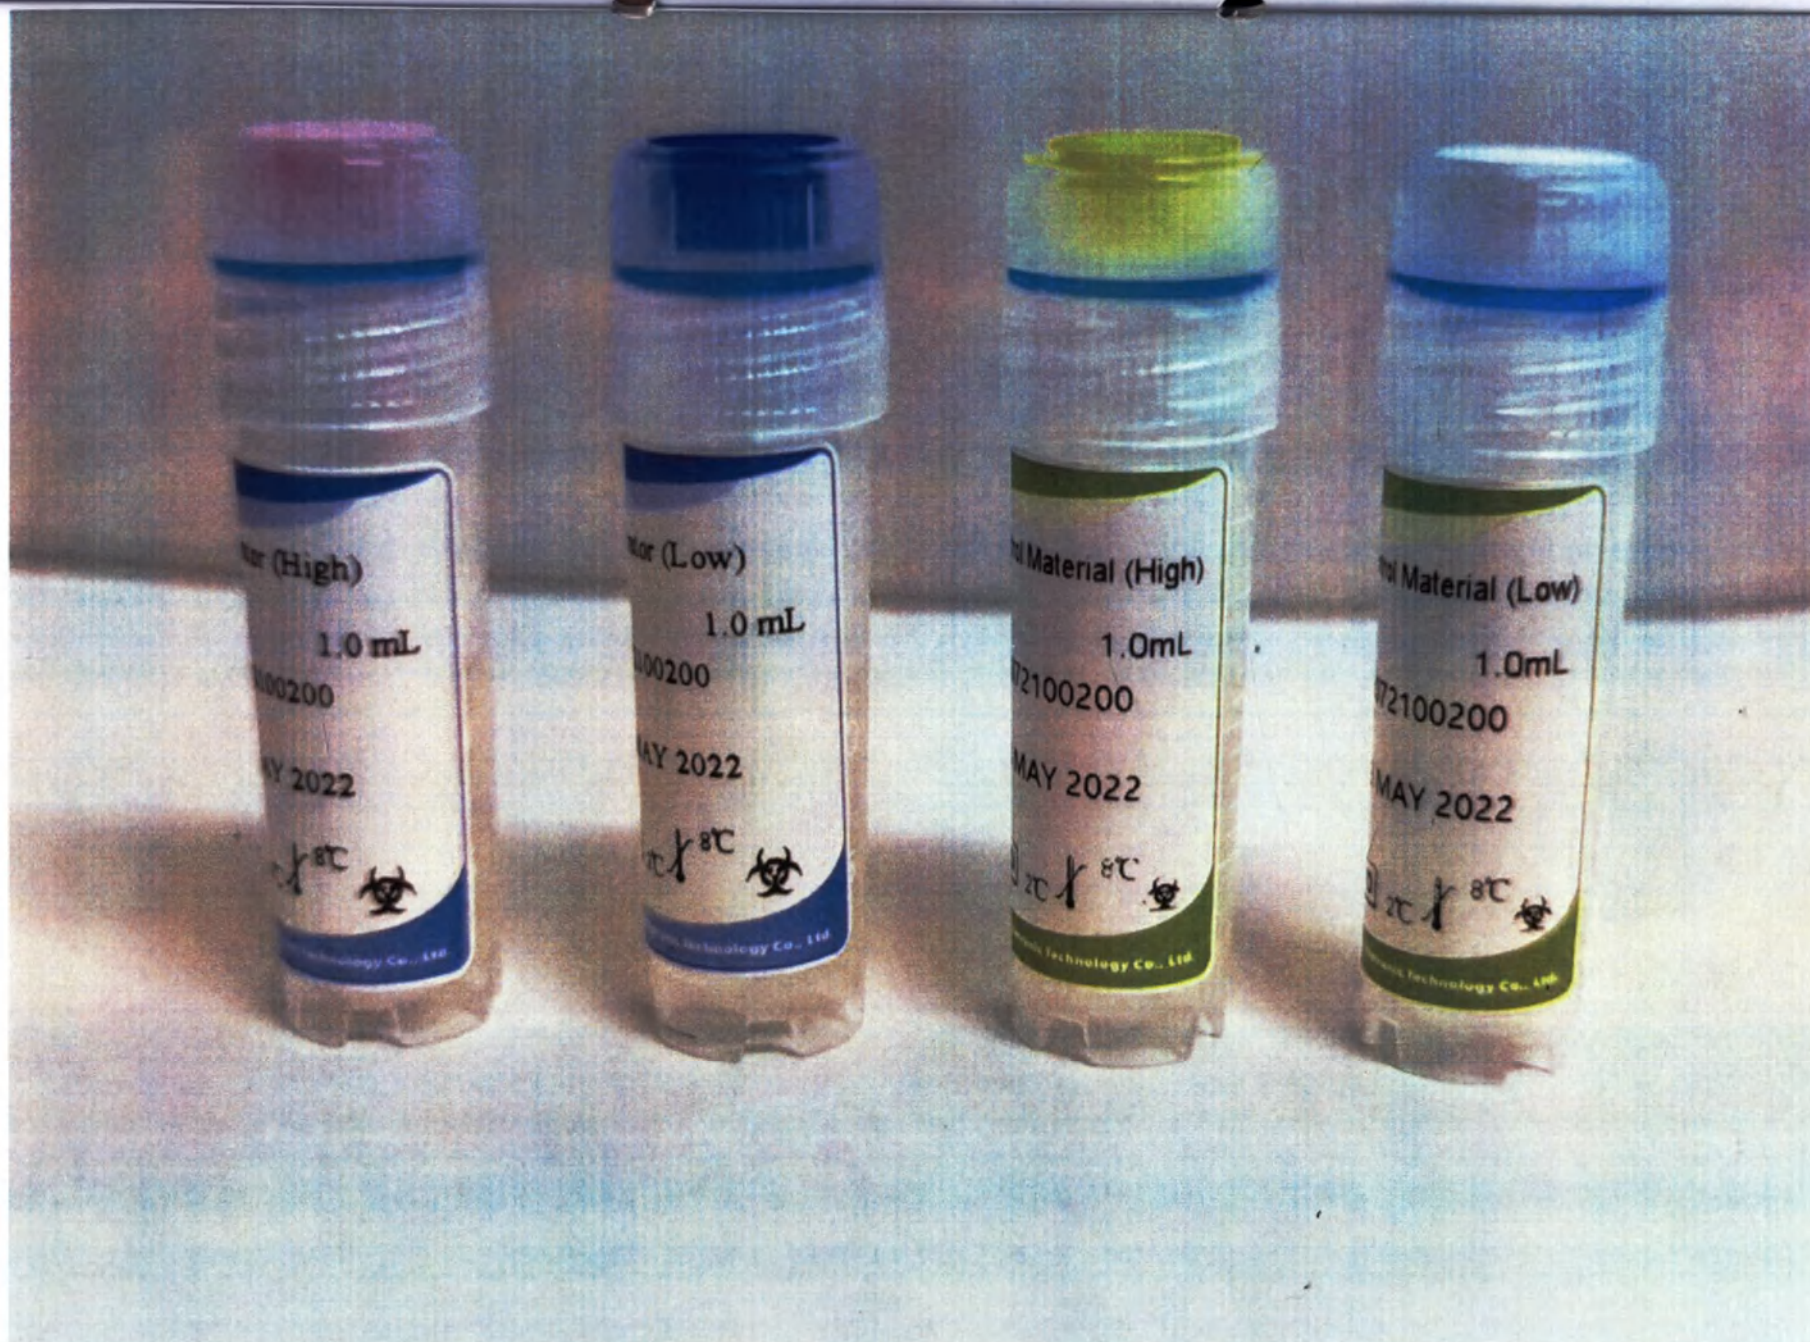

Калибратор (низкий и высокий уровень), Материал контрольный (низкий и высокий уровень) (Набор реагентов для количественного определения эстрадиола
тним методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Estradiol (Electrochemiluminescence Immunoassay) / E2))

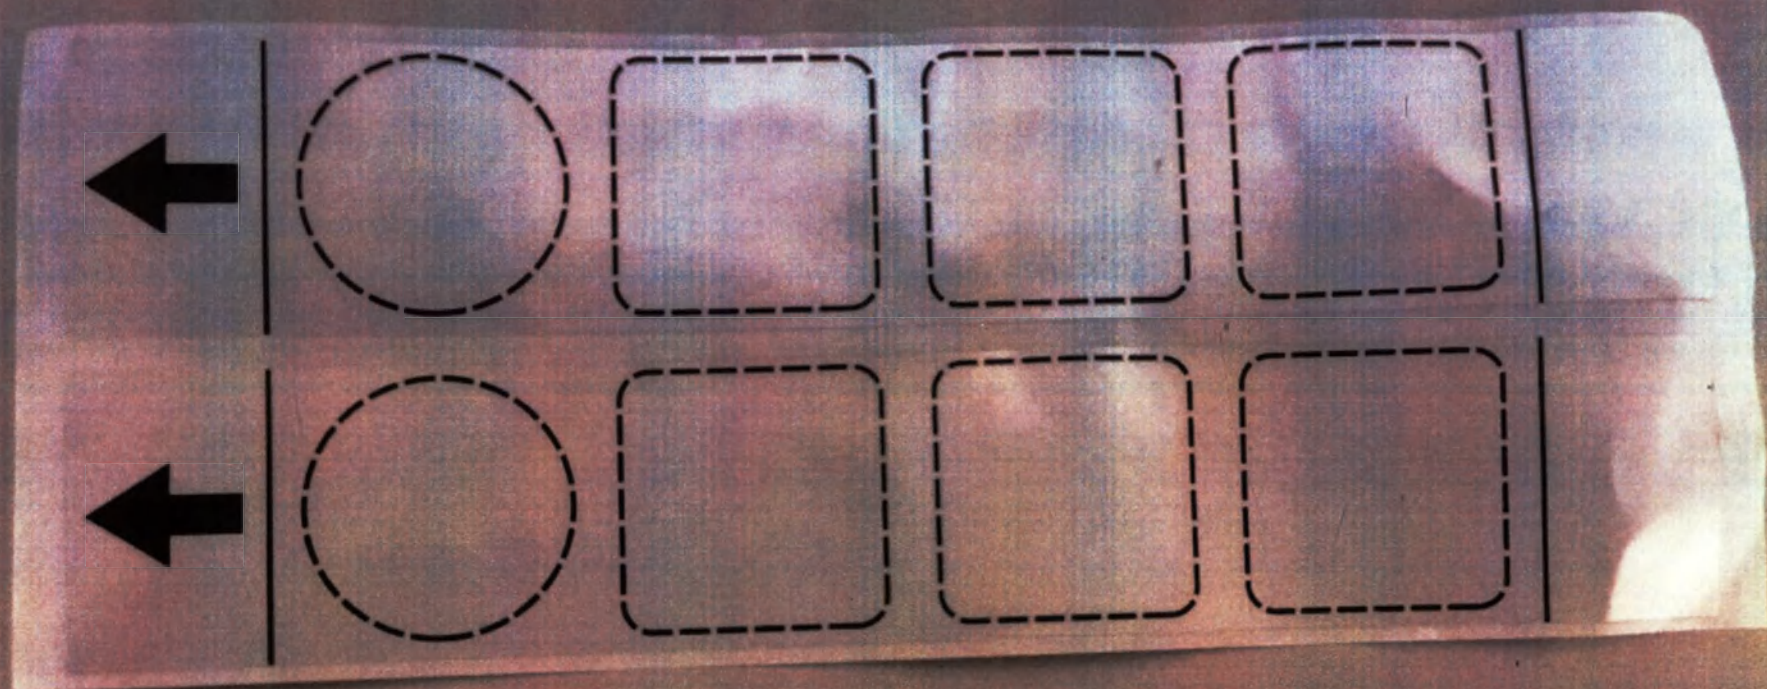


Этикетки для запечатывания флаконов (Набор реагентов для количественного определения эстрадиола электрохемилюминесцентным методом

E2 Quality Control Card


LOT H072100200  13 MAY 2022

QC Range(Low): 265.897-486.837 pg/mL

QC Range(High): 1022.436-2091.922 pg/mL



Этикетка результатов значений материалов контрольных (Набор реагентов для количественного определения эстрадиола электрохемилюминесцентным методом



Estradiol E2
(Electrochemiluminescence Immunoassay)



Components

MB 3.5 mL

LOT H072100200

RB 7.5 mL

SN 00002

RA 7.5 mL

13 MAY 2022



2°C 8°C

Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения эстрадиола электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Estradiol (Electrochemiluminescence Immunoassay) / E2))

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 8 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789

КУСАЙЛО Р.В.