

75
Years

Shaping the Future of Endoscopy with you



STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

Общество с ограниченной ответственностью КАРЛ ШТОРЦ – Эндоскопы ВОСТОК (ООО КШТЭ ВОСТОК)
Россия, 115114, Москва, Дербеневская наб, 7, стр. 4

Согласовано

Общество с ограниченной ответственностью КАРЛ ШТОРЦ –
Эндоскопы ВОСТОК (ООО КШТЭ ВОСТОК)

Организация

Россия, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, 7, стр. 4

Адрес

Генеральный директор

Должность


Мартин Пьер Колас

Фамилия, Имя

06.02.2023

Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись/Signature

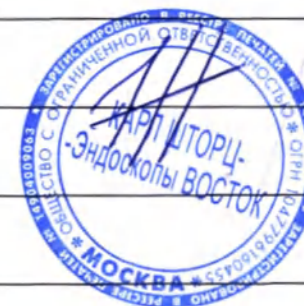

Фотографические изображения
Эндоскоп урологический жесткий HOPKINS в вариантах исполнения
с принадлежностями

2023



Рис. 1. Эндоскоп урологический жесткий HOPKINS в вариантах исполнения. Транспортная упаковка.



Рис. 2. Эндоскоп урологический жесткий HOPKINS в вариантах исполнения. Маркировка на транспортной упаковке.

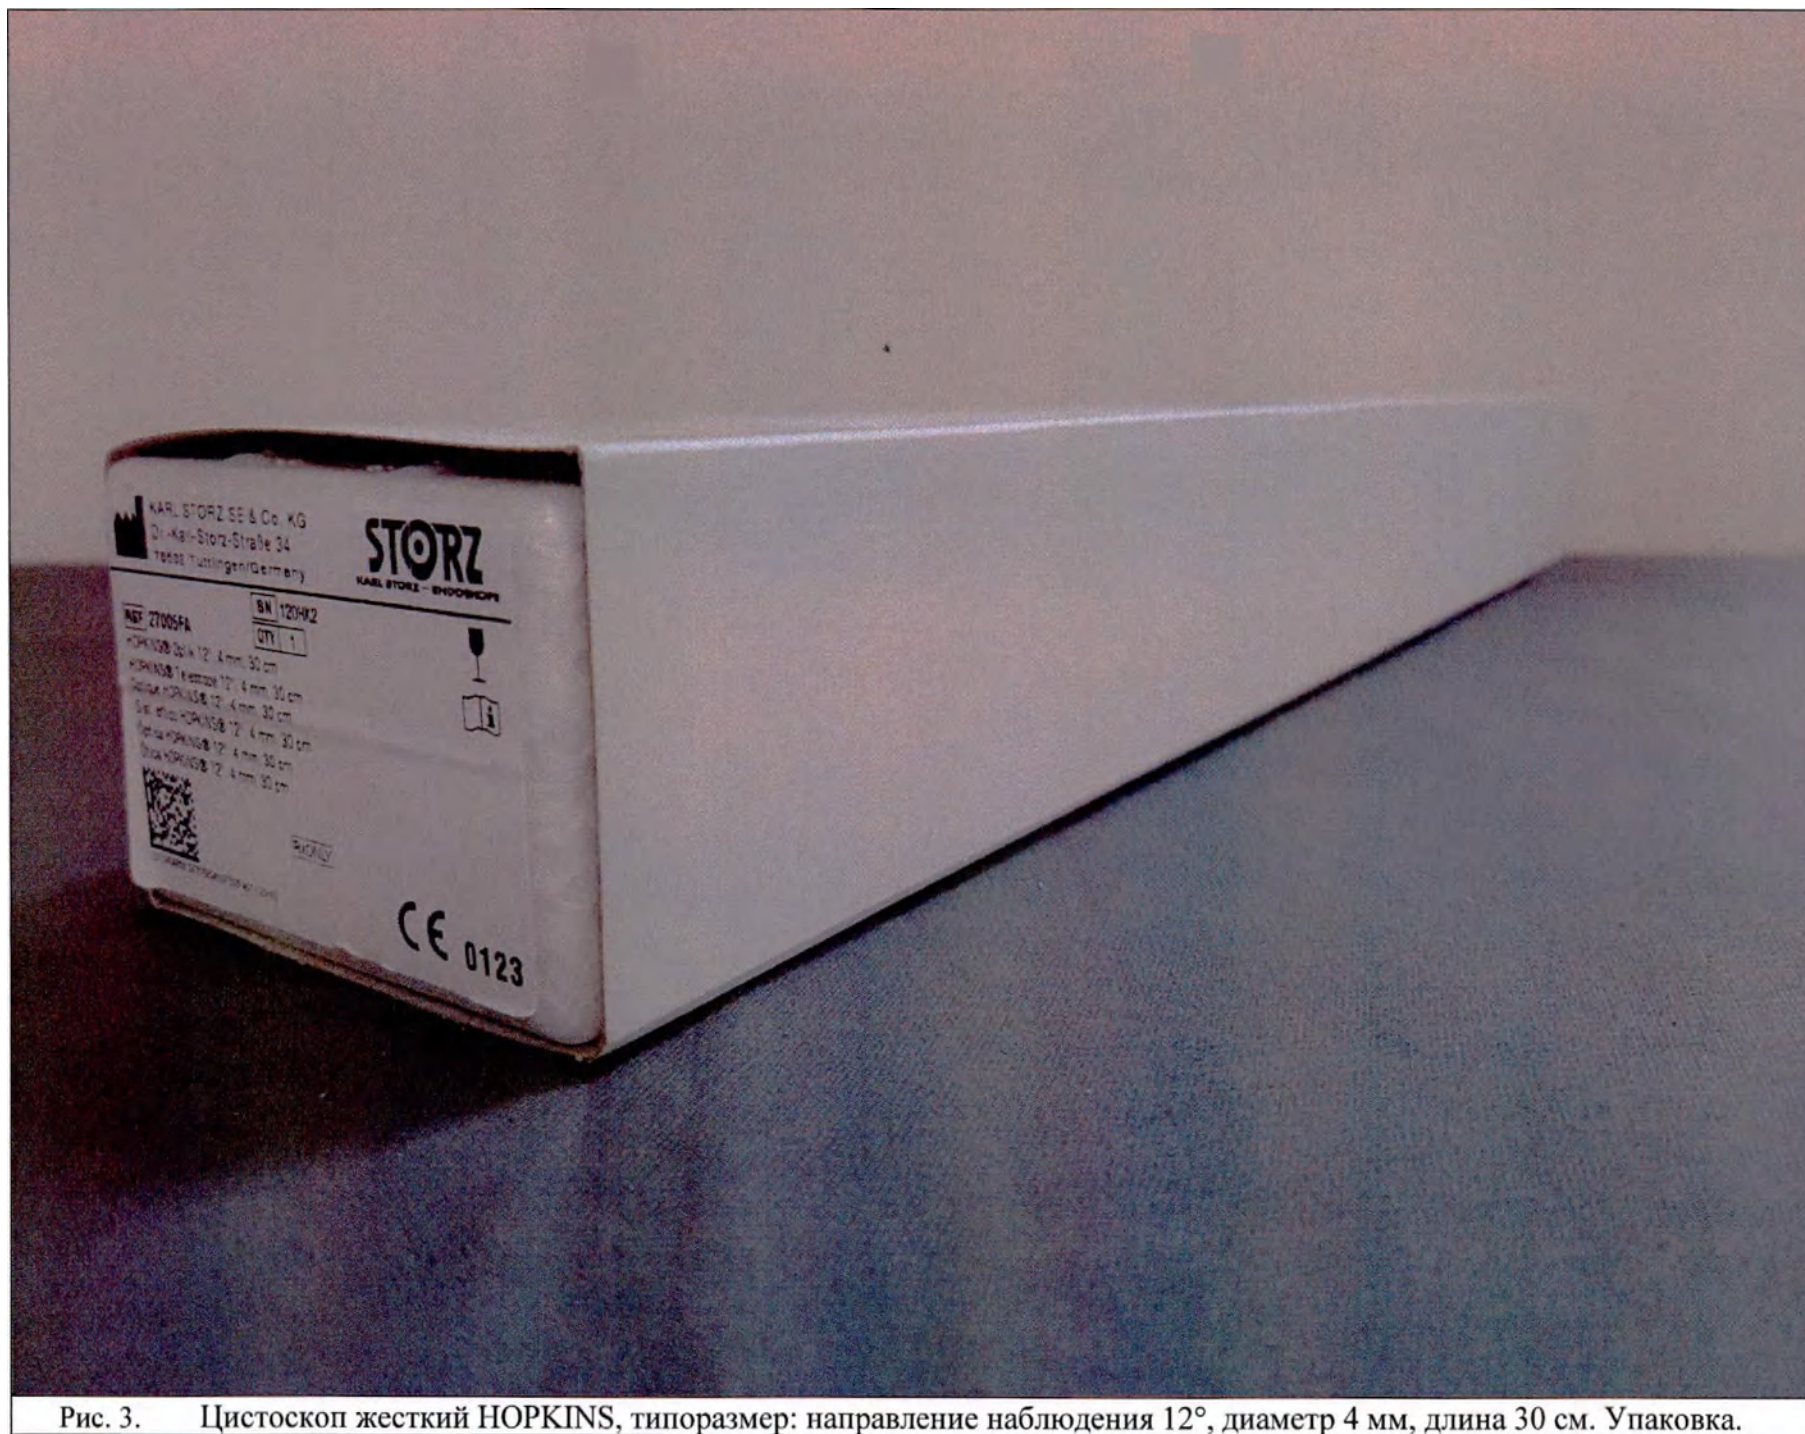


Рис. 3. Цистоскоп жесткий HOPKINS, типоразмер: направление наблюдения 12°, диаметр 4 мм, длина 30 см. Упаковка.

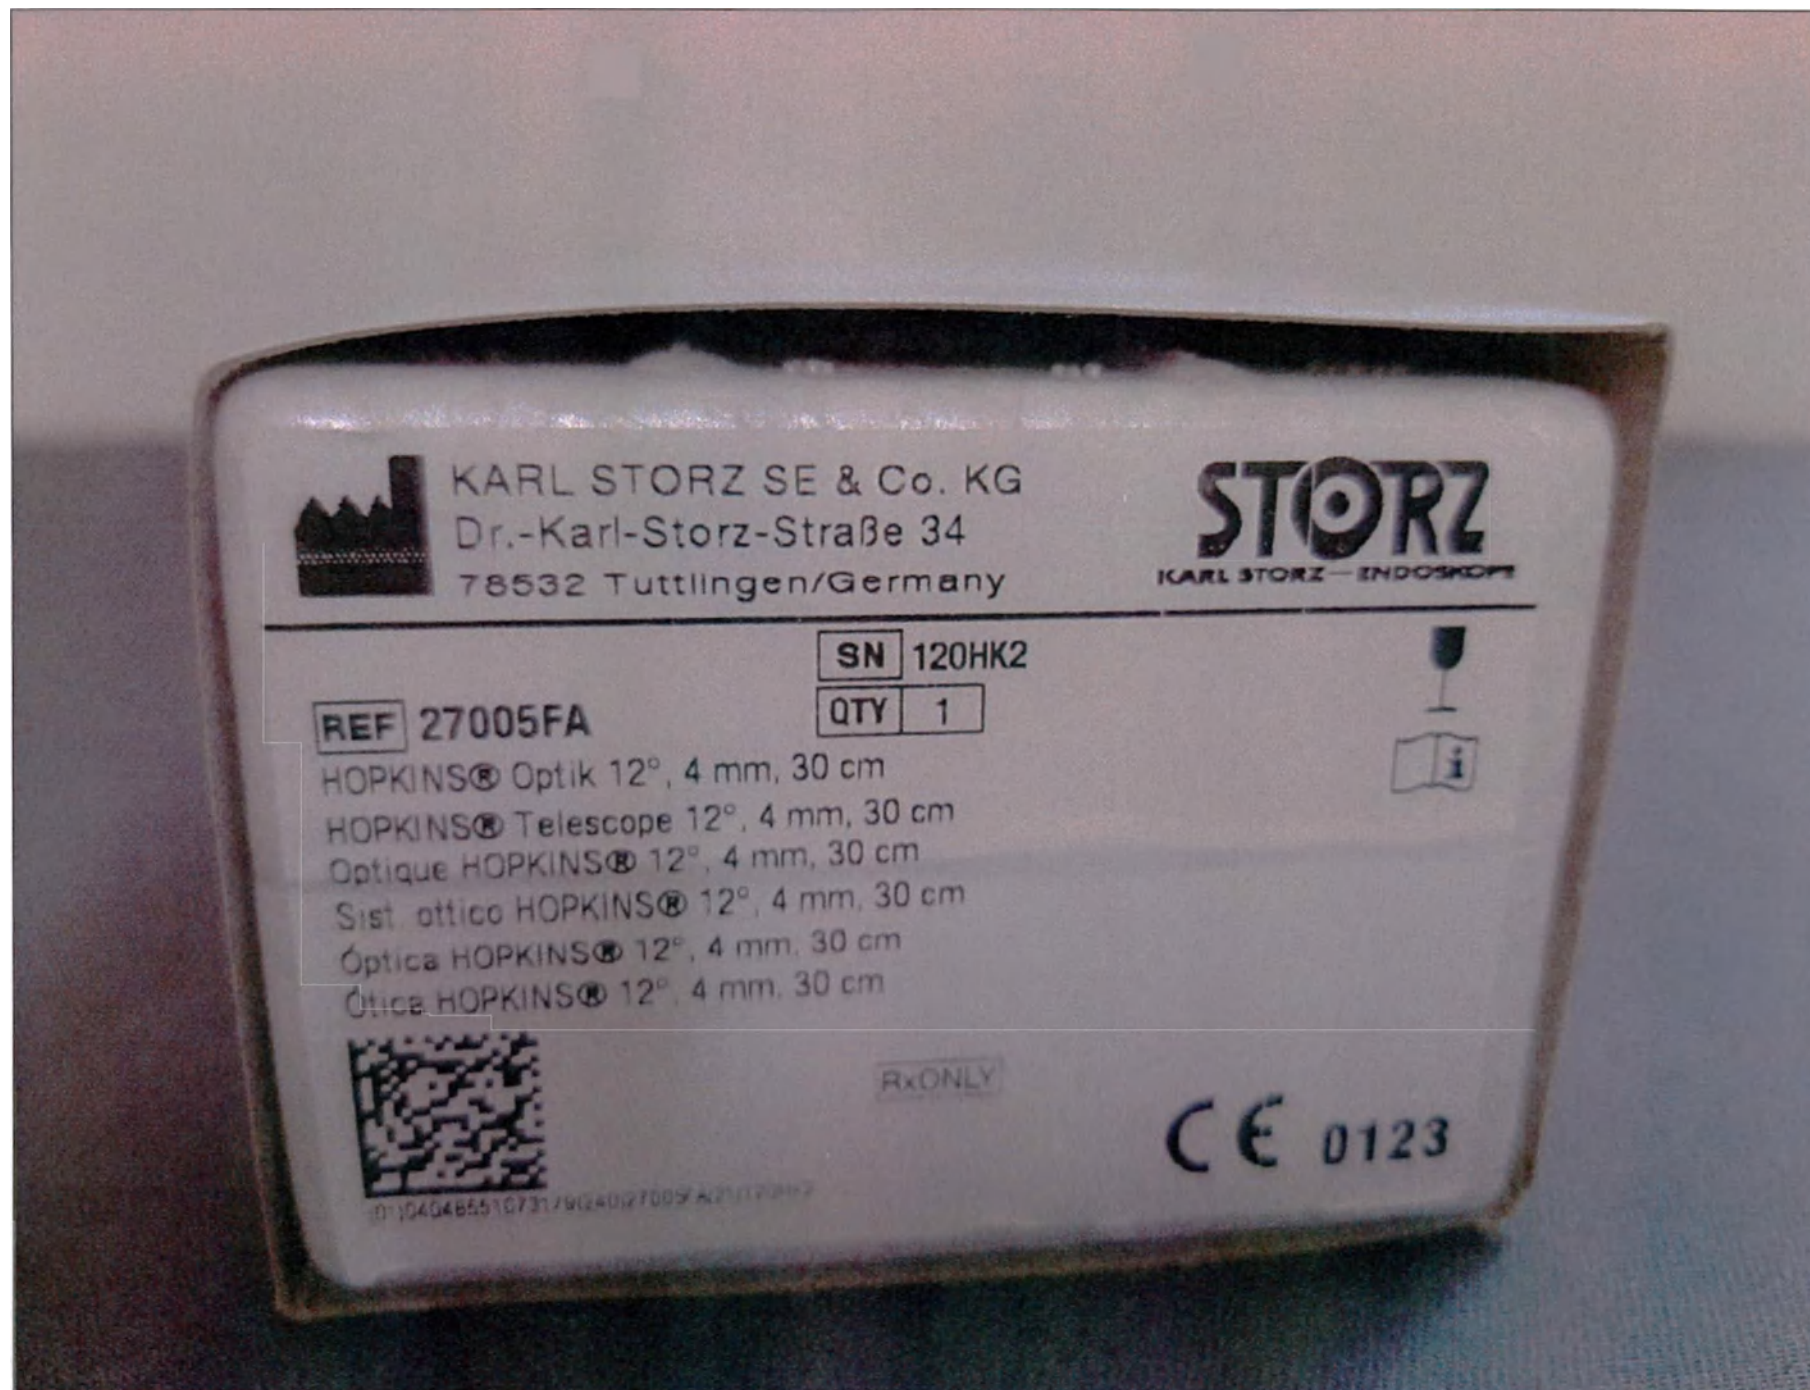


Рис. 4. Цистоскоп жесткий HOPKINS, типоразмер: направление наблюдения 12°, диаметр 4 мм, длина 30 см. Маркировка на упаковке.

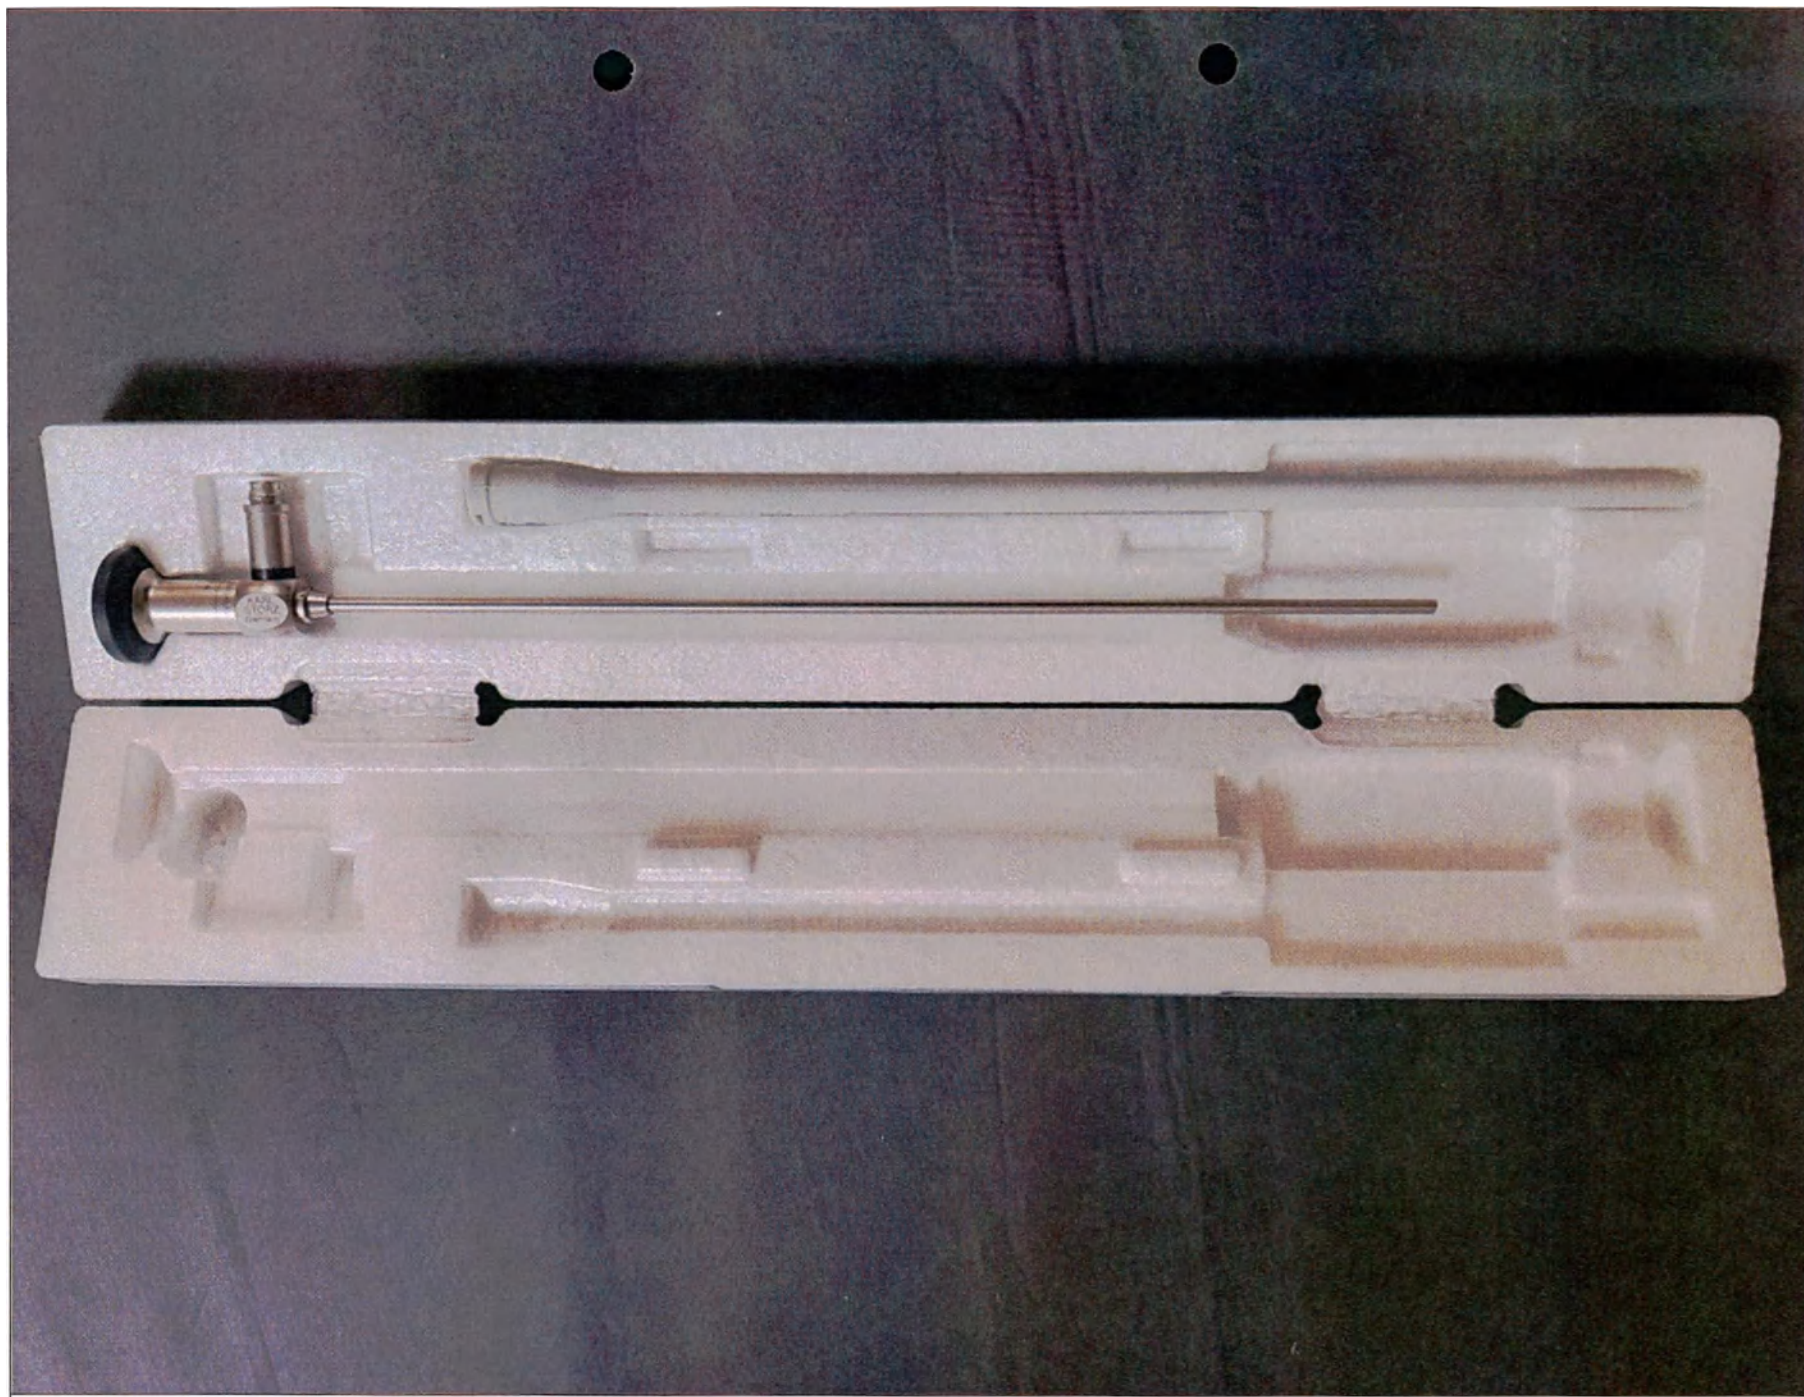


Рис. 5. Цистоскоп жесткий HOPKINS, типоразмер: направление наблюдения 12°, диаметр 4 мм, длина 30 см

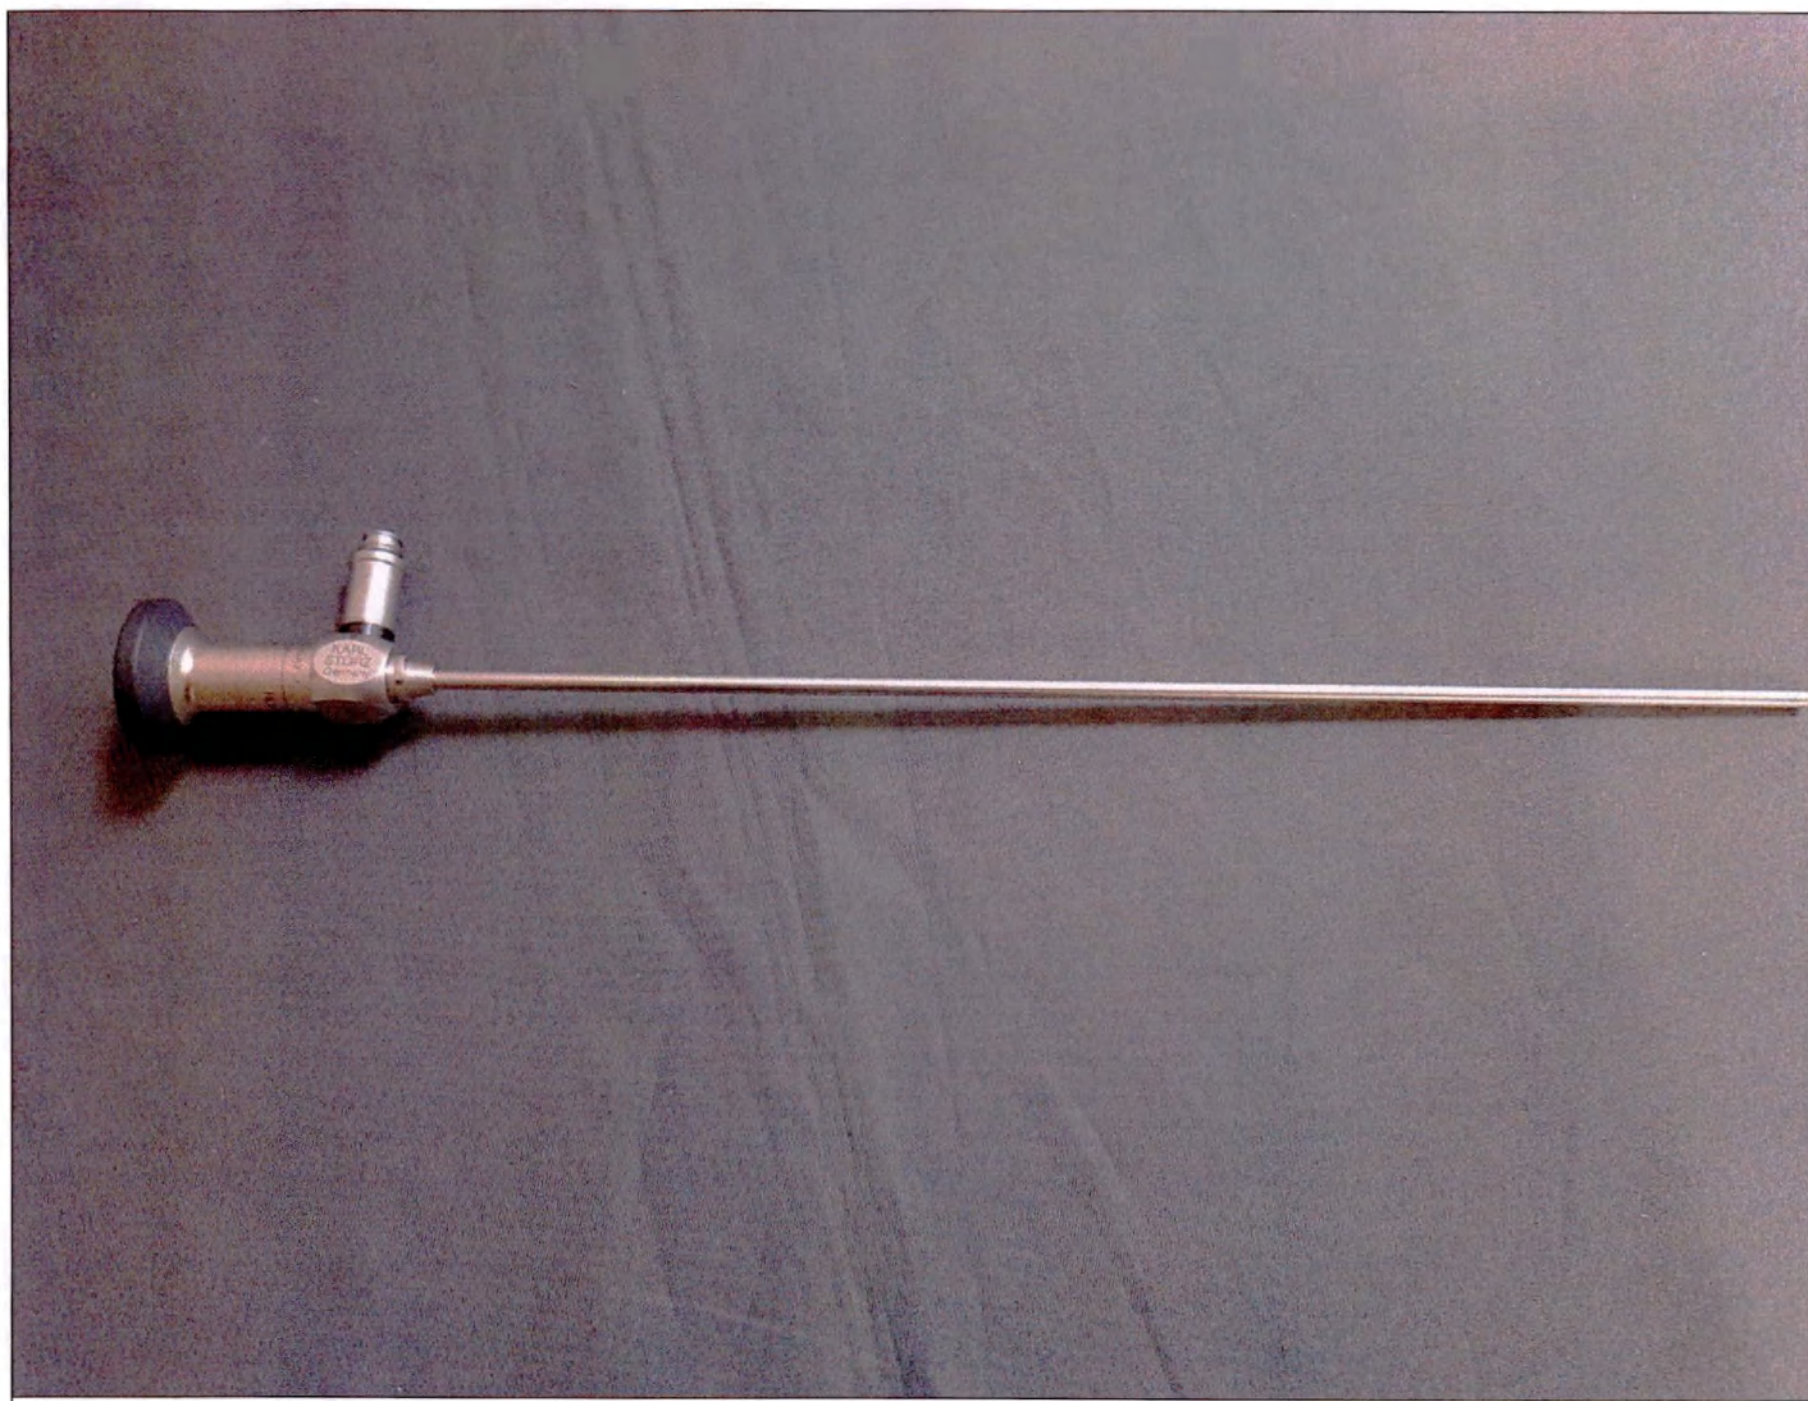


Рис. 6. Цистоскоп

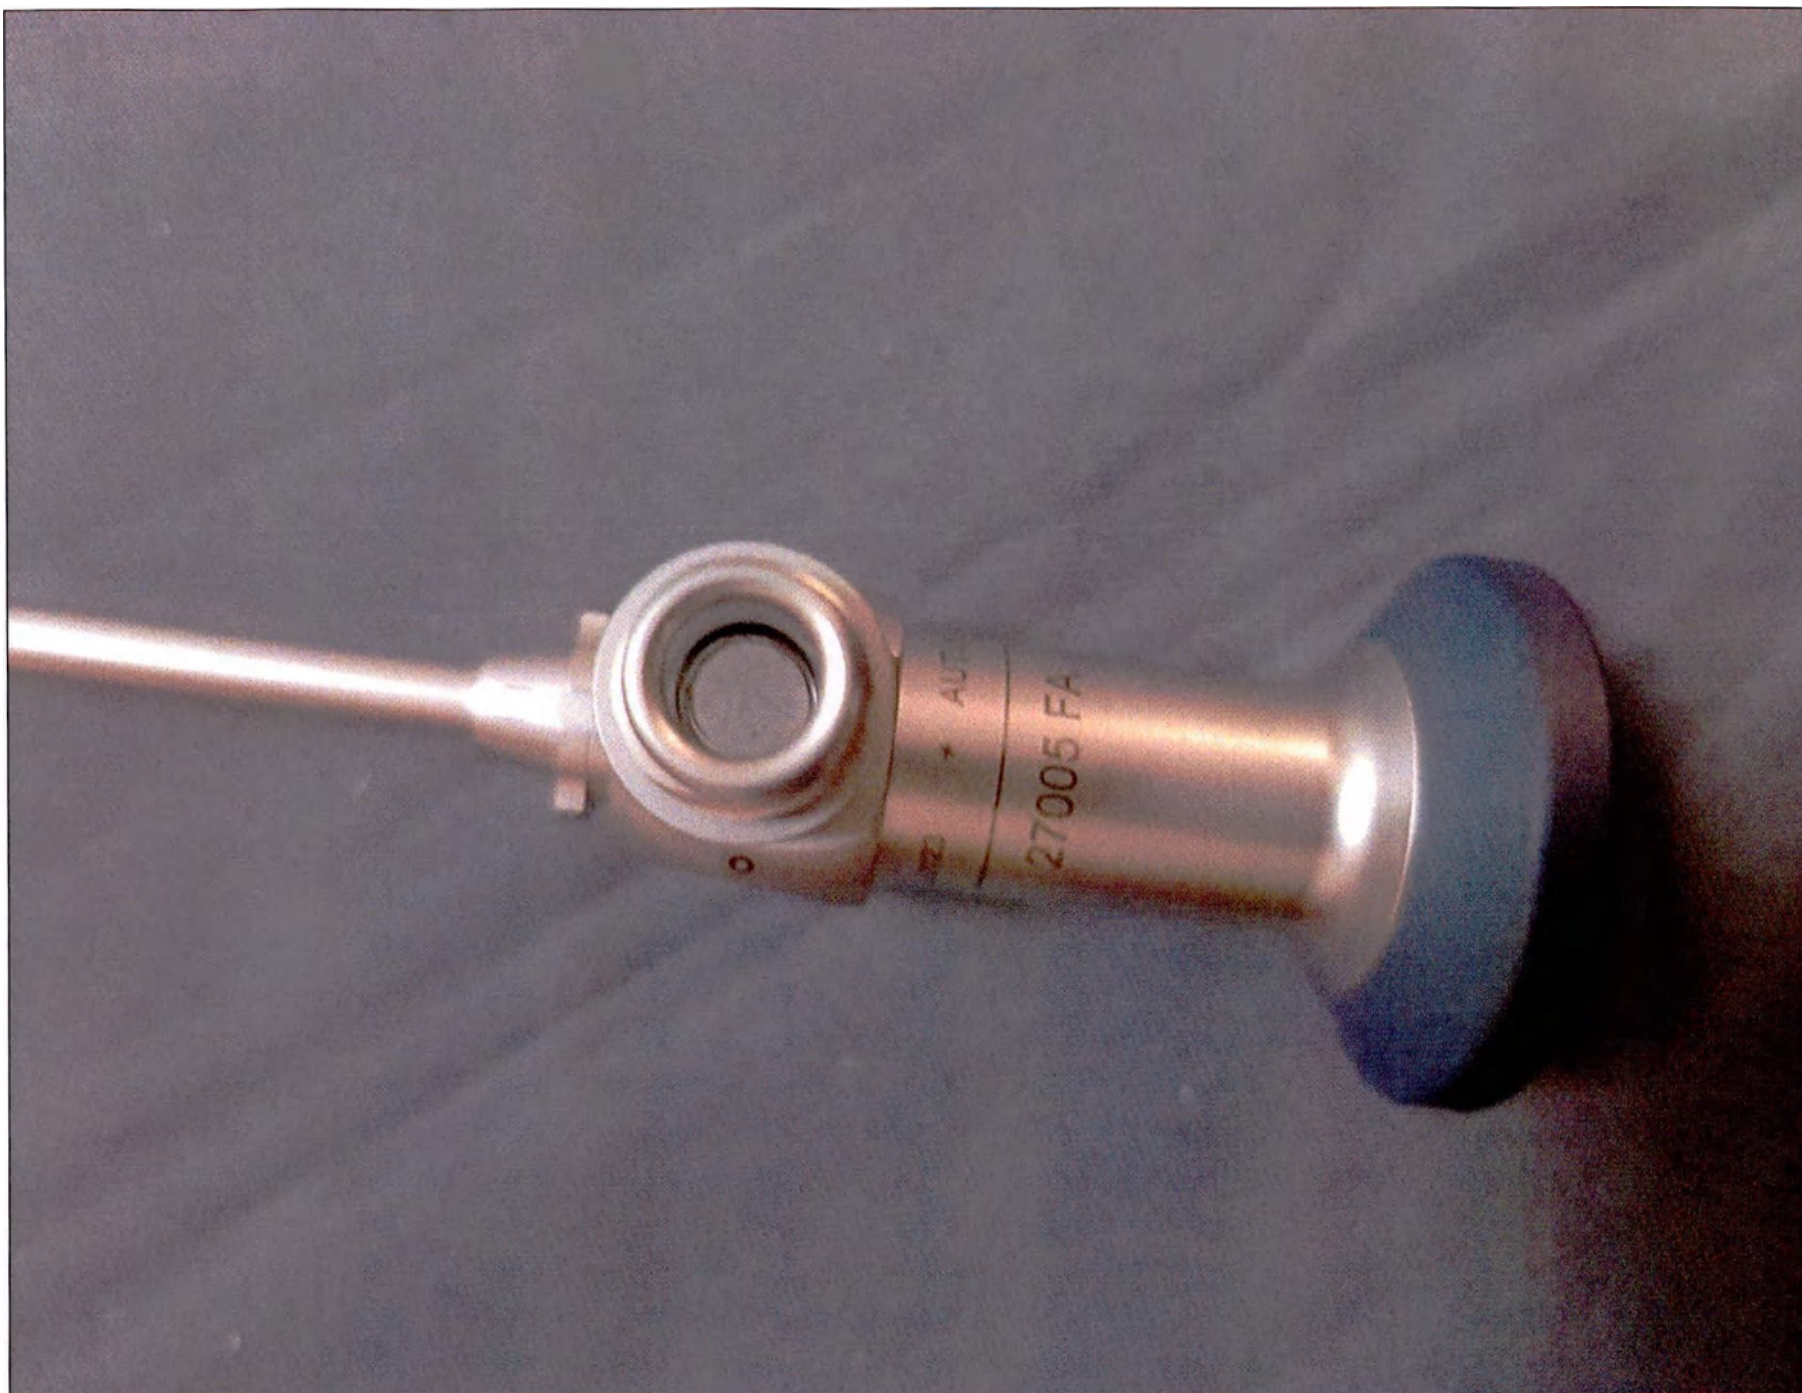


Рис. 7. Цистоскоп

Рис. 8. Цистоскоп



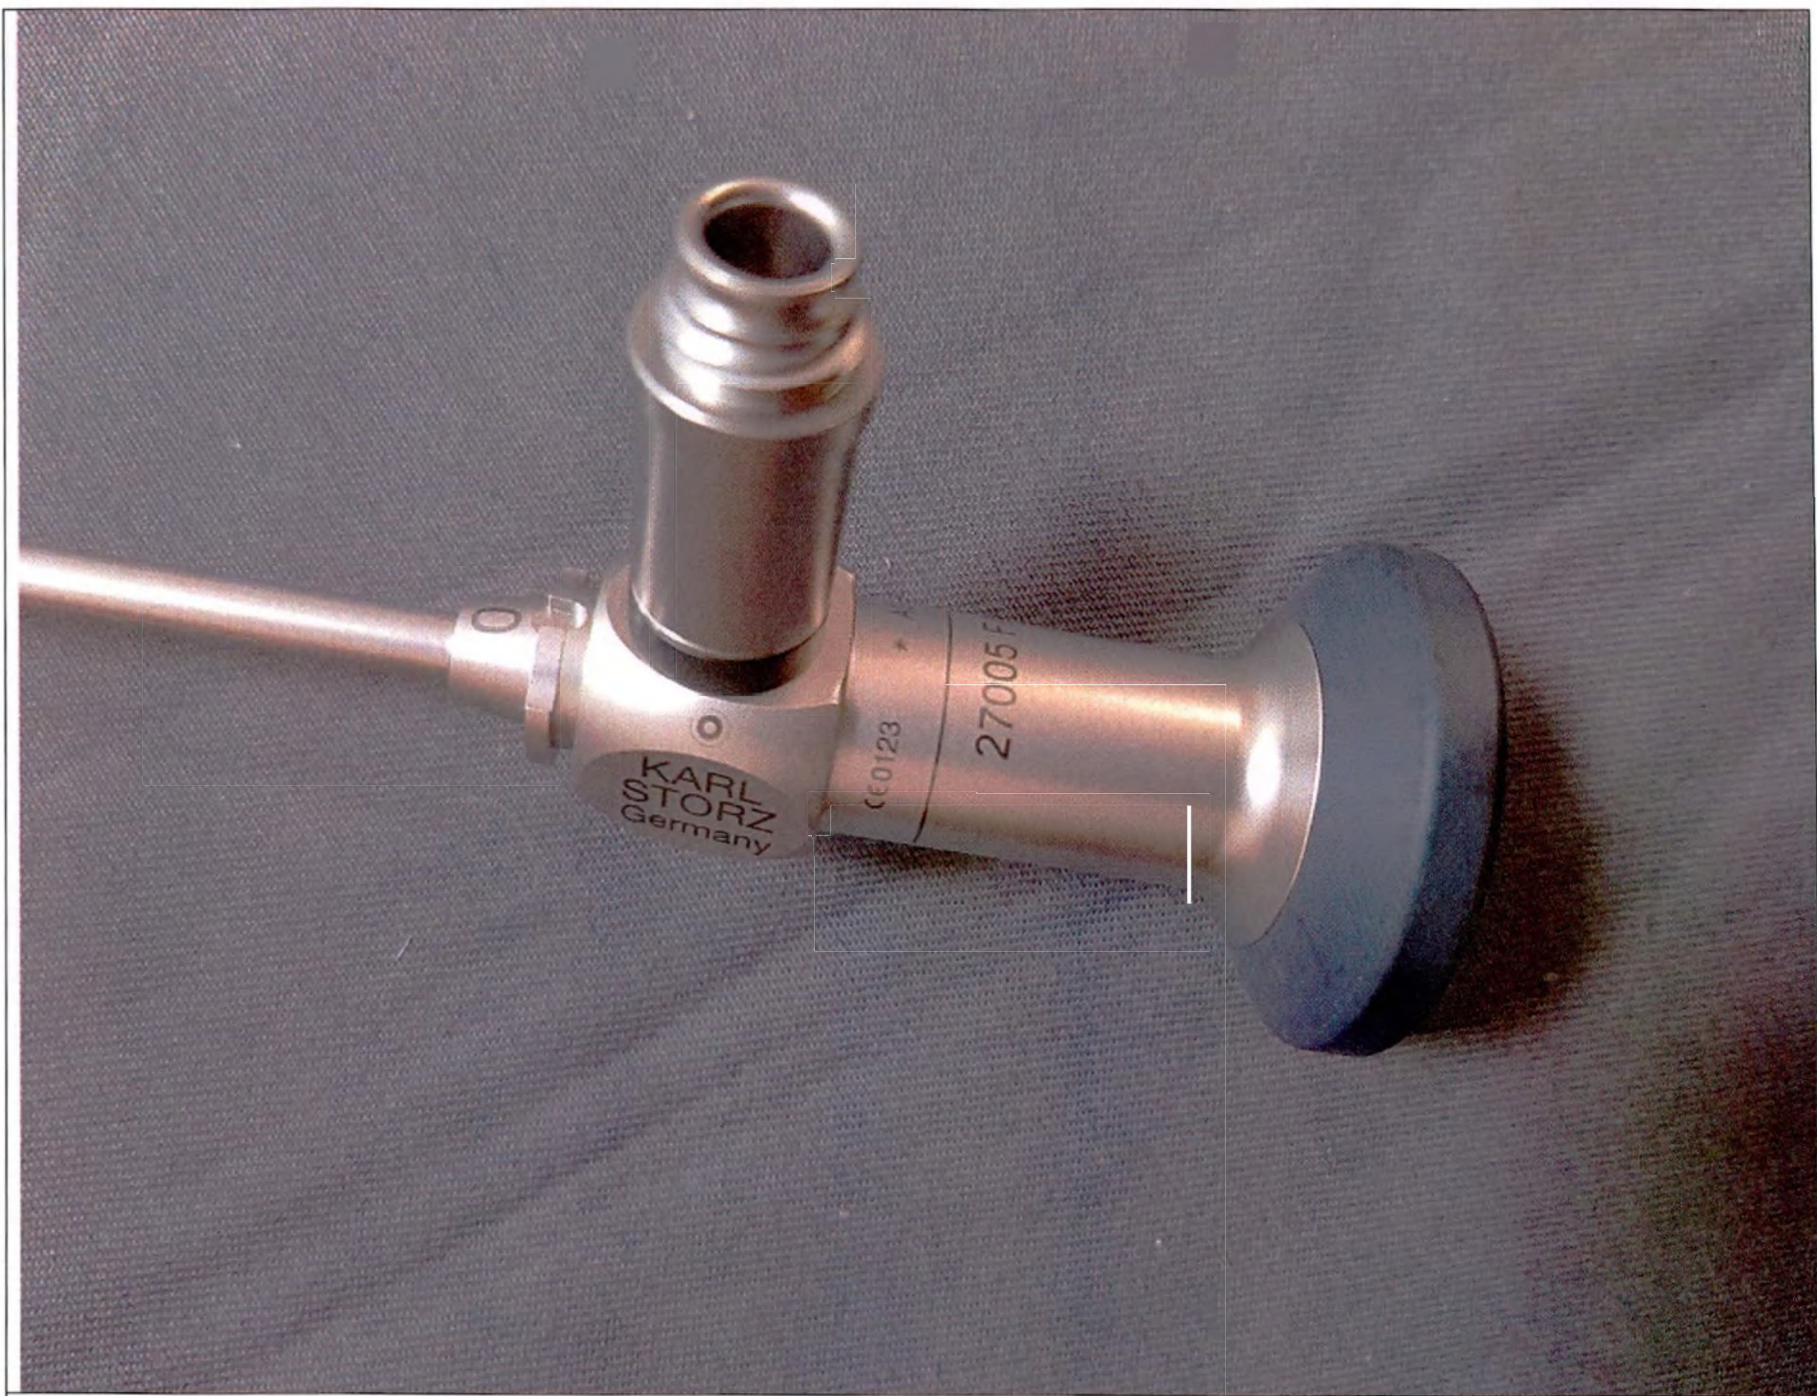


Рис. 9. Цистоскоп

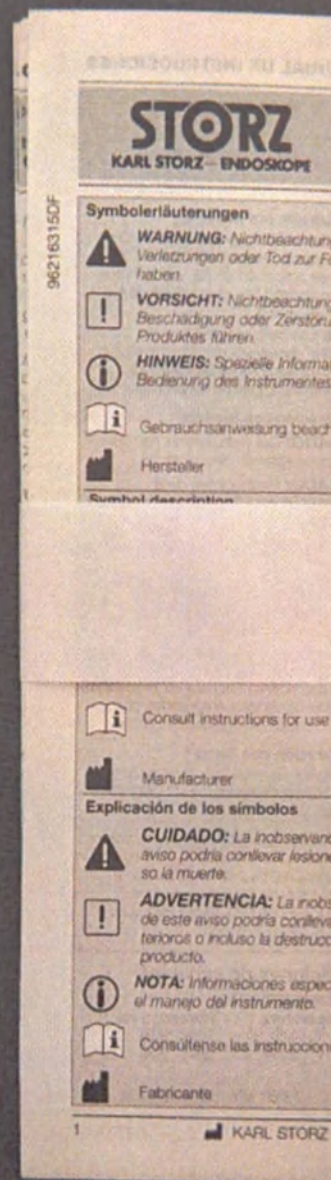


Рис. 10. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствии с документом в регистрационном досье.



Рис. 11. Гильза защитная, для эндоскопов длиной 30 см



Рис. 12. Цистоскоп жесткий HOPKINS для фотодинамической диагностики (PDD), типоразмер: направление наблюдения 70°, диаметр 4 мм, длина 30 см. Упаковка.



Рис. 13. Цистоскоп жесткий HOPKINS для фотодинамической диагностики (PDD), типоразмер: направление наблюдения 70°, диаметр 4 мм, длина 30 см. Маркировка на упаковке

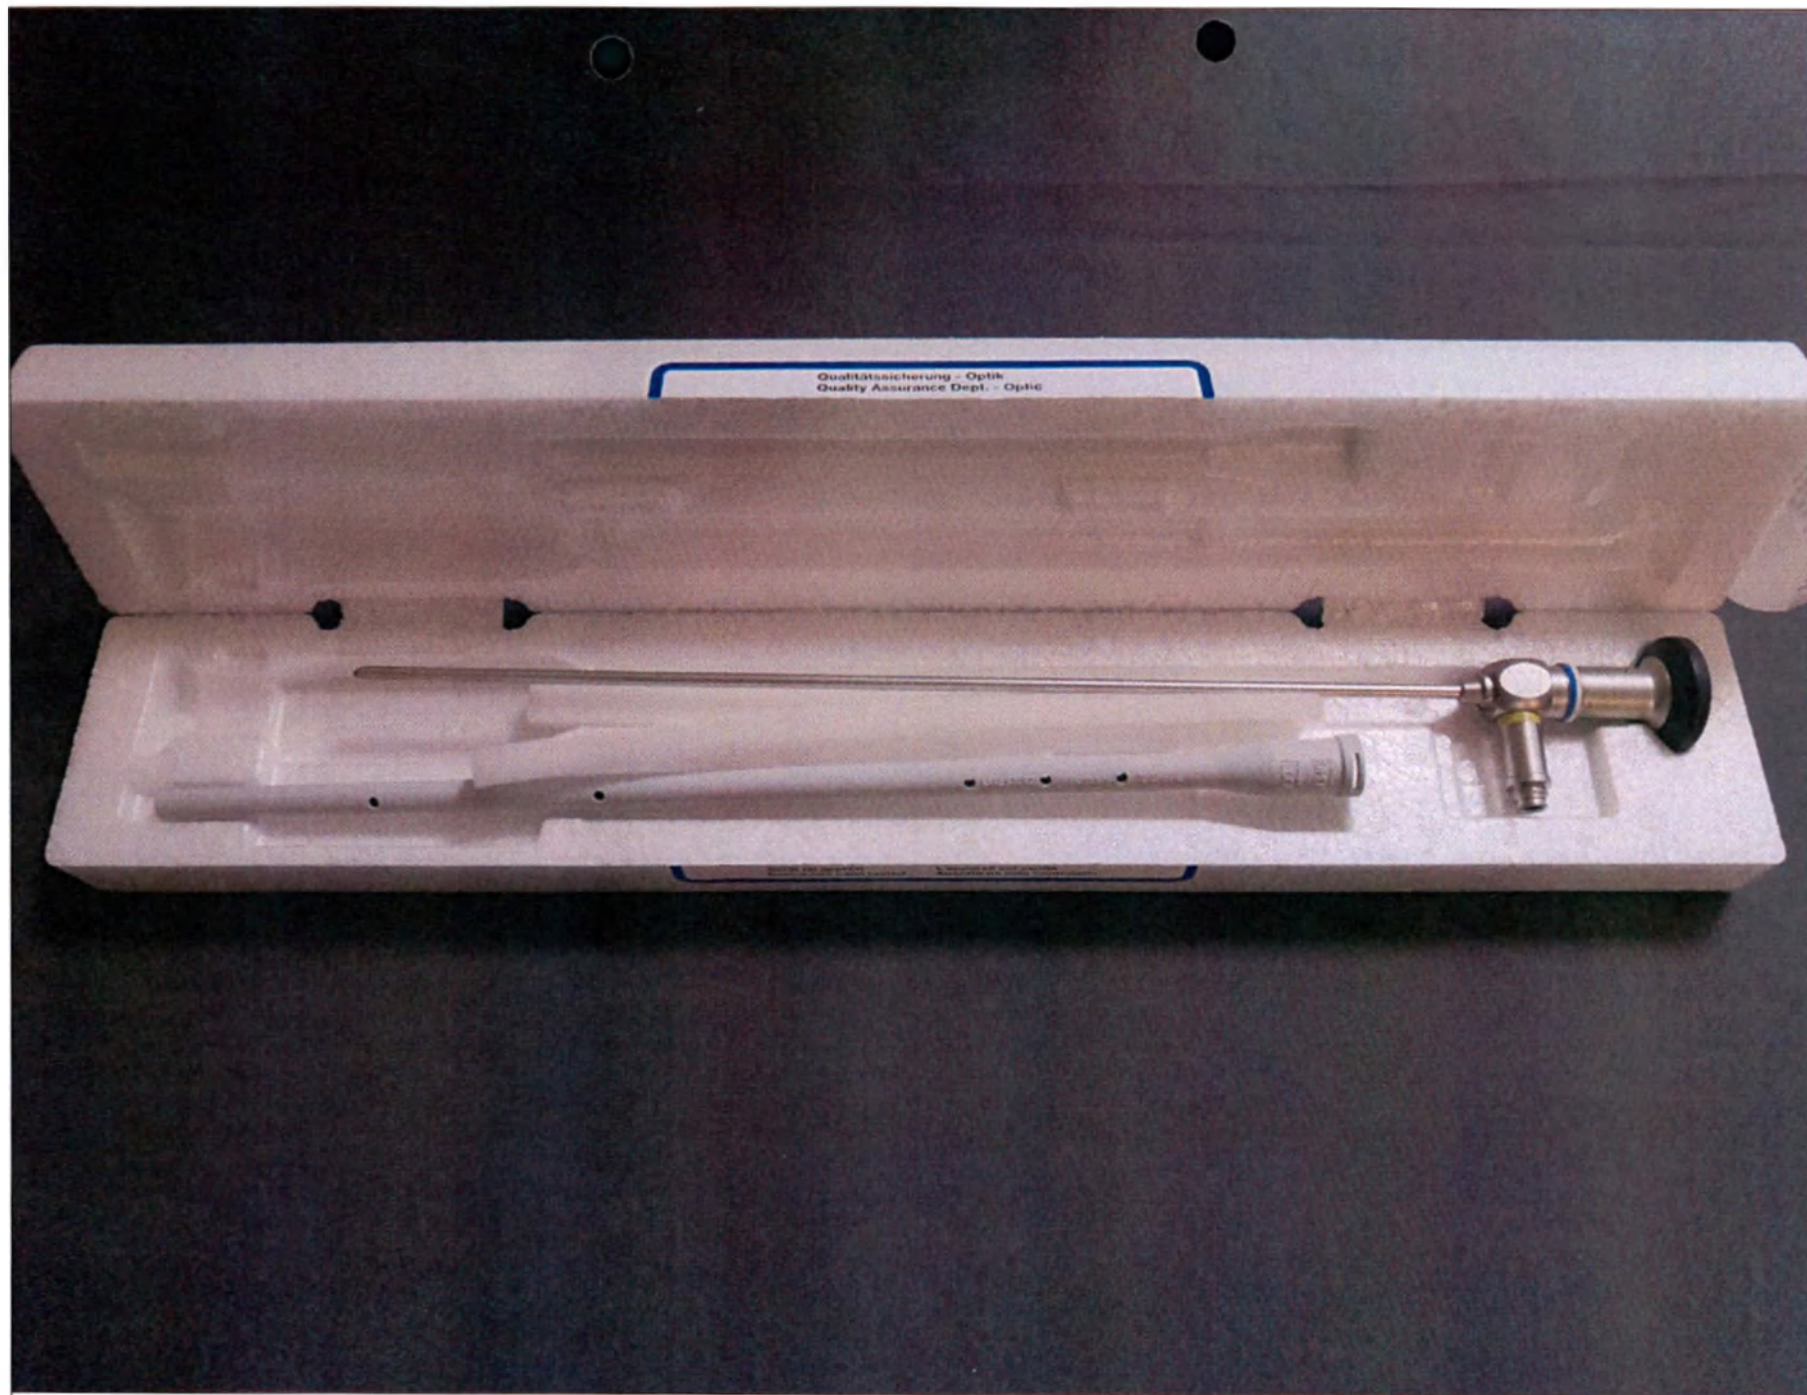


Рис. 14. Цистоскоп жесткий HOPKINS для фотодинамической диагностики (PDD), типоразмер: направление наблюдения 70°, диаметр 4 мм, длина 30 см.

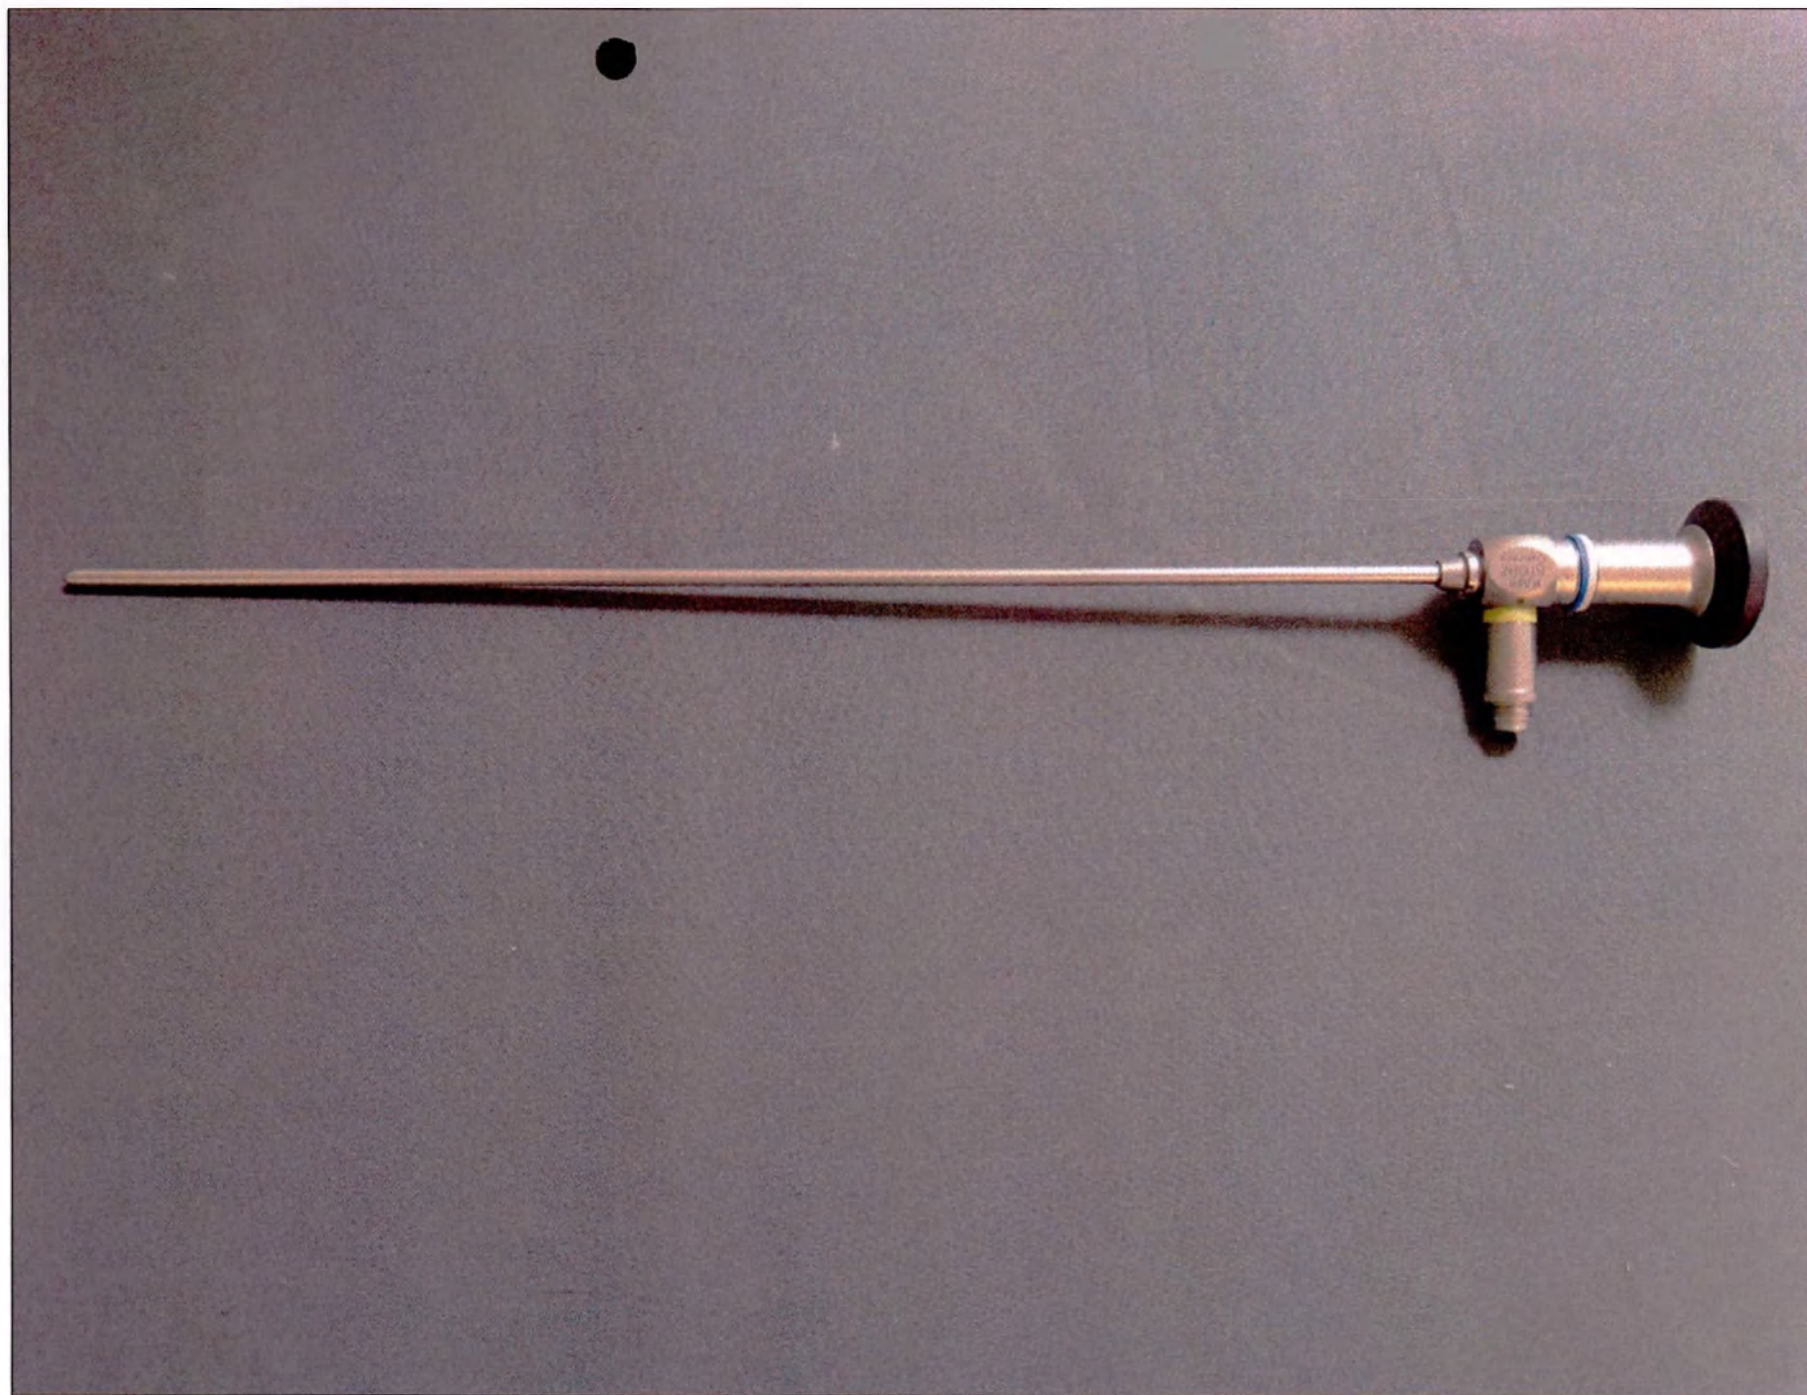


Рис. 15. Цистоскоп

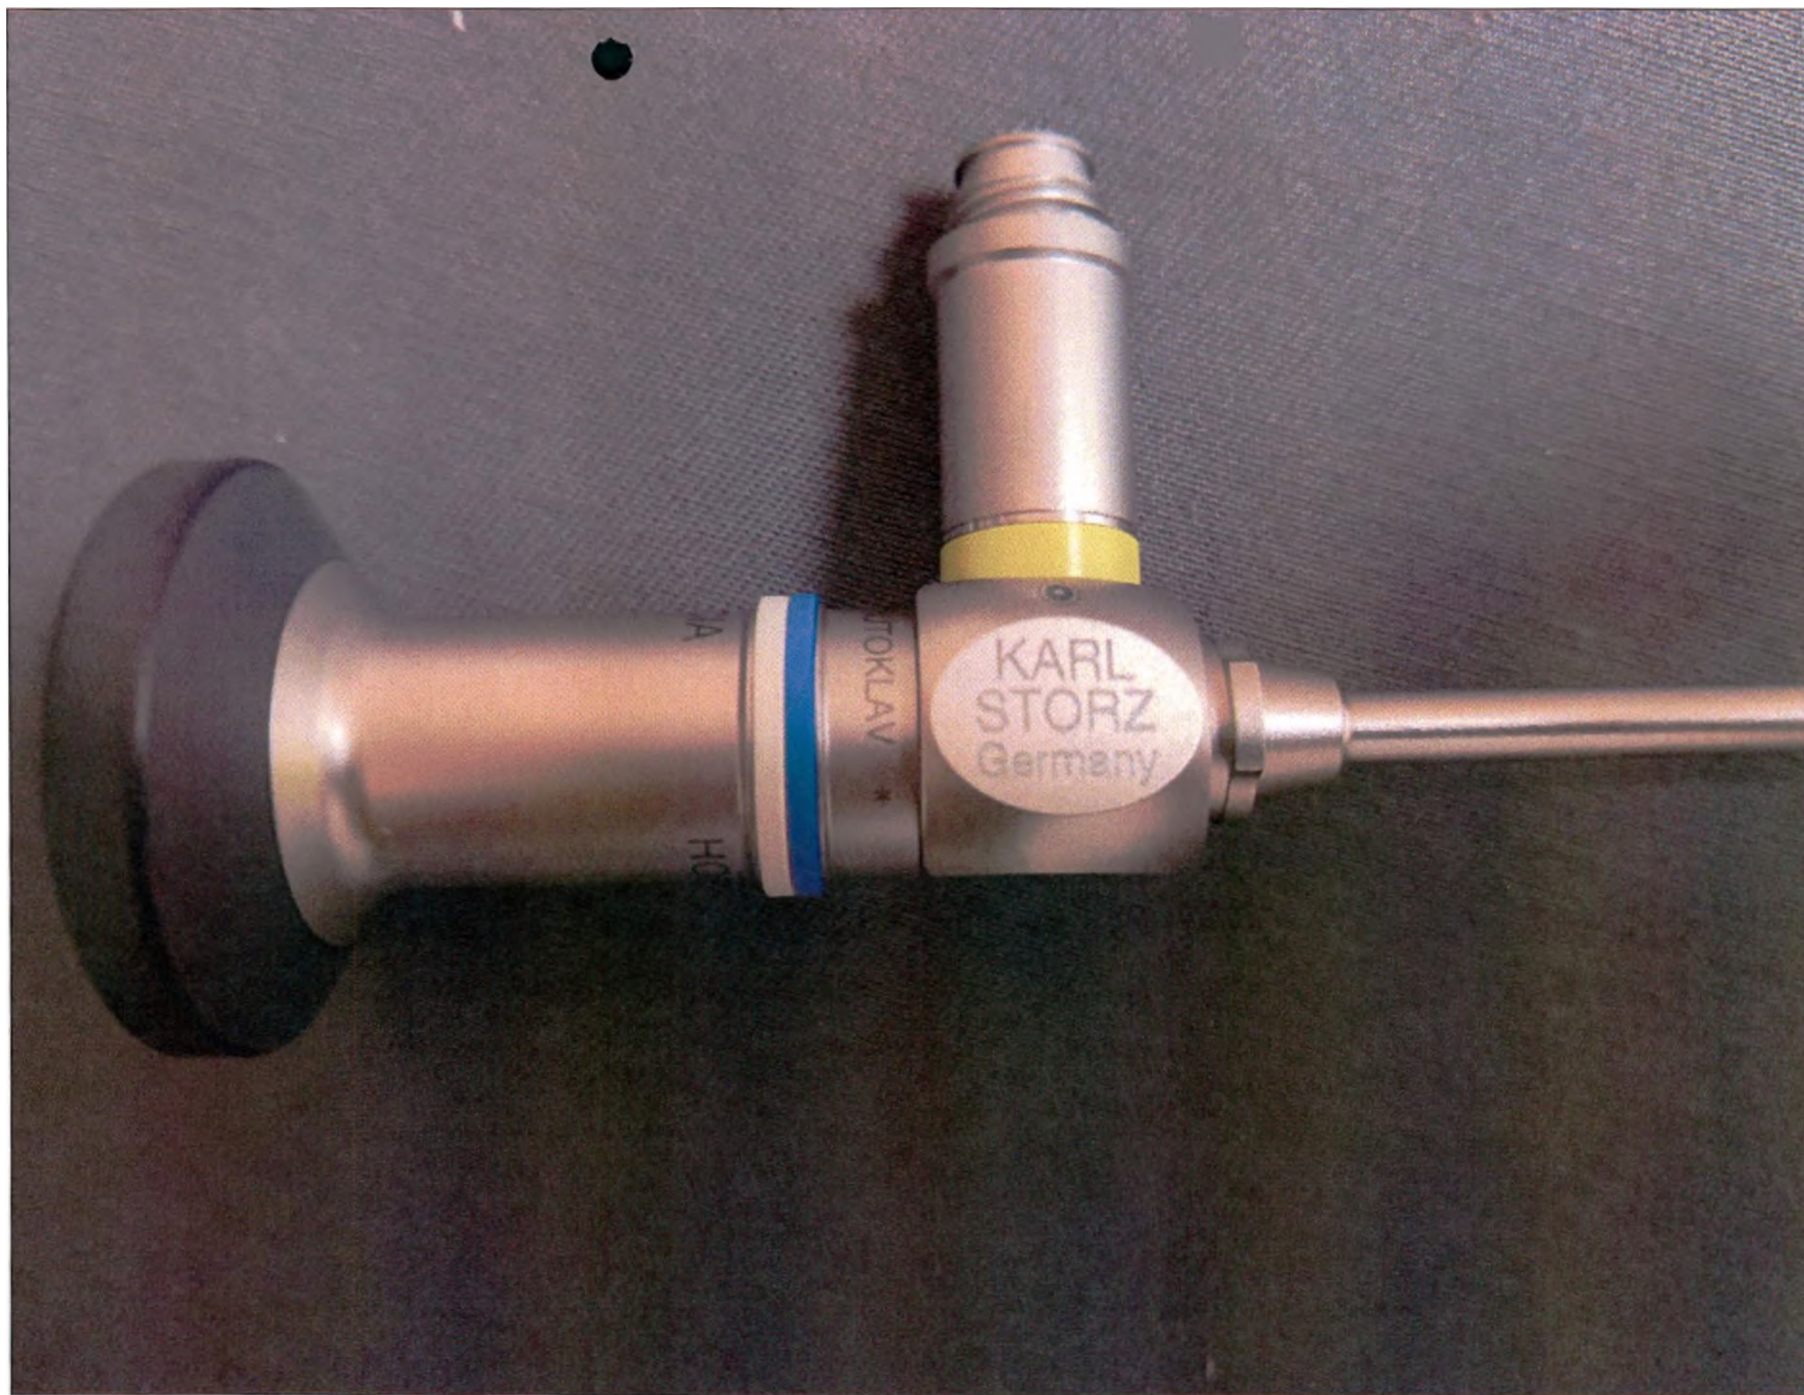


Рис. 16. Цистоскоп



Рис. 17. Цистоскоп



Рис. 18. Цистоскоп

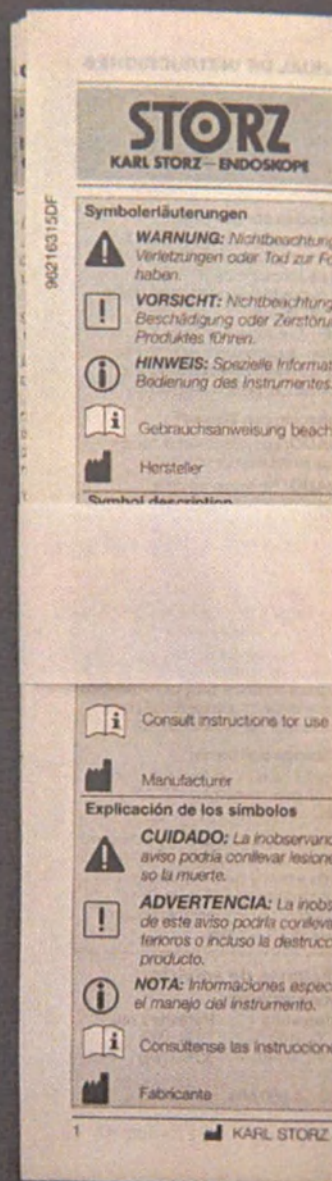


Рис. 19. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.

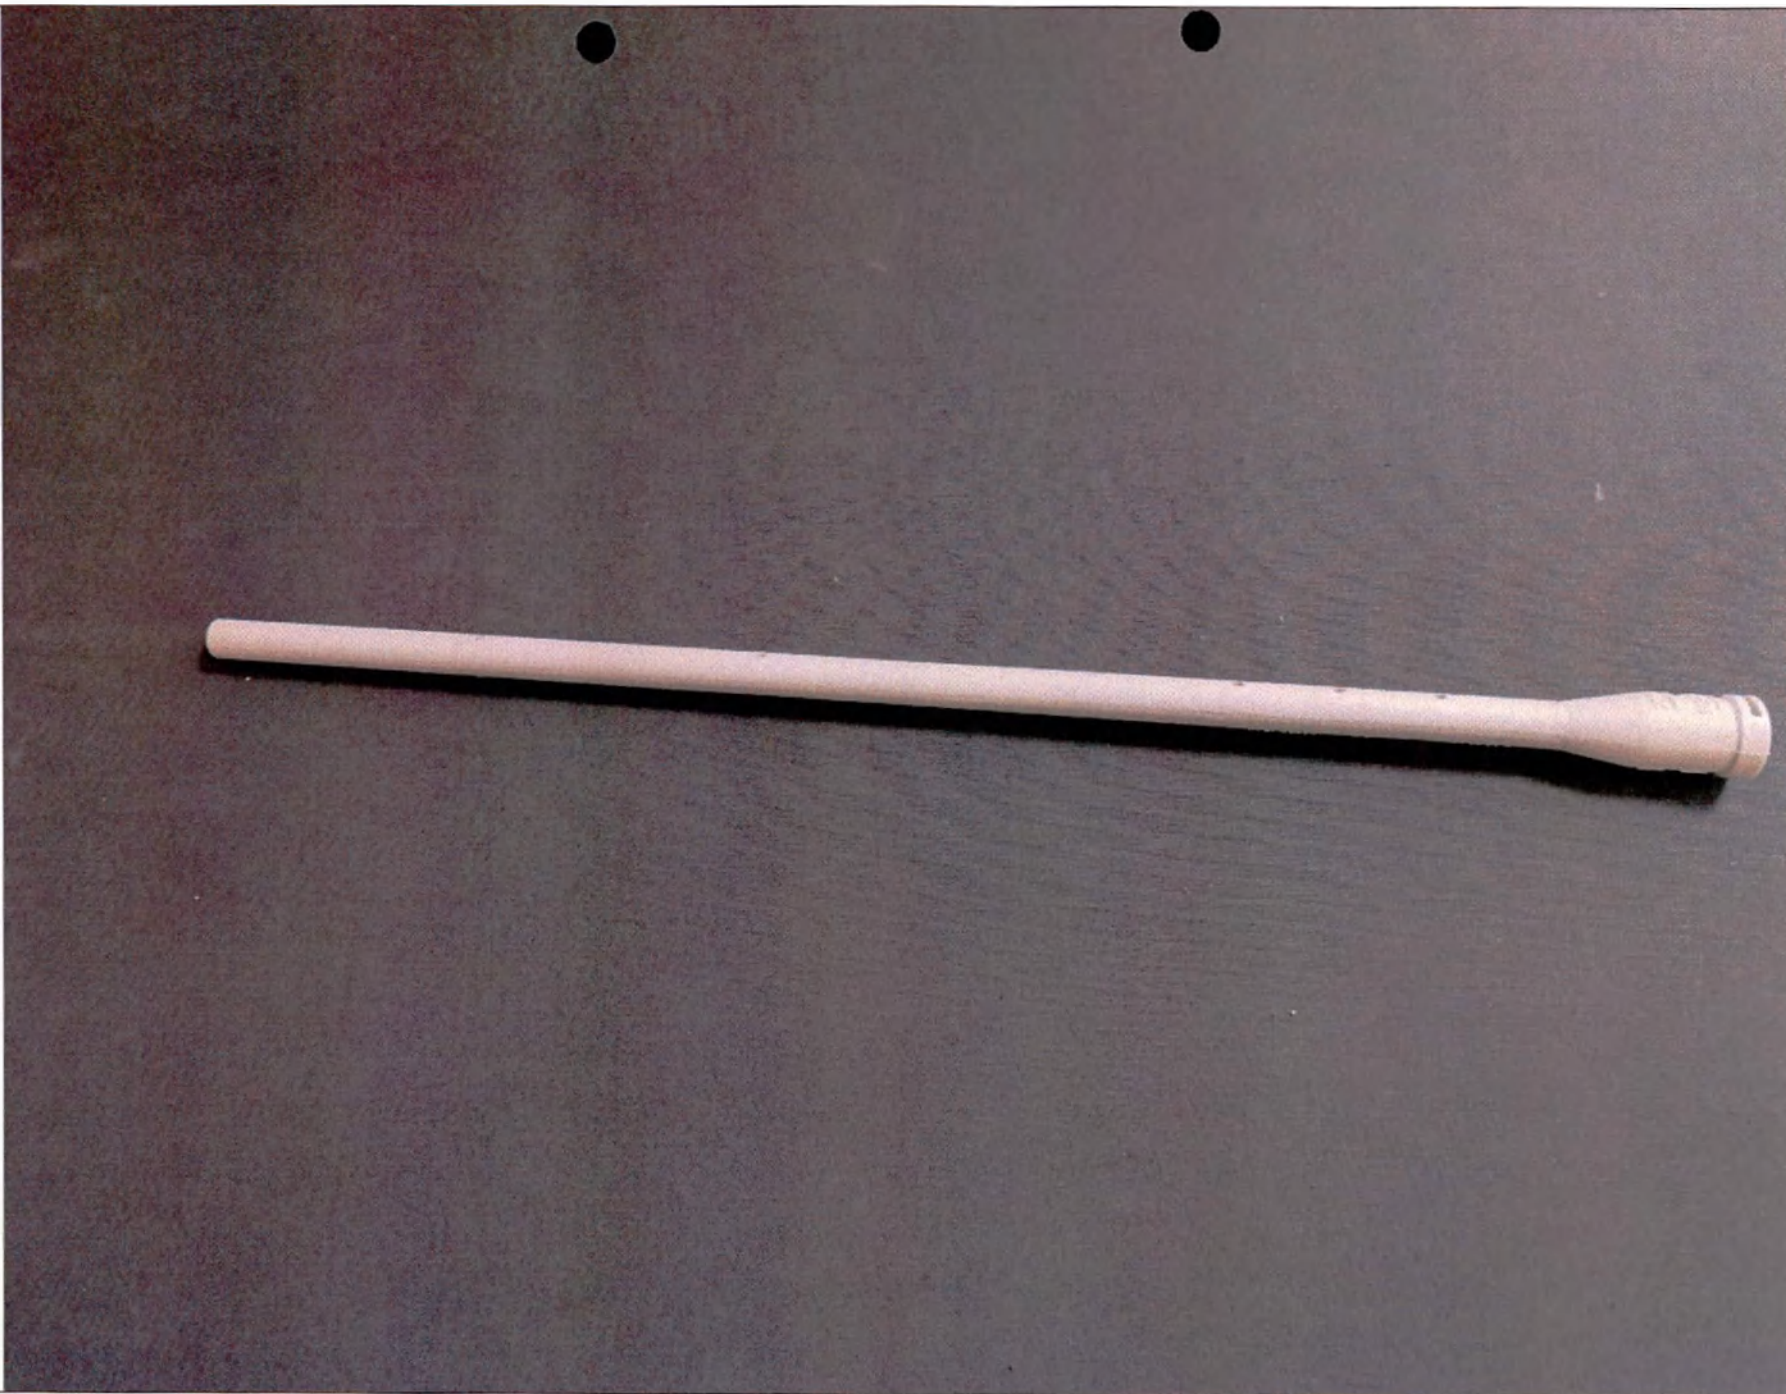


Рис. 20. Гильза защитная, для эндоскопов длиной 30 см.

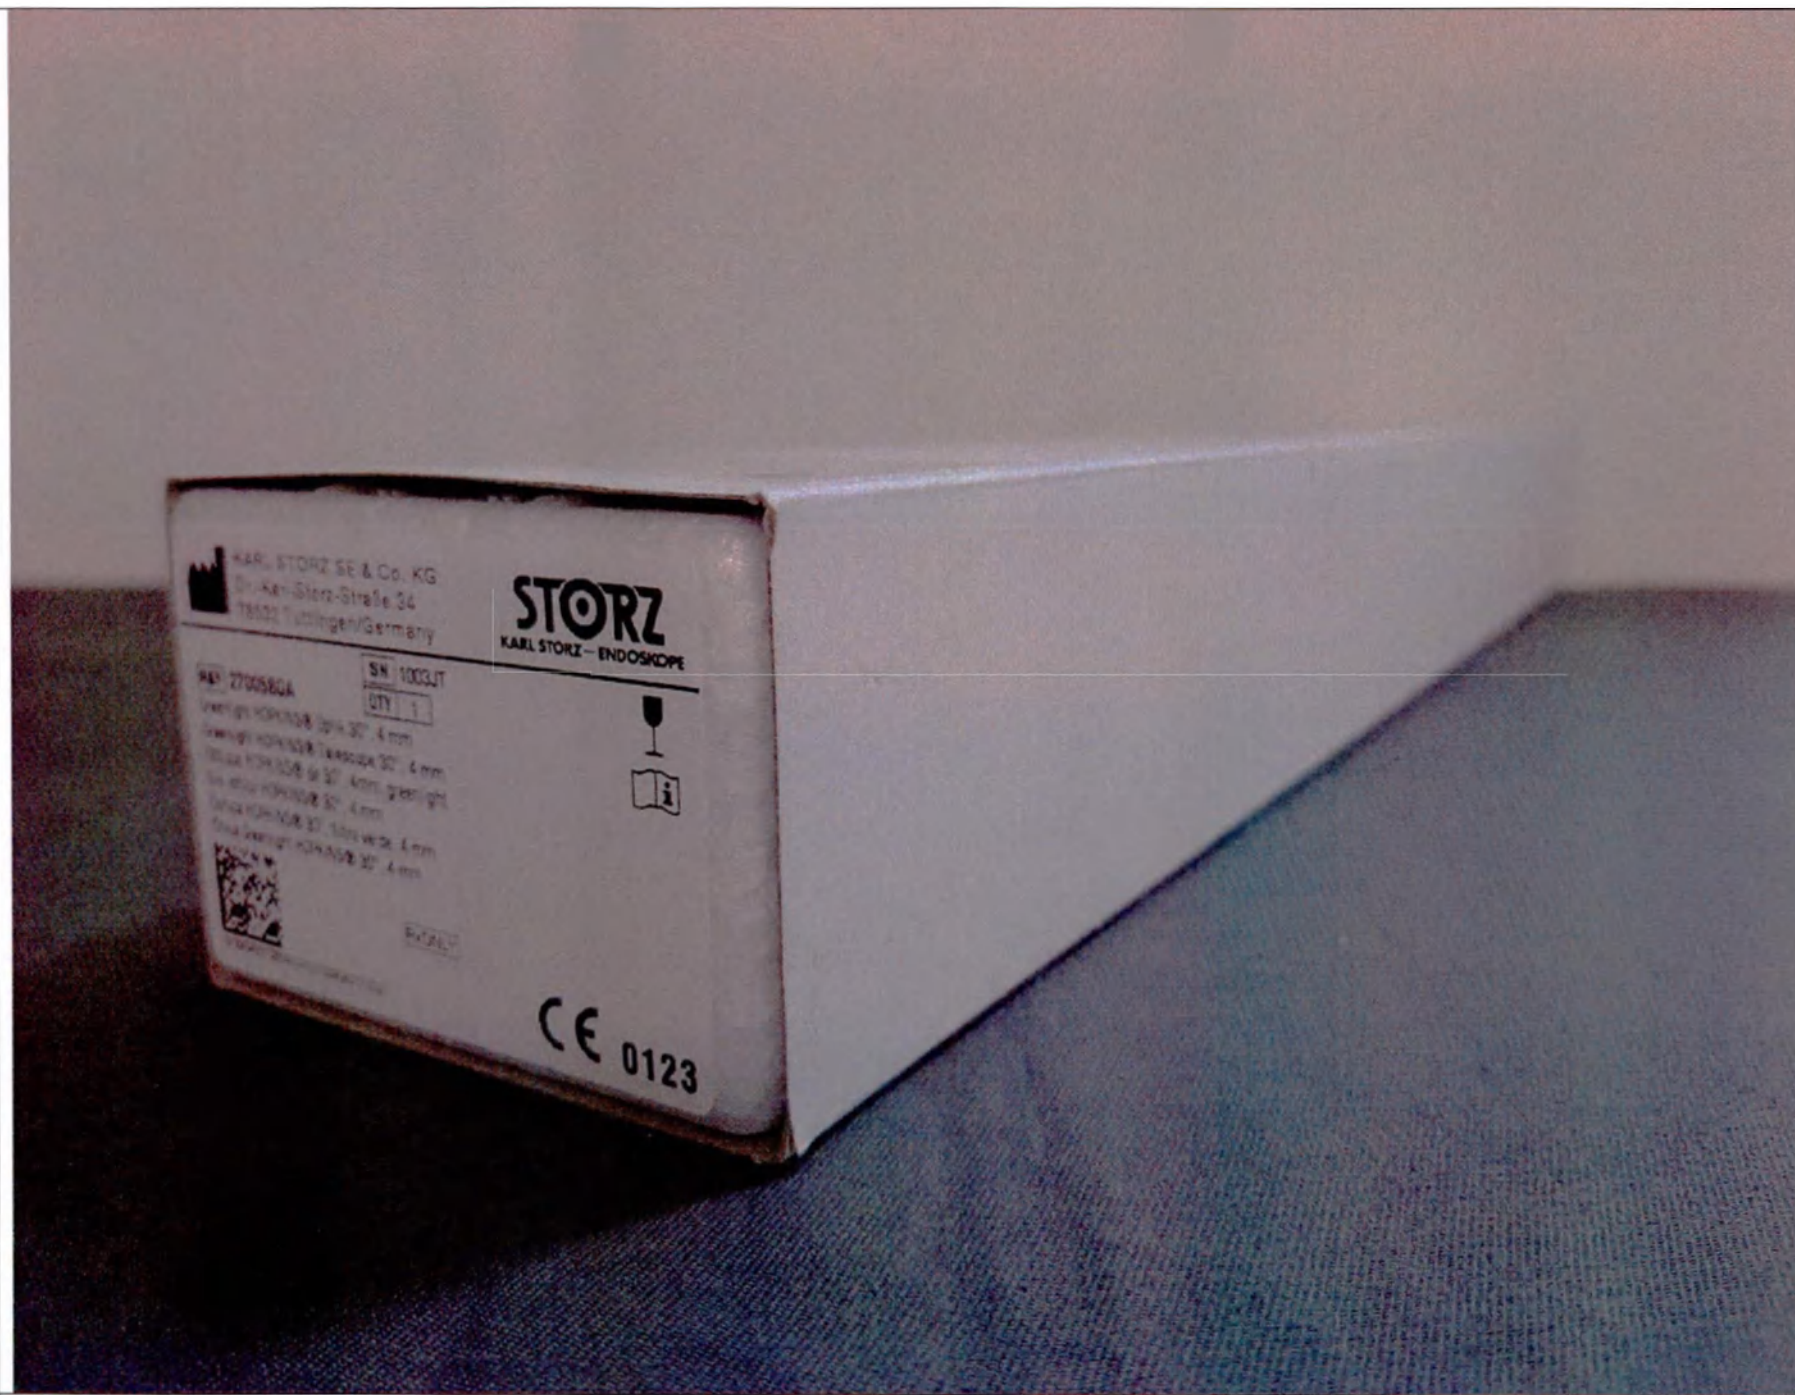


Рис. 21. Цистоскоп жесткий HOPKINS для фотодинамической диагностики (PDD) с фильтром Greenlight, направление наблюдения 30°, диаметр 4 мм, длина 30 см. Упаковка.

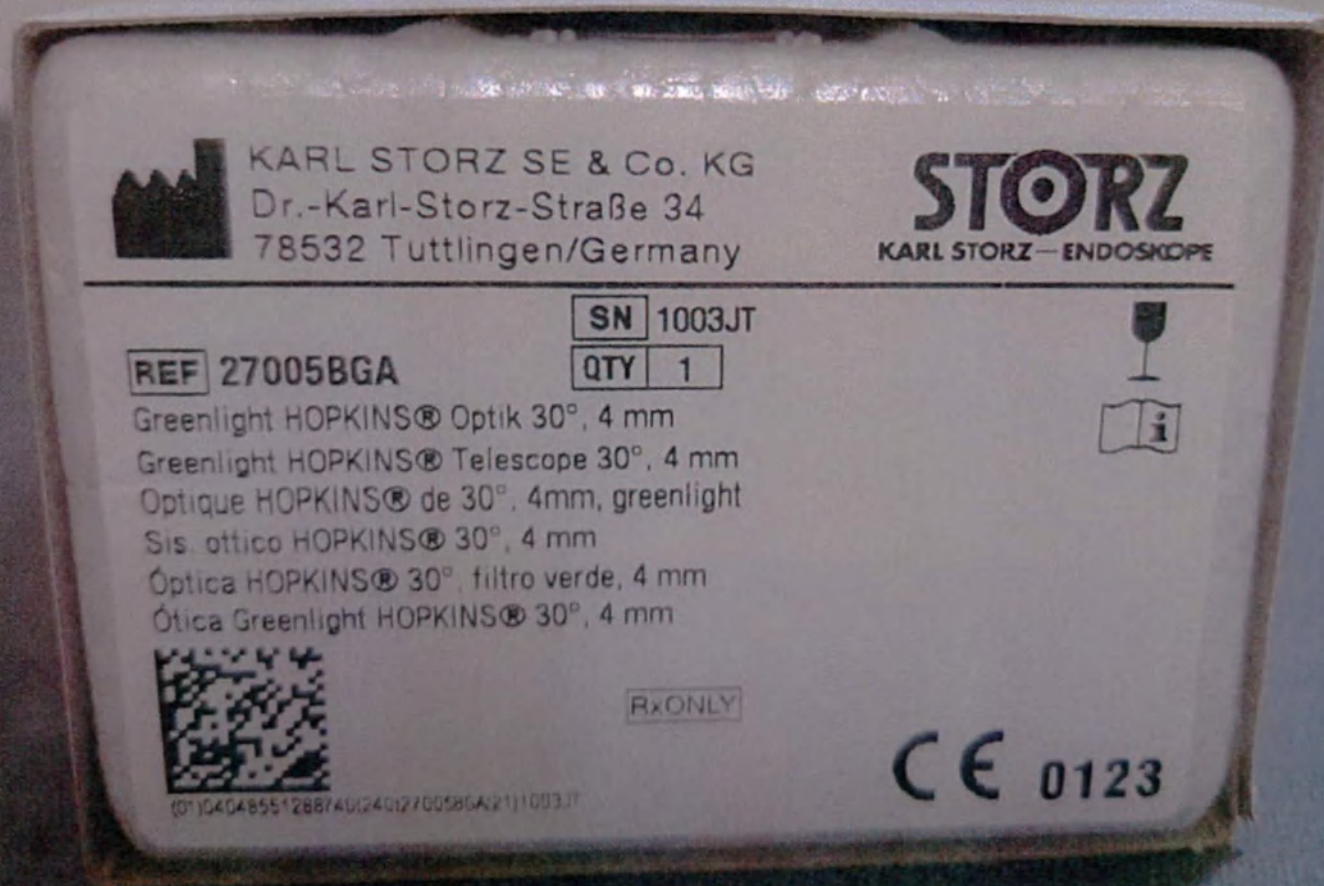


Рис. 22. Цистоскоп жесткий HOPKINS для фотодинамической диагностики (PDD) с фильтром Greenlight, направление наблюдения 30°, диаметр 4 мм, длина 30 см. Маркировка на упаковке



Рис. 23. Цистоскоп жесткий HOPKINS для фотодинамической диагностики (PDD) с фильтром Greenlight, направление наблюдения 30°, диаметр 4 мм, длина 30 см.



Рис. 24. Цистоскоп

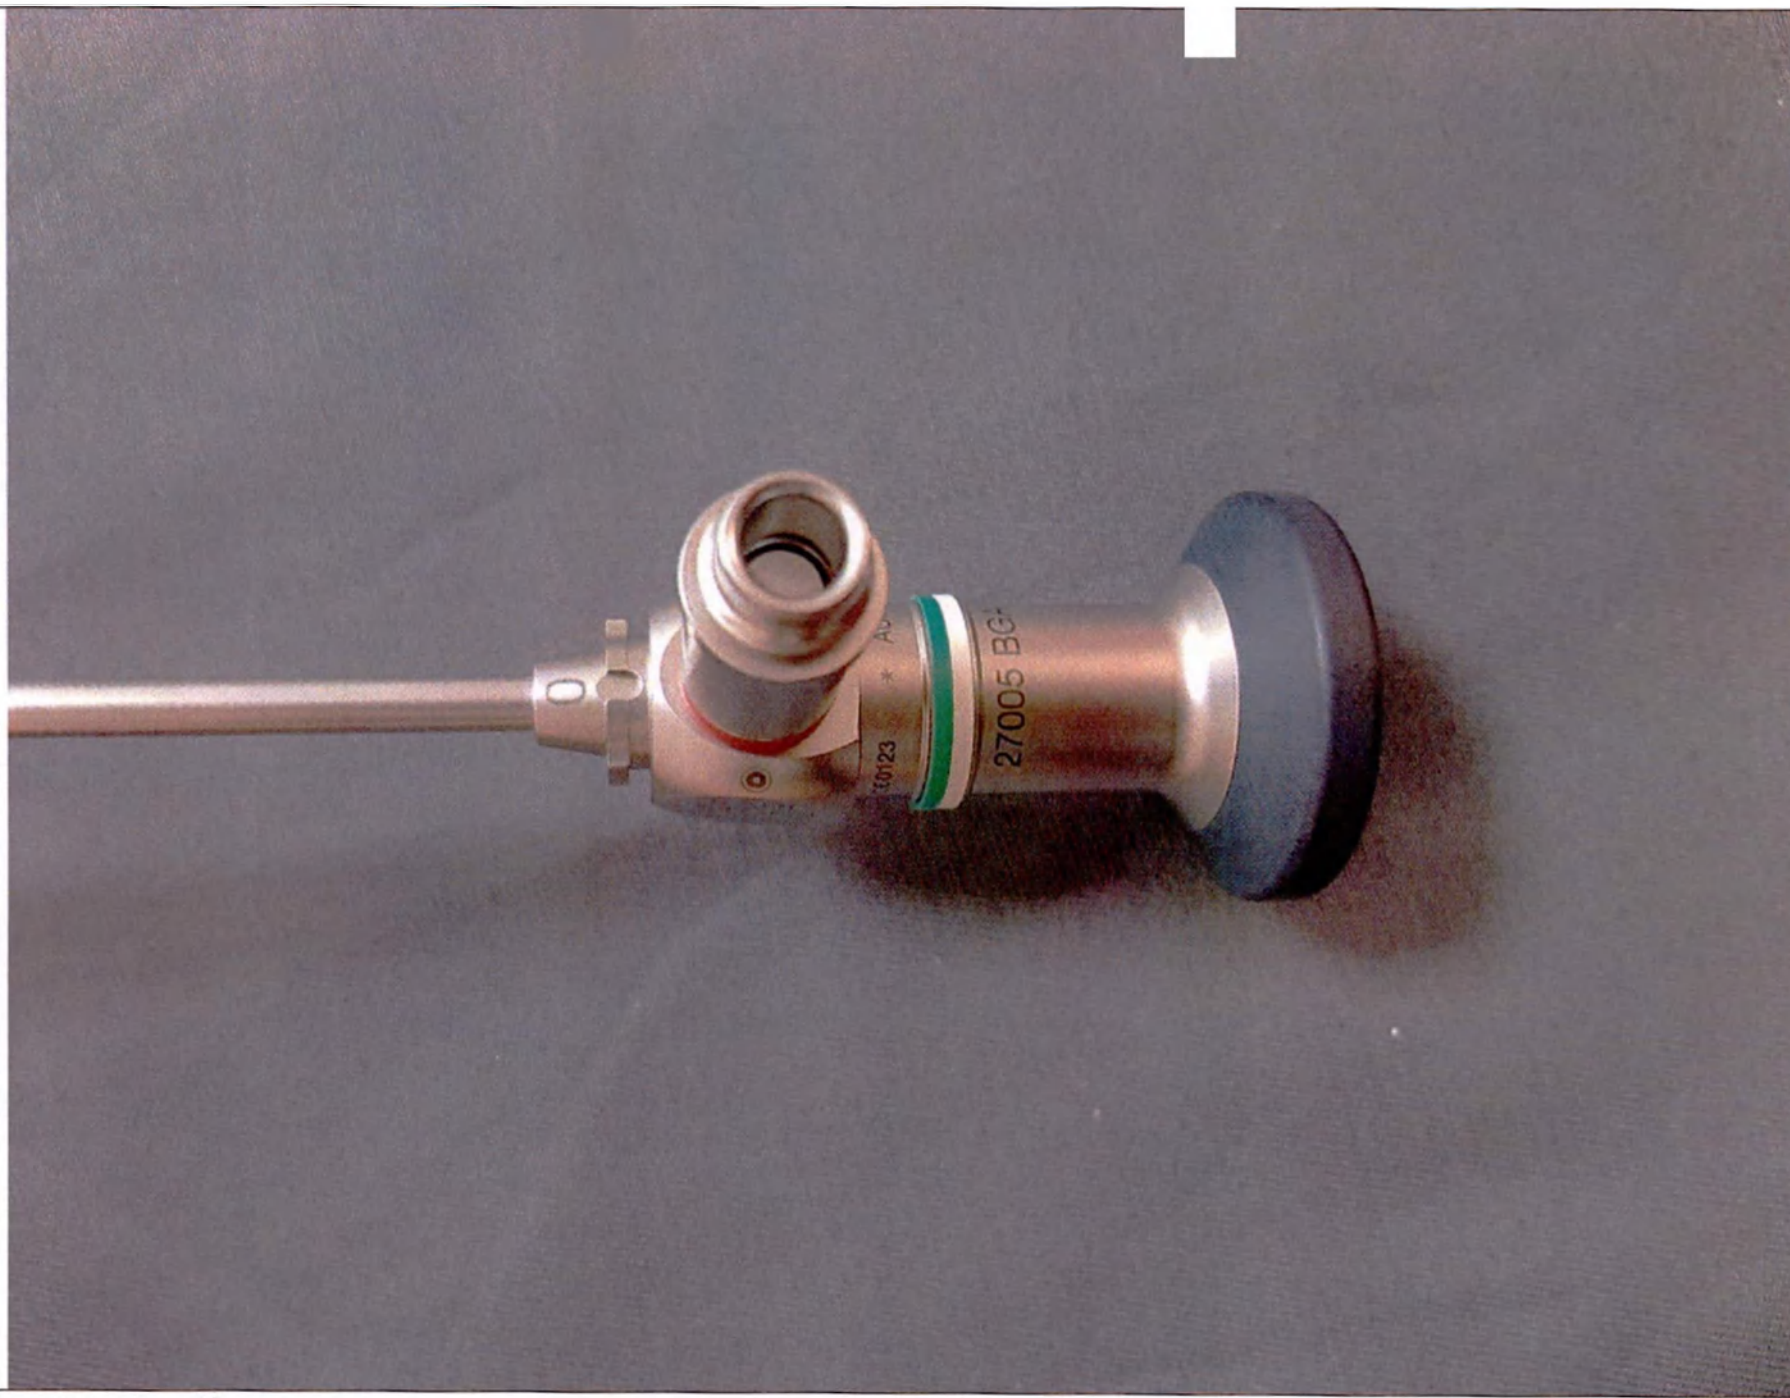


Рис. 25. Цистоскоп



Рис. 26. Цистоскоп

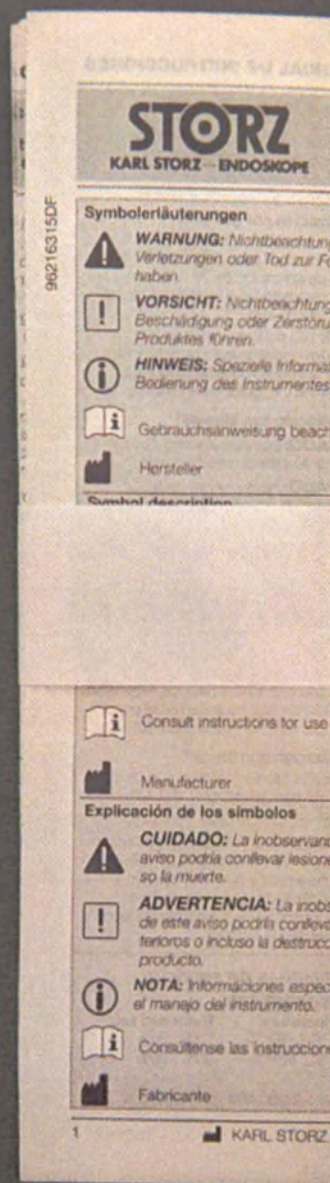


Рис. 27. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.



Рис. 28. Гильза защитная, для эндоскопов длиной 30 см

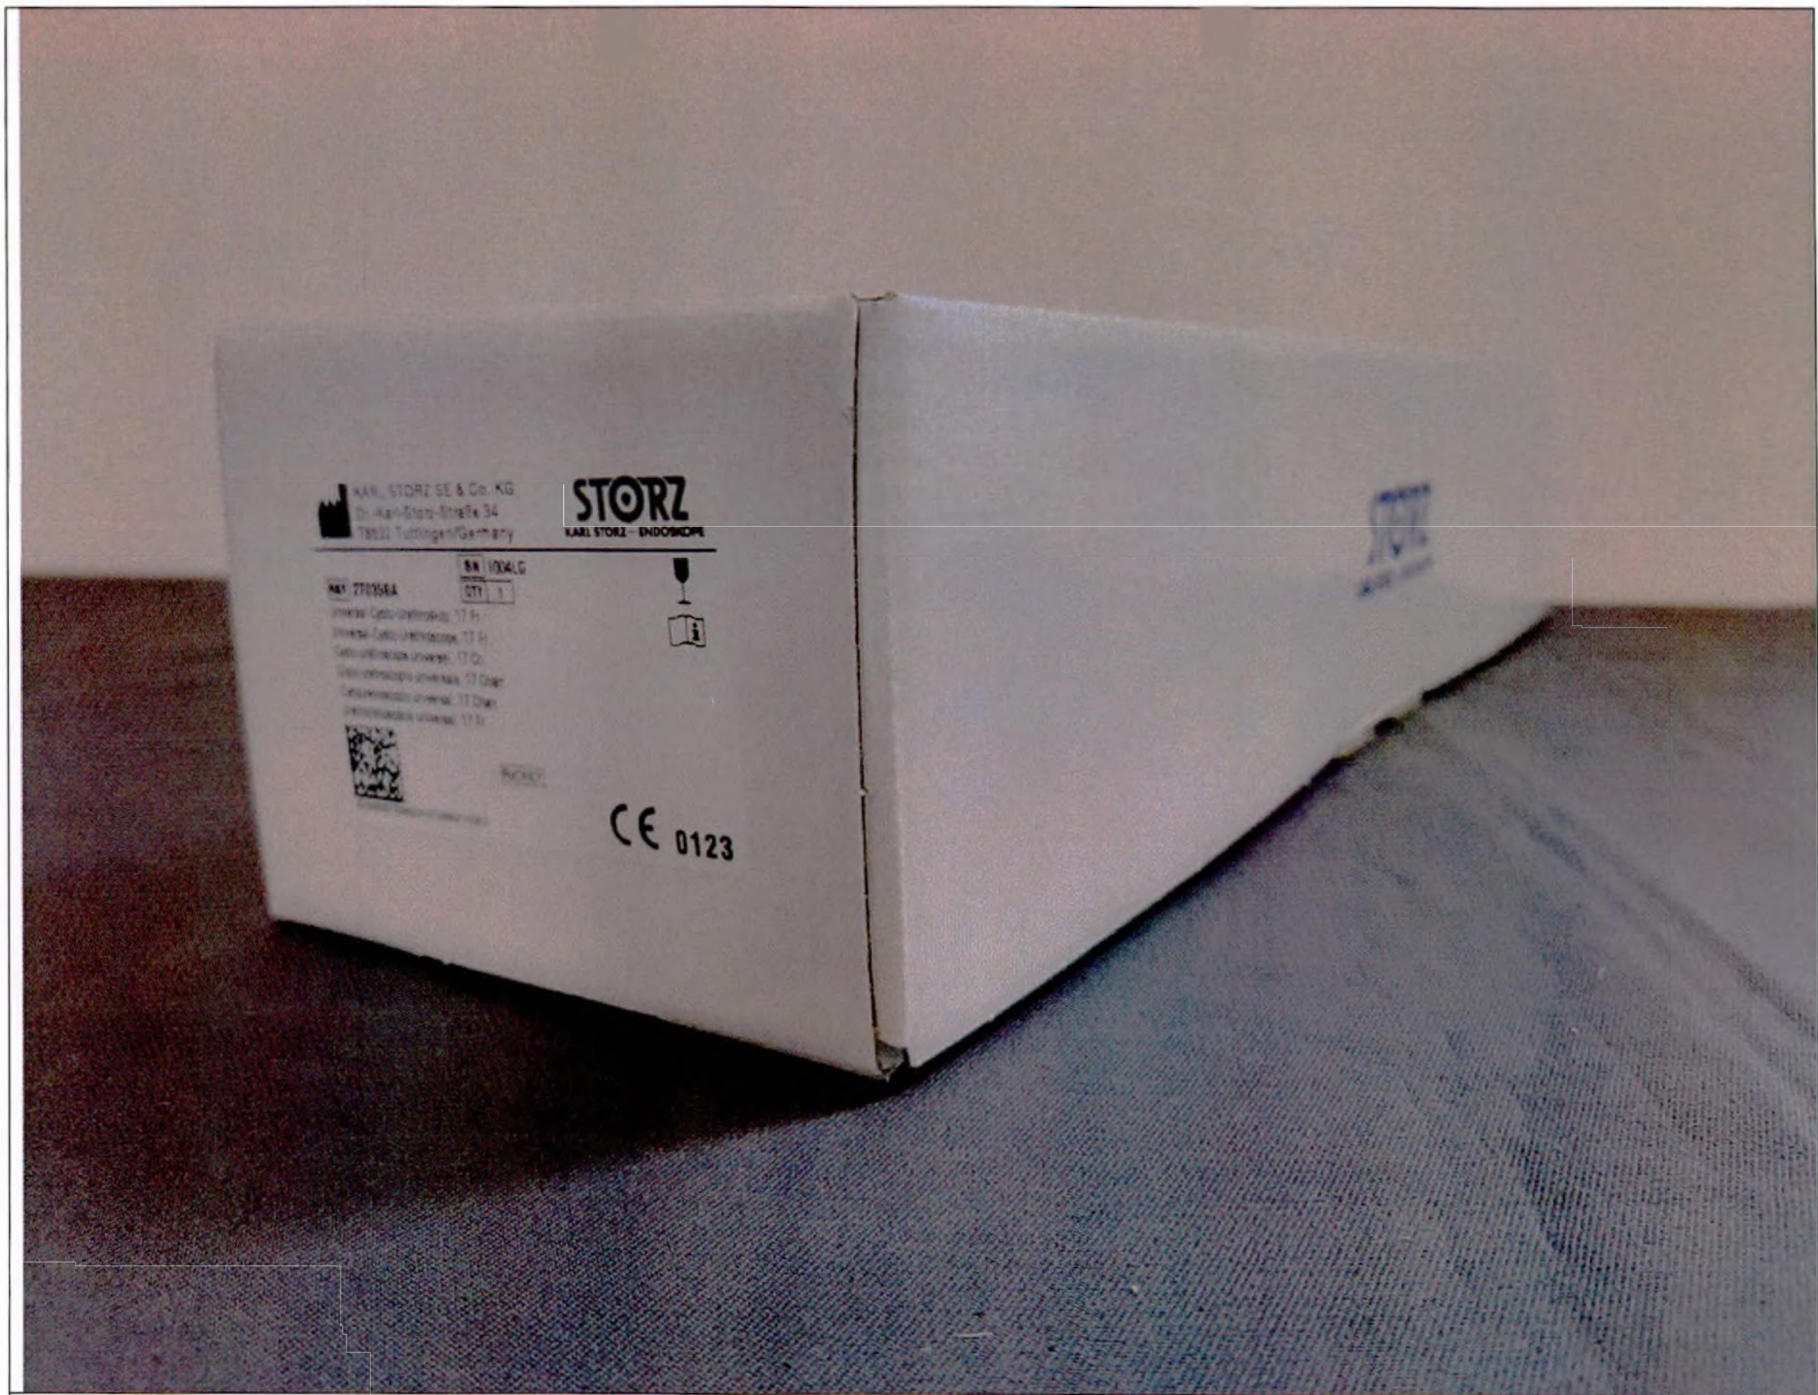


Рис. 29. Цистуретроскоп жесткий НОРКИНС с инструментальным каналом, типоразмер: направление наблюдения 30°, размер 17 Шр. Упаковка.



Рис. 30. Цистоуретроскоп жесткий HOPKINS с инструментальным каналом, типоразмер: направление наблюдения 30°, размер 17 Шр. Маркировка на упаковке.

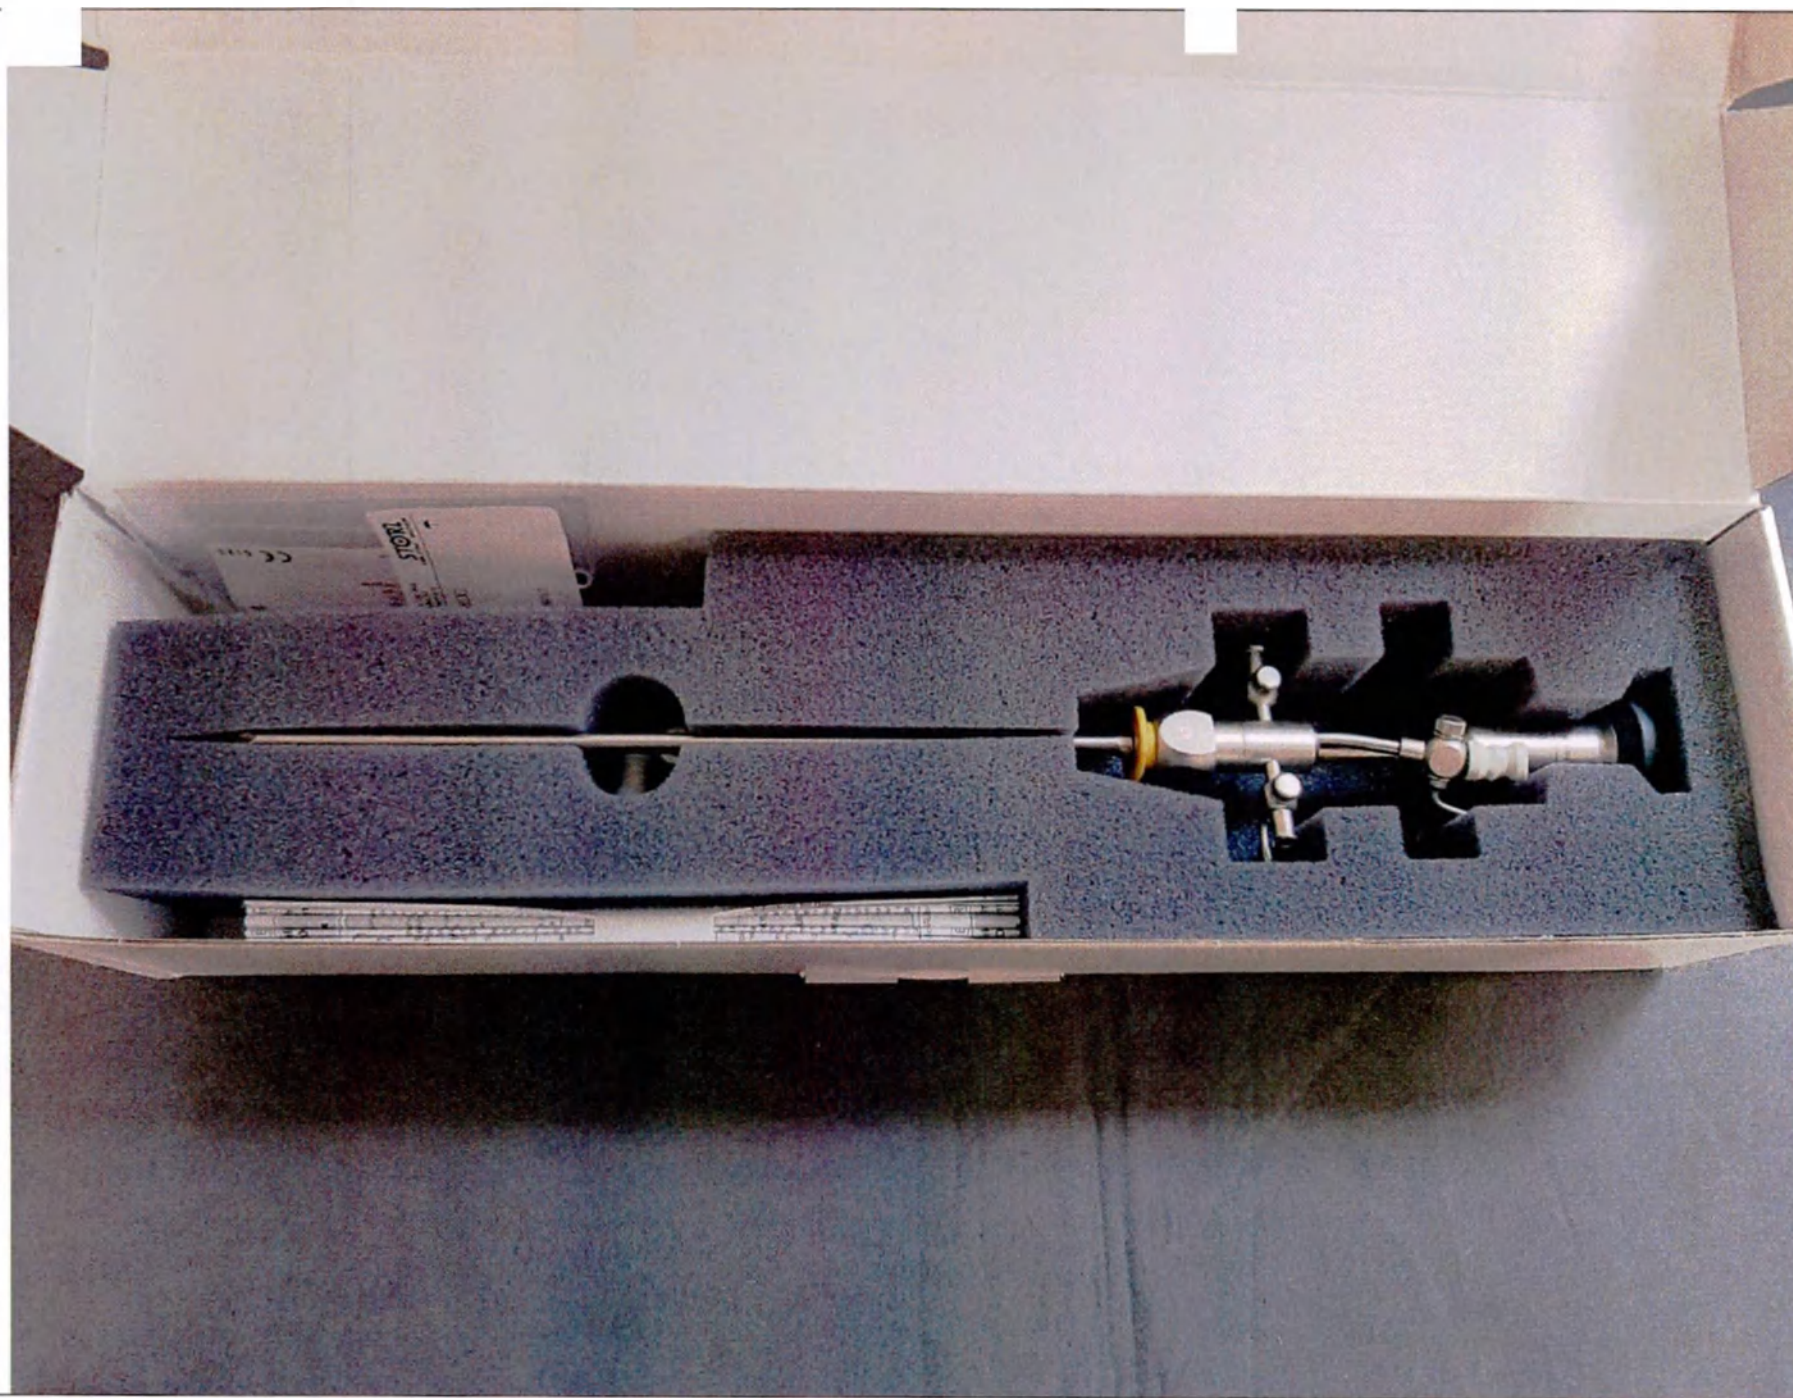


Рис. 31. Цистоуретроскоп жесткий HOPKINS с инструментальным каналом, типоразмер: направление наблюдения 30°, размер 17 Шр.

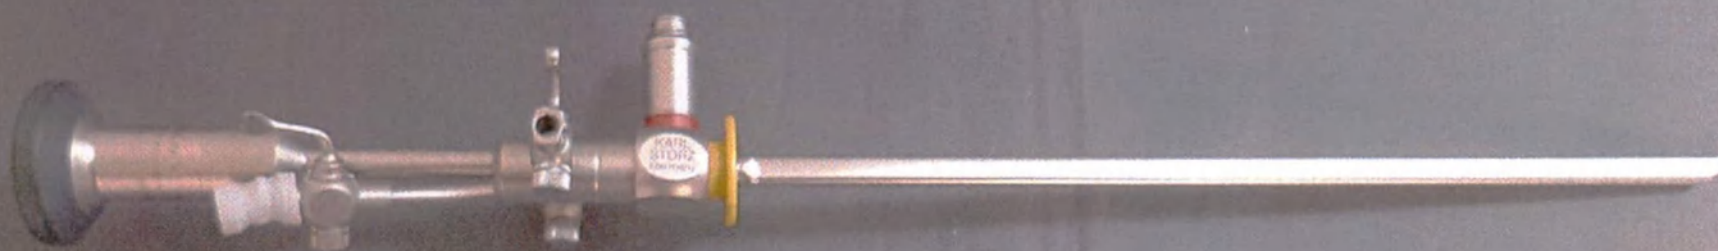


Рис. 32. Цистоуретроскоп

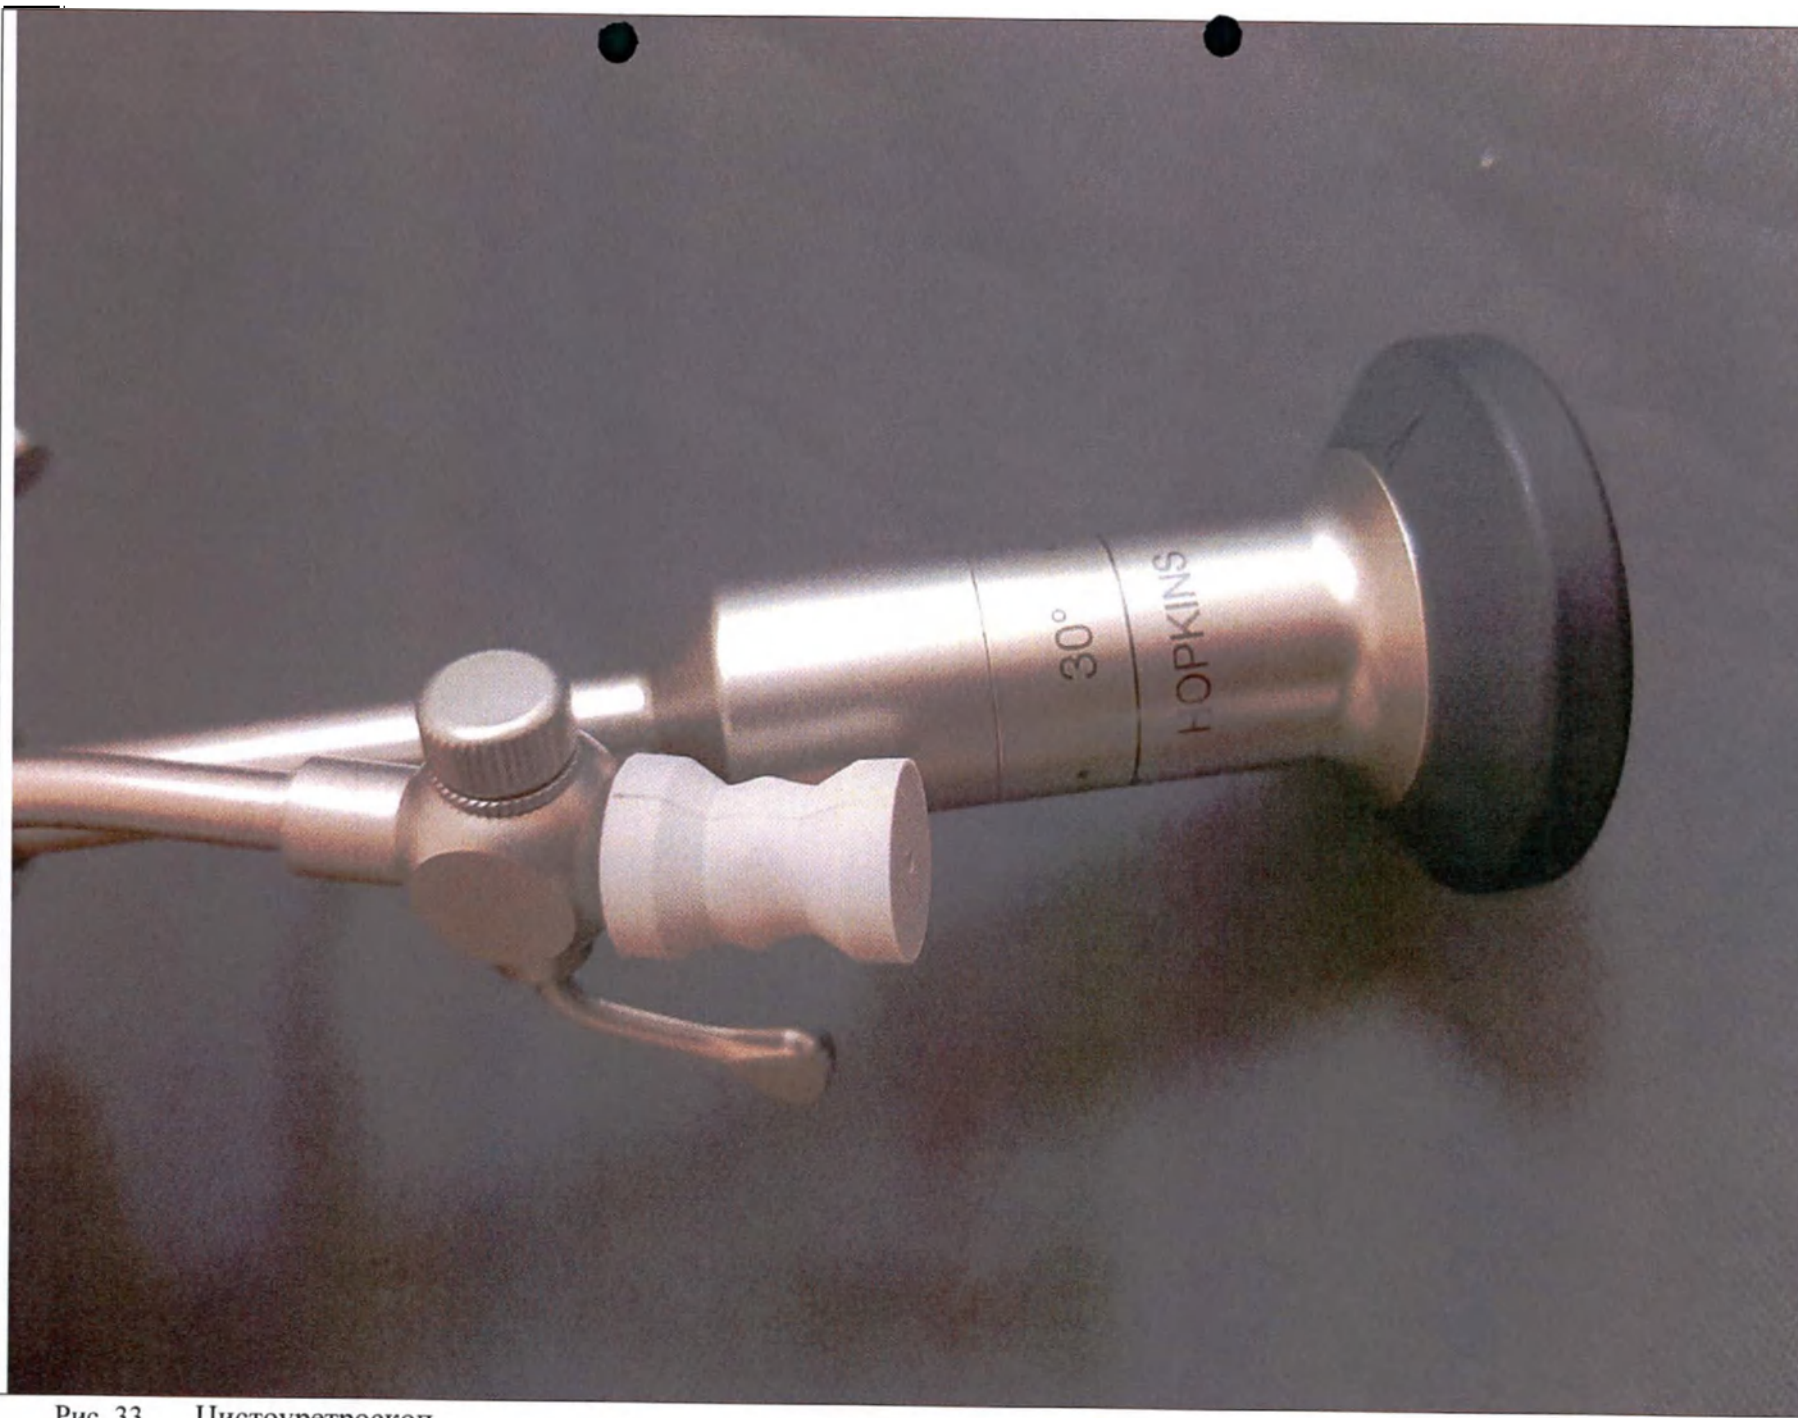


Рис. 33. Цистоуретроскоп



Рис. 34. Цистоуретроскоп

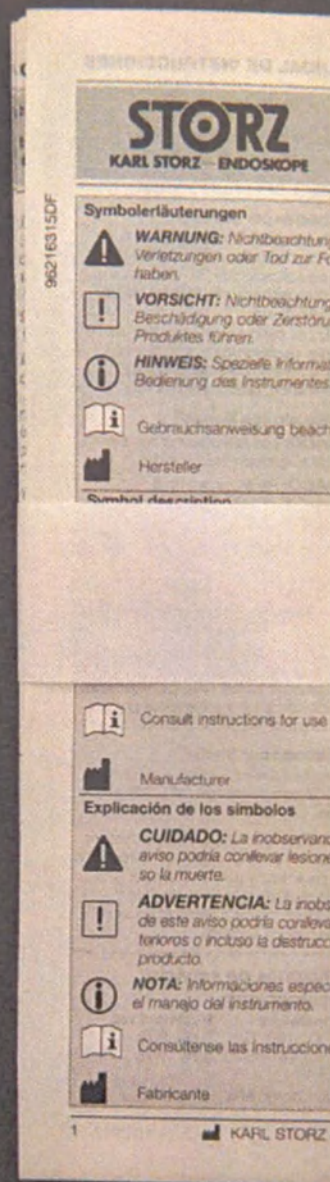


Рис. 35. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.

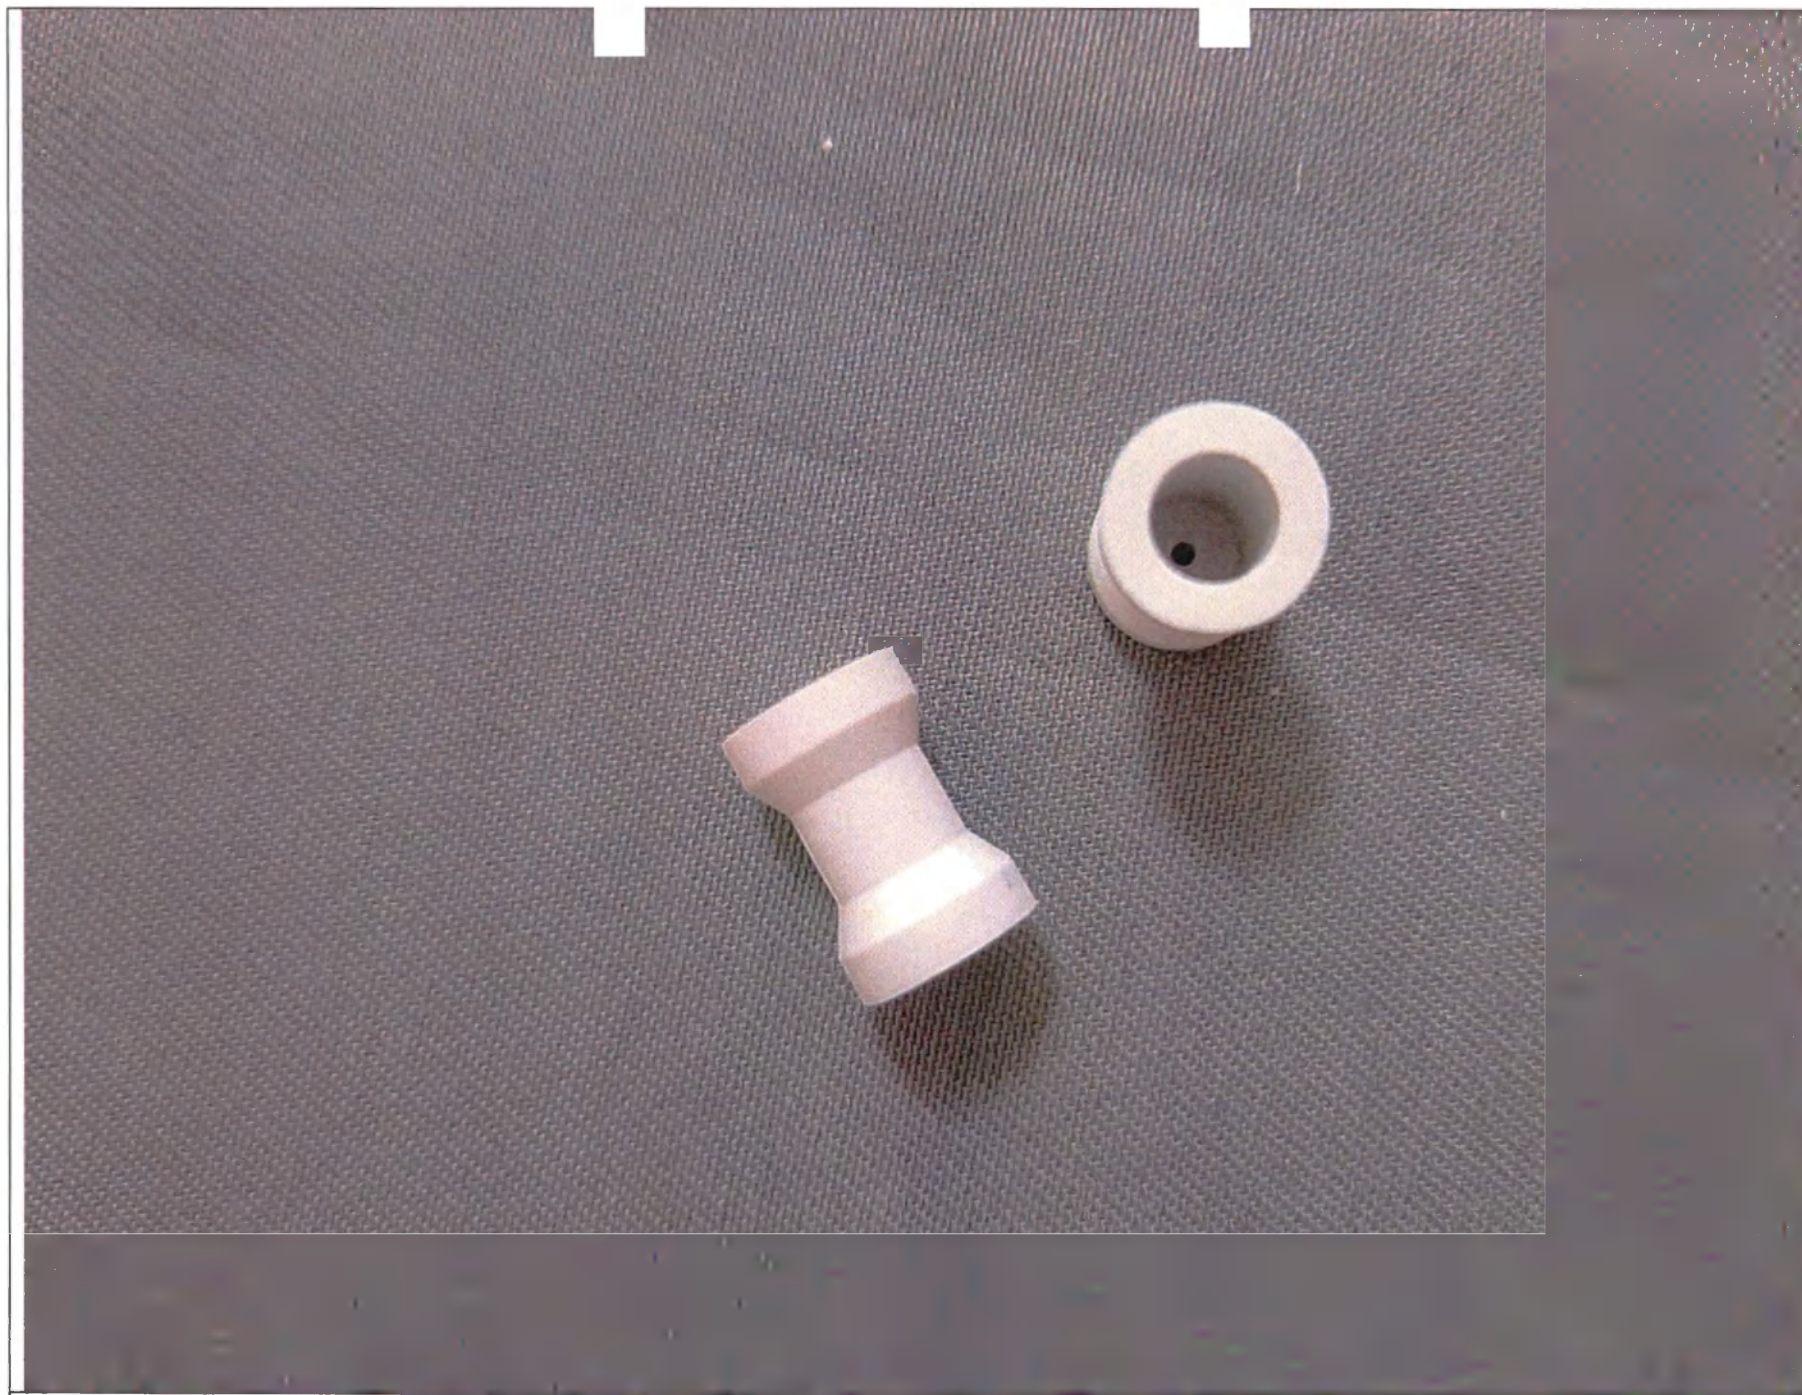


Рис. 36. Колпачок уплотнительный, диаметр 1,2 мм

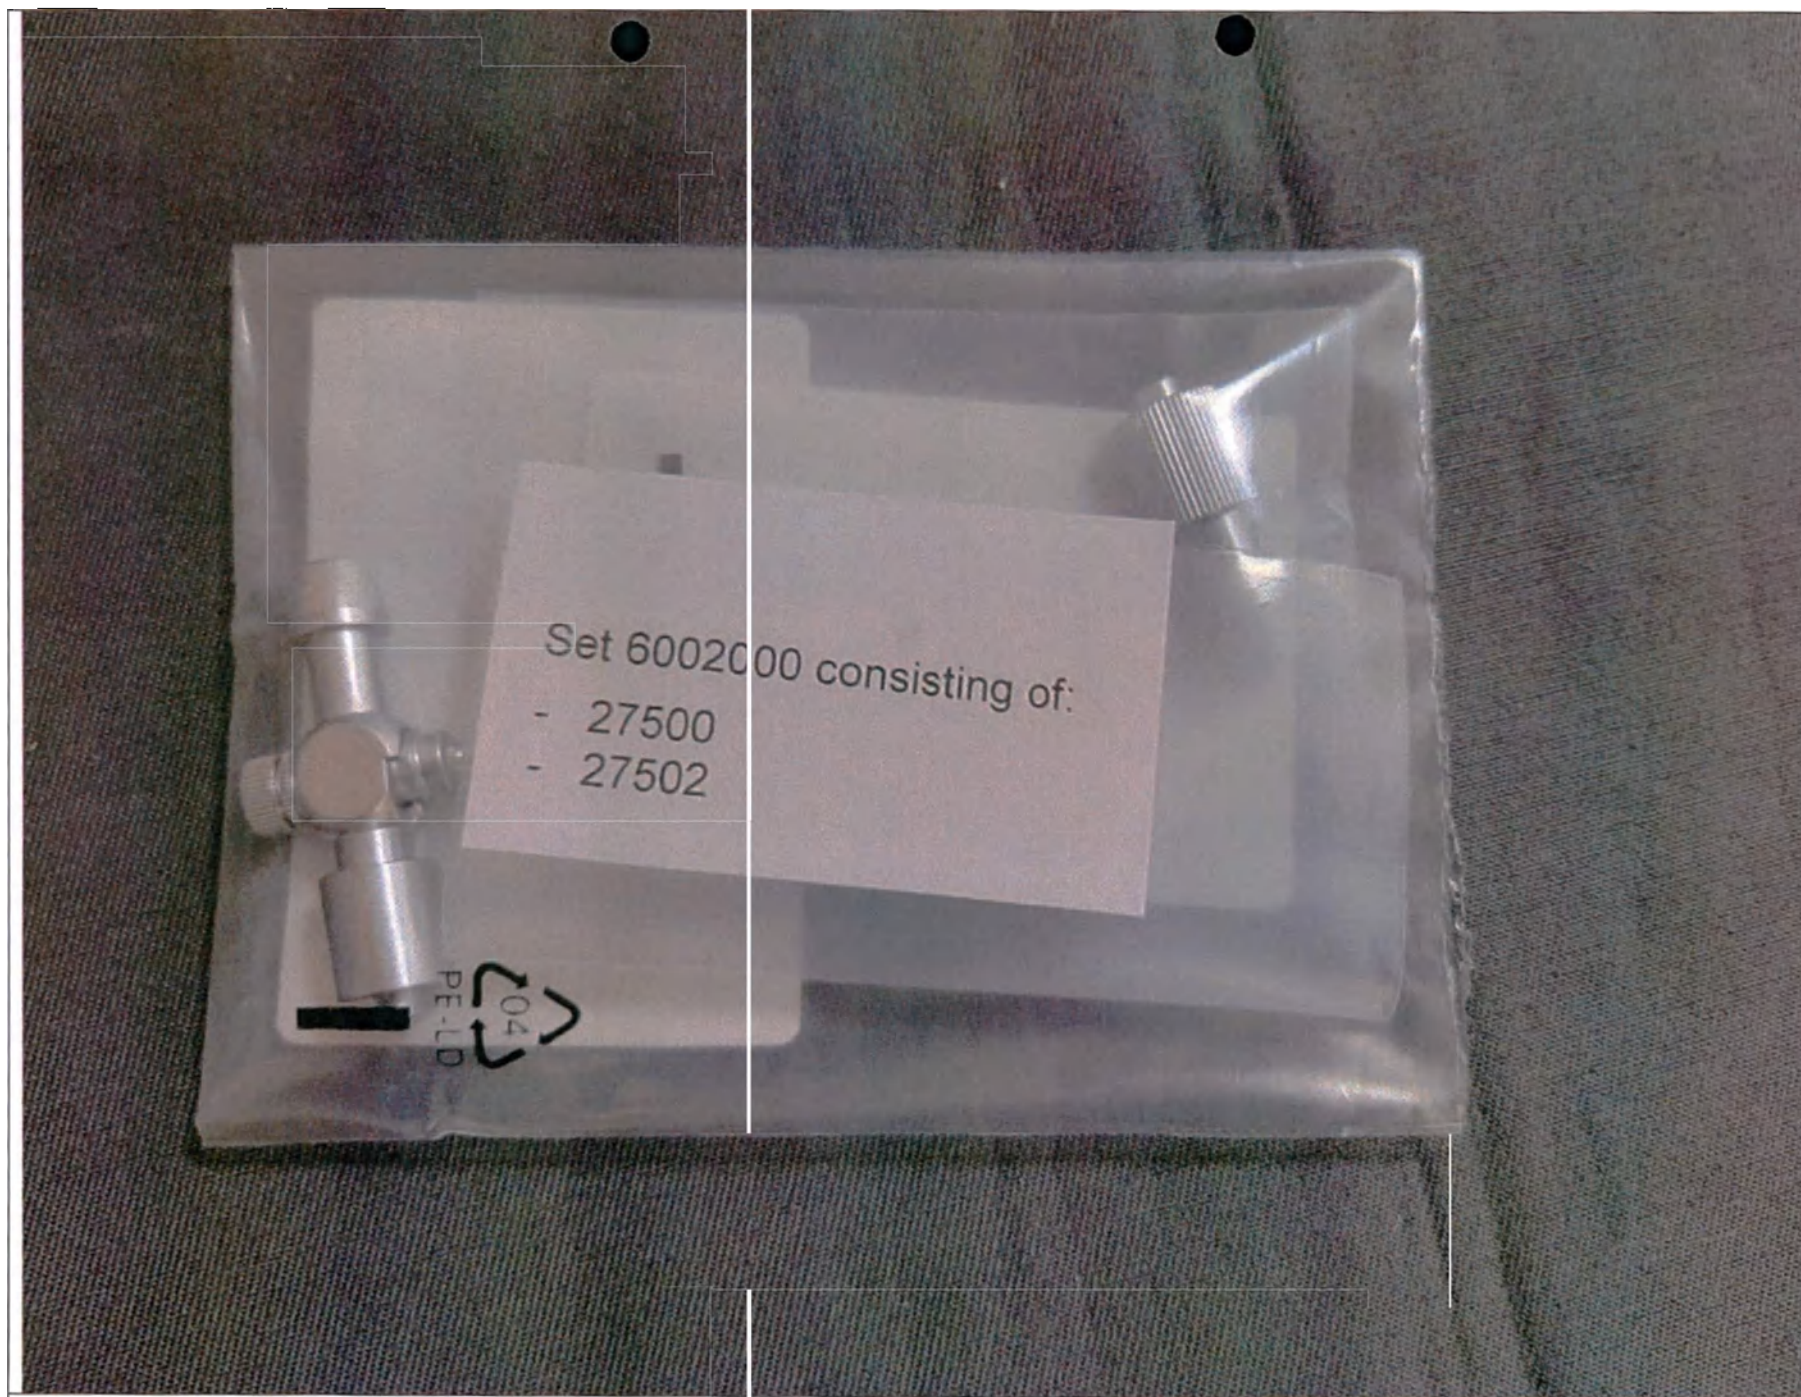


Рис. 37. Набор переходников для силиконовых трубок с соединением Luer.



Рис. 38. Переходник для силиконовых трубок с соединением Luer с запорным краном

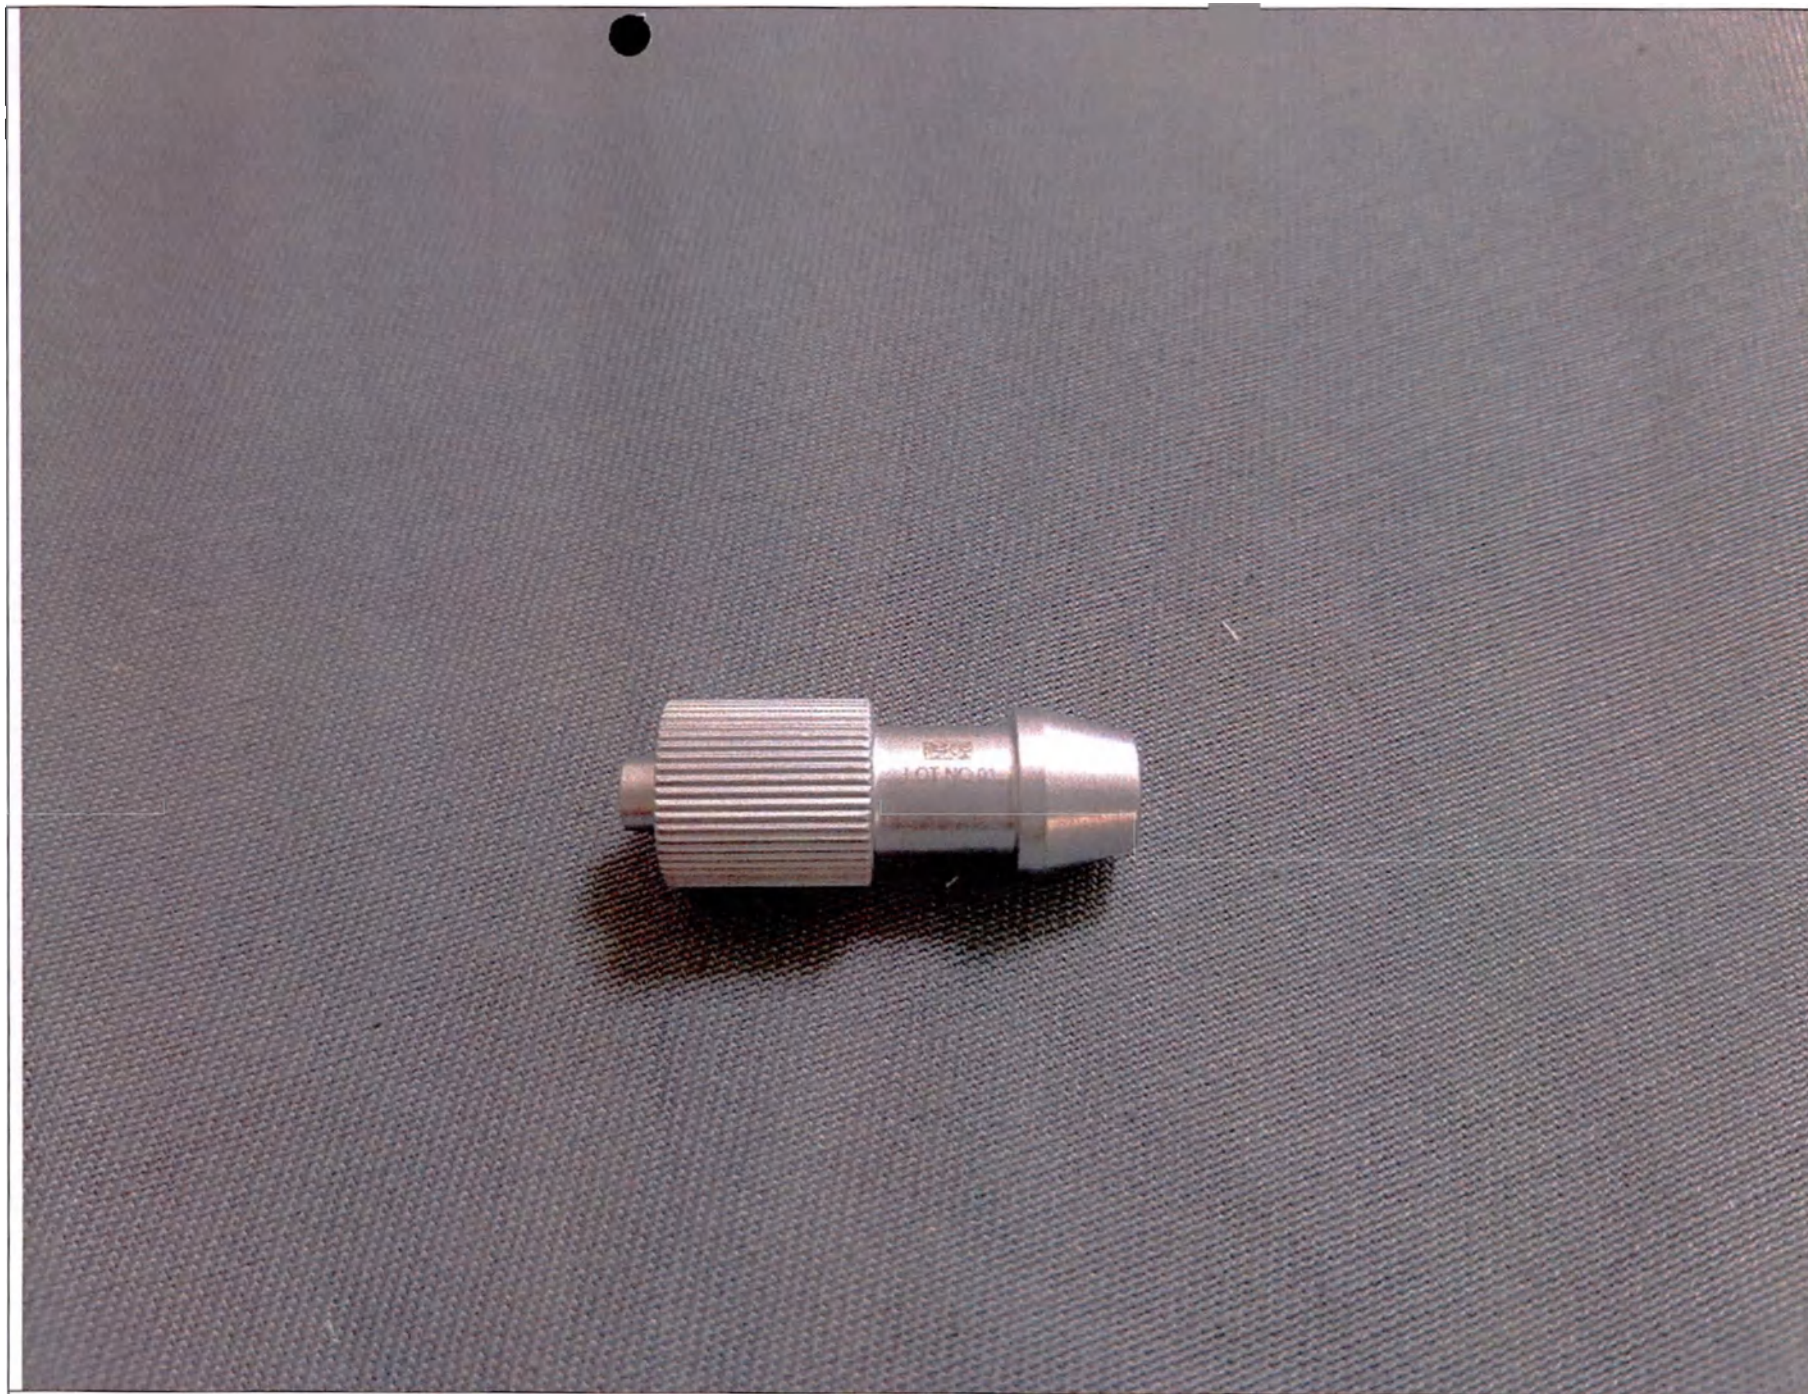


Рис. 39. Переходник для силиконовых трубок с соединением Luer



Рис. 40. Уретерореноскоп жесткий HOPKINS по GAUTIER, направление наблюдения 6°, размер 8 Шр., длина 41 см.
Упаковка.



Рис. 41. Уретерореноскоп жесткий HOPKINS по GAUTIER, направление наблюдения 6°, размер 8 Шр., длина 41 см. Маркировка на упаковке.

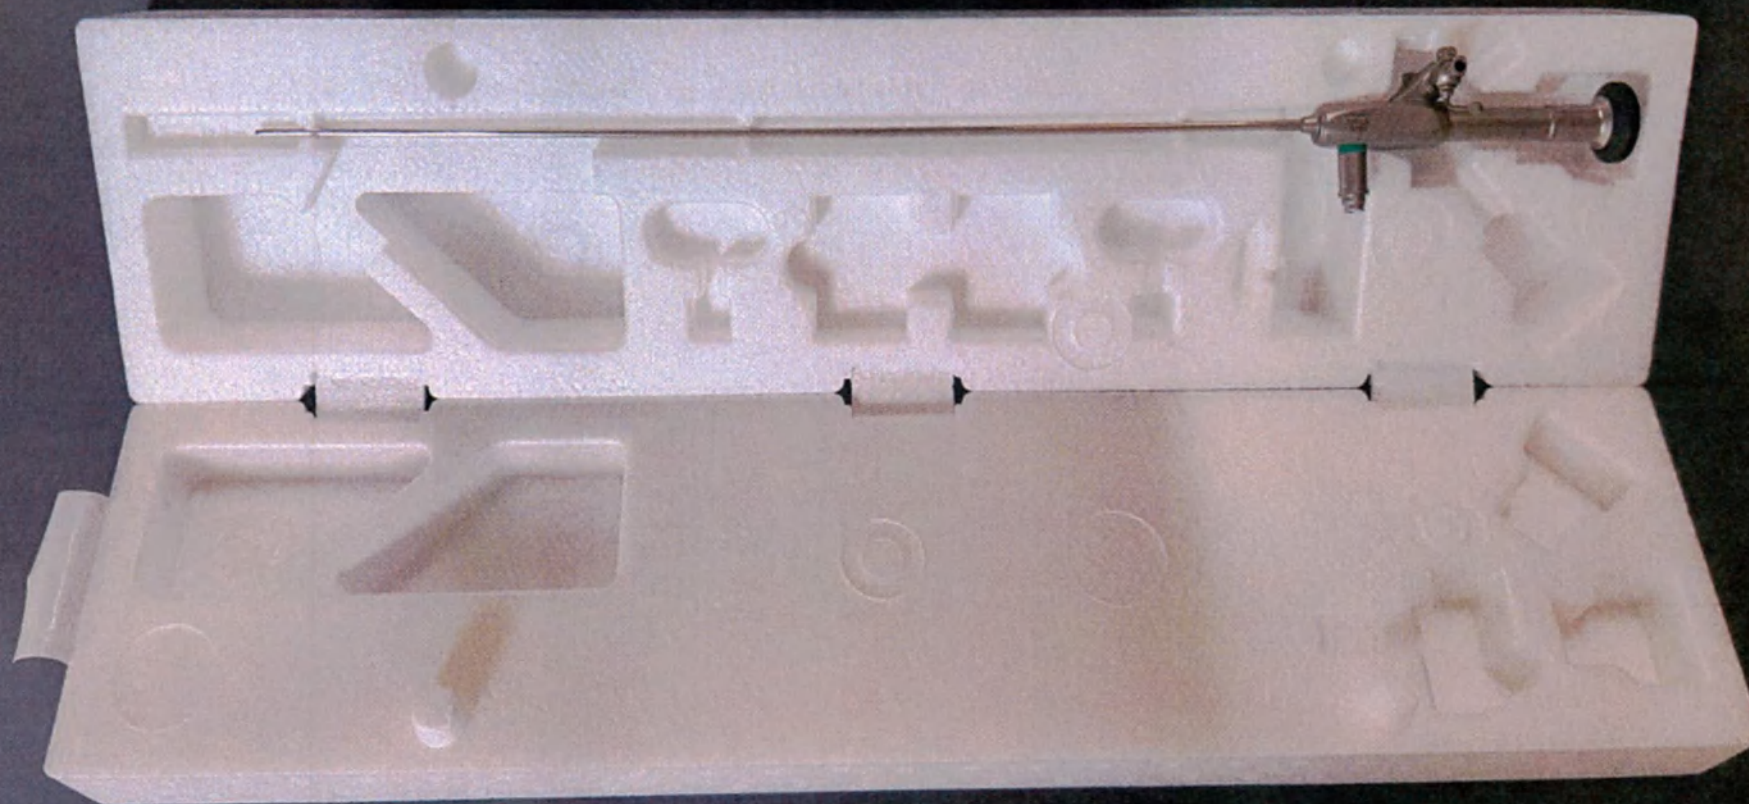


Рис. 42. Уретерореноскоп жесткий HOPKINS по GAUTIER, направление наблюдения 6°, размер 8 Шр., длина 41 см.



Рис. 43. Уретерореноскоп

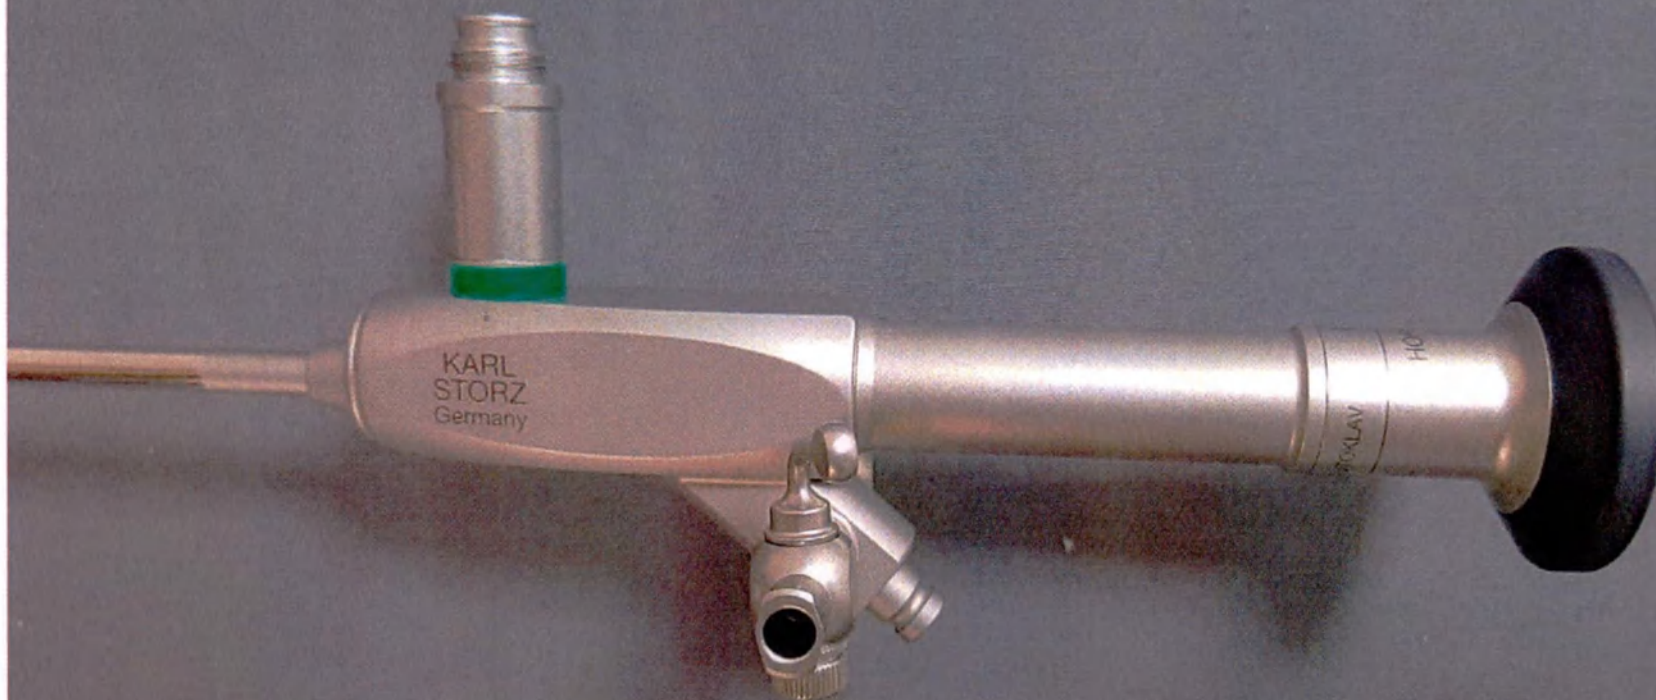


Рис. 44. Уретерореноскоп

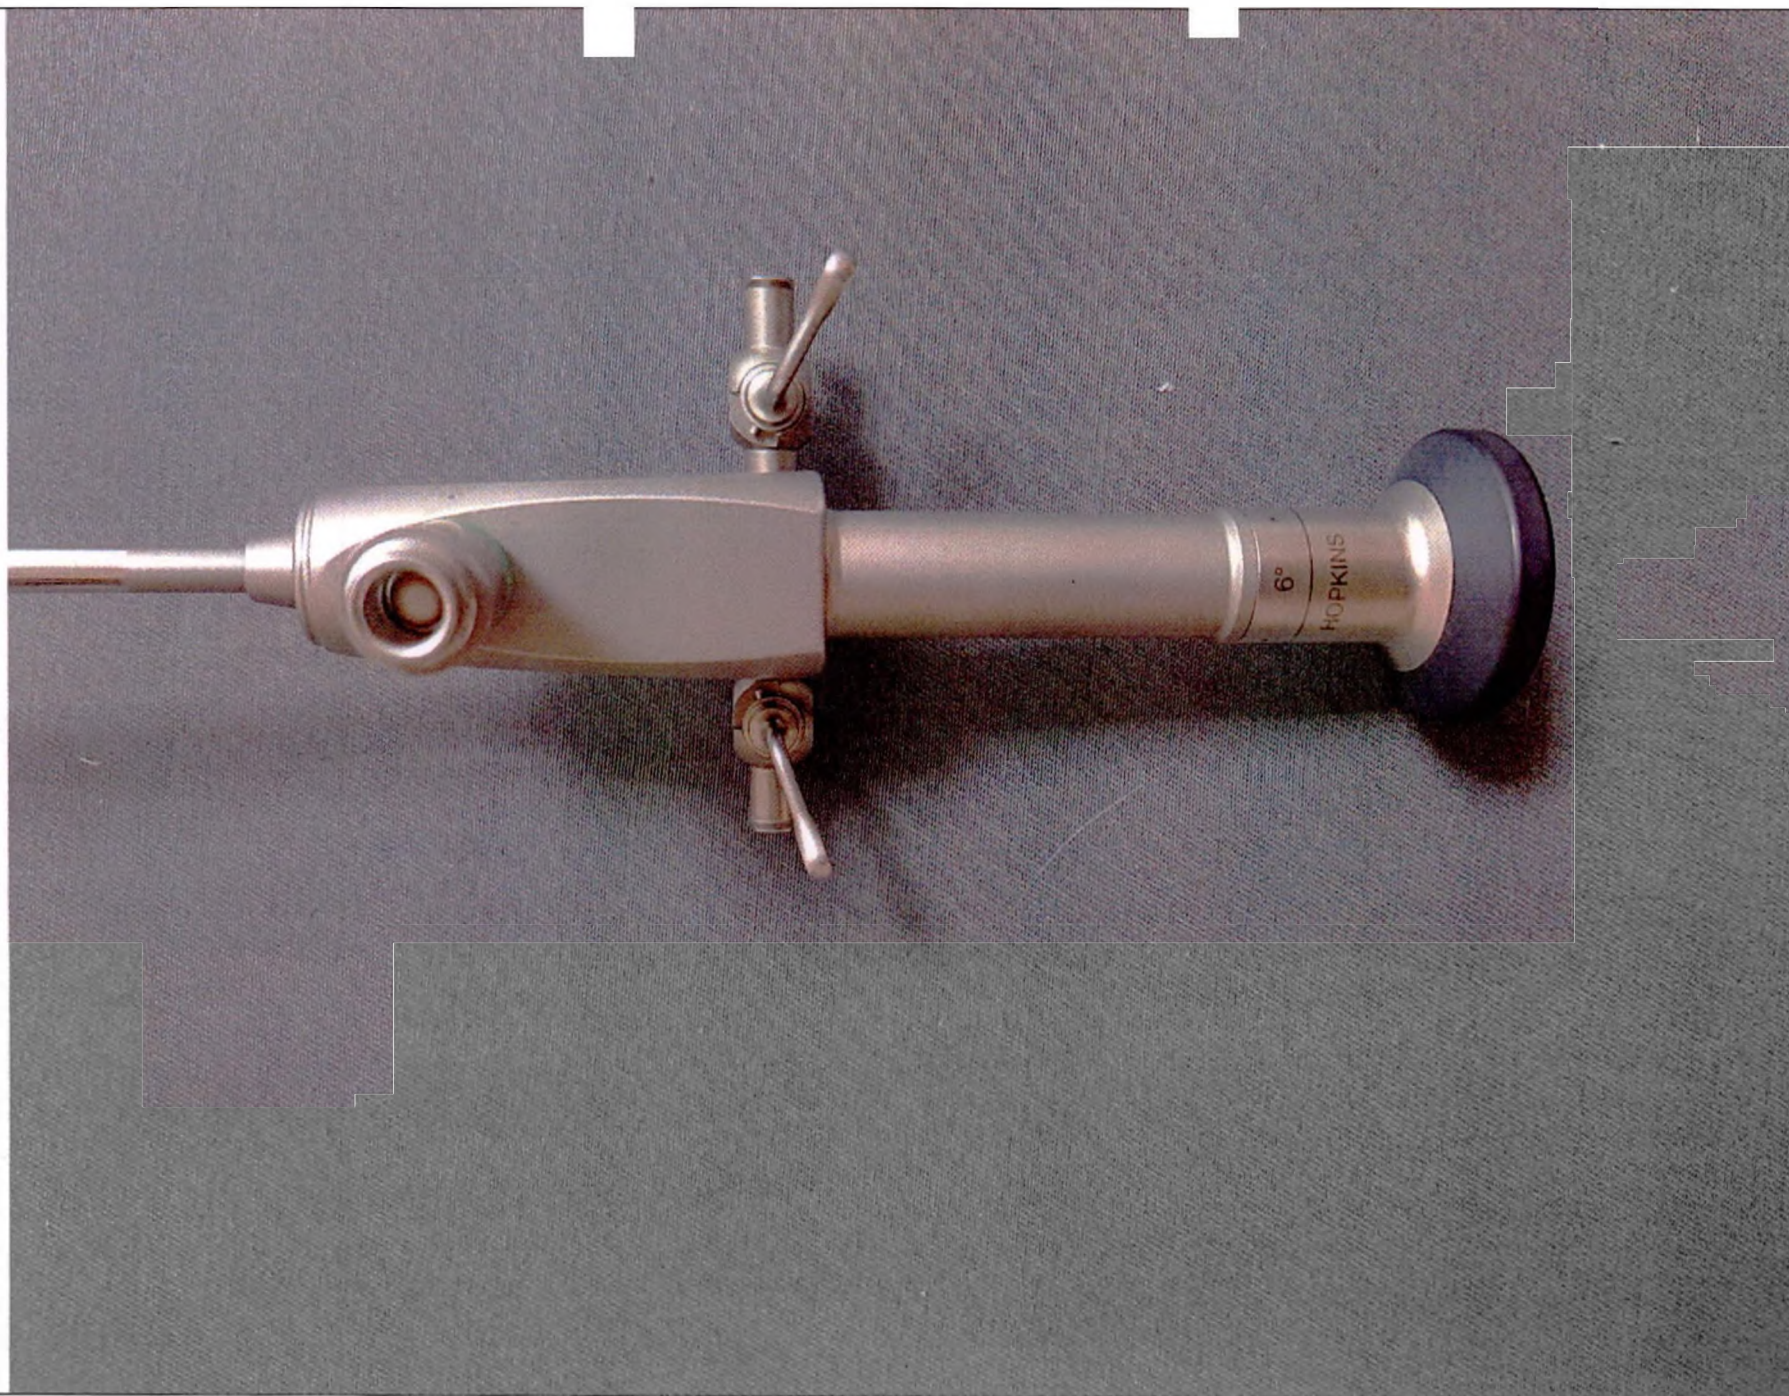


Рис. 45. Уретерореноскоп



Рис. 46. Уретерореноскоп

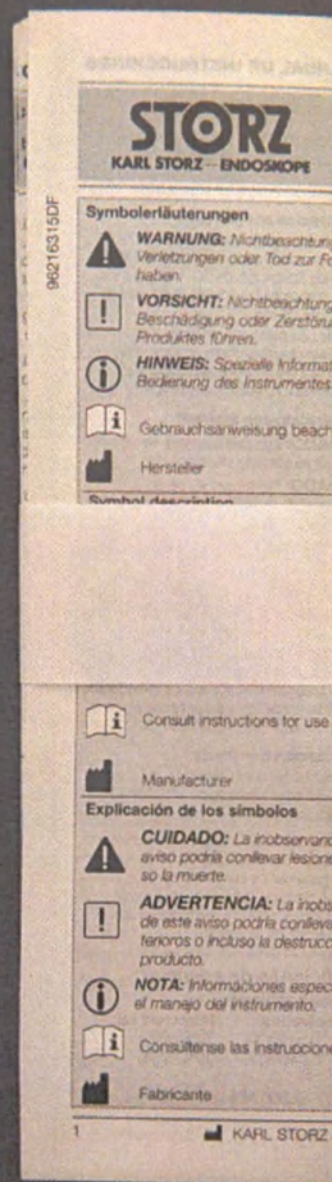


Рис. 47. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.



Рис. 48. Уретерореноскоп жесткий HOPKINS, направление наблюдения 0° , диаметр 2,8 мм, длина 44 см. Упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE

REF 27023ABA

SN 100093

QTY 1

HOPKINS® Optik 0°, 2.8mm

HOPKINS® Telescope 0°, 2.8mm

Optique HOPKINS® 0°, 2.8mm

Optica HOPKINS® 0°, 2.8mm

Óptica HOPKINS® 0°, 2.8mm

Telescópio HOPKINS® 0°, 2.8mm



0130404855107 36431240127023ABA(21)100093

RxONLY

CE 0123




Рис. 49. Уретерореноскоп жесткий HOPKINS, направление наблюдения 0°, диаметр 2,8 мм, длина 44 см. Маркировка на упаковке.

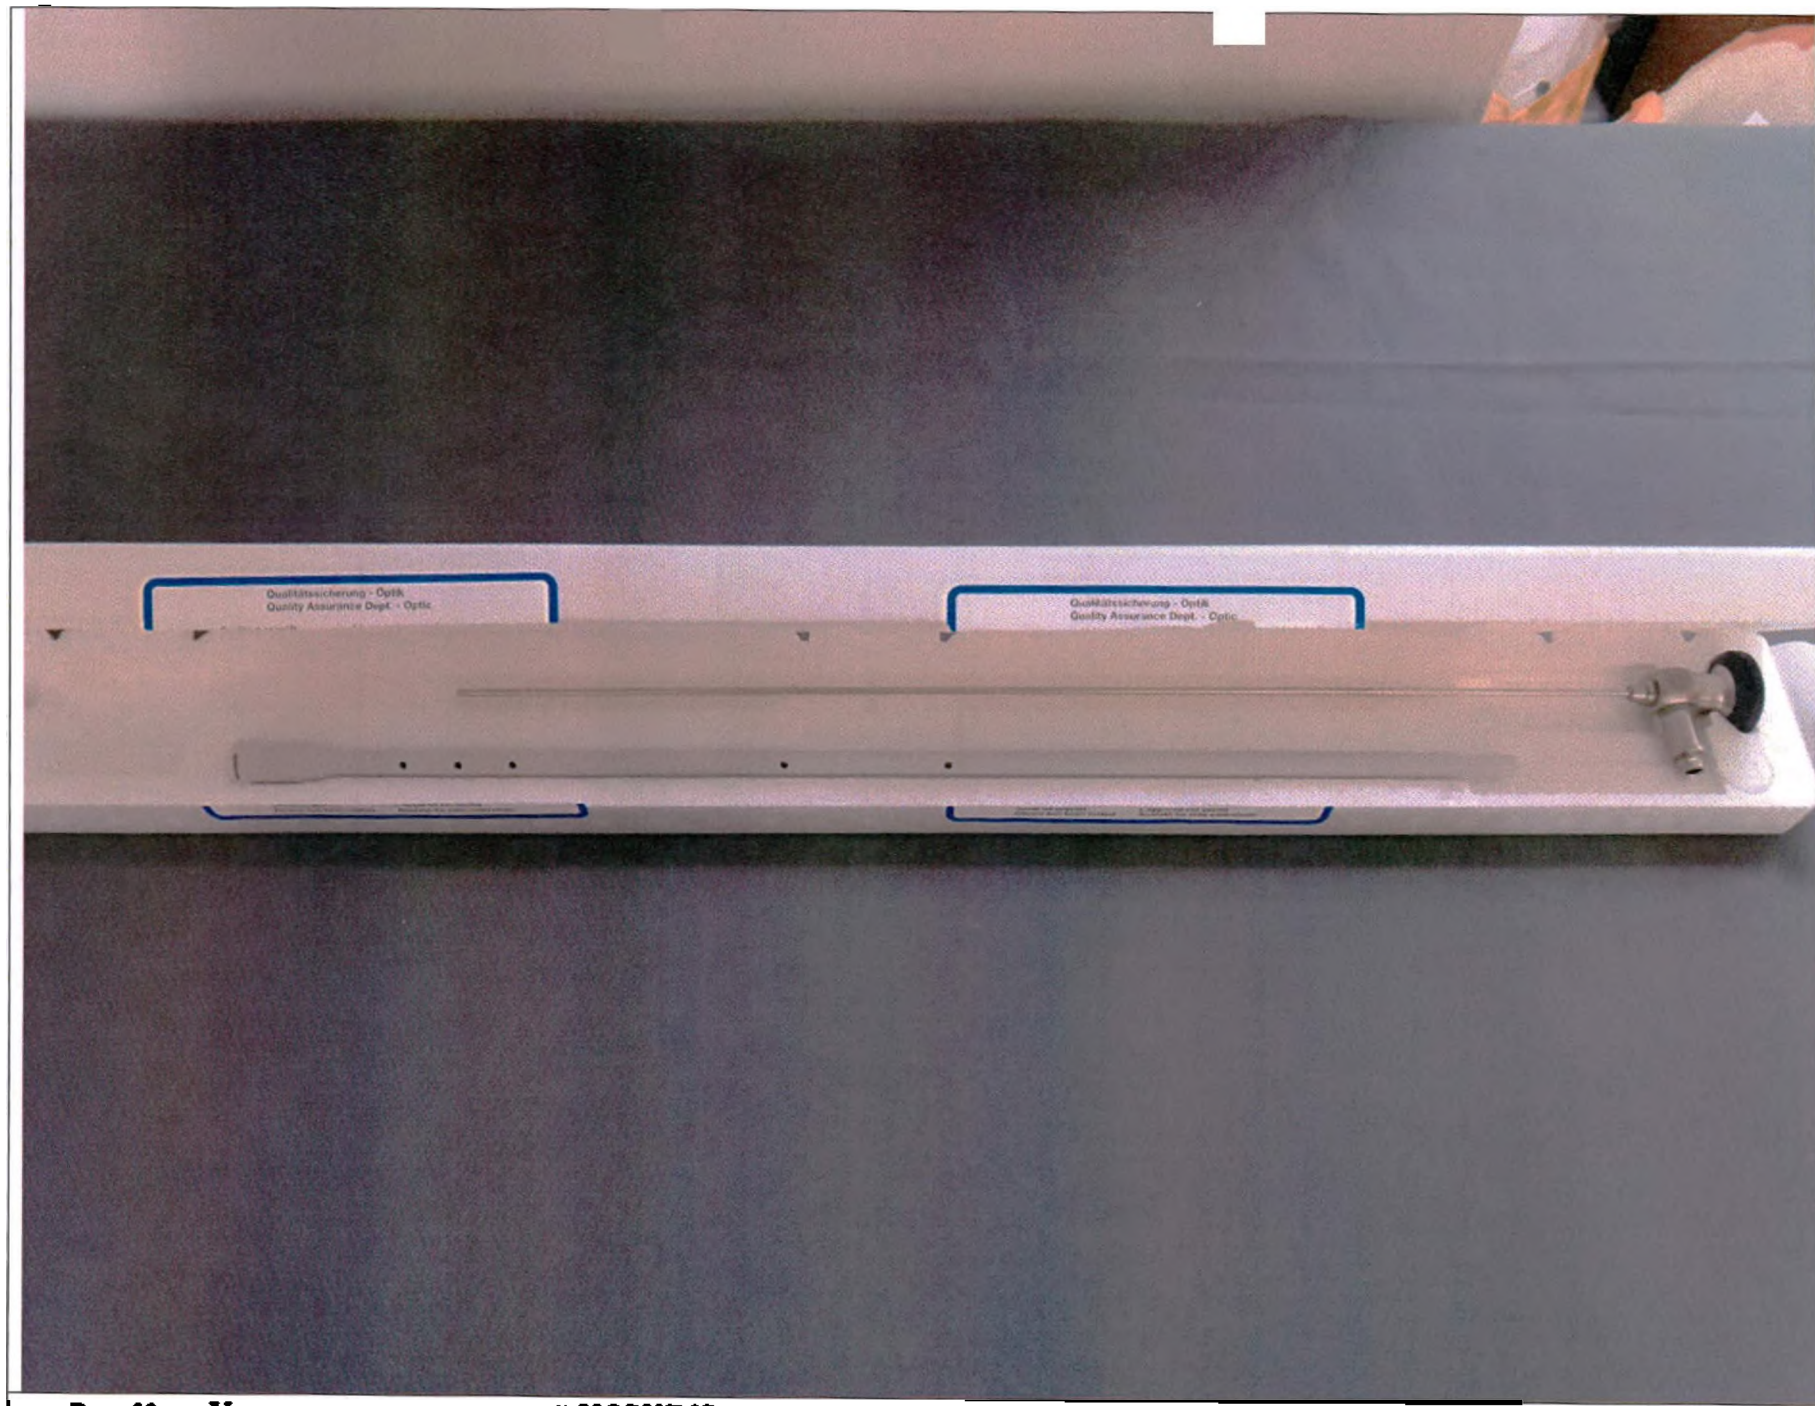


Рис. 50. Уретерореноскоп жесткий HOPKINS, направление наблюдения 0°, диаметр 2,8 мм, длина 44 см.

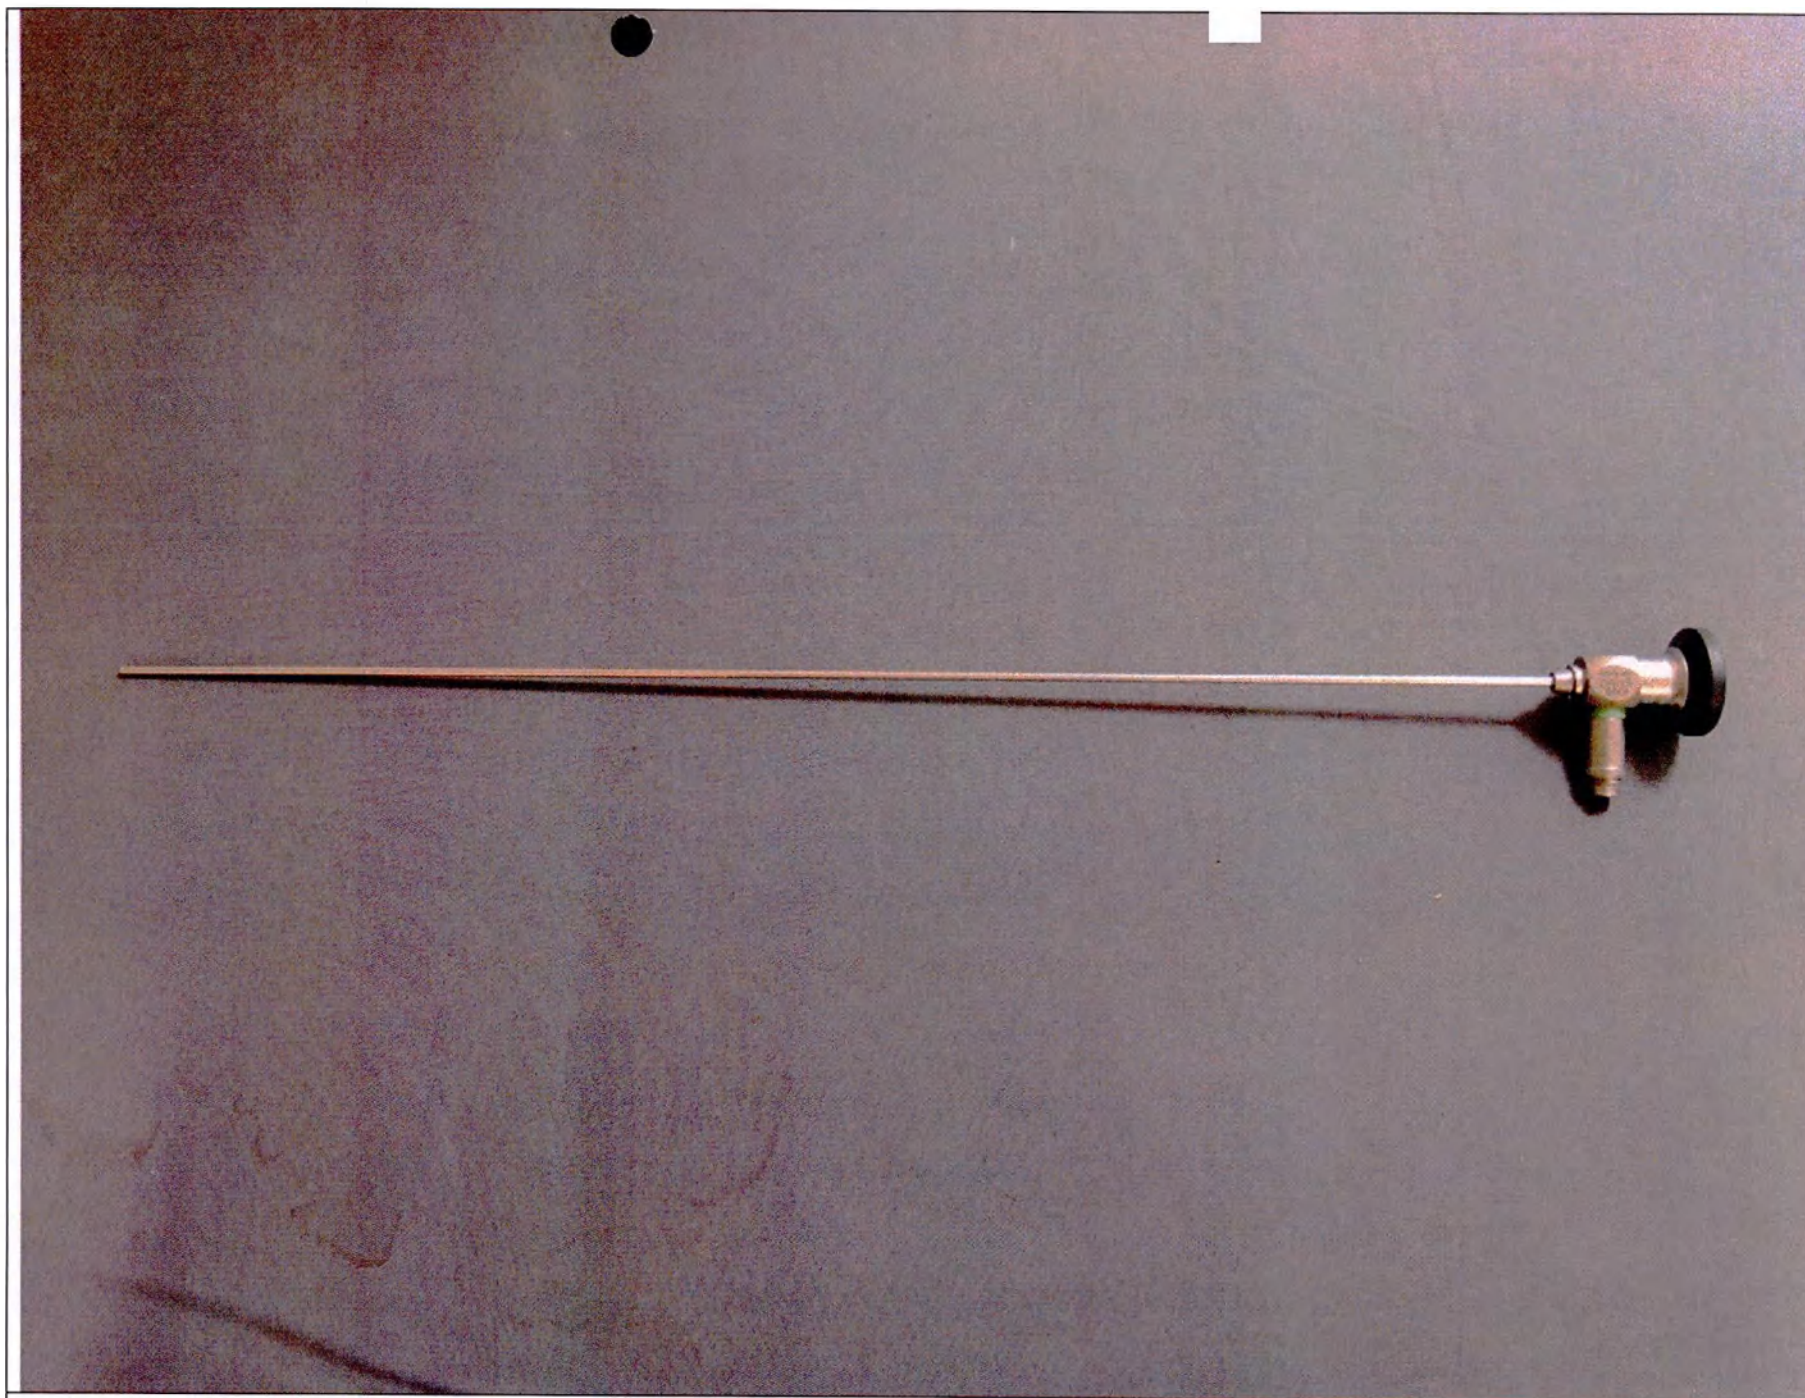


Рис. 51. Уретерореноскоп

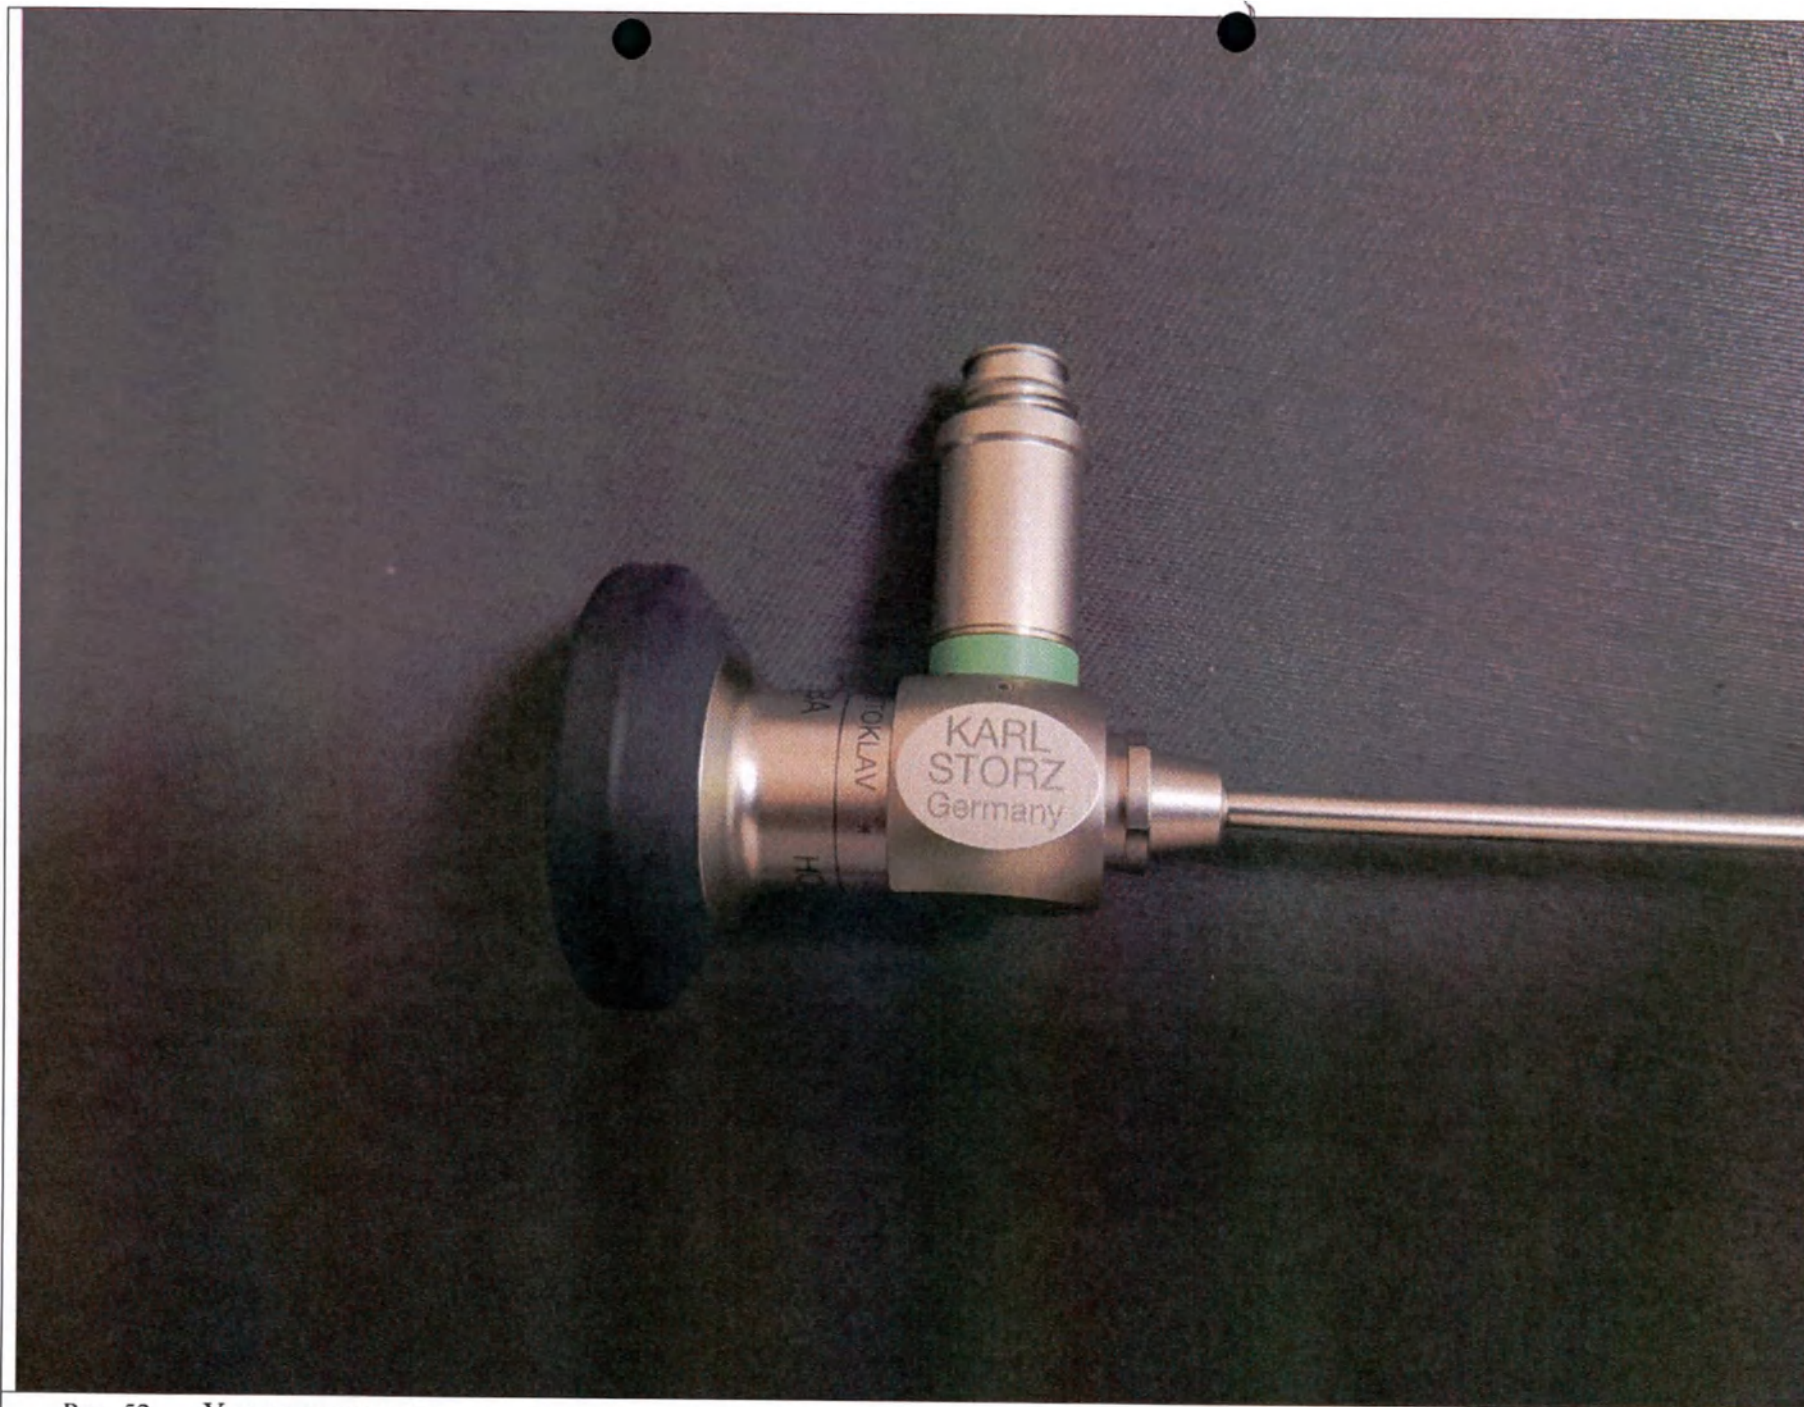


Рис. 52. Уретерореноскоп

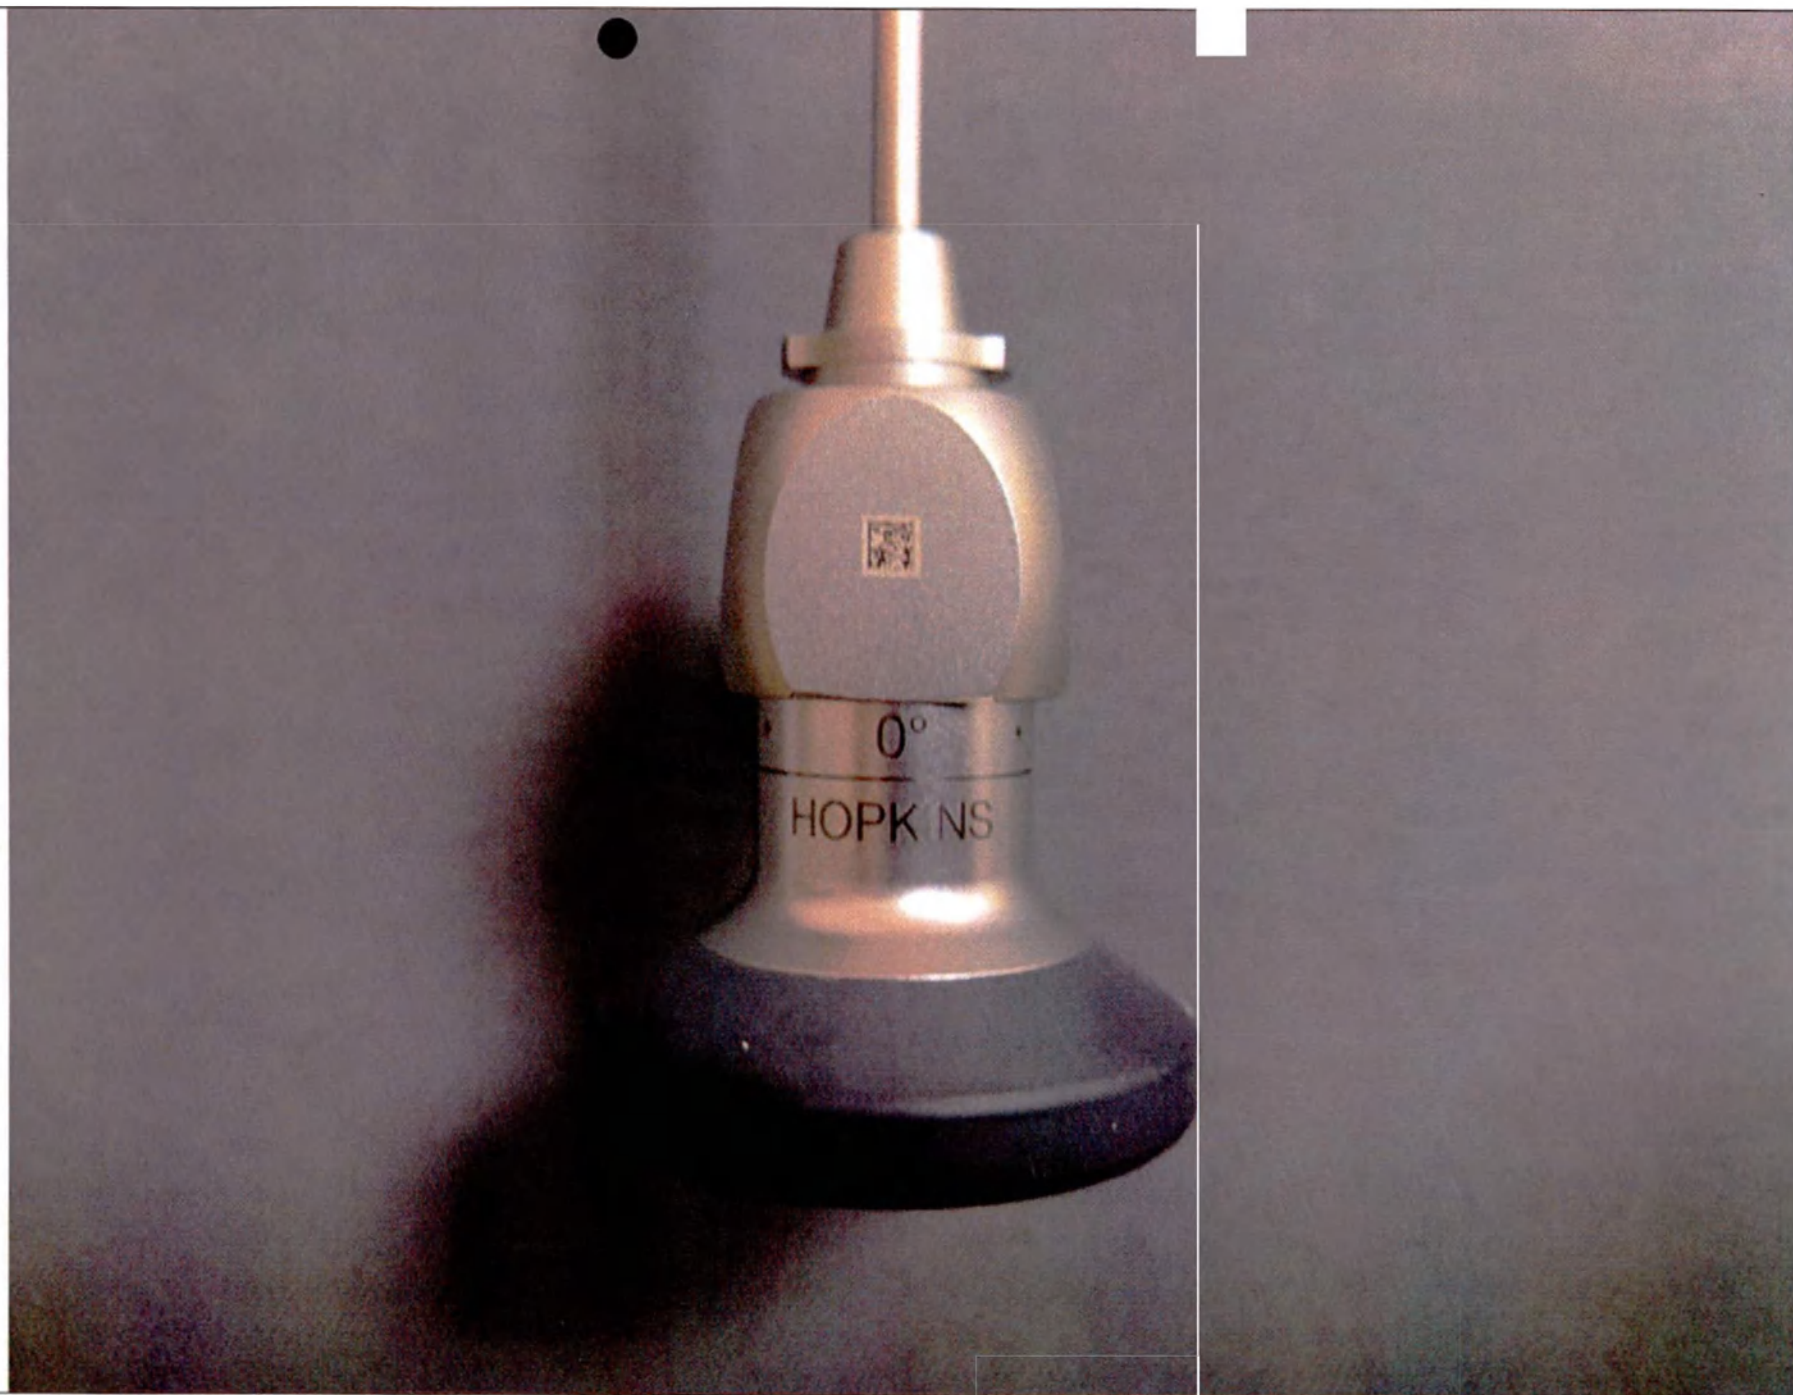


Рис. 53. Уретерореноскоп



Рис. 54. Уретерореноскоп

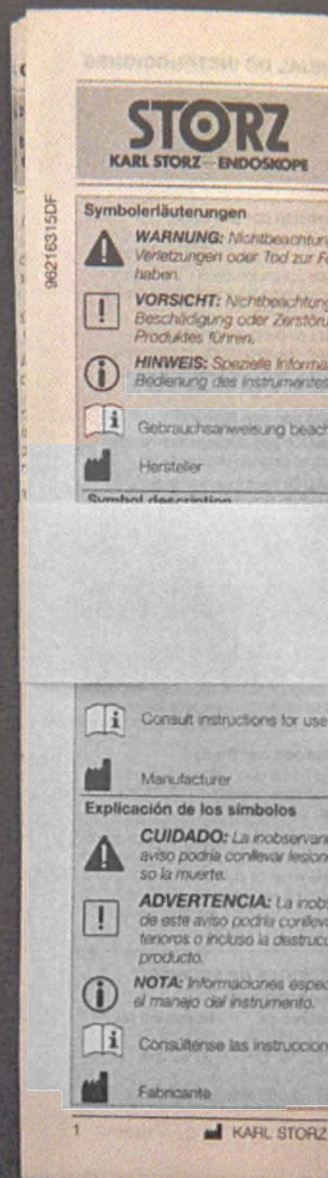


Рис. 55. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.

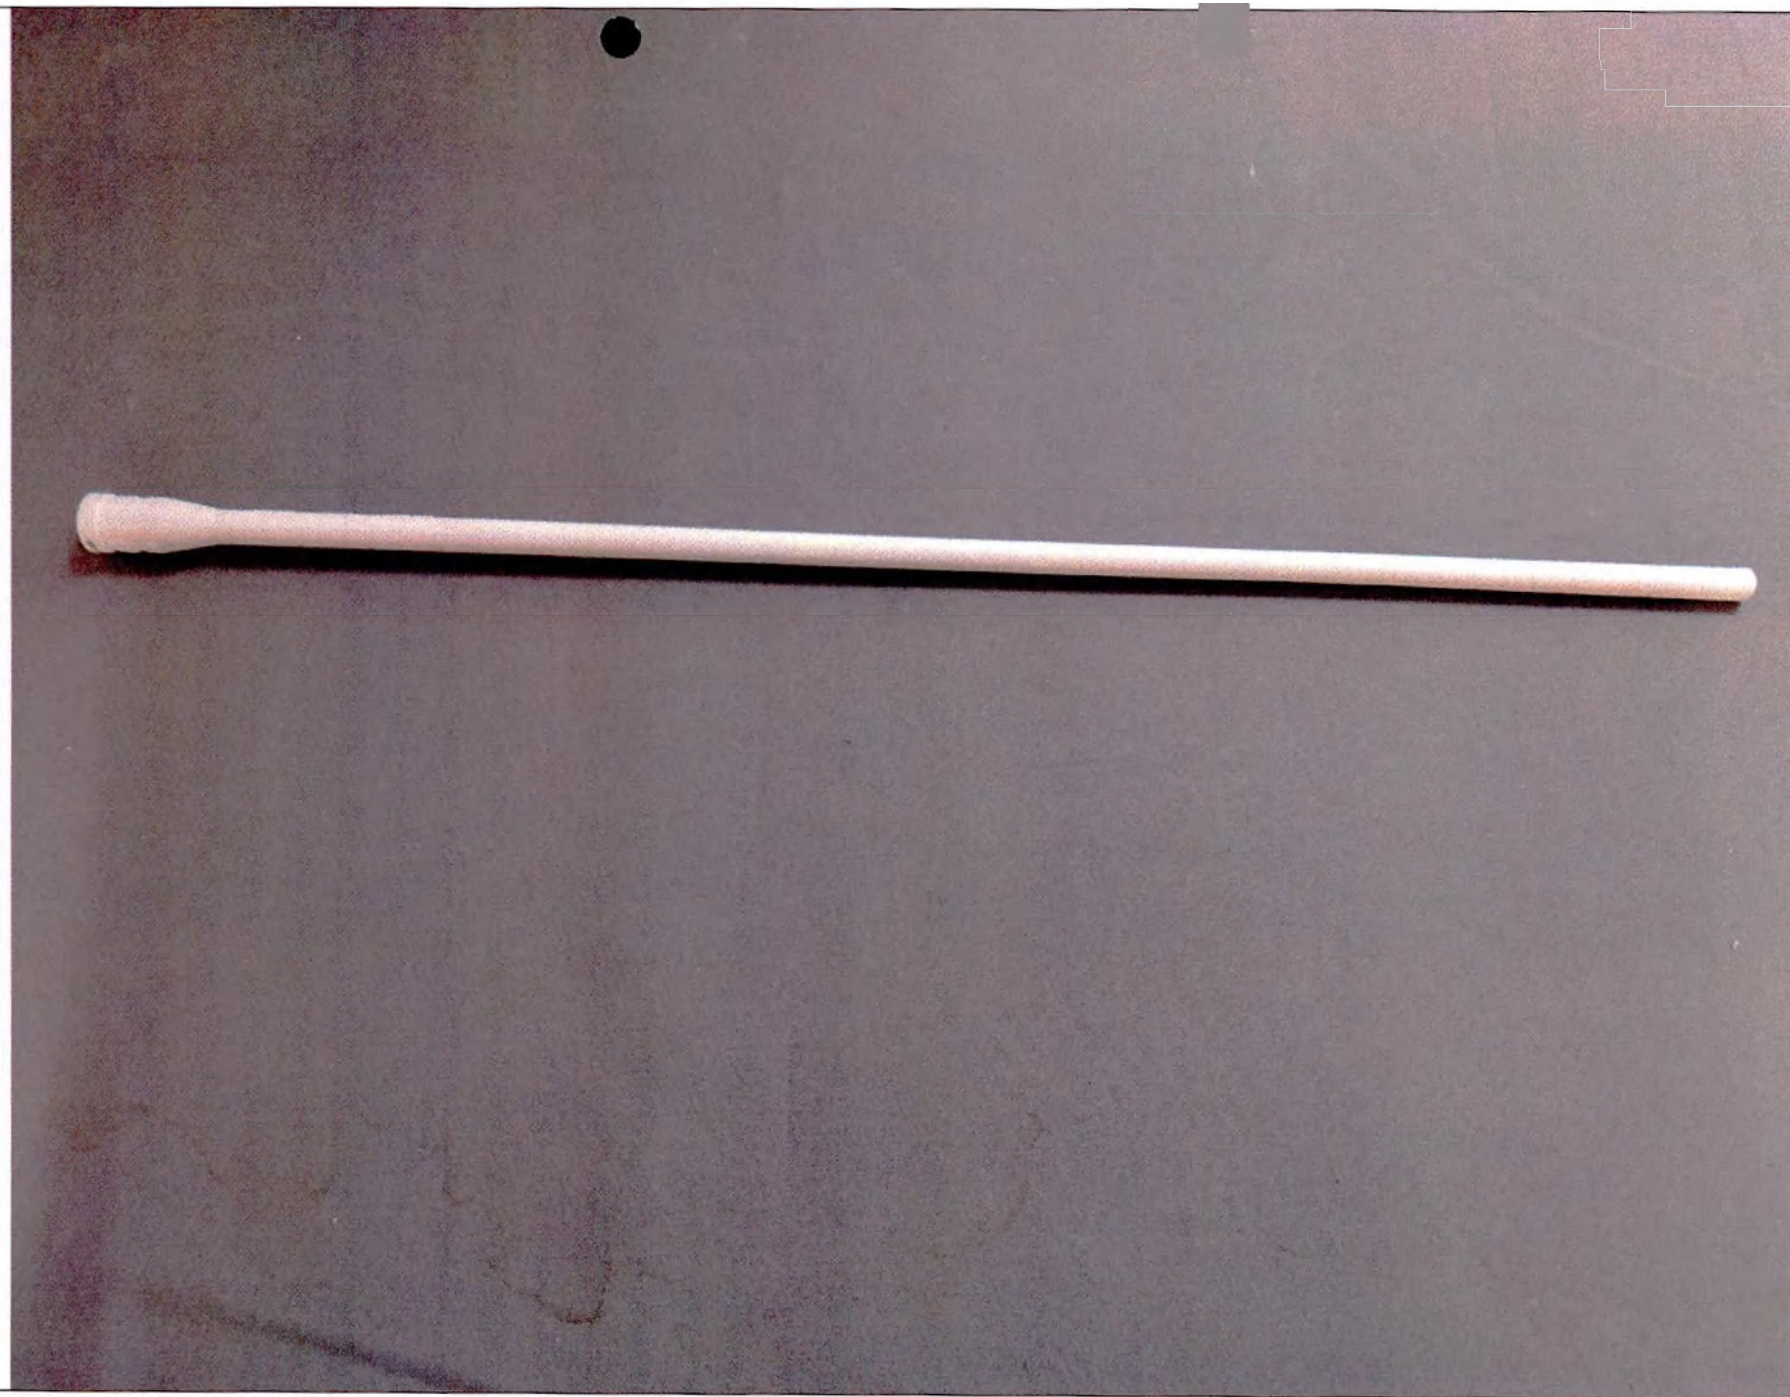


Рис. 56. Гильза защитная, для эндоскопов длиной 44 см



Рис. 57. Адаптер световодов KARL STORZ и Olympus. Первичная упаковка.



Рис. 58. Адаптер световодов KARL STORZ и Olympus.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPY

REF 495F

LOT S006

QTY 1

Stecksockel, 9 mm ø
Attachm. for cable STORZ-Wolf
Culot à emboîter, ø 9 mm
Bussola, 9 mm Ø
Base enchufable, 9 mm.
adaptad.p/cabo de luz fria



0104048551188585(240)495F(10)S006

Рис. 59. Адаптер световодов Richard Wolf. Первичная упаковка.

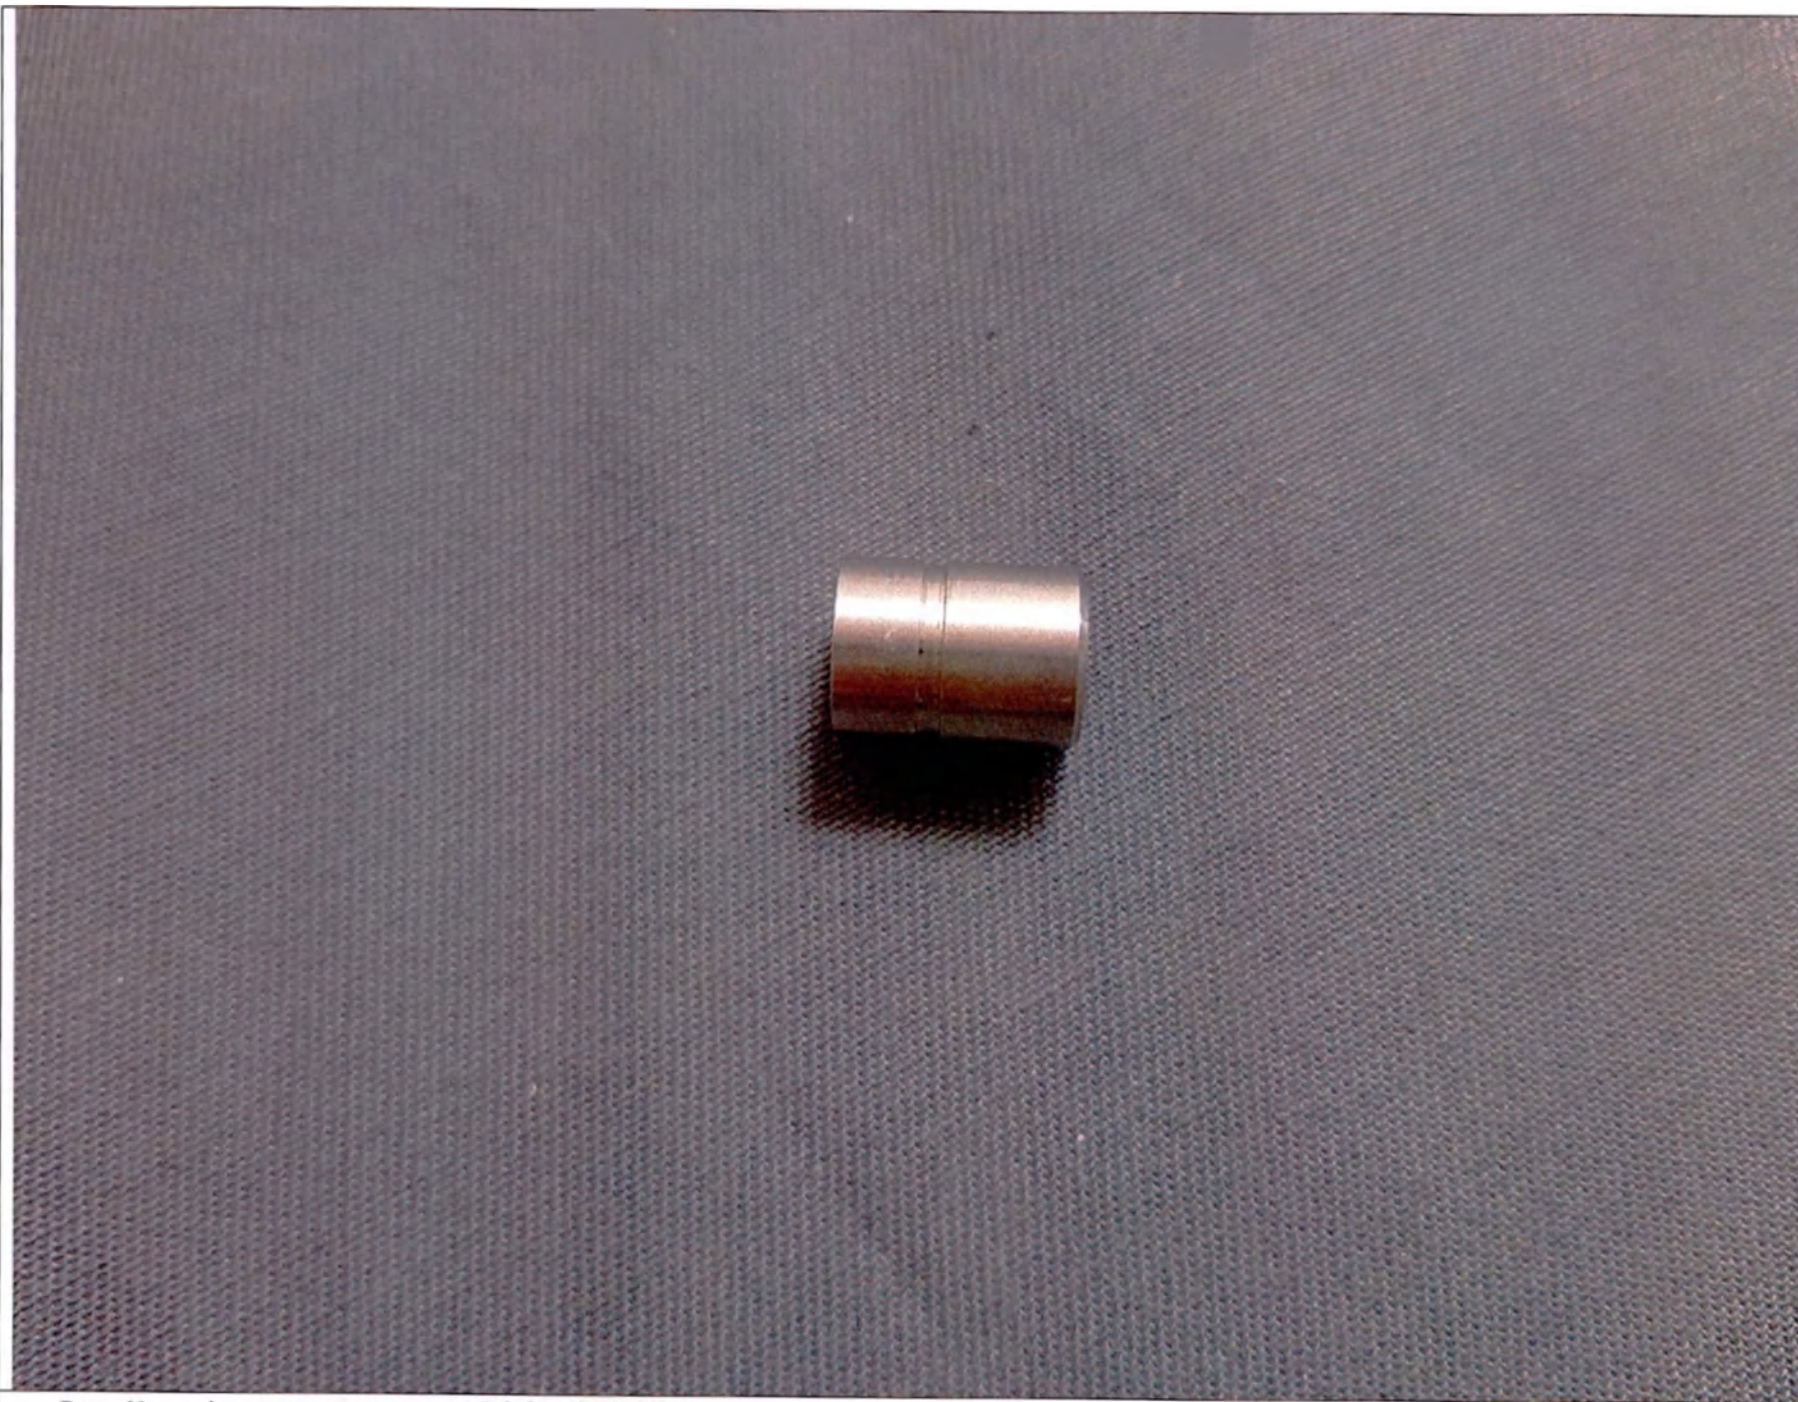


Рис. 60. Адаптер световодов Richard Wolf

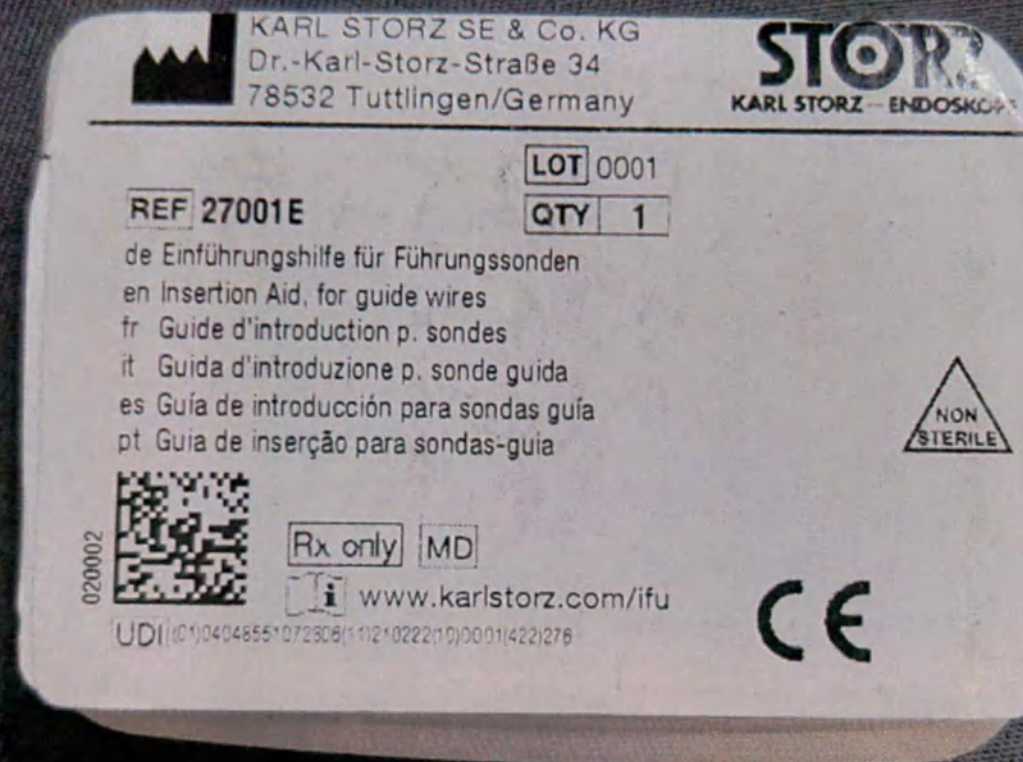


Рис. 61. Инструмент вспомогательный для введения гибких проводников. Вторичная упаковка.



Рис. 62. Инструмент вспомогательный для введения гибких проводников. Первичная упаковка.



Рис. 63. Инструмент вспомогательный для введения гибких проводников.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

REF 27500

LUER-Lock Schlauchverbinder
LUER-Lock Tube Connector
Raccord LUER-Lock pour tuyau
Raccordo LUER-Lock per tubo
Conector para tubos LUER-Lock
Conector LUER-Lock para mangueiras

LOT	0001
QTY	1



(21)04048551083451(249)27500(10)0001

CE 0123

Рис. 64. Переходник для силиконовых трубок с соединением Лuer. Первичная упаковка



Рис. 65. Переходник для силиконовых трубок с соединением Luer

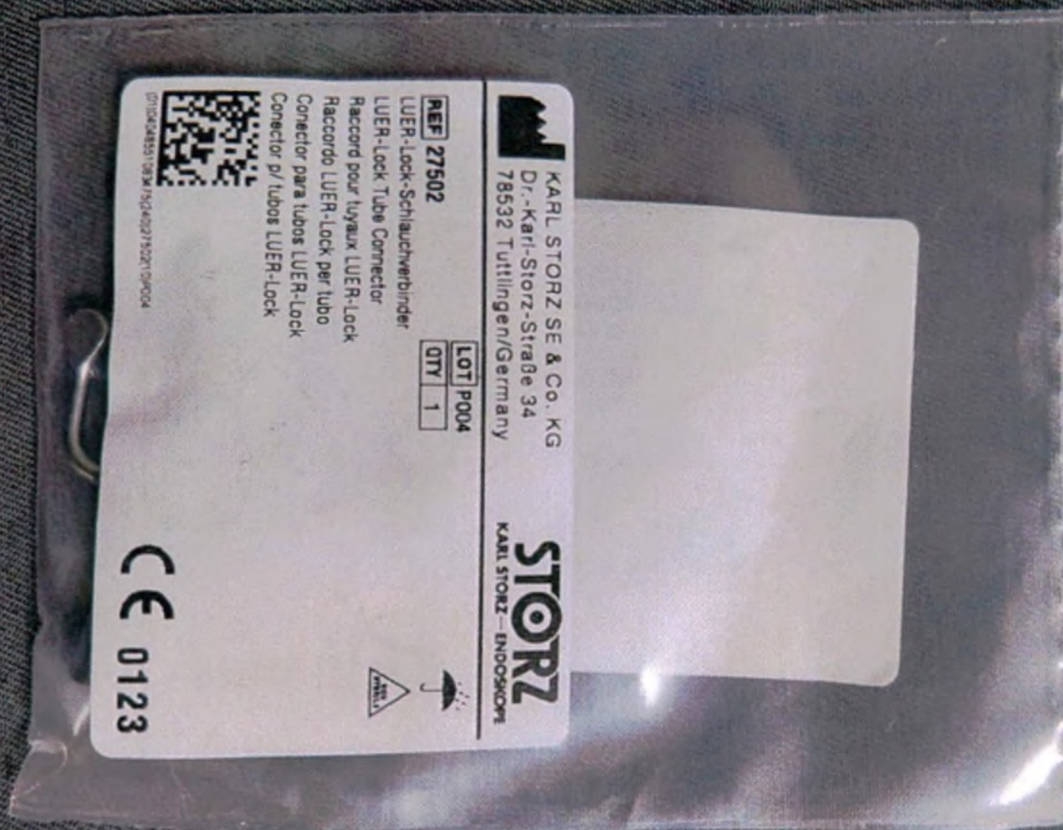


Рис. 66. Переходник для силиконовых трубок с соединением Luer с запорным краном. Первичная упаковка



Рис. 67. Переходник для силиконовых трубок с соединением Льюэ с запорным краном.



Рис. 68. Адаптер рабочего канала. Вторичная упаковка

Рис. 69. Адаптер рабочего канала. Первичная упаковка





Рис. 70. Адаптер рабочего канала.



Рис. 71. Уплотнитель для инструментального порта – 10 шт./уп. Первичная упаковка



Рис. 72. Уплотнитель для инструментального порта – 10 шт./уп.



Рис. 73. Адаптер для чистки. Вторичная упаковка

Рис. 74. Адаптер для чистки. Первичная упаковка

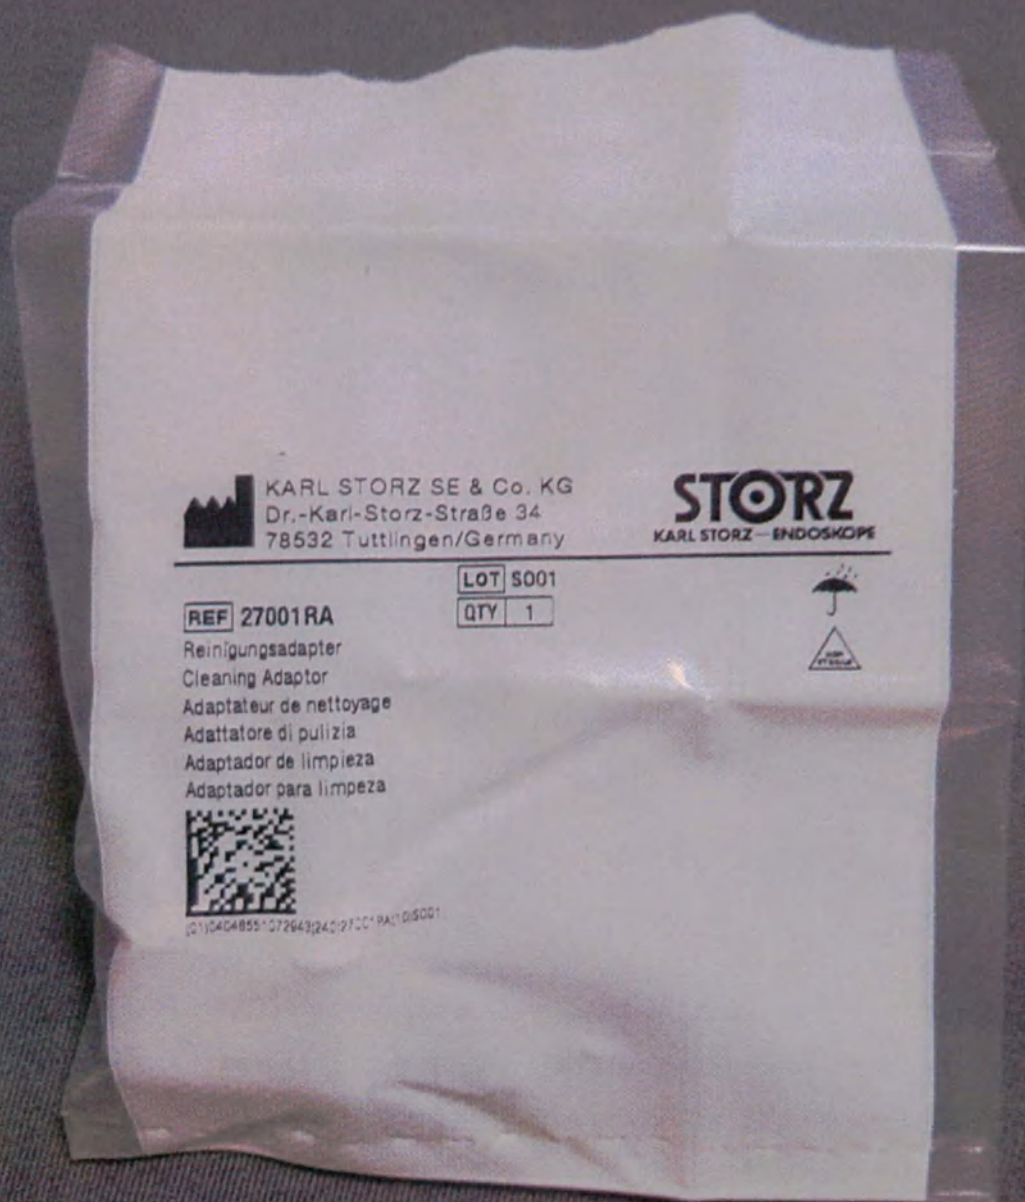




Рис. 75. Адаптер для чистки.

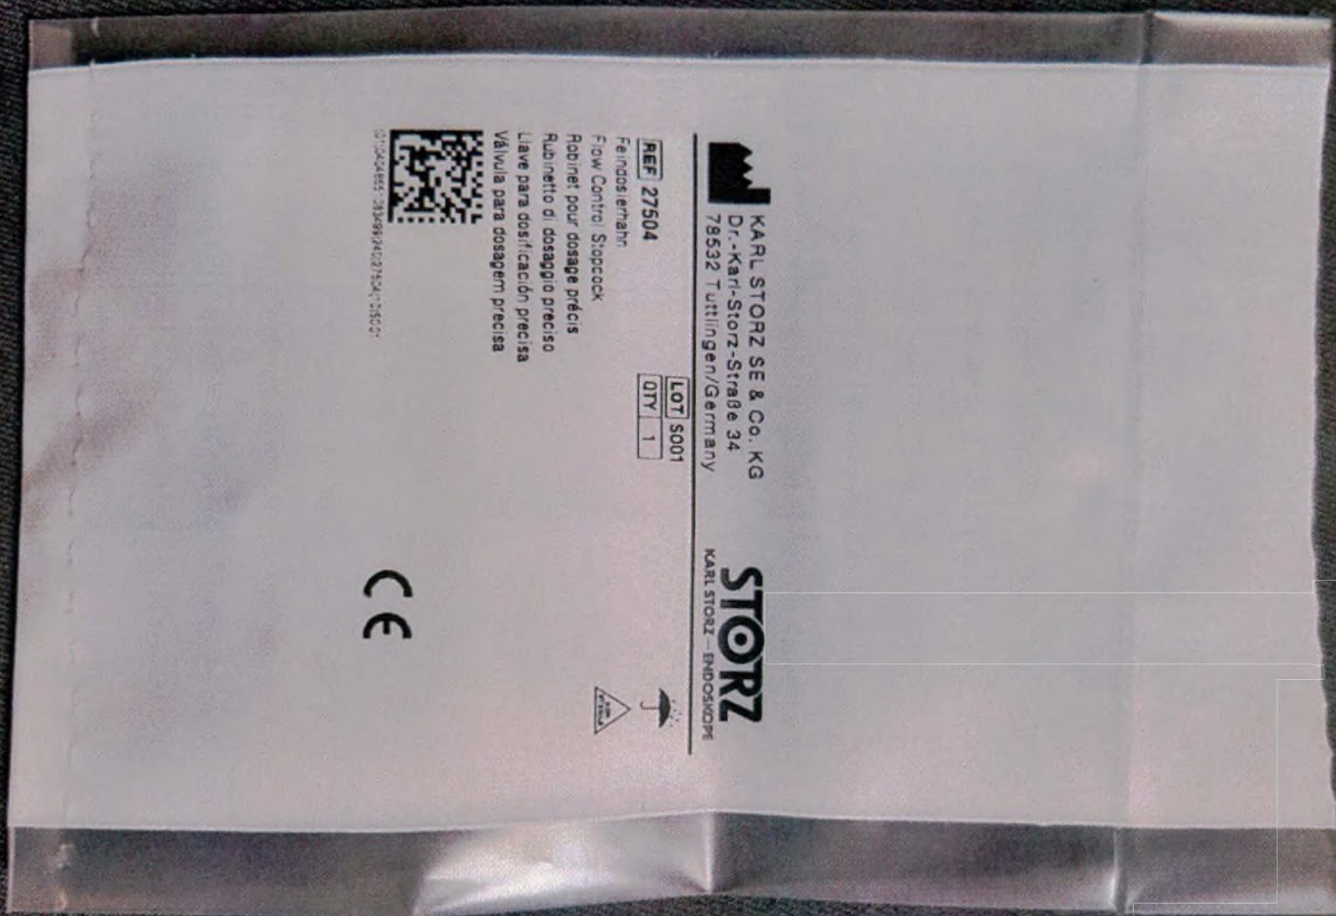


Рис. 76. Запорный элемент крана для точного дозирования. Первичная упаковка



Рис. 77. Запорный элемент крана для точного дозирования.

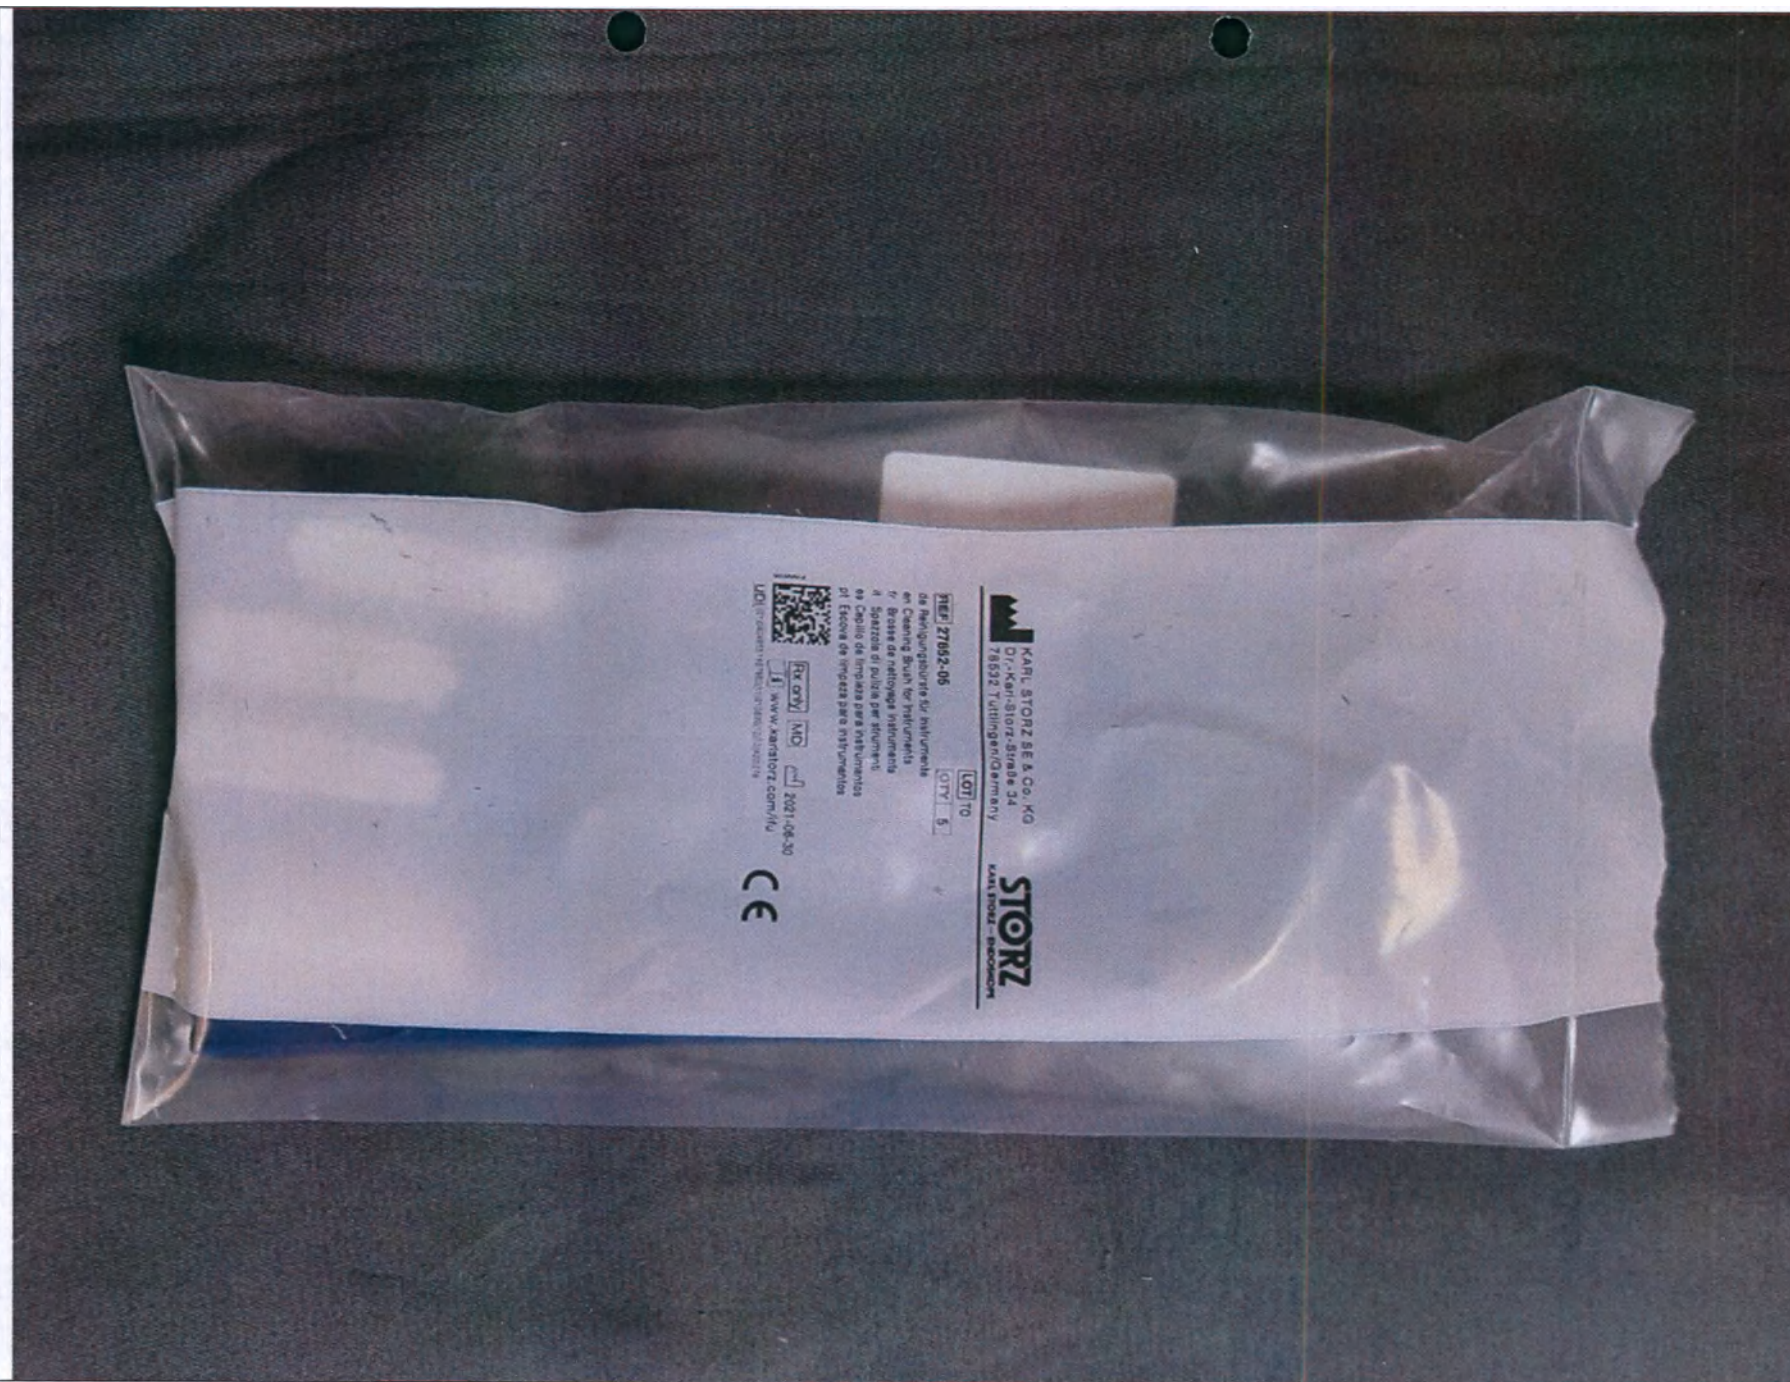


Рис. 78. Щетка плоская для очистки - 5 шт./уп. Первичная упаковка.



Рис. 79. Щетка плоская для очистки - 5 шт./уп

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

mtp

Vertrieb durch/distributed by:
KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

EC REP

Shanghai International Trading Corp. GmbH
Elfenstraße 80
200377 Hamburg/Germany



Asst. (Shanghai) Medical Instruments Co., Ltd.
No. 24 Suixiang Road, 200000 Shanghai
China 200000 Shanghai, P.R. China

110932-50



REF AF-D1320MT

QTY 50 x 1: 110932-01

Reinigungsbürste, 200 cm
Cleaning Brush, 200 cm
Brosse de nettoyage, 200cm
Spazzola per pulizia, 200 cm
Escova de limpeza, 200 cm
Cepillo de limpieza, 200 cm
Für/for/pour/para:
Flexible endoscopes with working channels
ranging from diameter 1.2 - 1.5 mm



RxOnly



Do not sterilize



2021-04-02 LOT 210402



(340)AF-D1320MT1171310402N101210402

Рис. 80. Щетка для очистки, одноразовая, длина 200 см – 50 шт./уп. Упаковка.

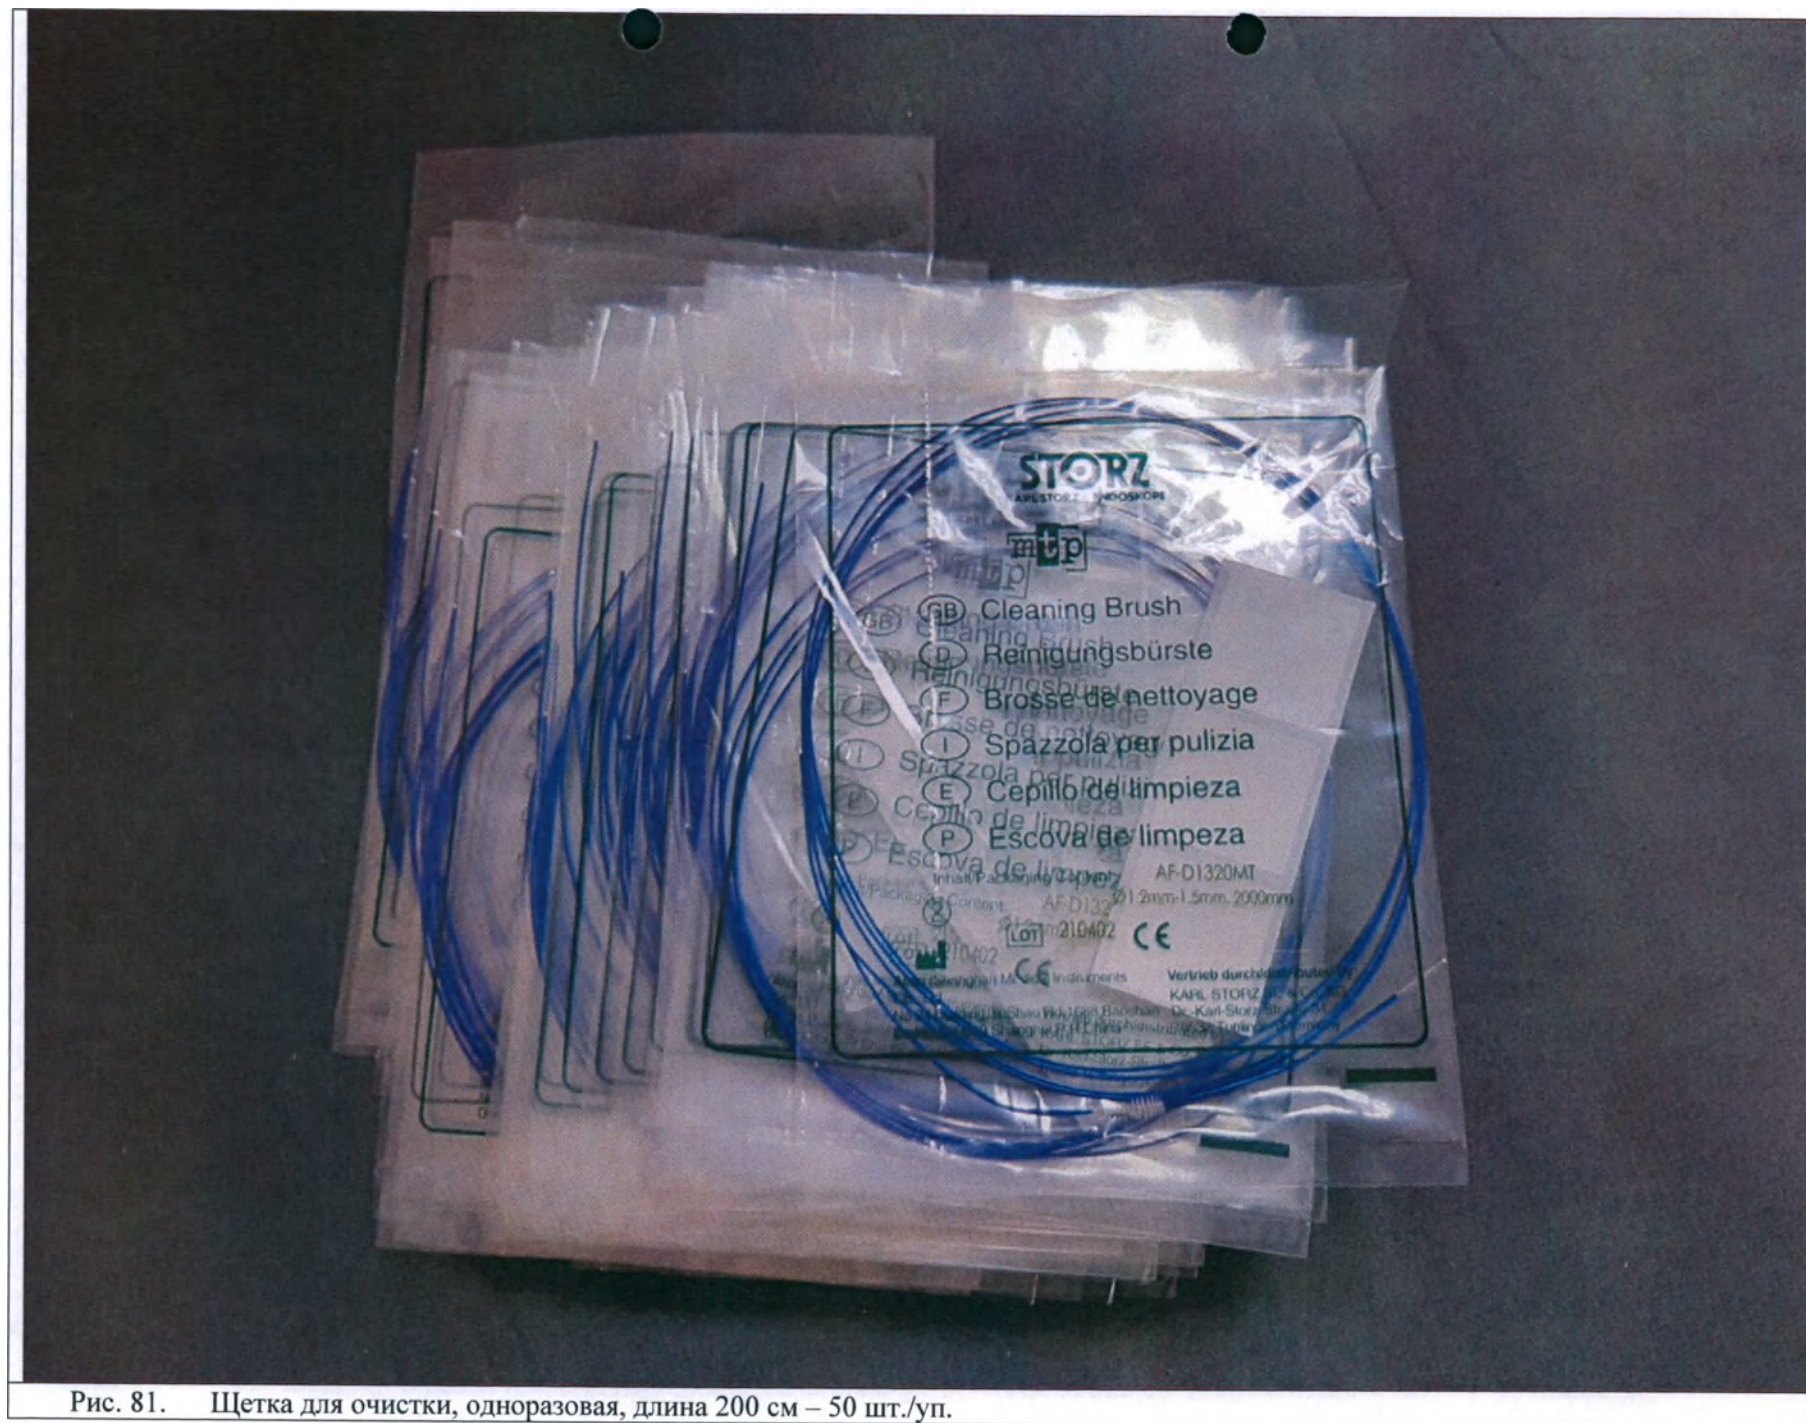


Рис. 81. Щетка для очистки, одноразовая, длина 200 см – 50 шт./уп.



Рис. 82. Щетка для очистки, одноразовая, длина 200 см – 50 шт./уп.

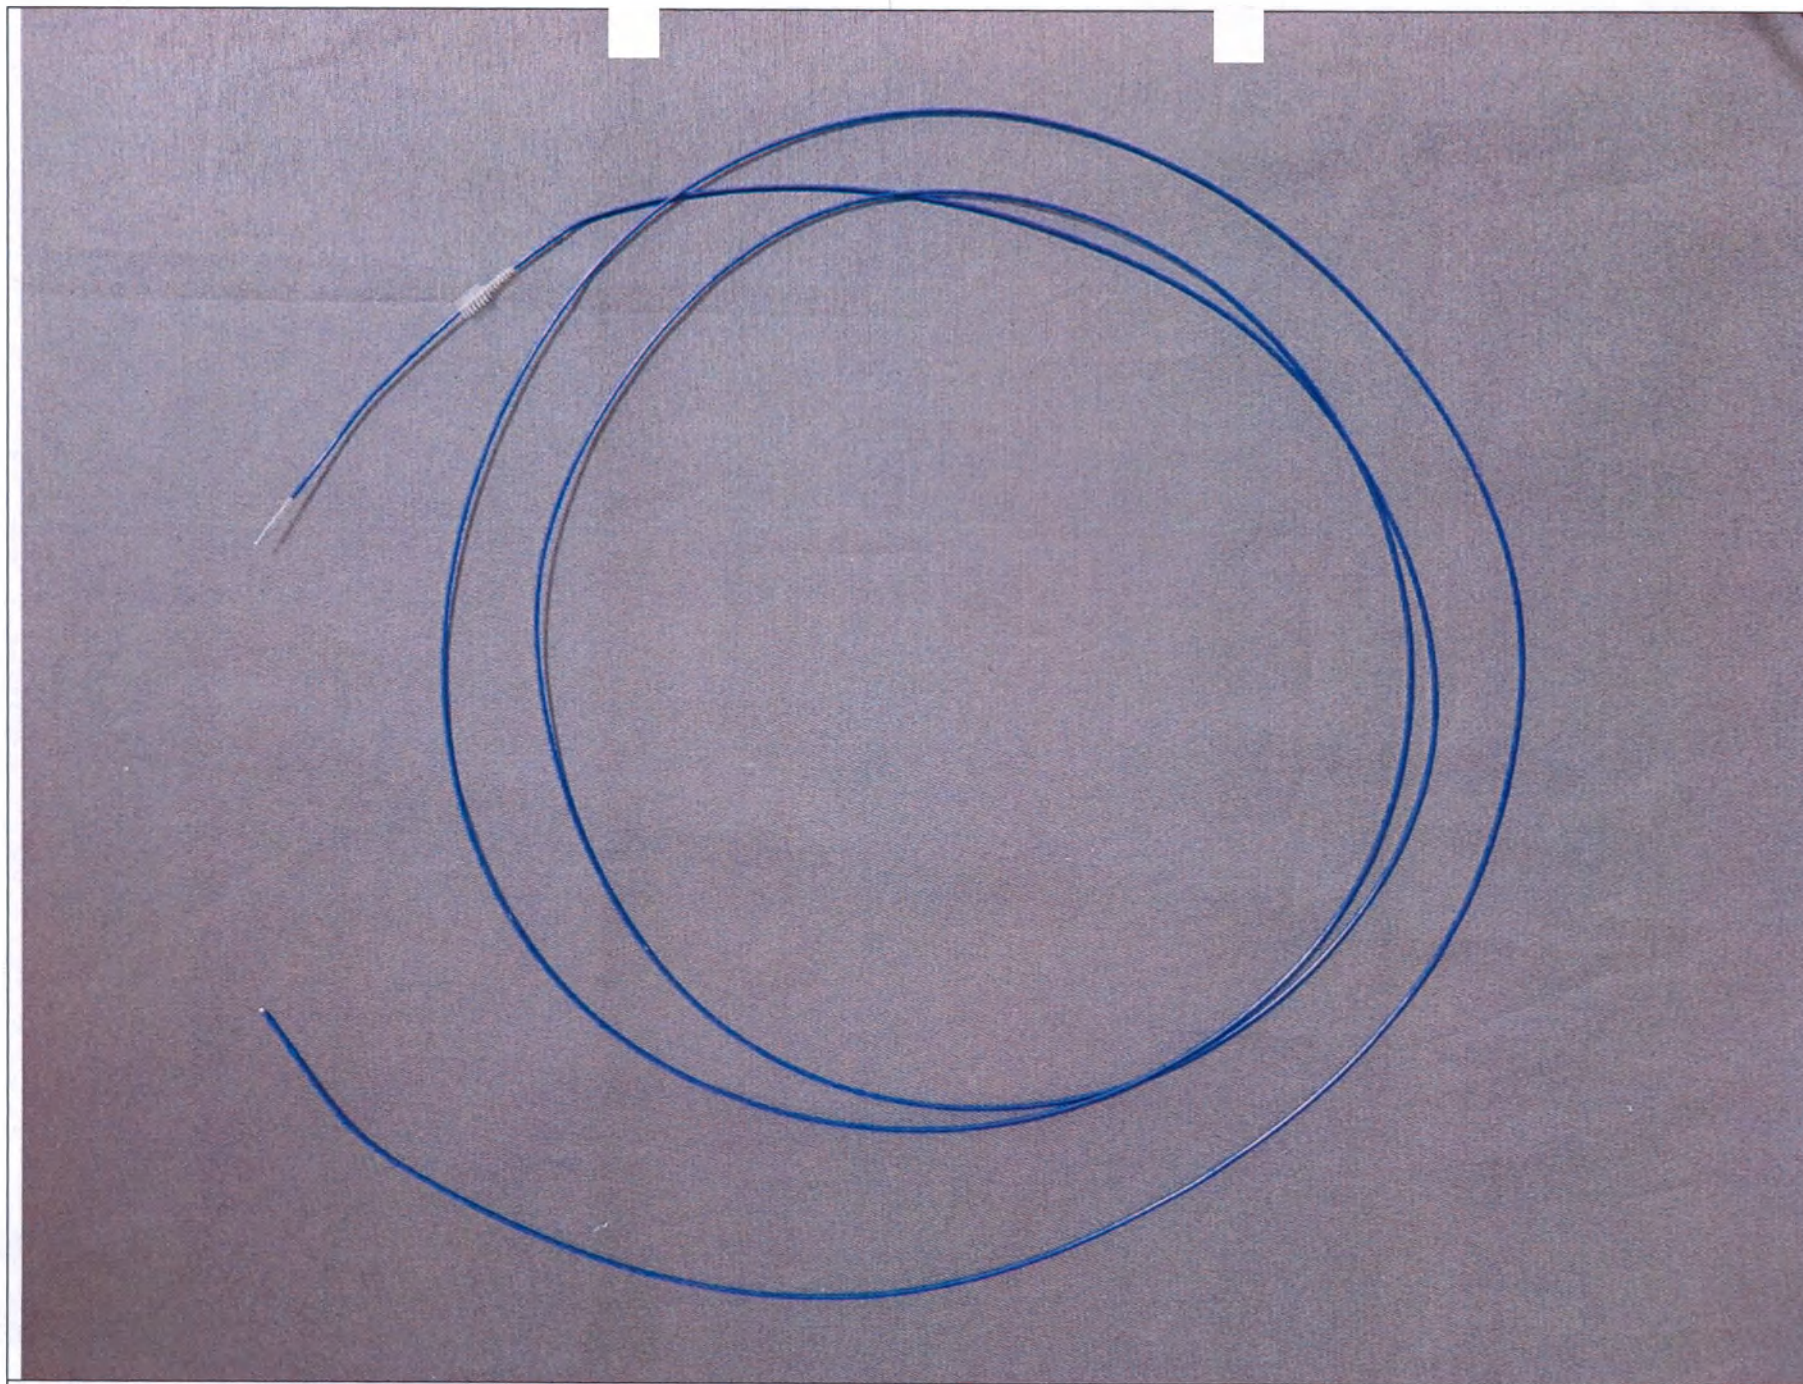


Рис. 83. Щетка для очистки, одноразовая, длина 200 см – 50 шт./уп.

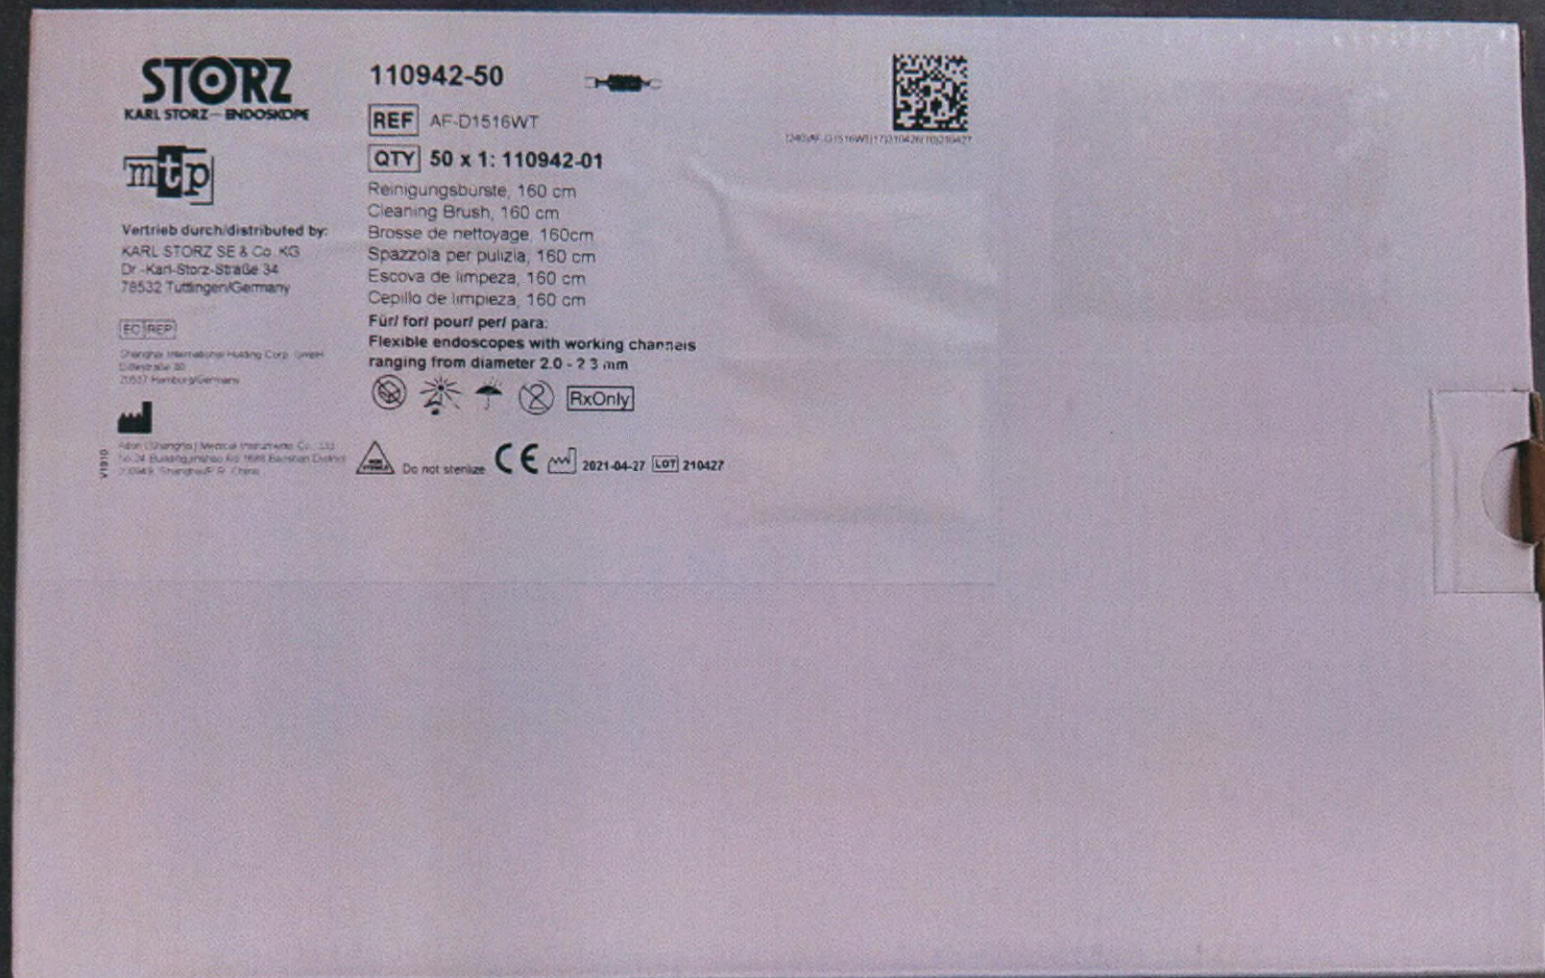


Рис. 84. Щетка для очистки, одноразовая, длина 160 см – 50 шт./уп. Упаковка.



Рис. 85. Щетка для очистки, одноразовая, длина 160 см – 50 шт./уп.



Рис. 86. Щетка для очистки, одноразовая, длина 160 см – 50 шт./уп.

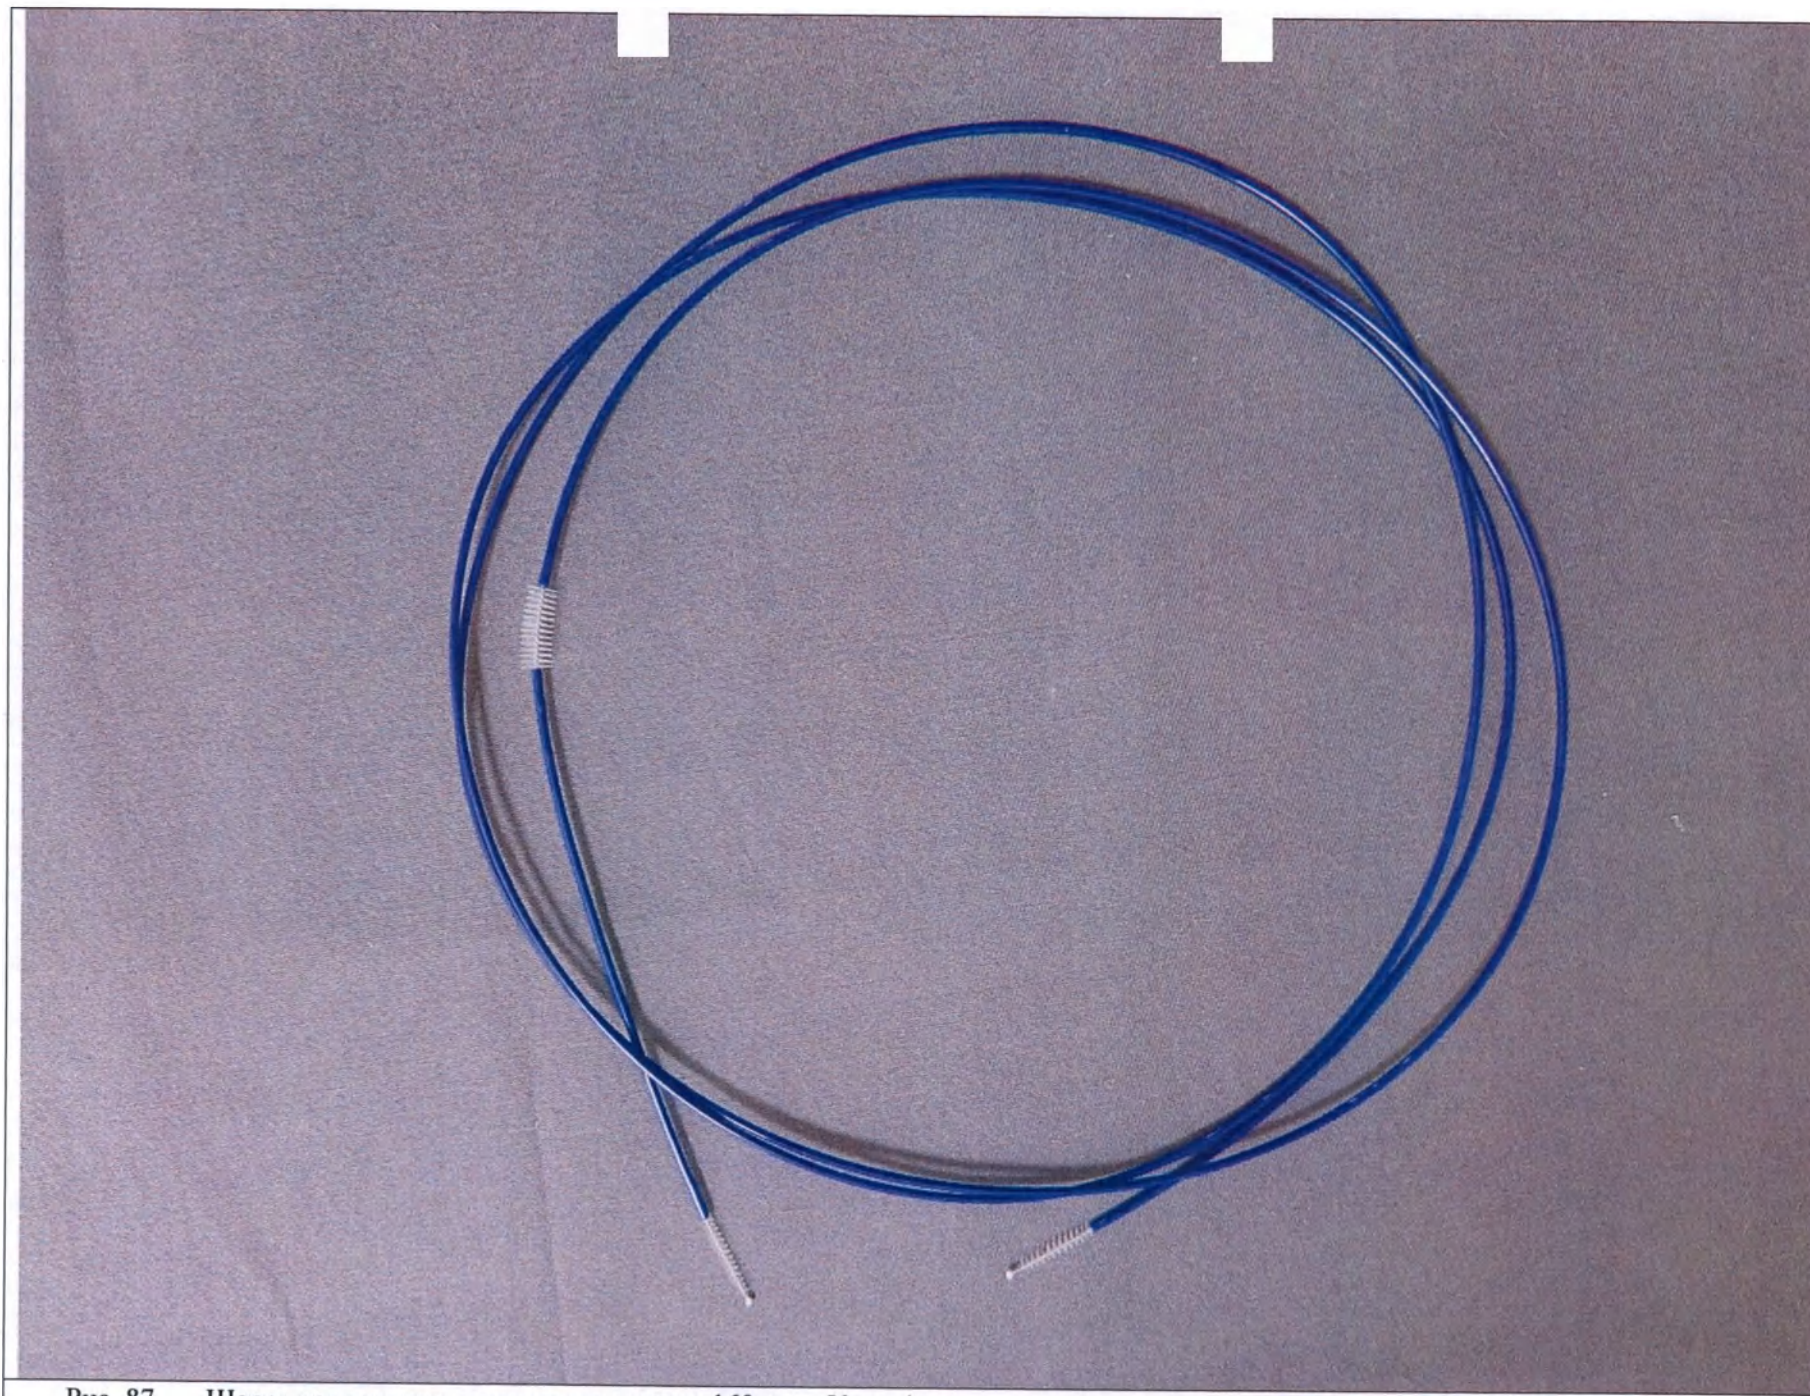


Рис. 87. Щетка для очистки, одноразовая, длина 160 см – 50 шт./уп.

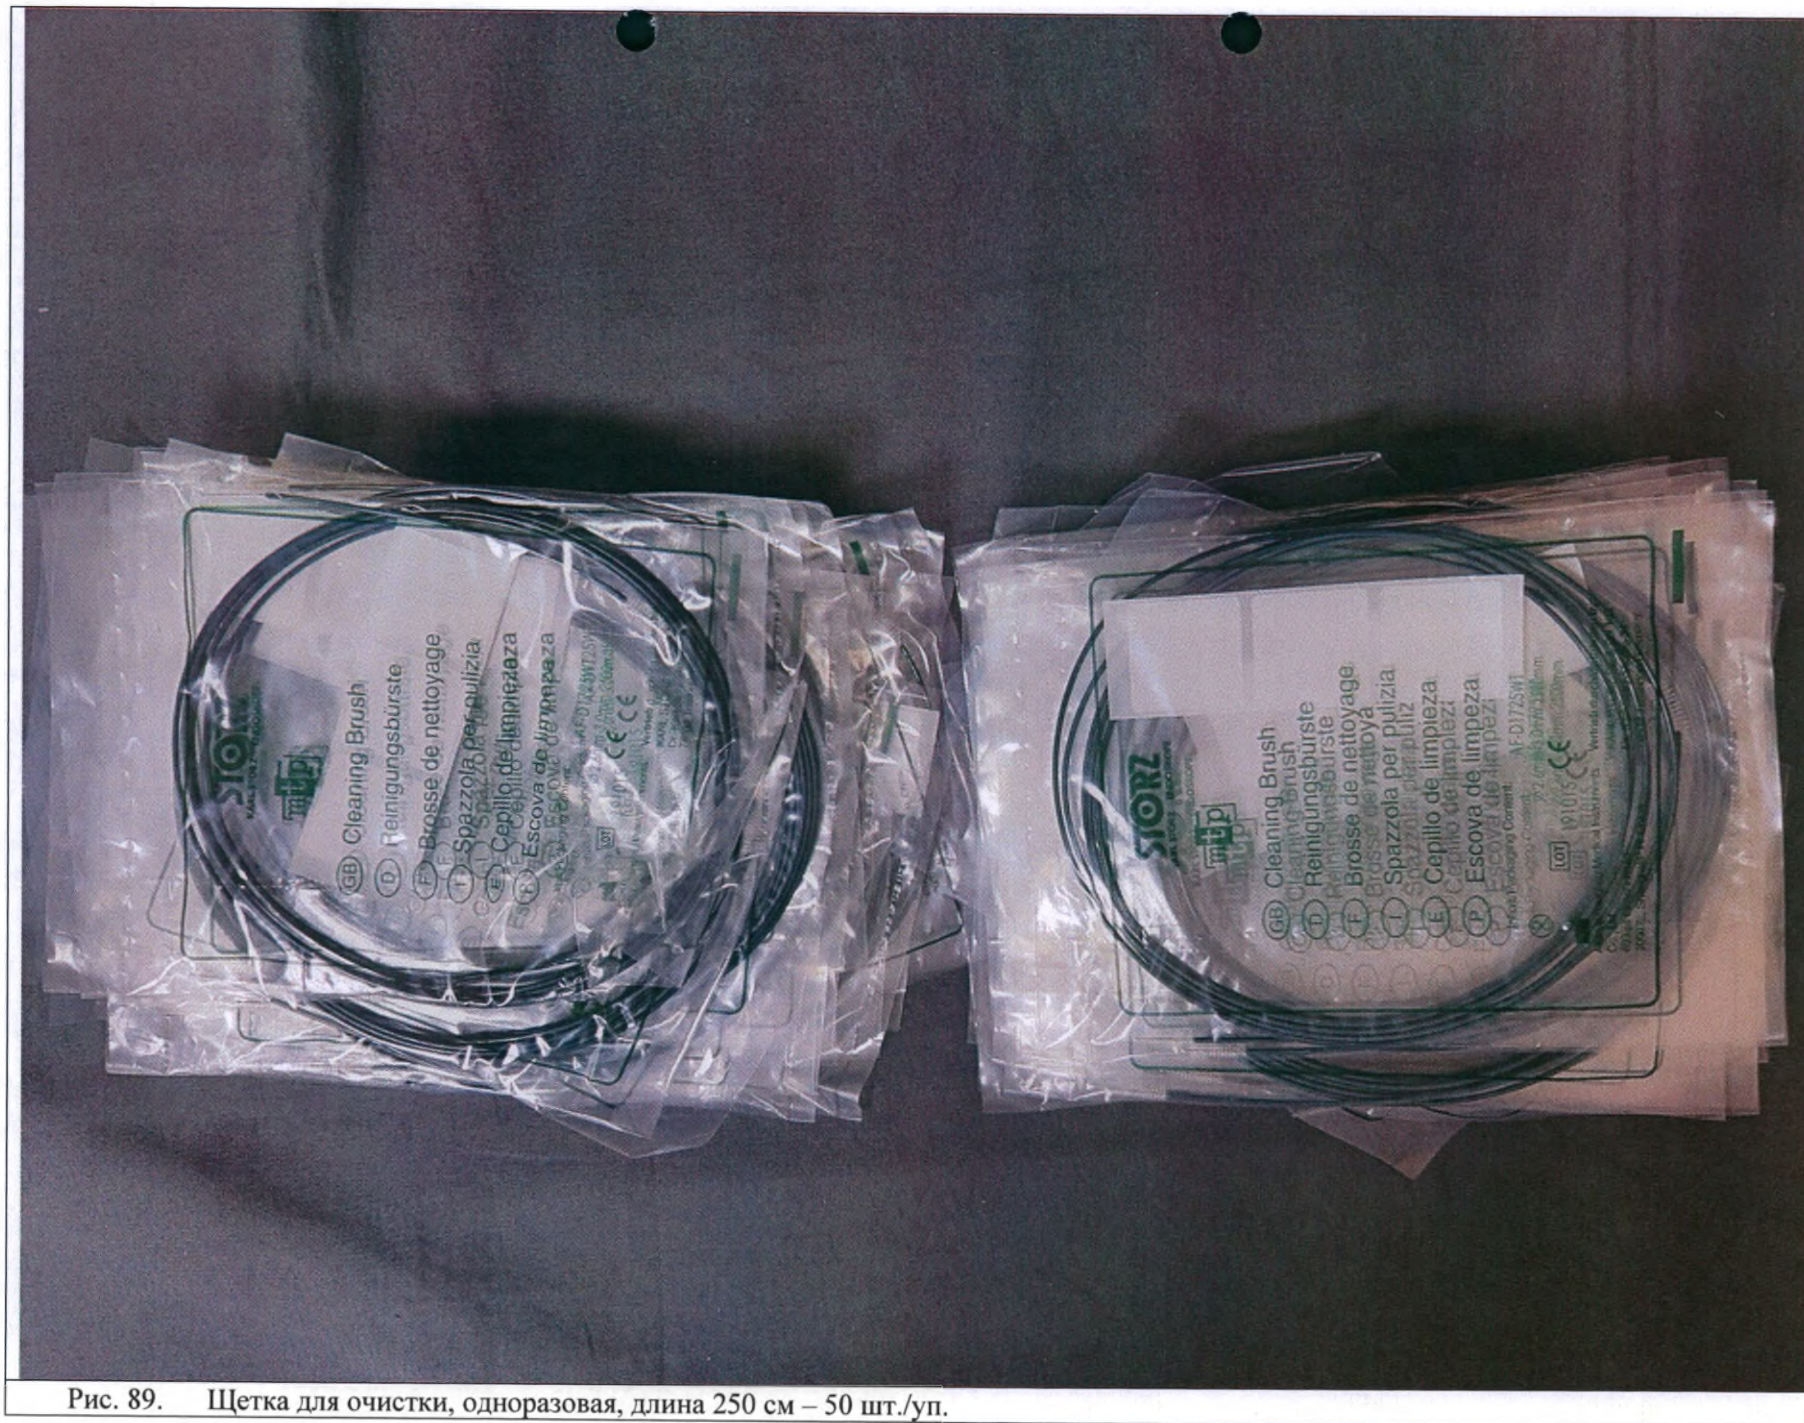


Рис. 89. Щетка для очистки, одноразовая, длина 250 см – 50 шт./уп.

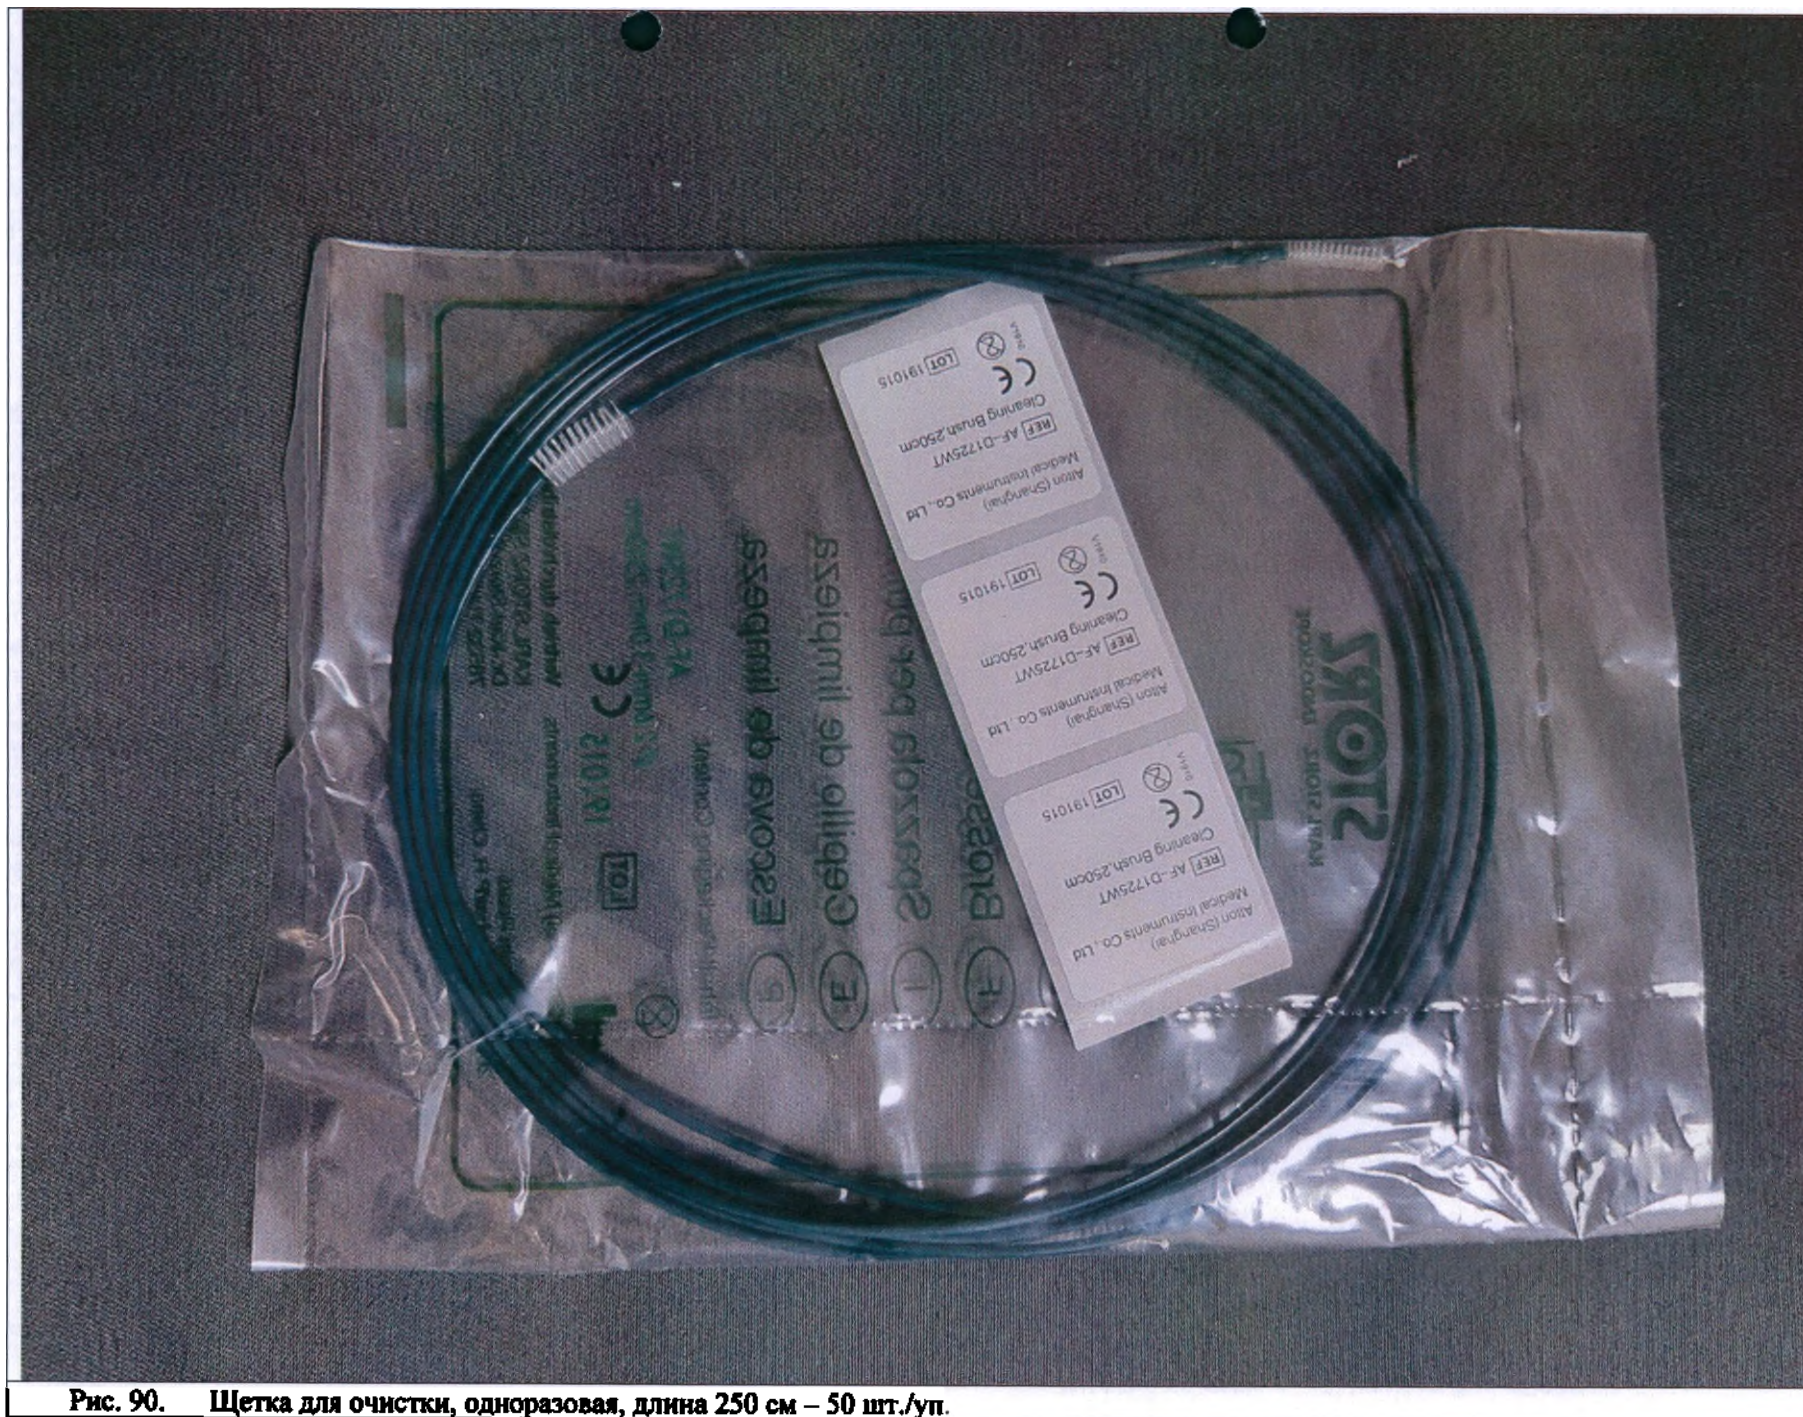


Рис. 90. Щетка для очистки, одноразовая, длина 250 см – 50 шт./уп.

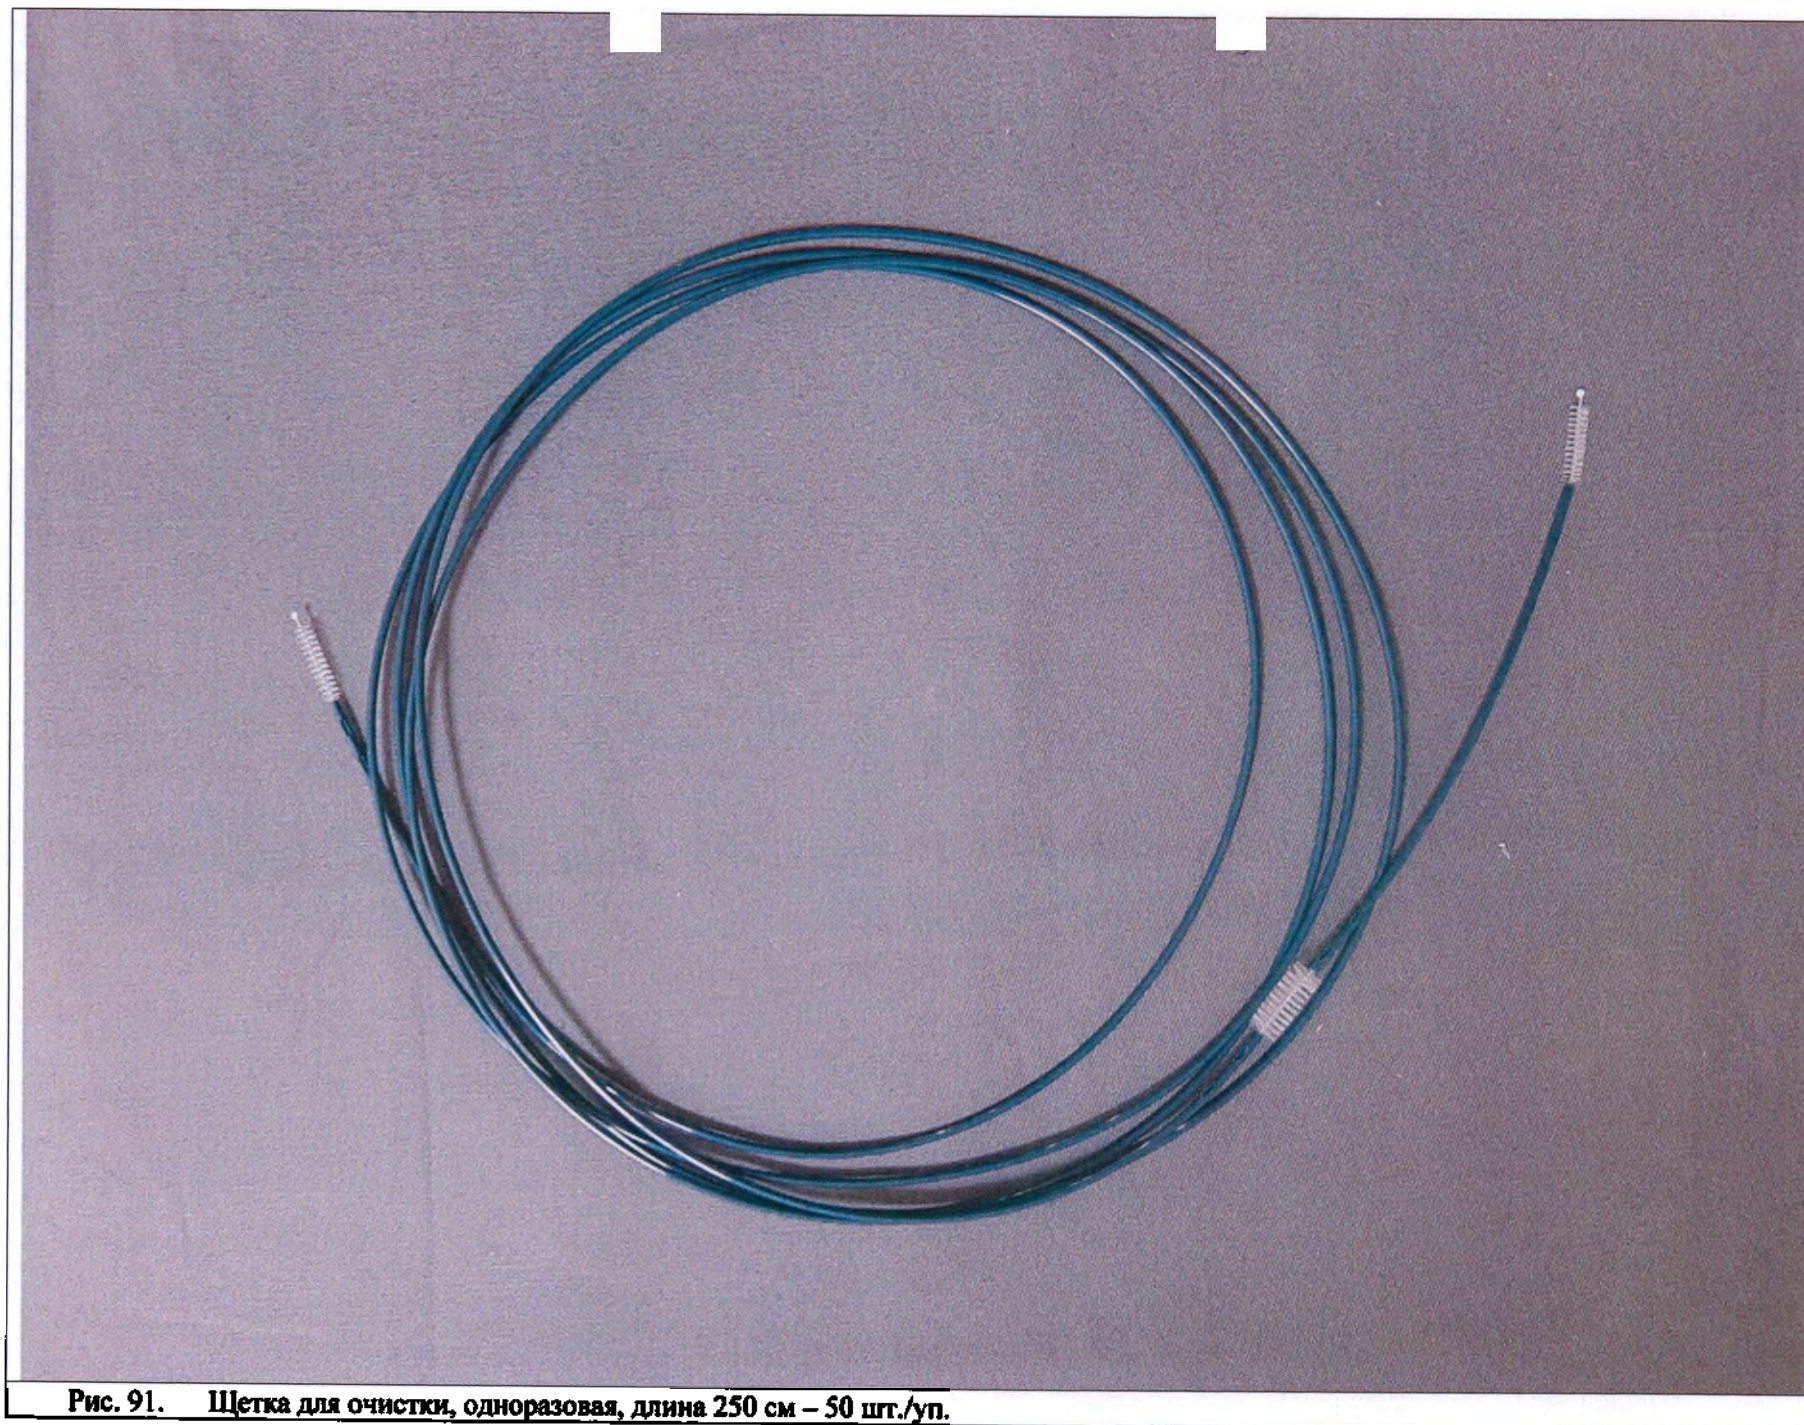


Рис. 91. Щетка для очистки, одноразовая, длина 250 см – 50 шт./уп.

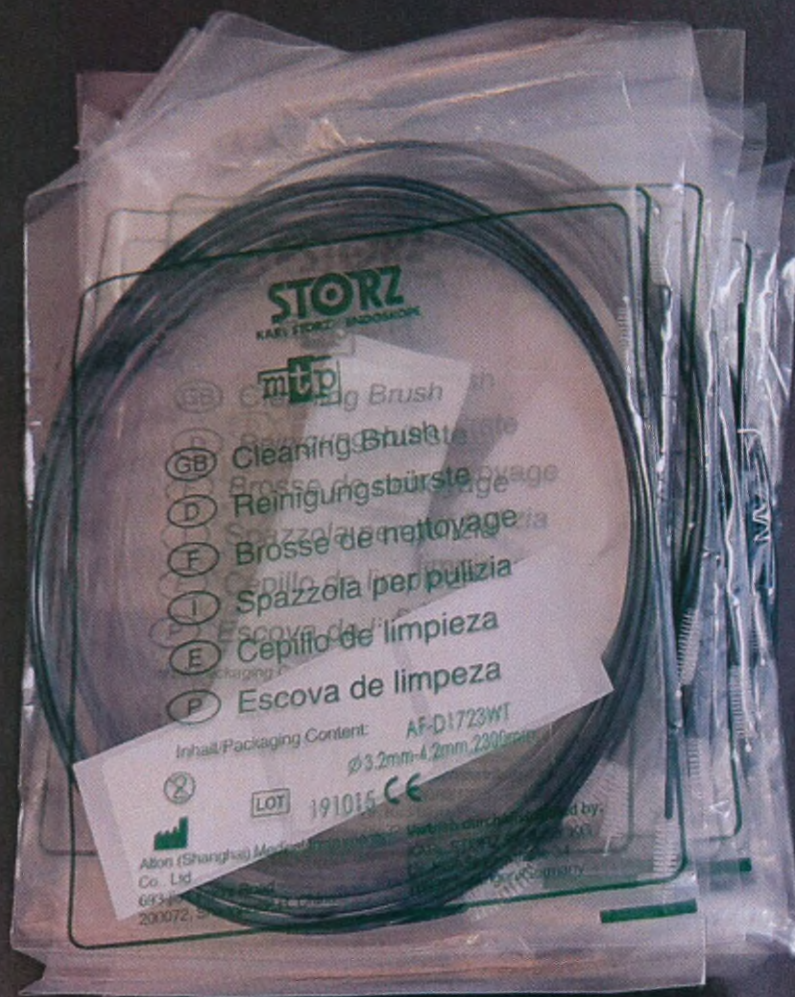


Рис. 93. Щетка для очистки, одноразовая, длина 230 см – 50 шт./уп.



Рис. 94. Щетка для очистки, одноразовая, длина 230 см – 50 шт./уп.

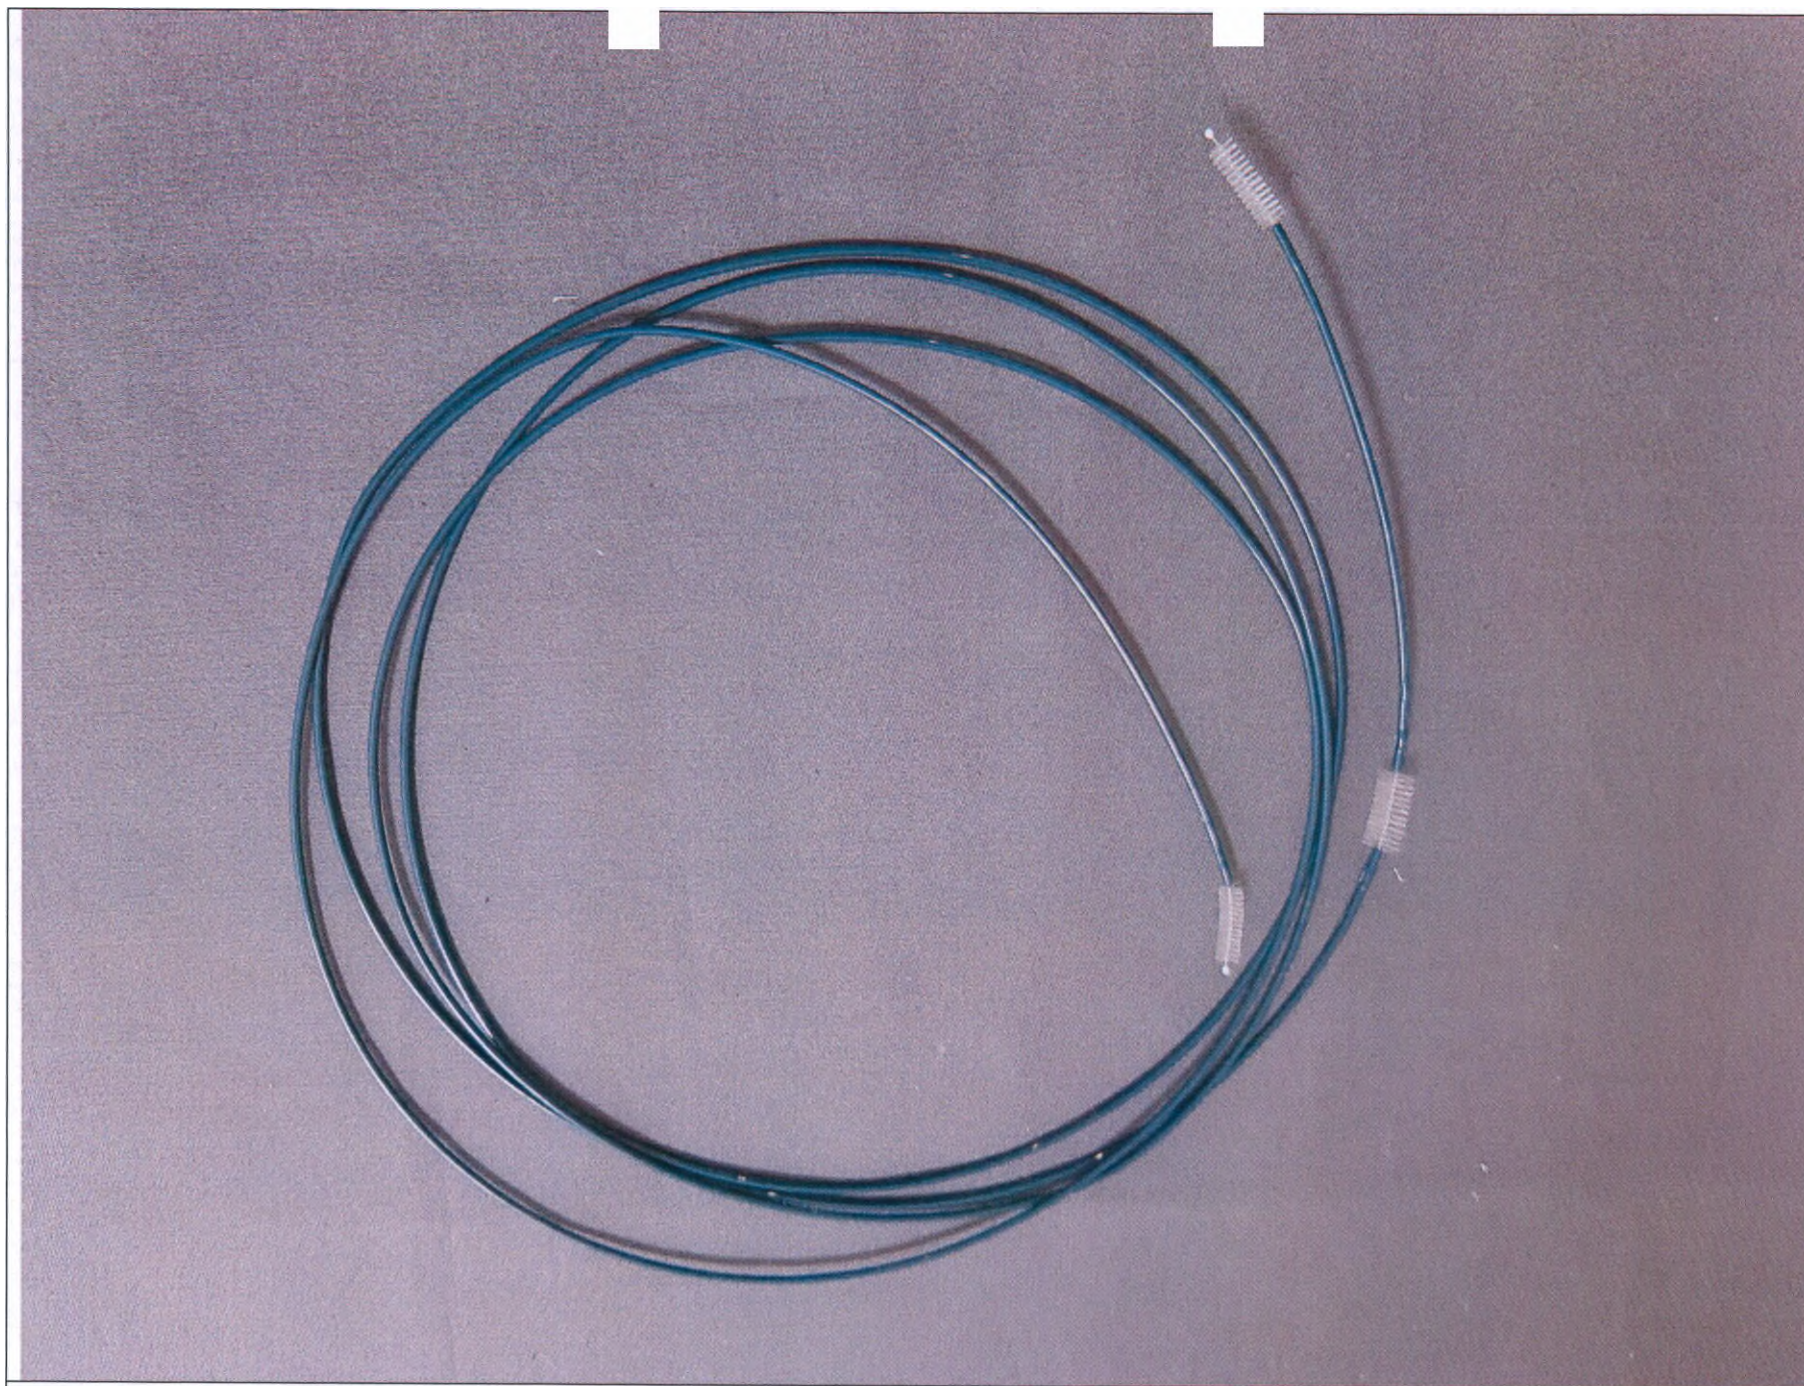


Рис. 95. Щетка для очистки, одноразовая, длина 230 см – 50 шт./уп.

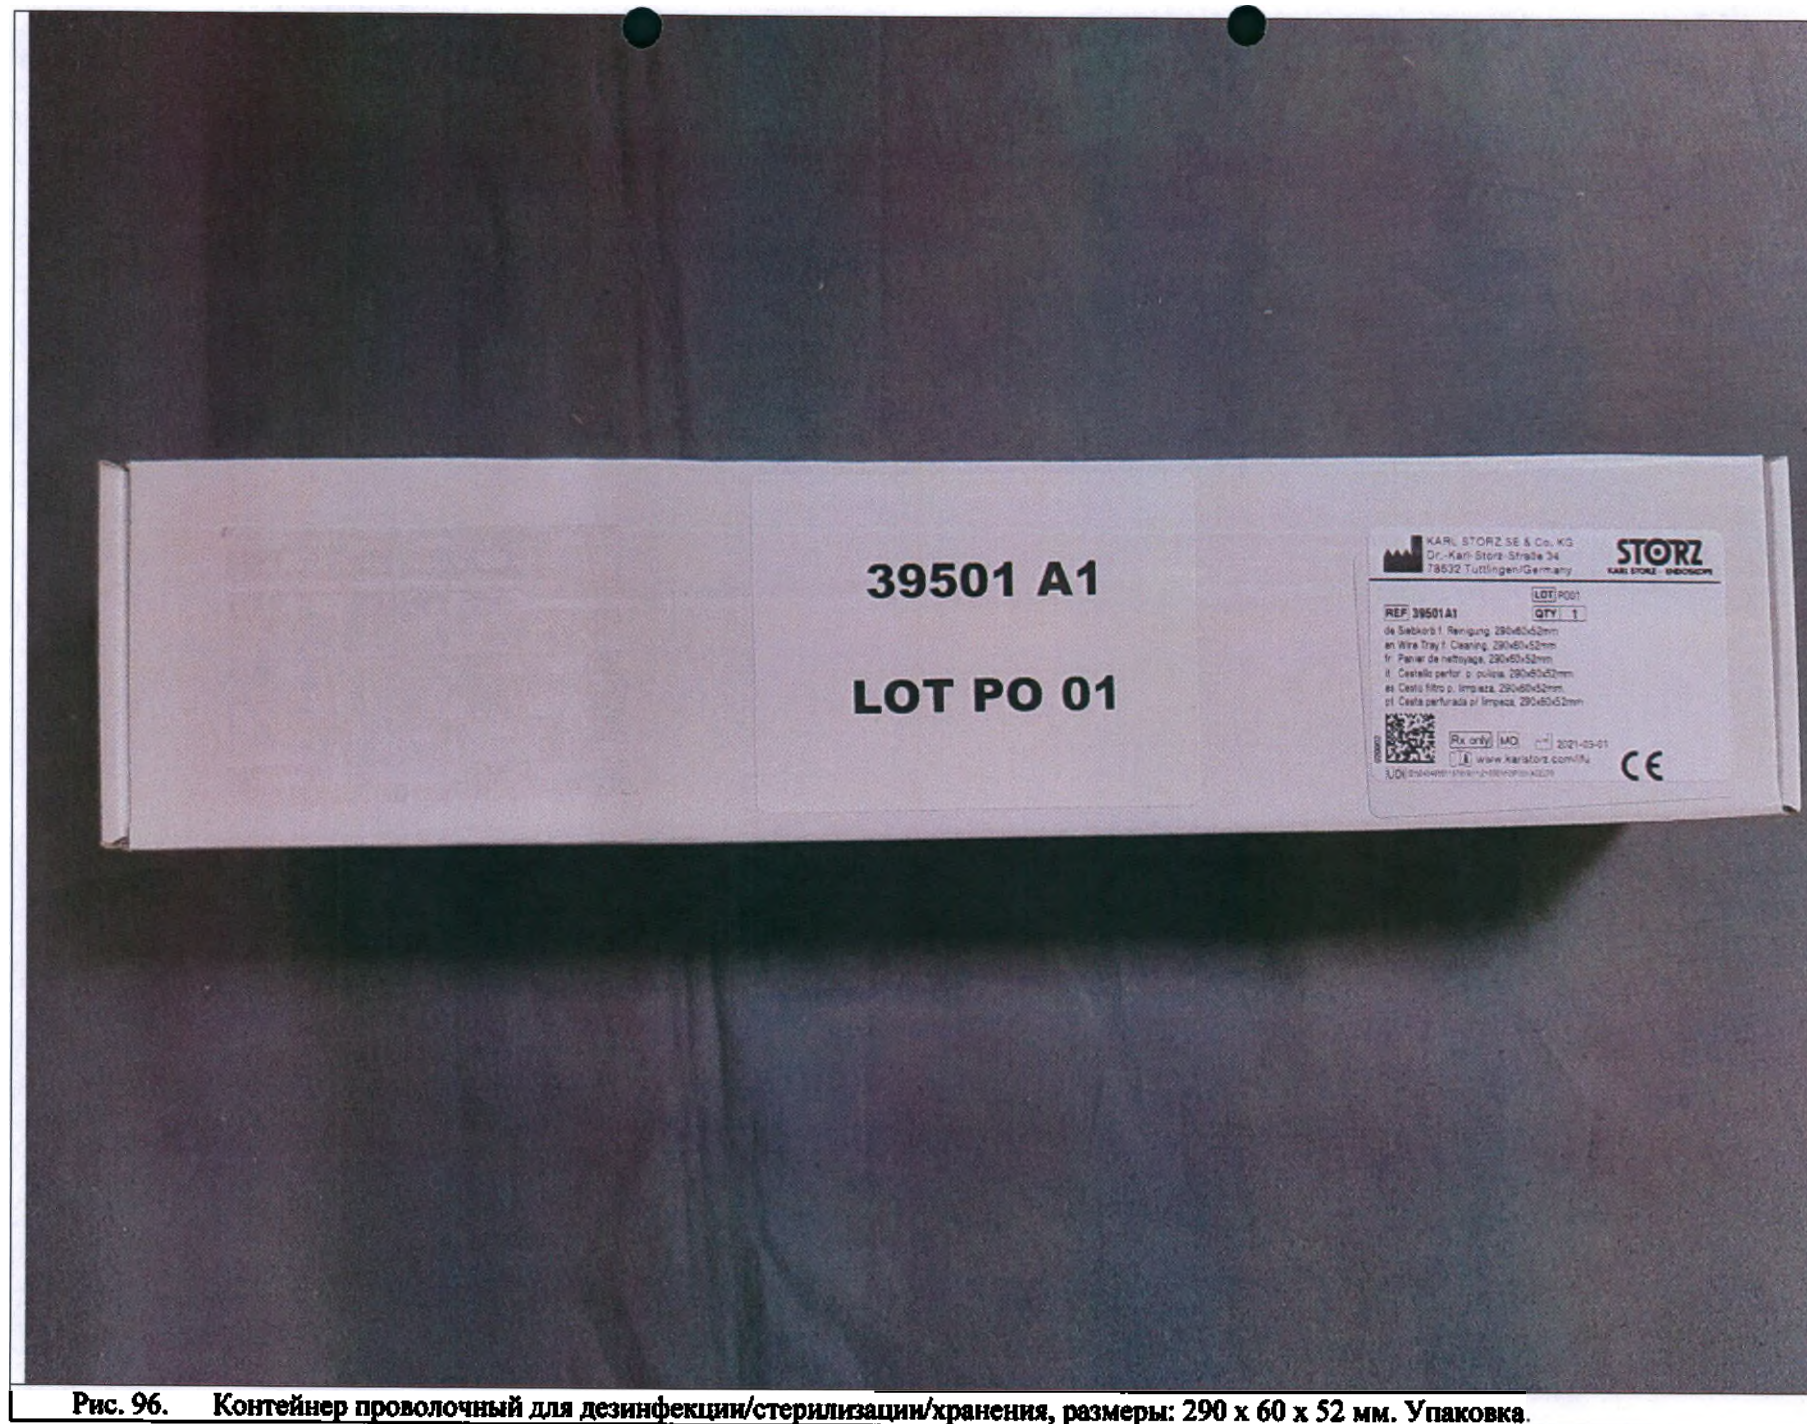


Рис. 96. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 290 x 60 x 52 мм. Упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

LOT P001

REF 39501A1

QTY 1

de Siebkorb f. Reinigung, 290x60x52mm
en Wire Tray f. Cleaning, 290x60x52mm
fr Panier de nettoyage, 290x60x52mm
it Cestello perfor. p. pulizia, 290x60x52mm
es Cesto filtro p. limpieza, 290x60x52mm
pt Cesta perfurada p/ limpeza, 290x60x52mm



020002

Rx only

MD



2021-03-01



www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)04048551157619(11)210301(10)P001(422)276



Рис. 97. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 290 x 60 x 52 мм. Маркировка на упаковке.

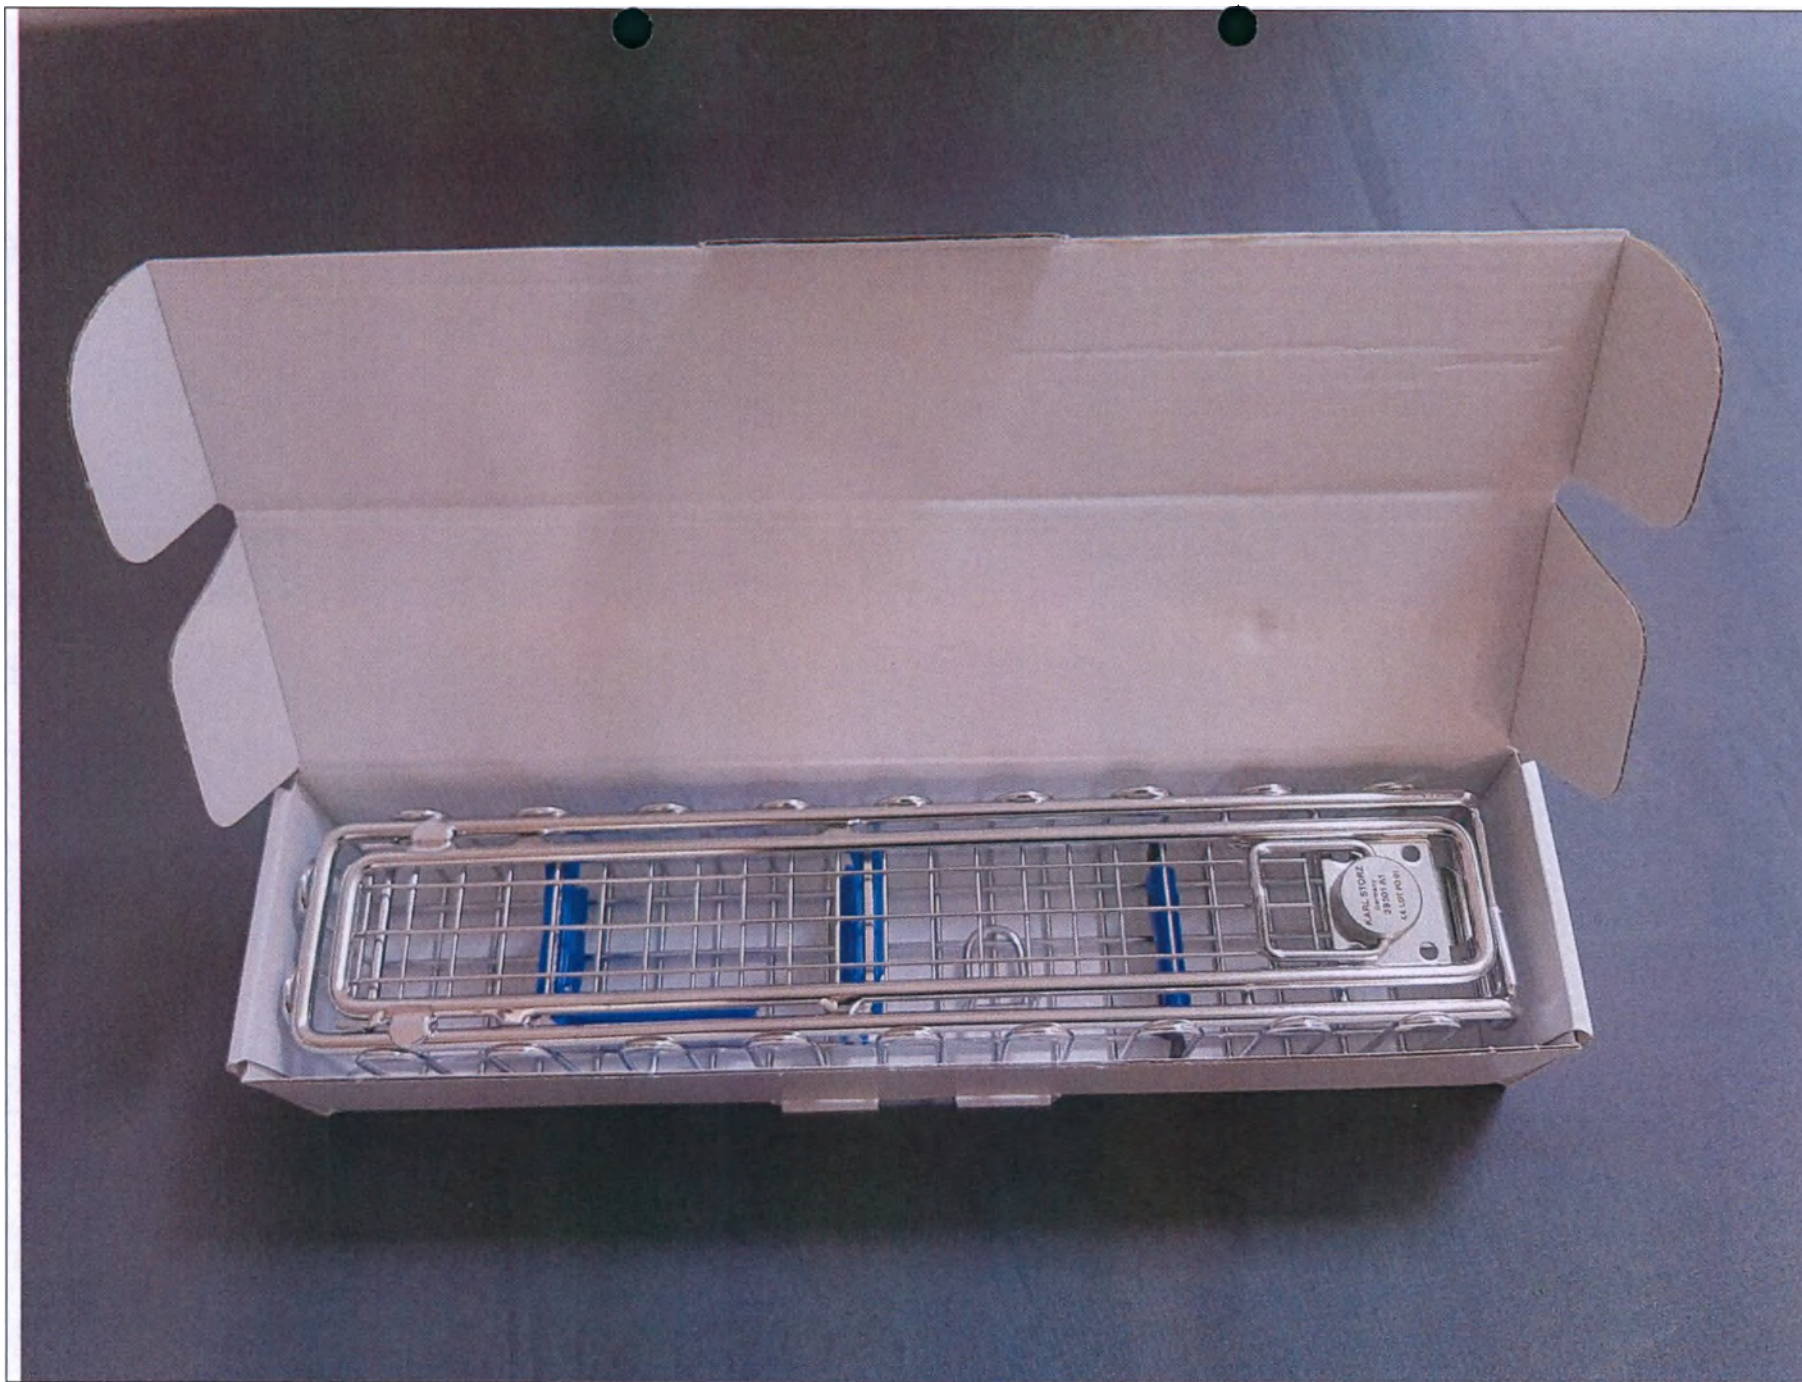


Рис. 98. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 290 x 60 x 52 мм.



Рис. 99. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 290 x 60 x 52 мм.

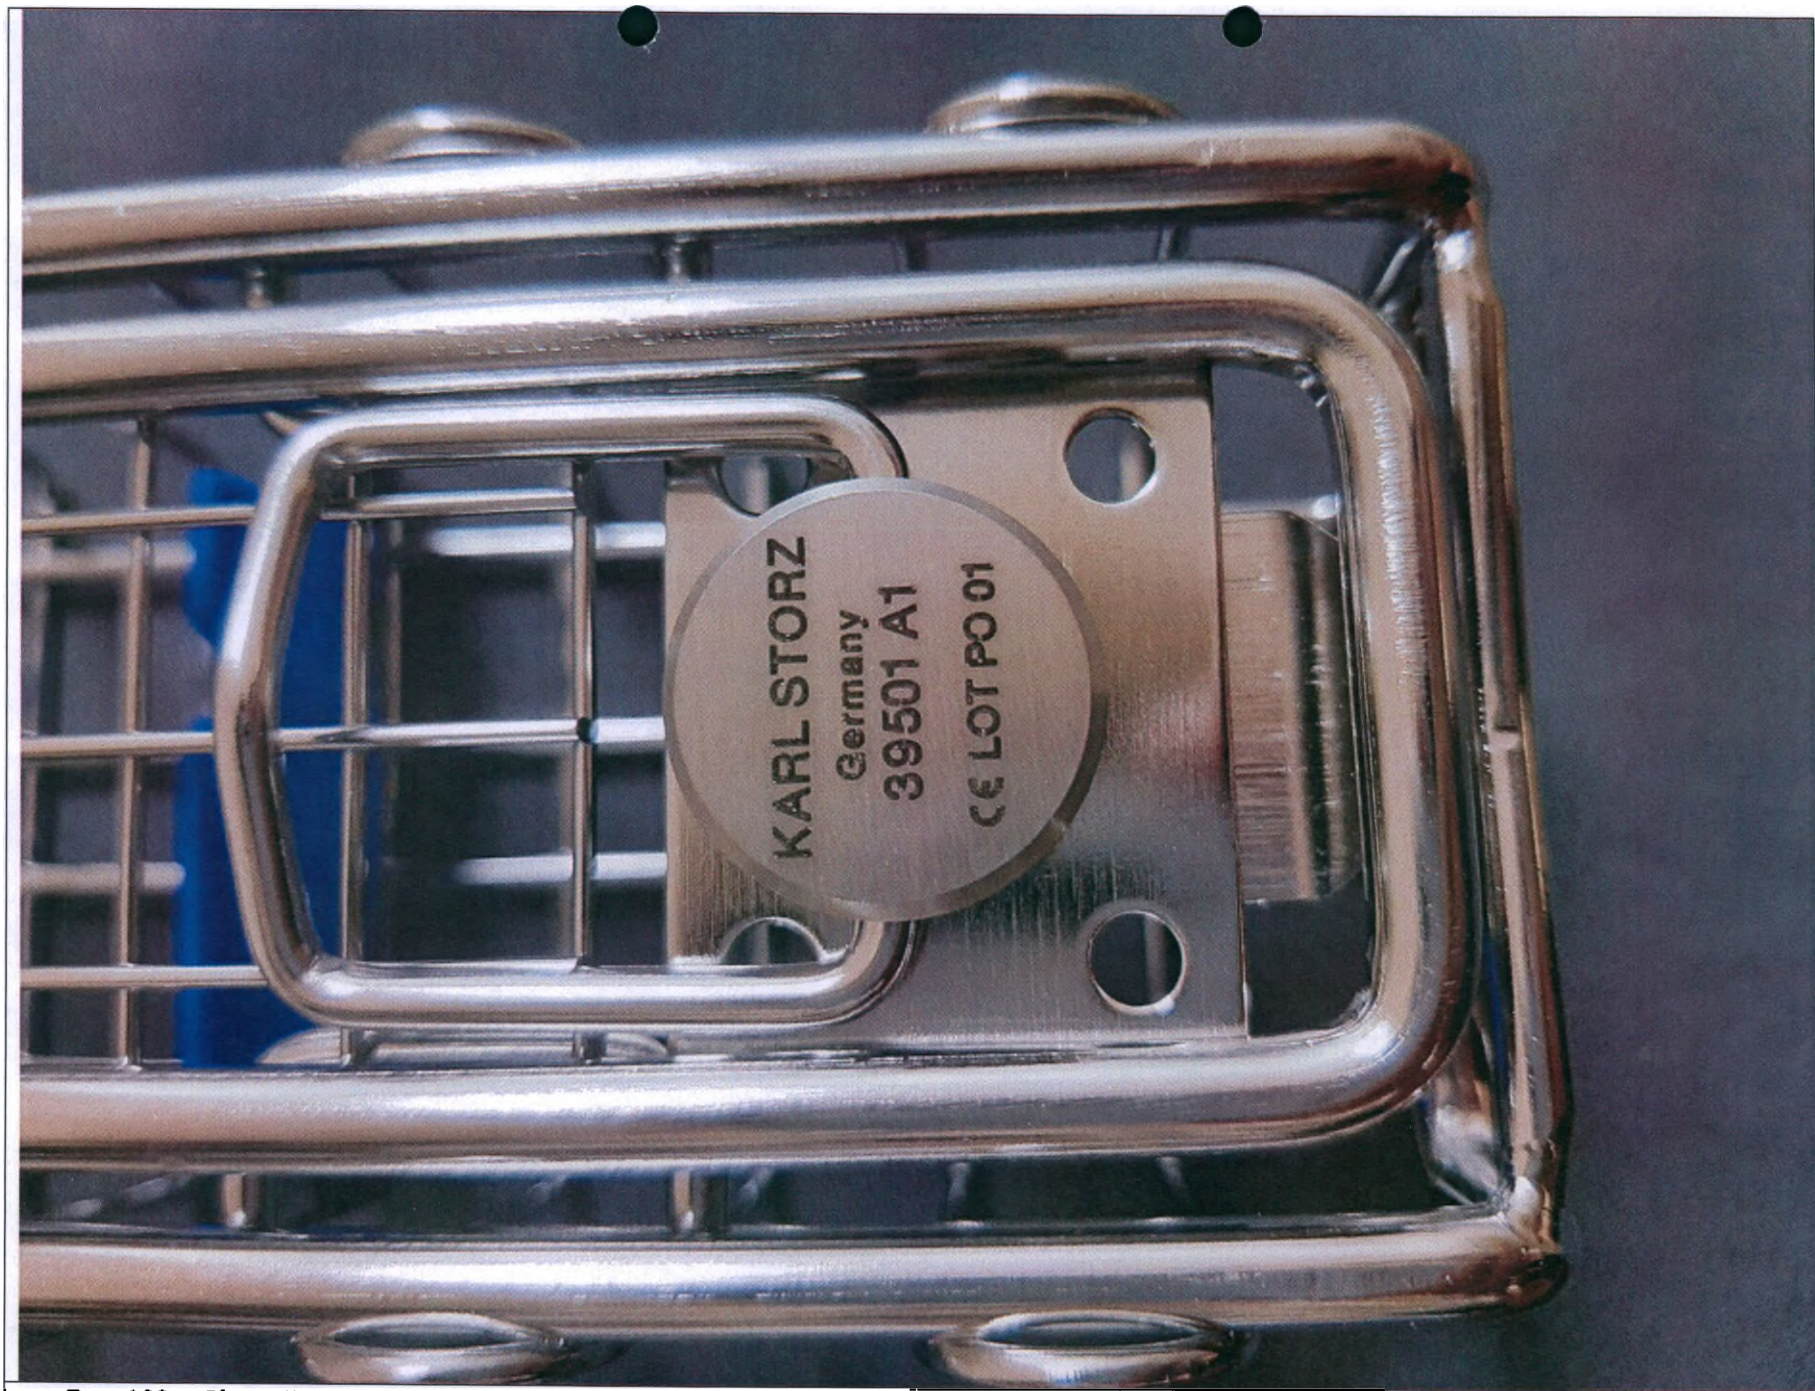


Рис. 100. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 290 x 60 x 52 мм.



Рис. 101. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 290 x 60 x 52 мм.

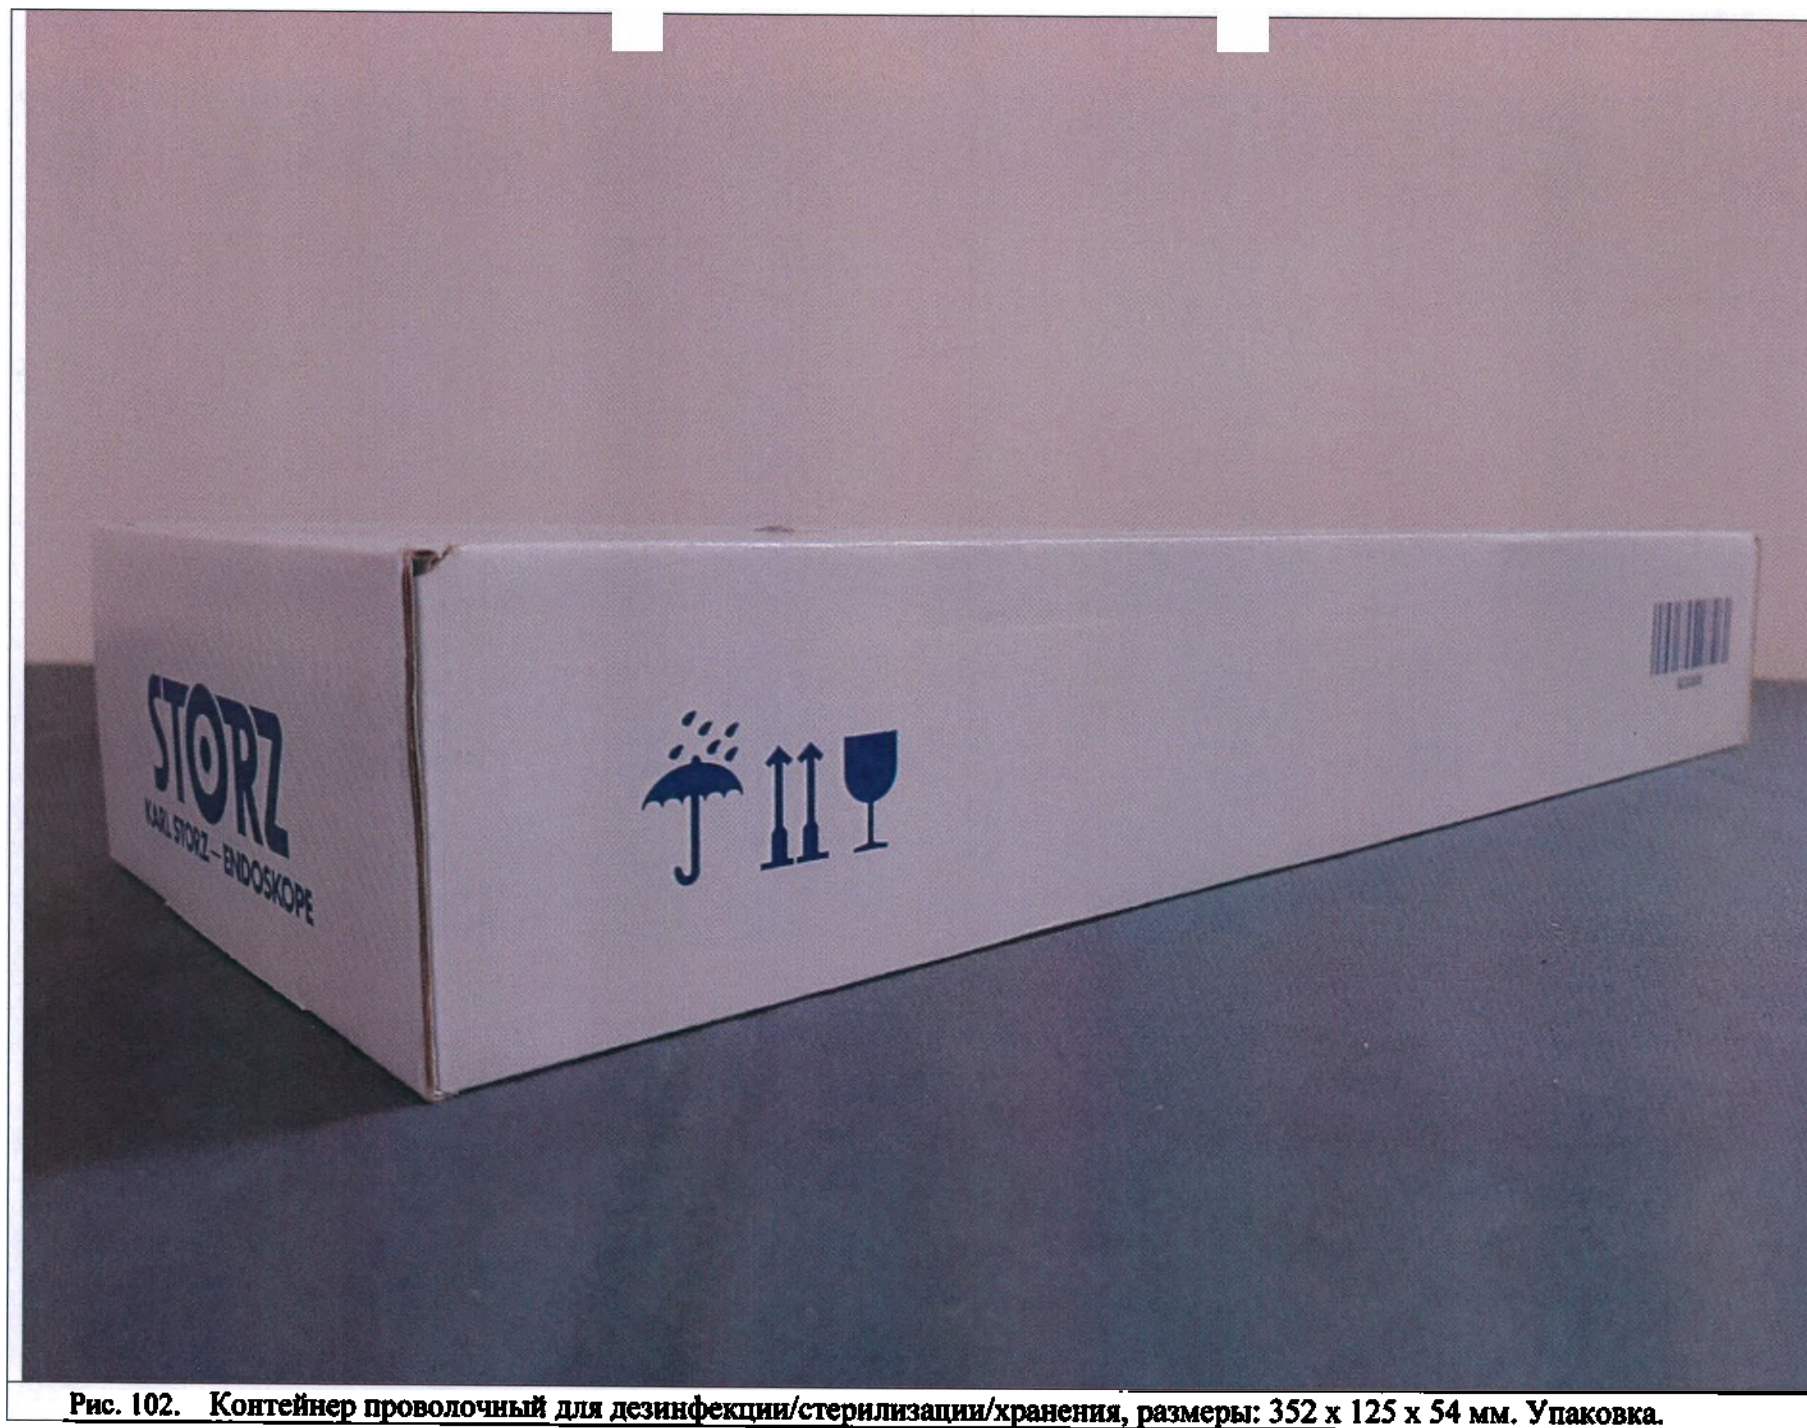


Рис. 102. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 352 x 125 x 54 мм. Упаковка.



Рис. 103. Контейнер проволоочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 352 x 125 x 54 мм. Маркировка на упаковке.

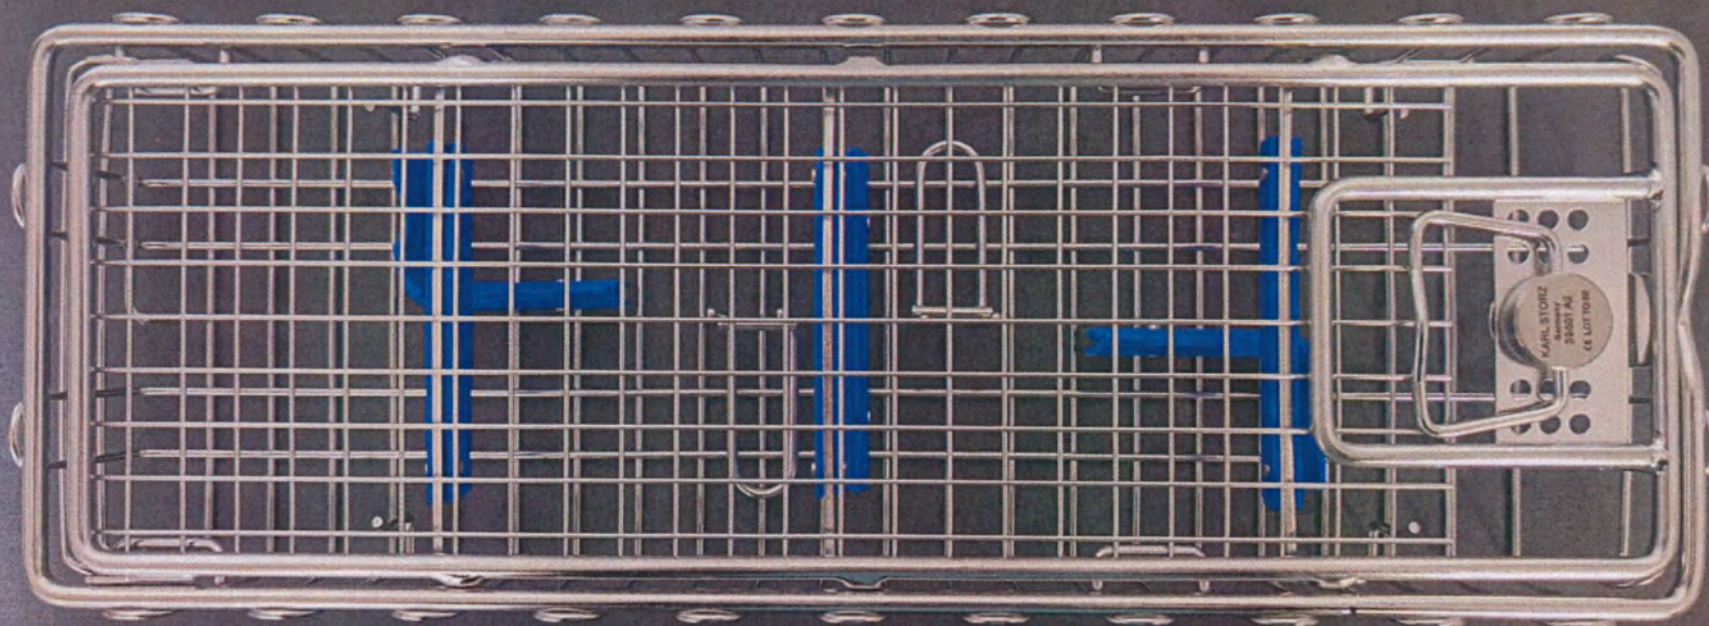


Рис. 104. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 352 x 125 x 54 мм.



Рис. 105. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 352 x 125 x 54 мм.

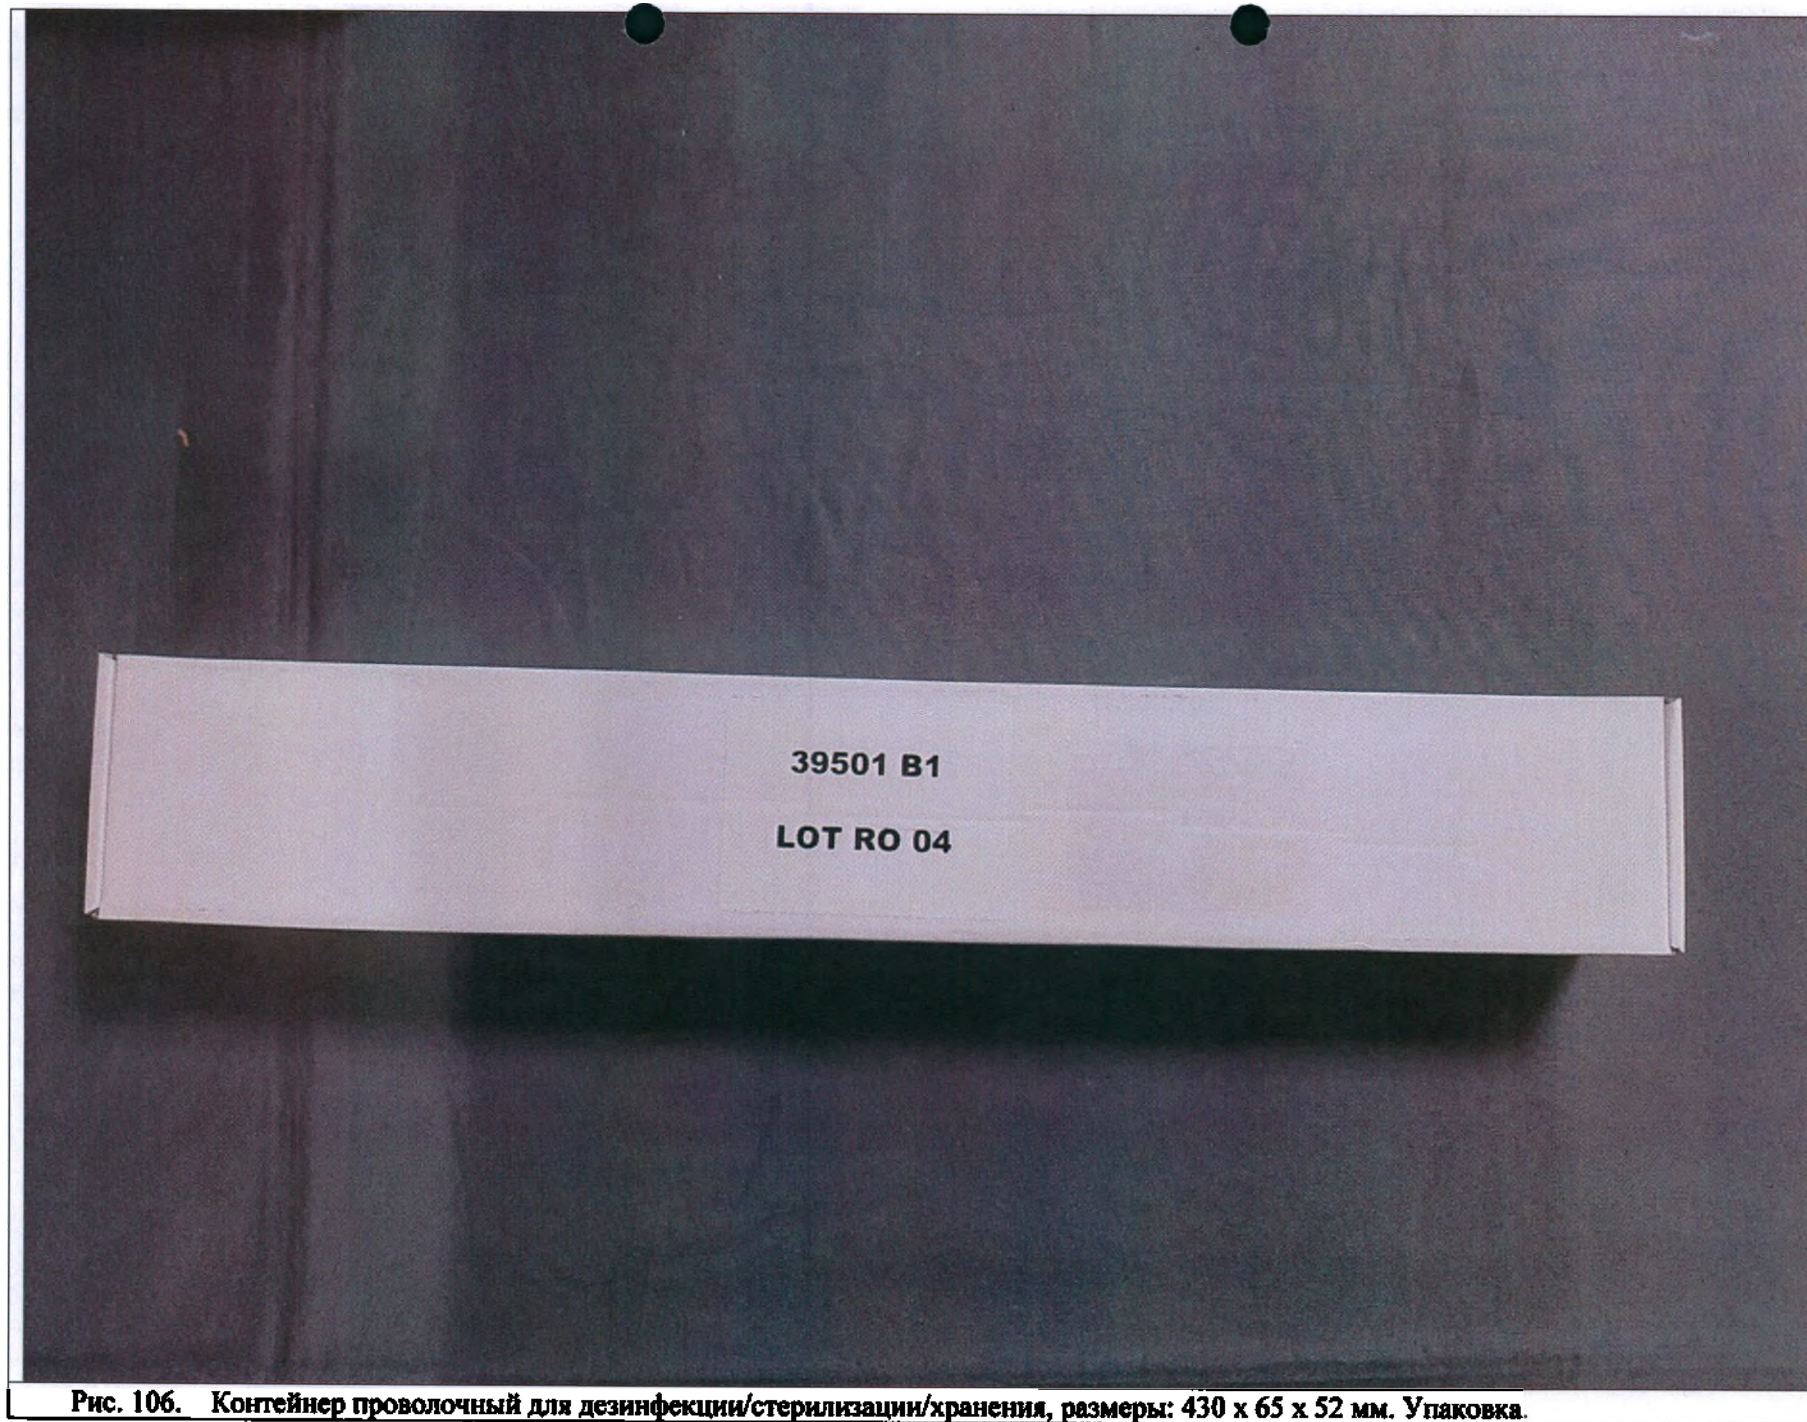


Рис. 106. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 430 х 65 х 52 мм. Упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

LOT R004

REF 39501B1

QTY 1

de Siebkorb f. Reinigung, 430x65x52mm
en Wire Tray f. Cleaning, 430x65x52mm
fr Panier de nettoyage, 430x65x52mm
it Cestello perfor. p. pulizia, 430x65x52mm
es Cesto filtro p. limpieza, 430x65x52mm
pt Cesta perfurada p/ limpeza, 430x65x52mm



Rx only MD 2021-04-30

 www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)04048551157640(11)210430(10)R004(422)276



Рис. 107. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 430 x 65 x 52 мм. Маркировка на упаковке

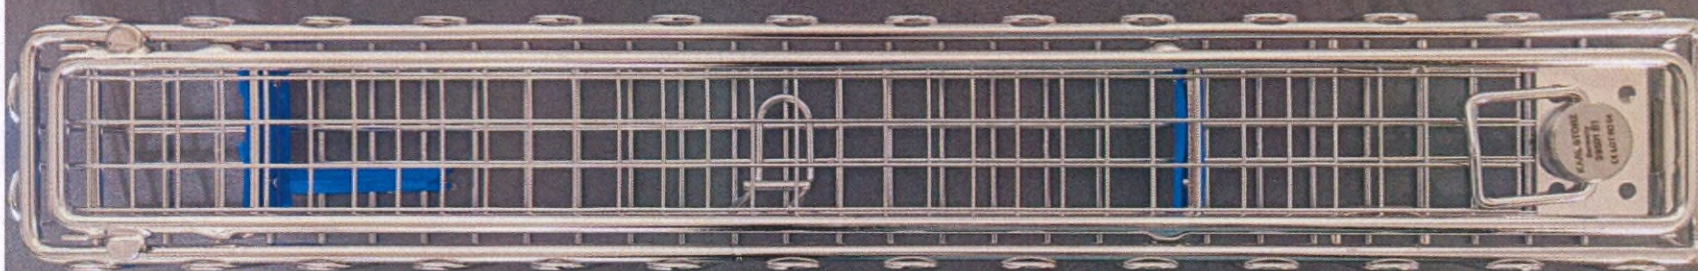


Рис. 108. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 430 x 65 x 52 мм.

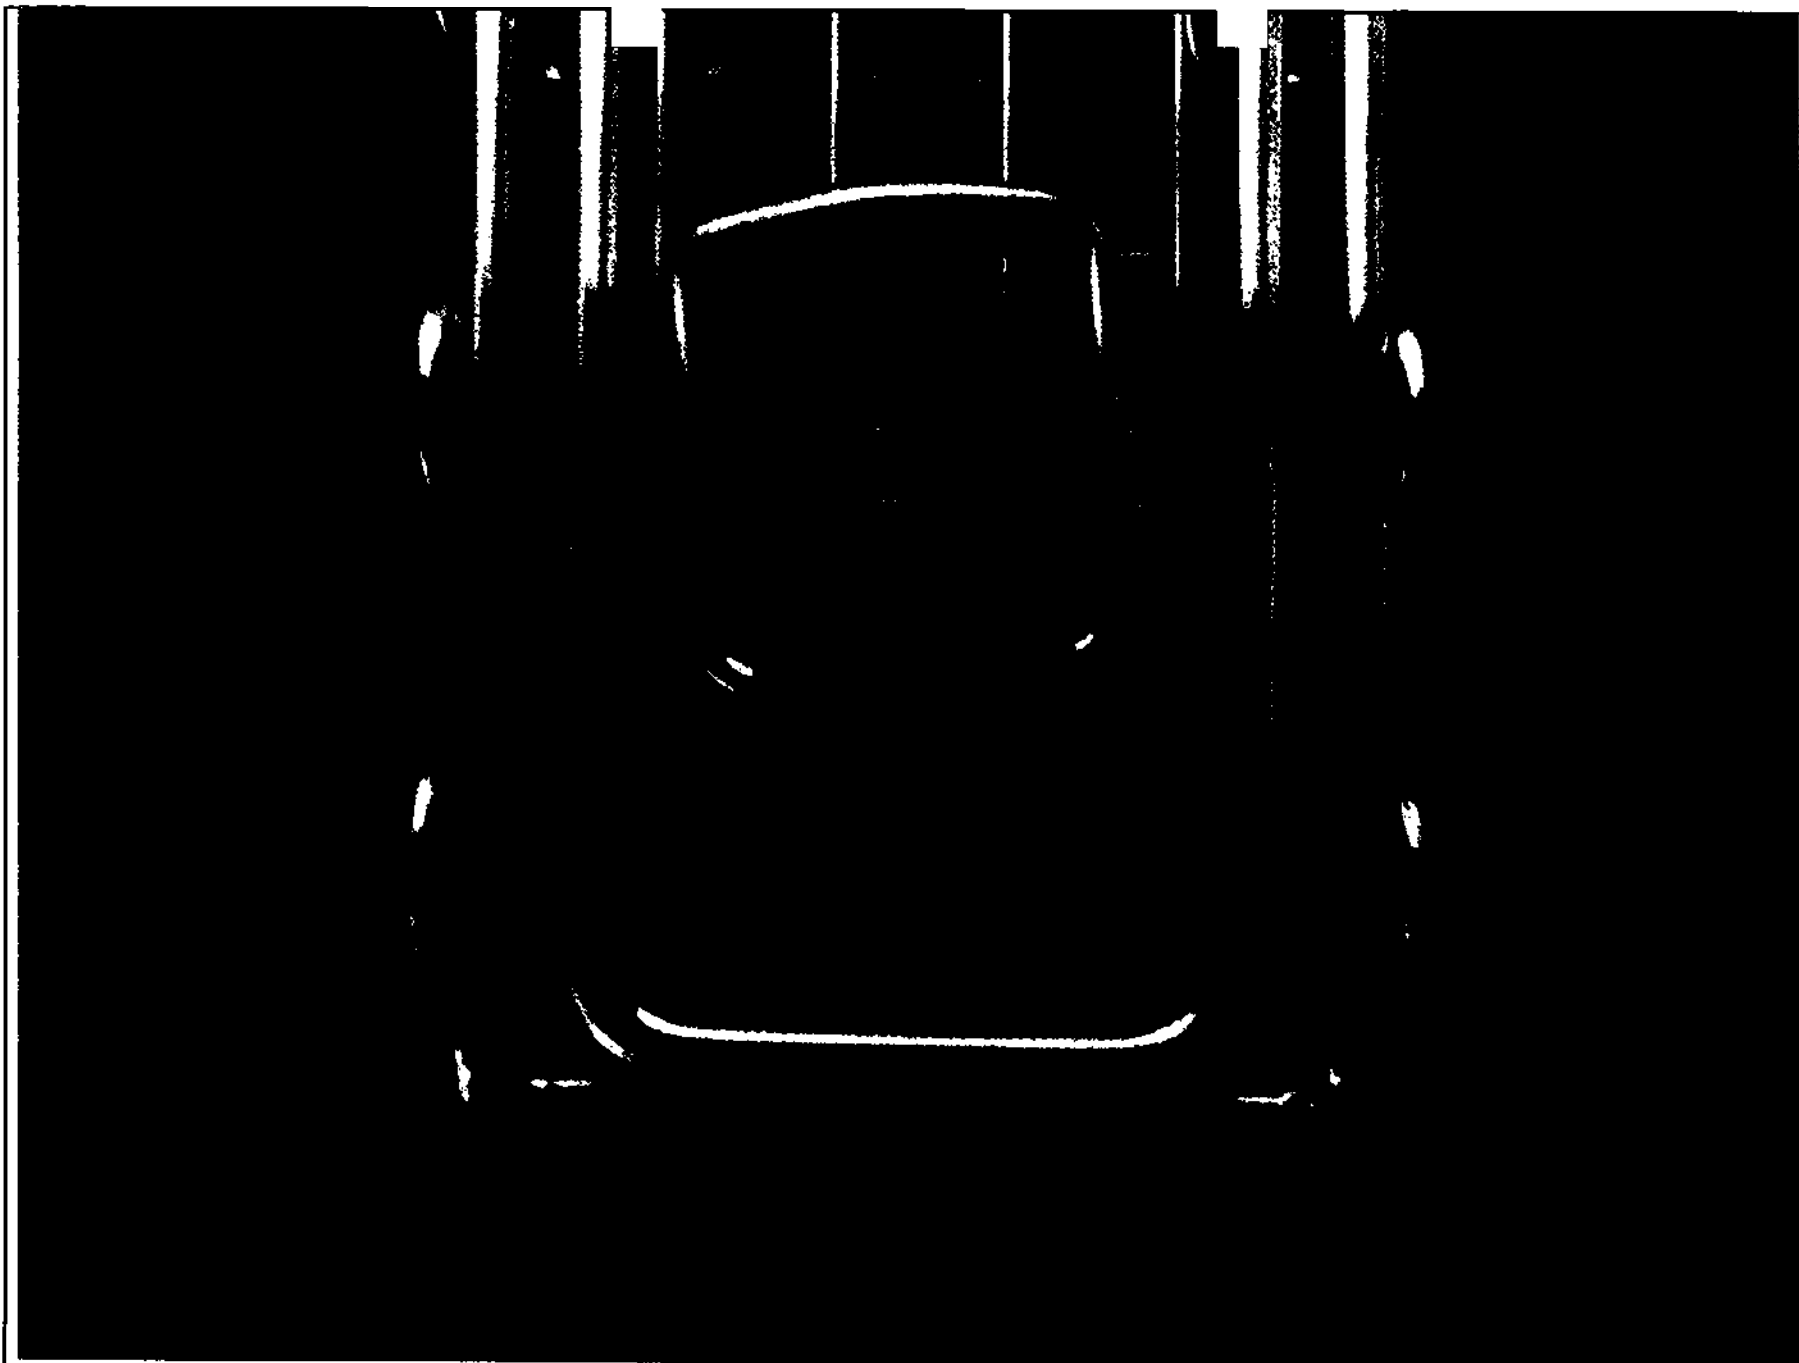


Рис. 109. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 430 x 65 x 52 мм.

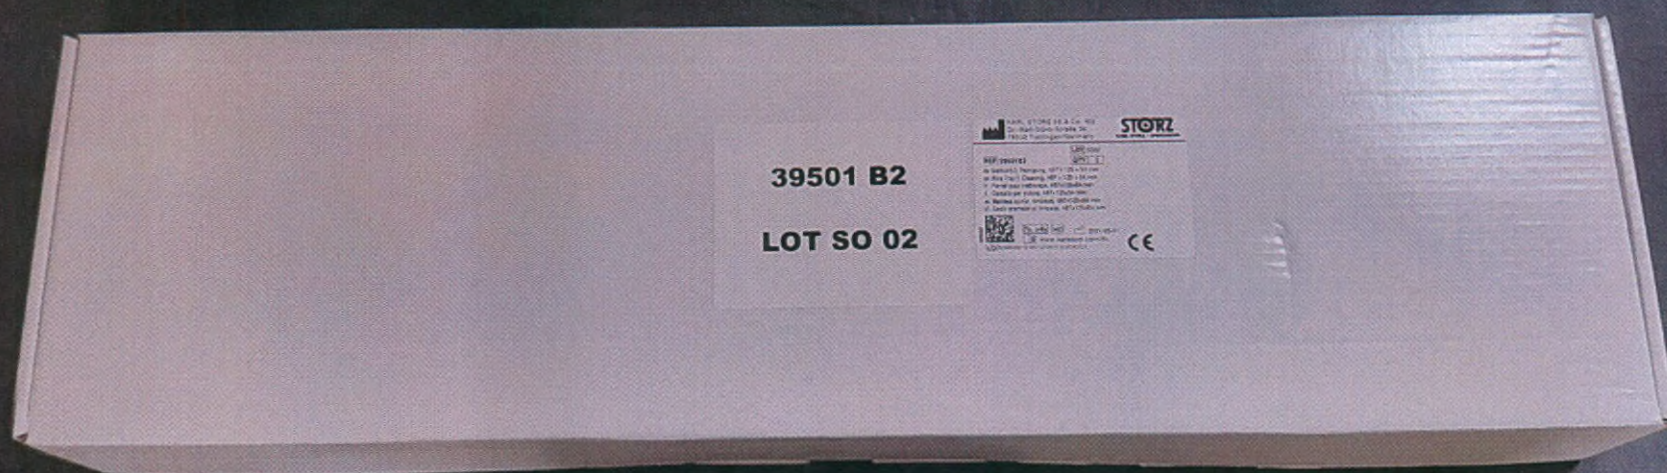


Рис. 110. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 487 x 125 x 54 мм. Упаковка.

39501 B2

LOT SO 02



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

LOT S002

REF 39501B2

QTY 1

de Siebkorb f. Reinigung, 487 x 125 x 54 mm
en Wire Tray f. Cleaning, 487 x 125 x 54 mm
fr Panier pour nettoyage, 487x125x54 mm
it Cestello per pulizia, 487x125x54 mm
es Bandeja quirúr. limpieza, 487x125x54 mm
pt Cesto aramado p/ limpeza, 487x125x54 mm

020002



Rx only MD

2021-05-01

www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)04048551157857(11)210501(1)015002(422)278



Рис. 111. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 487 x 125 x 54 мм. Маркировка на упаковке.



Рис. 112. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 487 x 125 x 54 мм.



Рис. 113. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 487 x 125 x 54 мм.

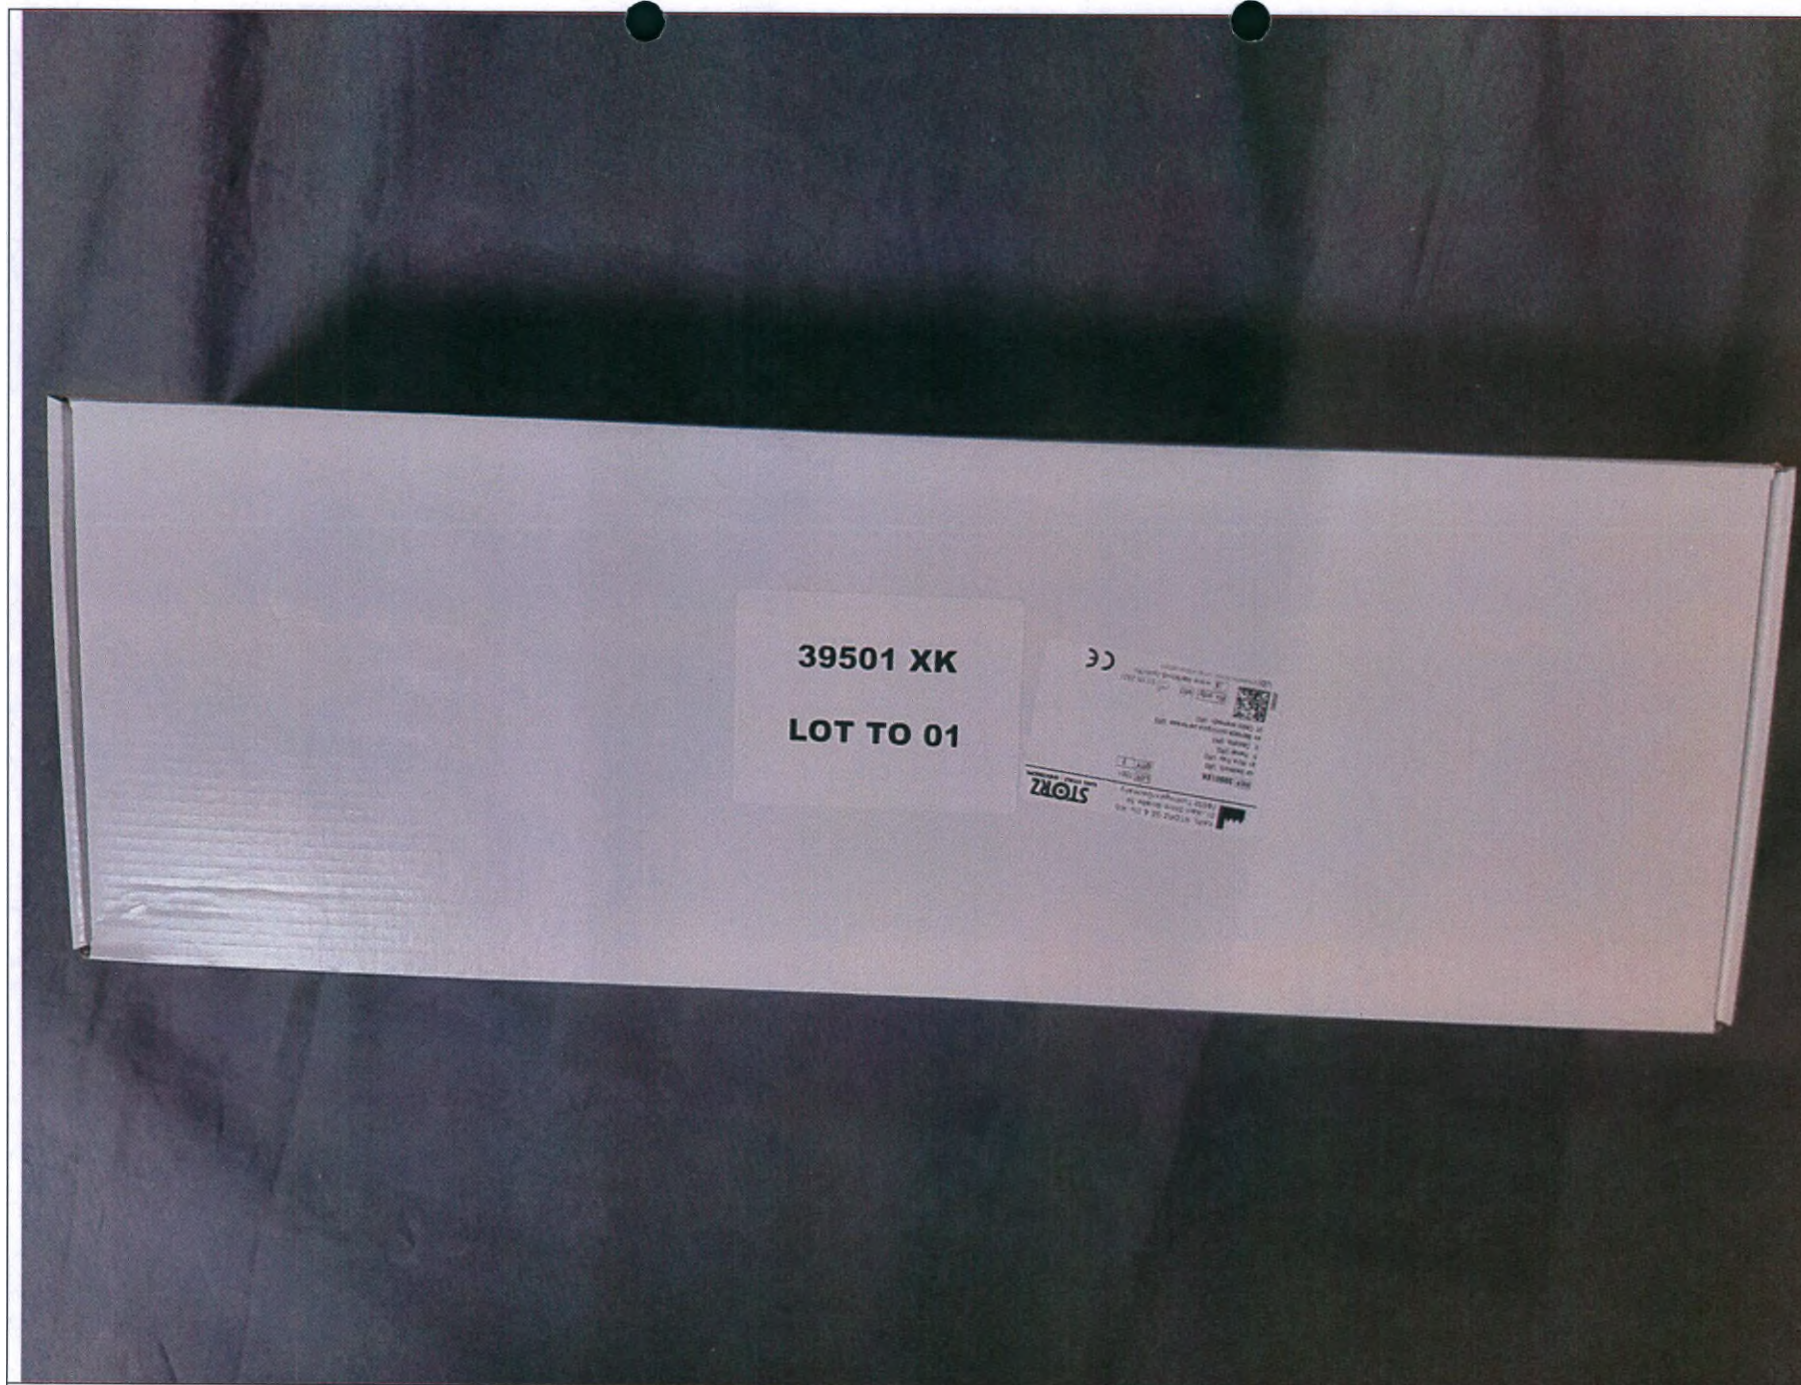


Рис. 114. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения с ячейкой для мелких деталей, размеры: 460 x 150 x 80 мм. Упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

REF 39501XK

LOT T001

QTY 1

de Siebkorb, URS
en Wire Tray, URS
fr Panier URS
it Cestello, URS
es Bandeja quirúrgica perforada, URS
pt Cesto aramado, URS

020002



Rx only MD



01.06.2021



www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)04048551157763(11)210814(10)T001(422)276

CE

Рис. 115. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения с ячейкой для мелких деталей, размеры: 460 x 150 x 80 мм.
Маркировка на упаковке.



Рис. 116. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения с ячейкой для мелких деталей, размеры: 460 x 150 x 80 мм.



Рис. 117. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения с ячейкой для мелких деталей, размеры: 460 x 150 x 80 мм.



Рис. 118. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения с ячейкой для мелких деталей, размеры: 460 x 150 x 80 мм.

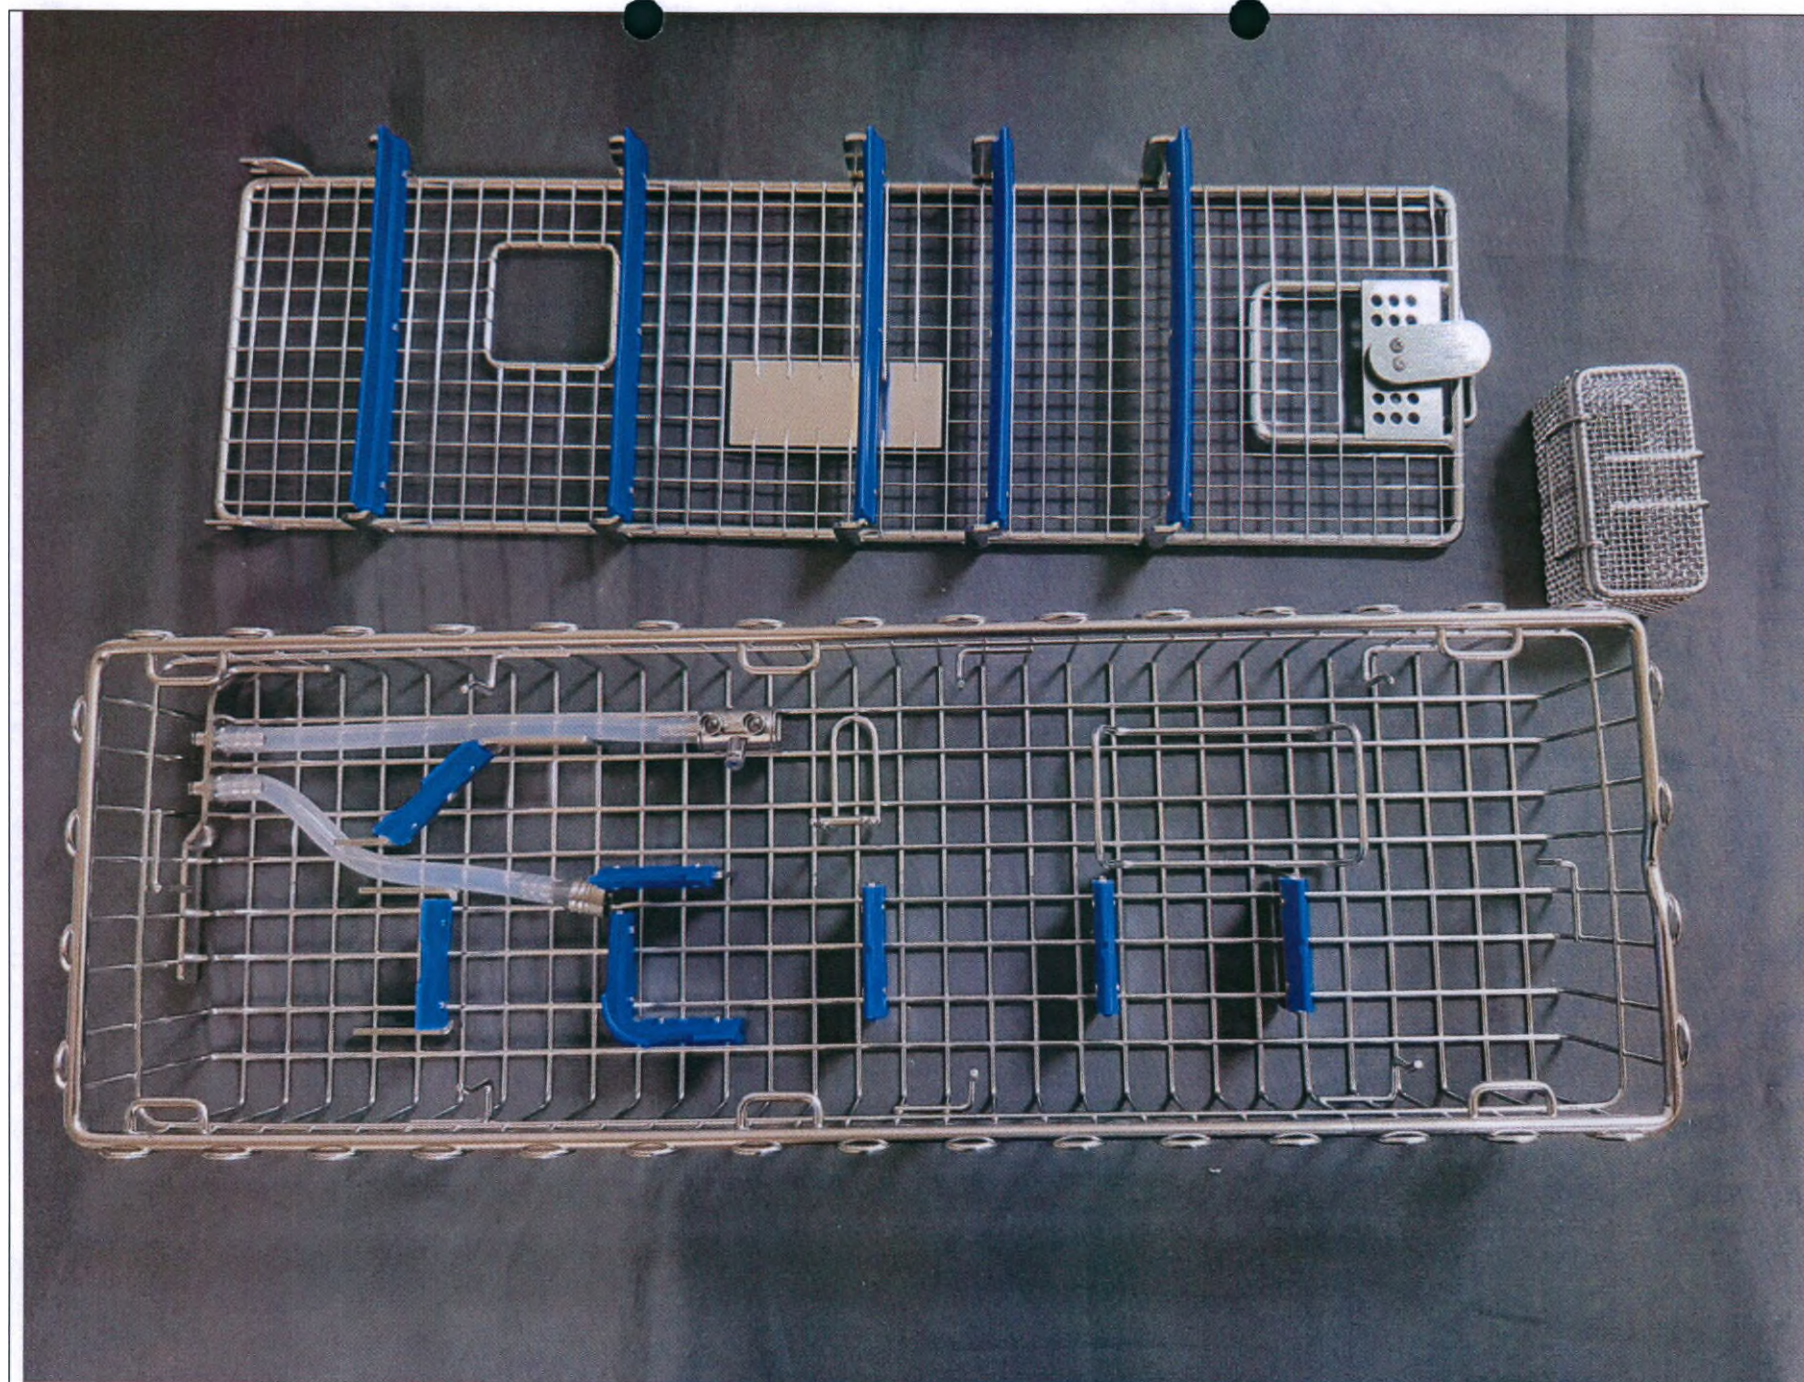


Рис. 119. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения с ячейкой для мелких деталей, размеры: 460 x 150 x 80 мм.

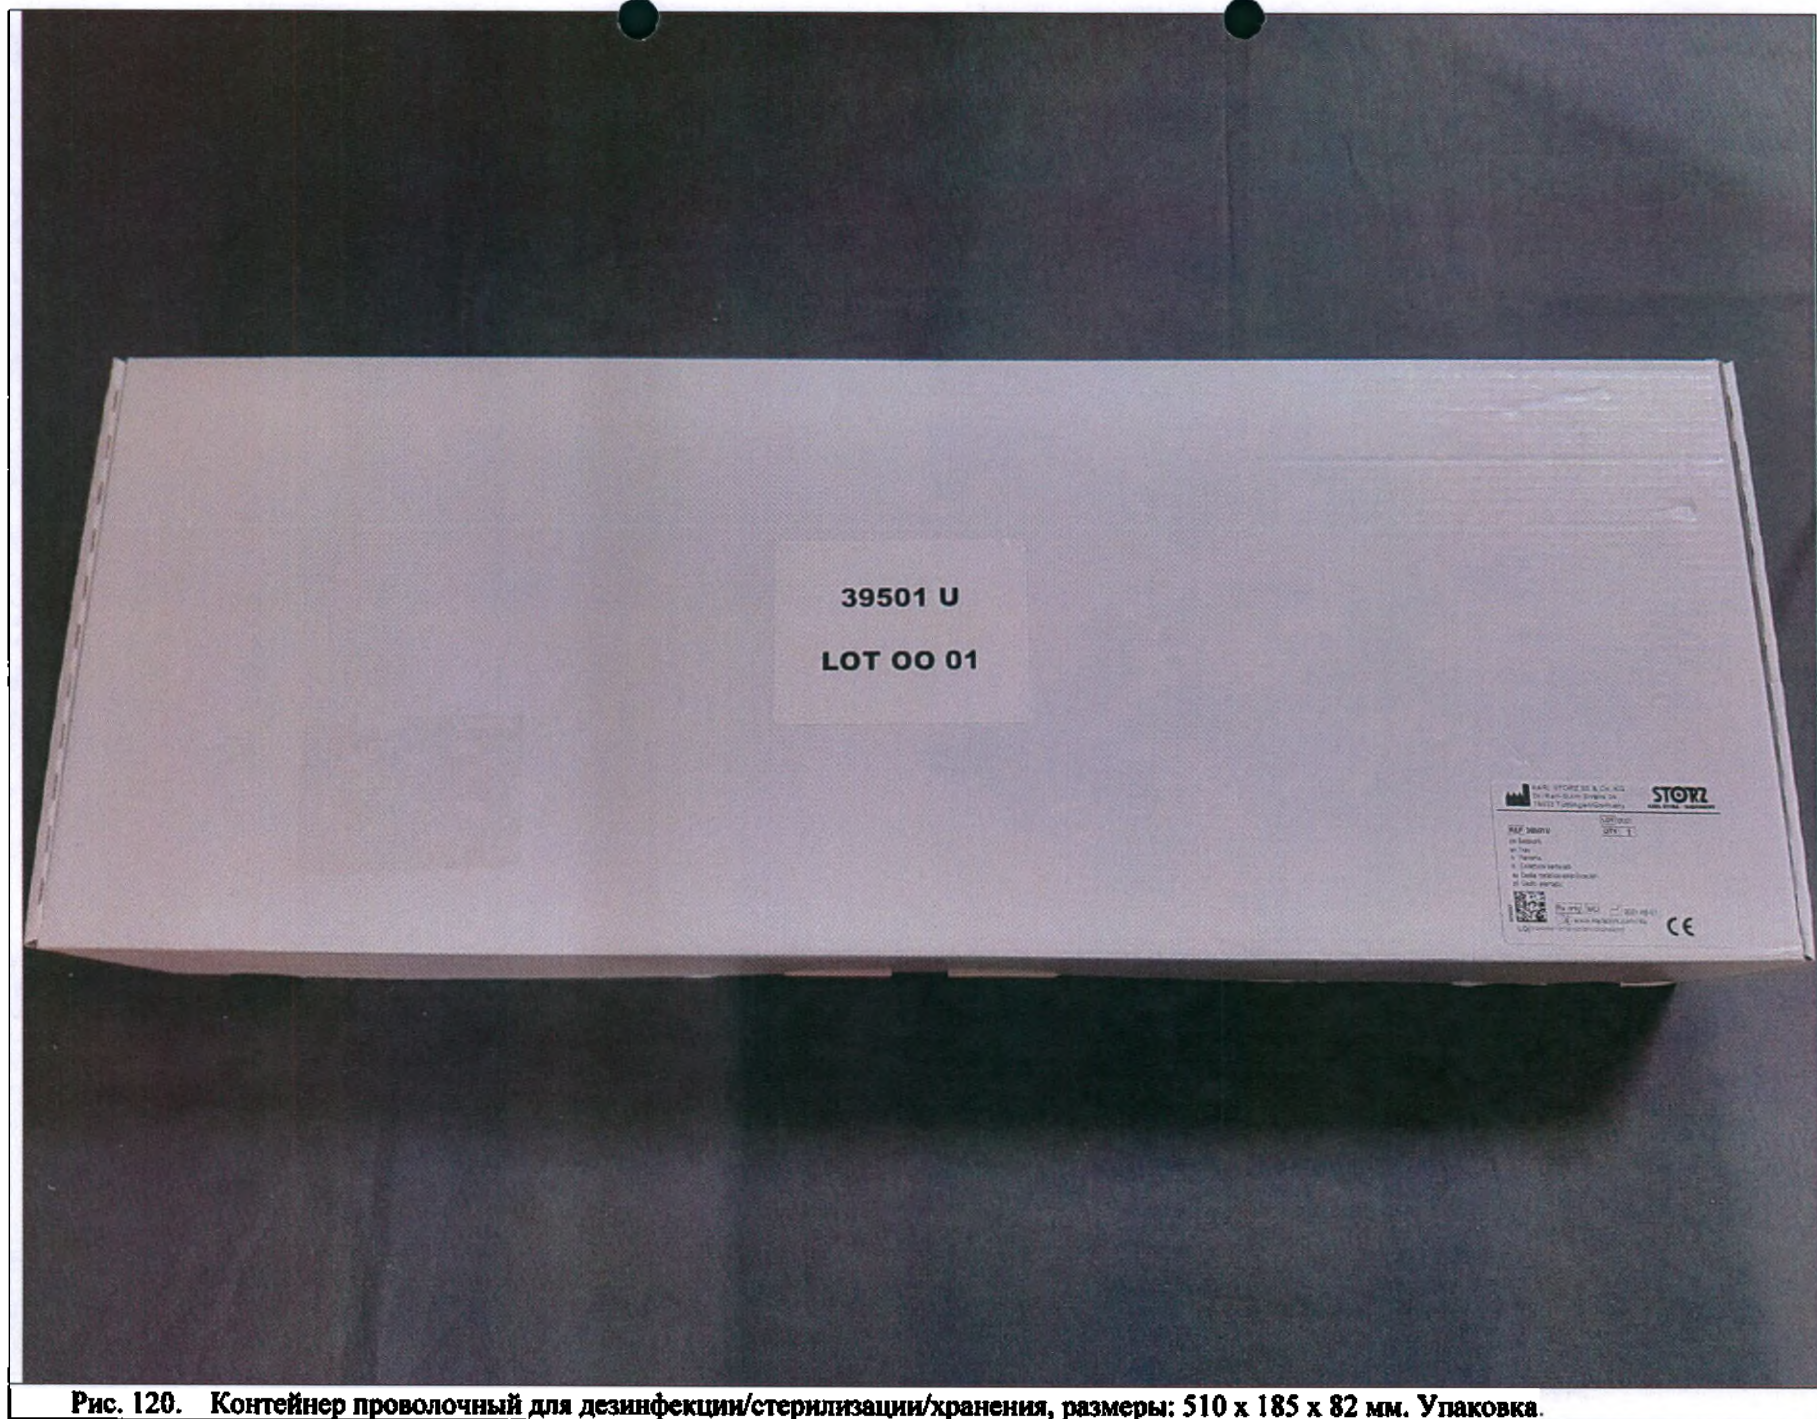


Рис. 120. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 510 x 185 x 82 мм. Упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF 39501U

LOT 0001

QTY 1

de Siebkorb
en Tray
fr Paniette
it Collettore perforato
es Cesta metálica esterilización
pt Cesto aramado

020002



Rx only

MD

2021-02-01



www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)04048551157718(11)210201(10)0001(422)278



Рис. 121. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 510 x 185 x 82 мм. Маркировка на упаковке.



Рис. 122. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 510 x 185 x 82 мм.



Рис. 123. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 510 x 185 x 82 мм.



Рис. 124. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 510 x 185 x 82 мм.



Рис. 125. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 510 x 185 x 82 мм.

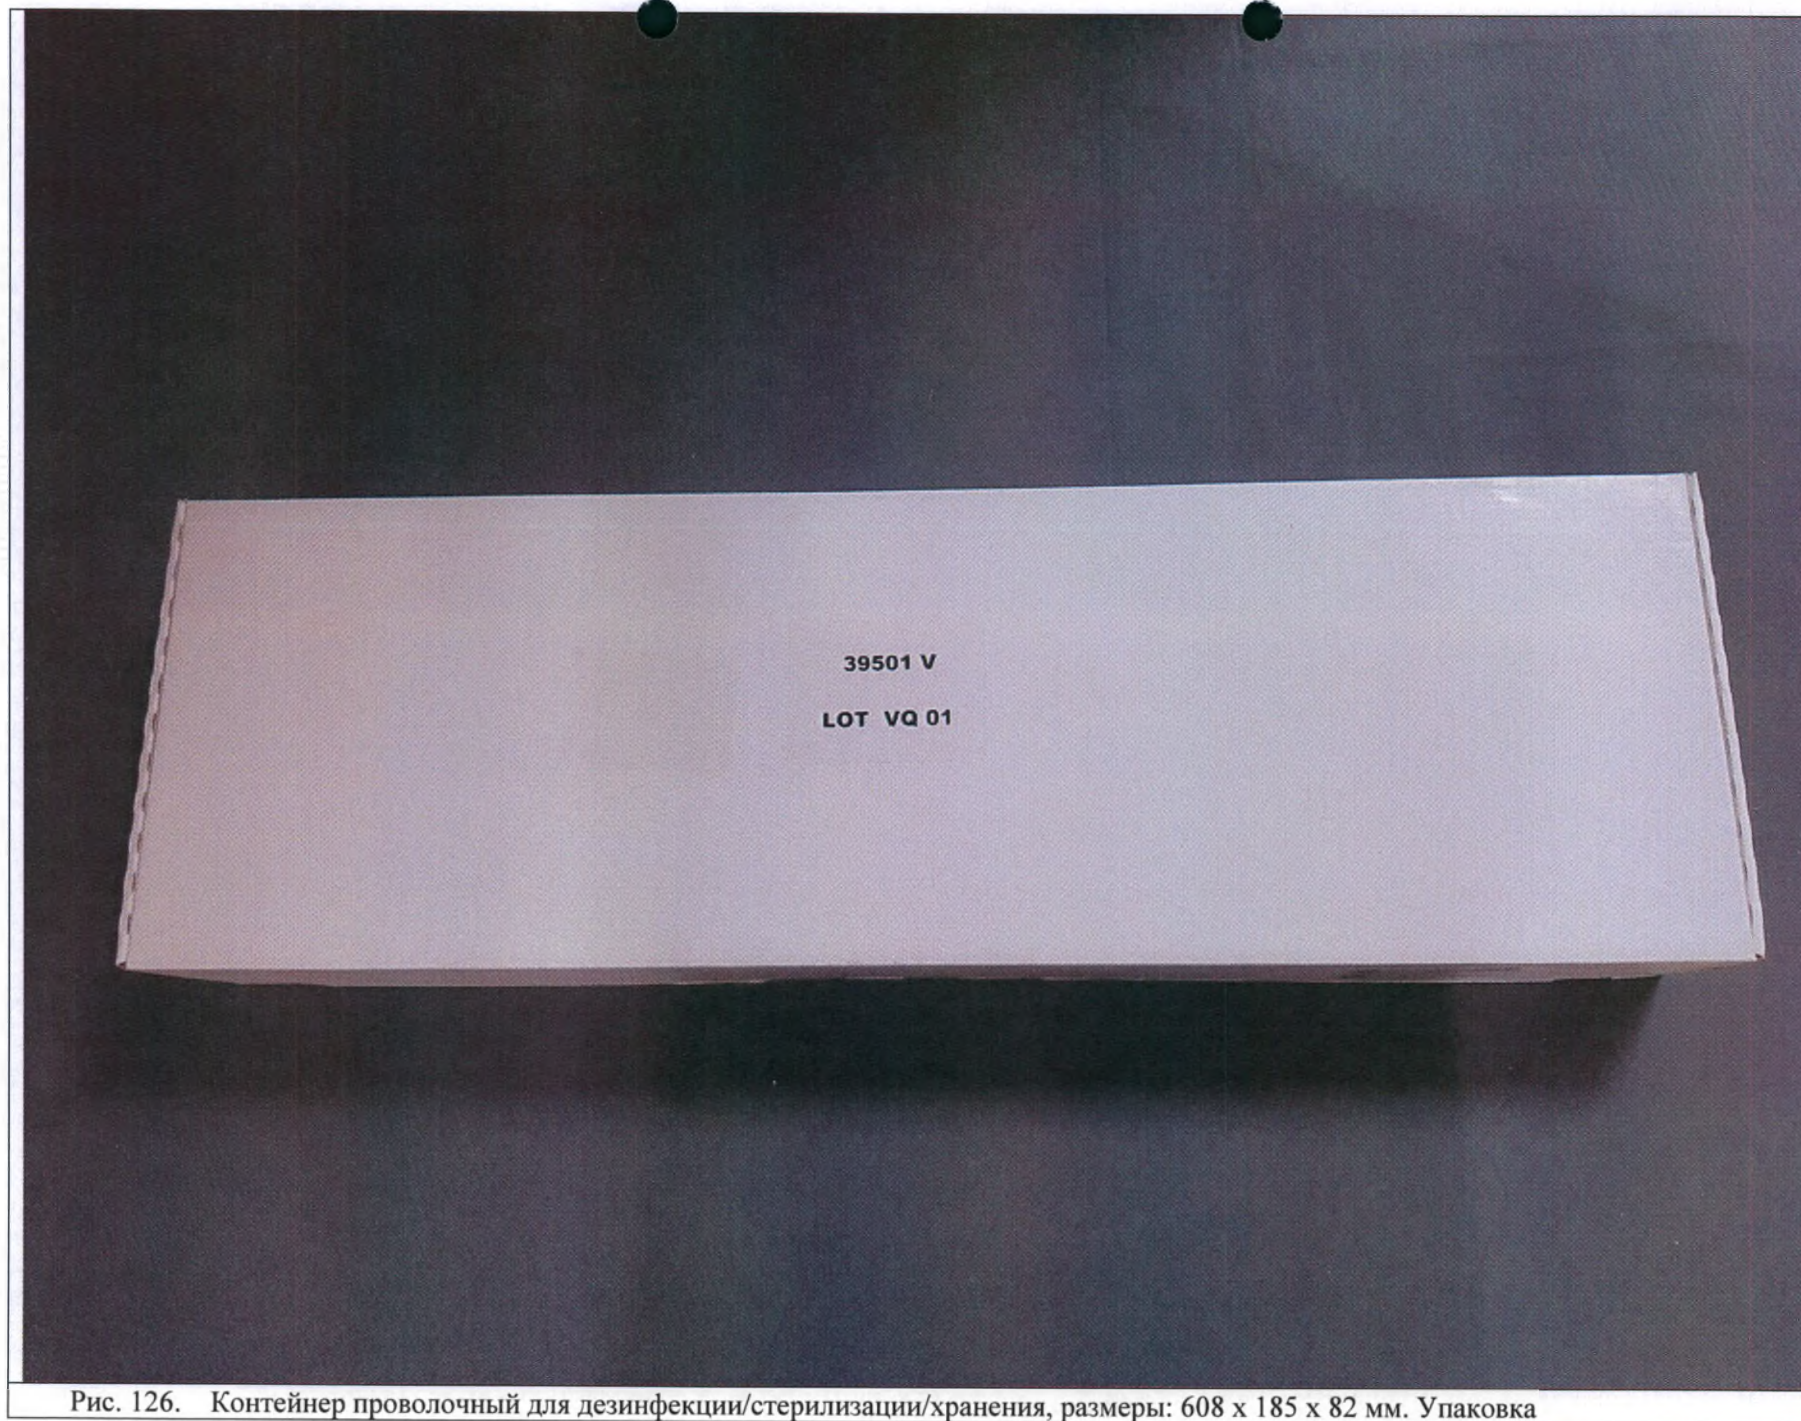


Рис. 126. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 608 x 185 x 82 мм. Упаковка

 **KARL STORZ SE & Co. KG**
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF 39501V

de Siebkorb
en Tray
fr Paniette
it Collettore perforato
es Cesta.
pt Cesto aramado

LOT VQ01

QTY 1



Rx only

MD



2019-08-01



www.karlstorz.com/ifu

CE

UDI (01)04048551157749(11)190801(10)VQ01(422)276

Рис. 127. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 608 x 185 x 82 мм. Маркировка на упаковке.



Рис. 128. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 608 x 185 x 82 мм.



Рис. 129. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 608 x 185 x 82 мм.

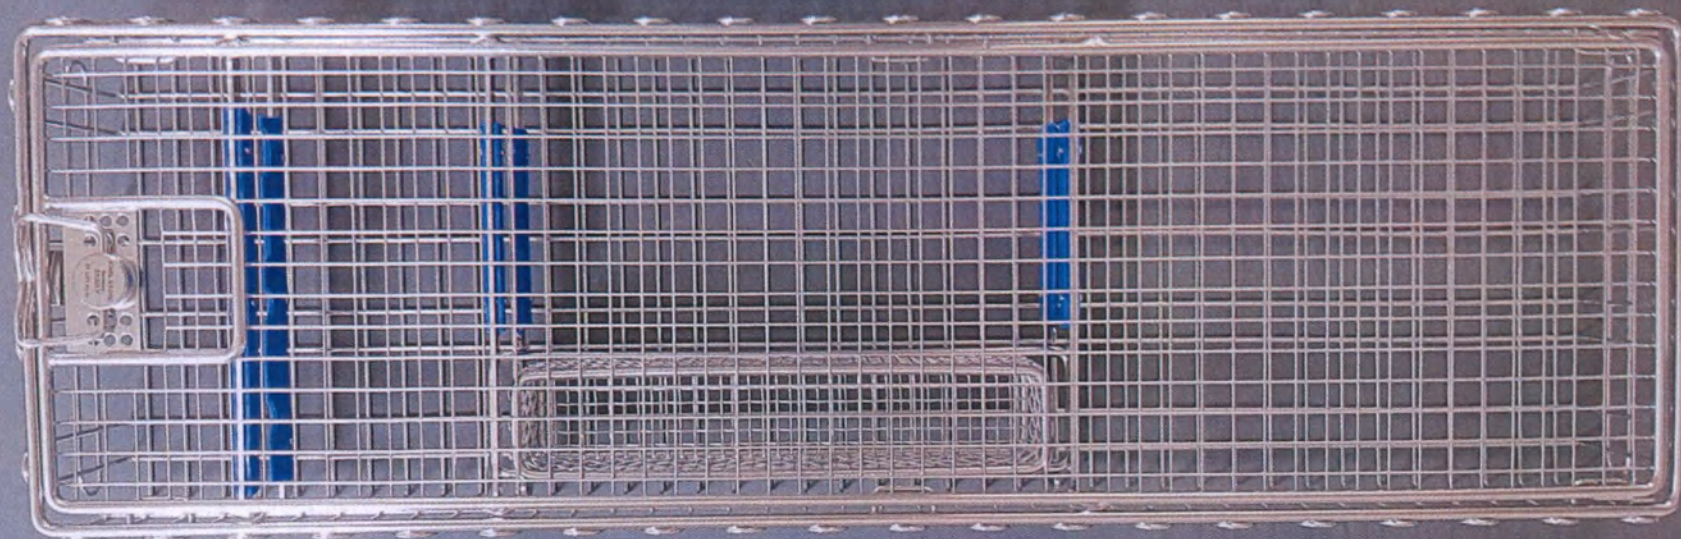


Рис. 130. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 608 x 185 x 82 мм.

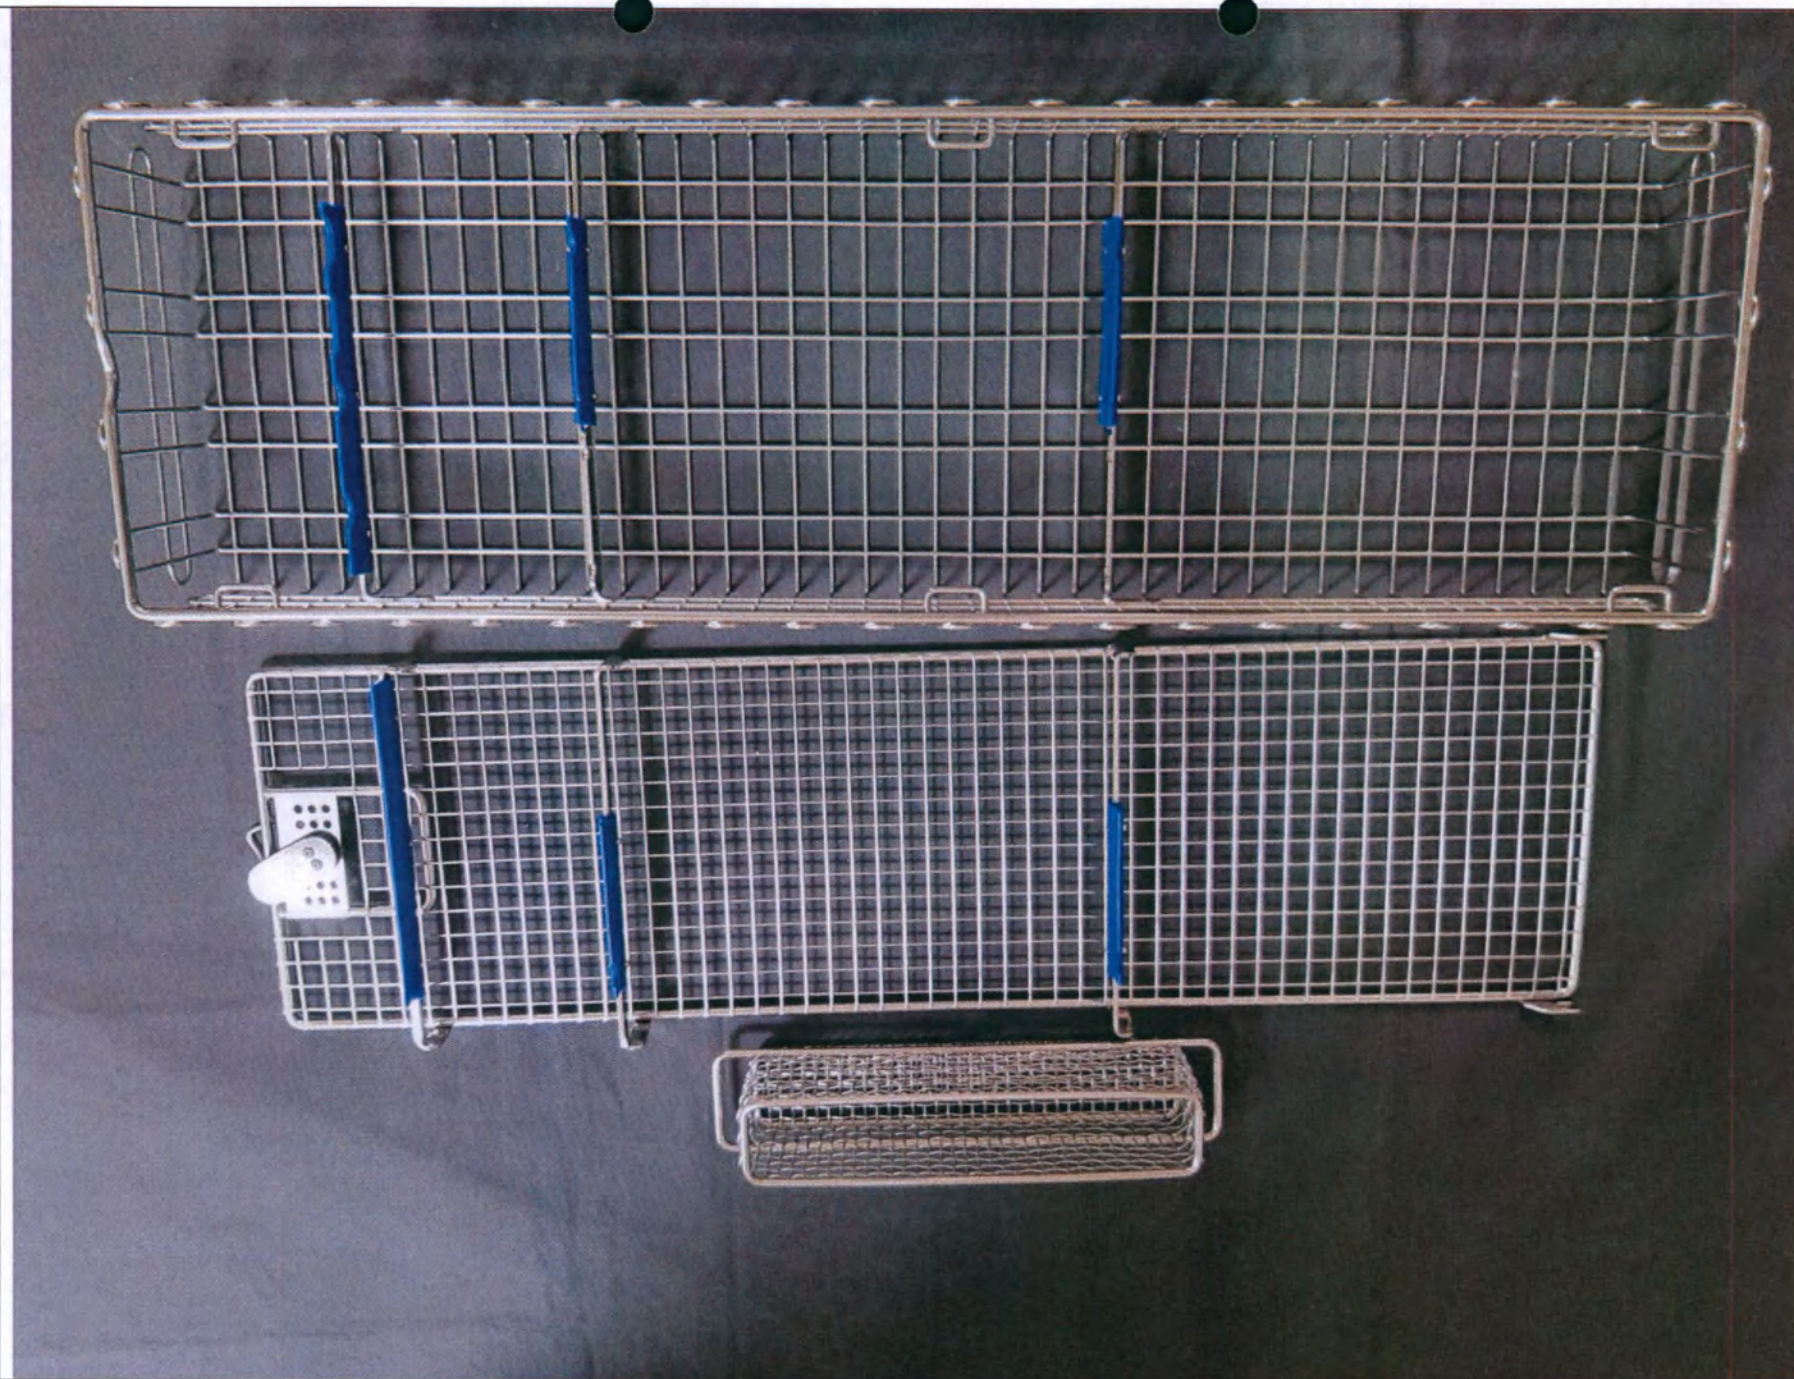


Рис. 131. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 608 x 185 x 82 мм.

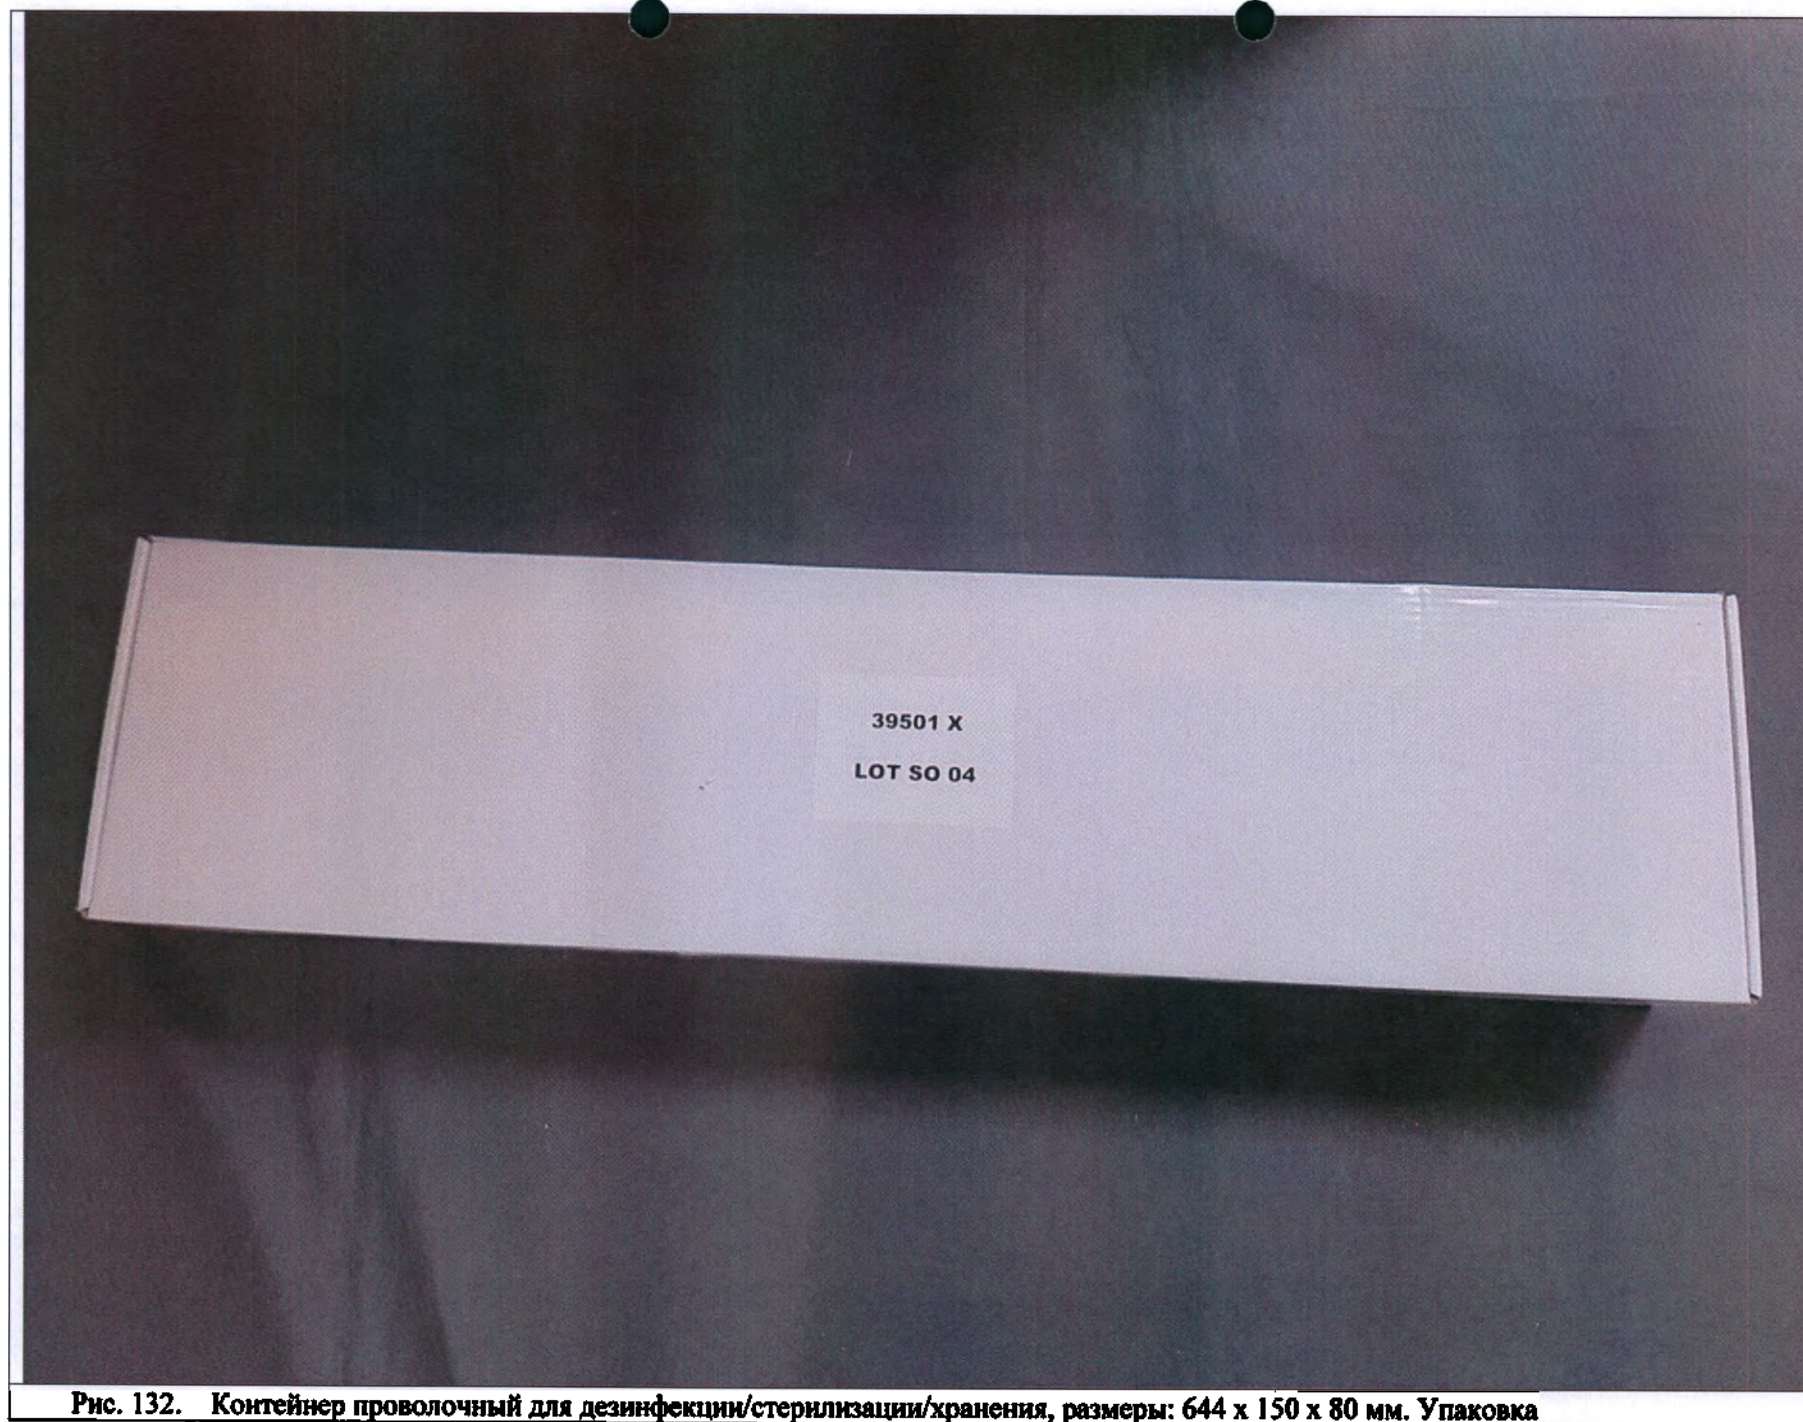


Рис. 132. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 644 x 150 x 80 мм. Упаковка



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ -- ENDOSKOPE

LOT S004

REF 39501X

QTY 1

de Siebkorb, URS, 644 x 150 x 80 mm
en Tray, URS, 644 x 150 x 80 mm
fr Panier, URS, 644 x 150 x 80 mm
it Cestello perforato, URS, 644x150x80 mm
es Cesto filtro, URS, 644x150x80 mm
pt Cesta perfurada, URS, 644x150x80 mm



Rx only MD 2021-05-31



www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)04048551157758(11)210531(10)S004(422)278




Рис. 133. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 644 x 150 x 80 мм. Маркировка на упаковке



Рис. 134. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 644 x 150 x 80 мм.



Рис. 135. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 644 x 150 x 80 мм.



Рис. 136. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 644 x 150 x 80 мм.

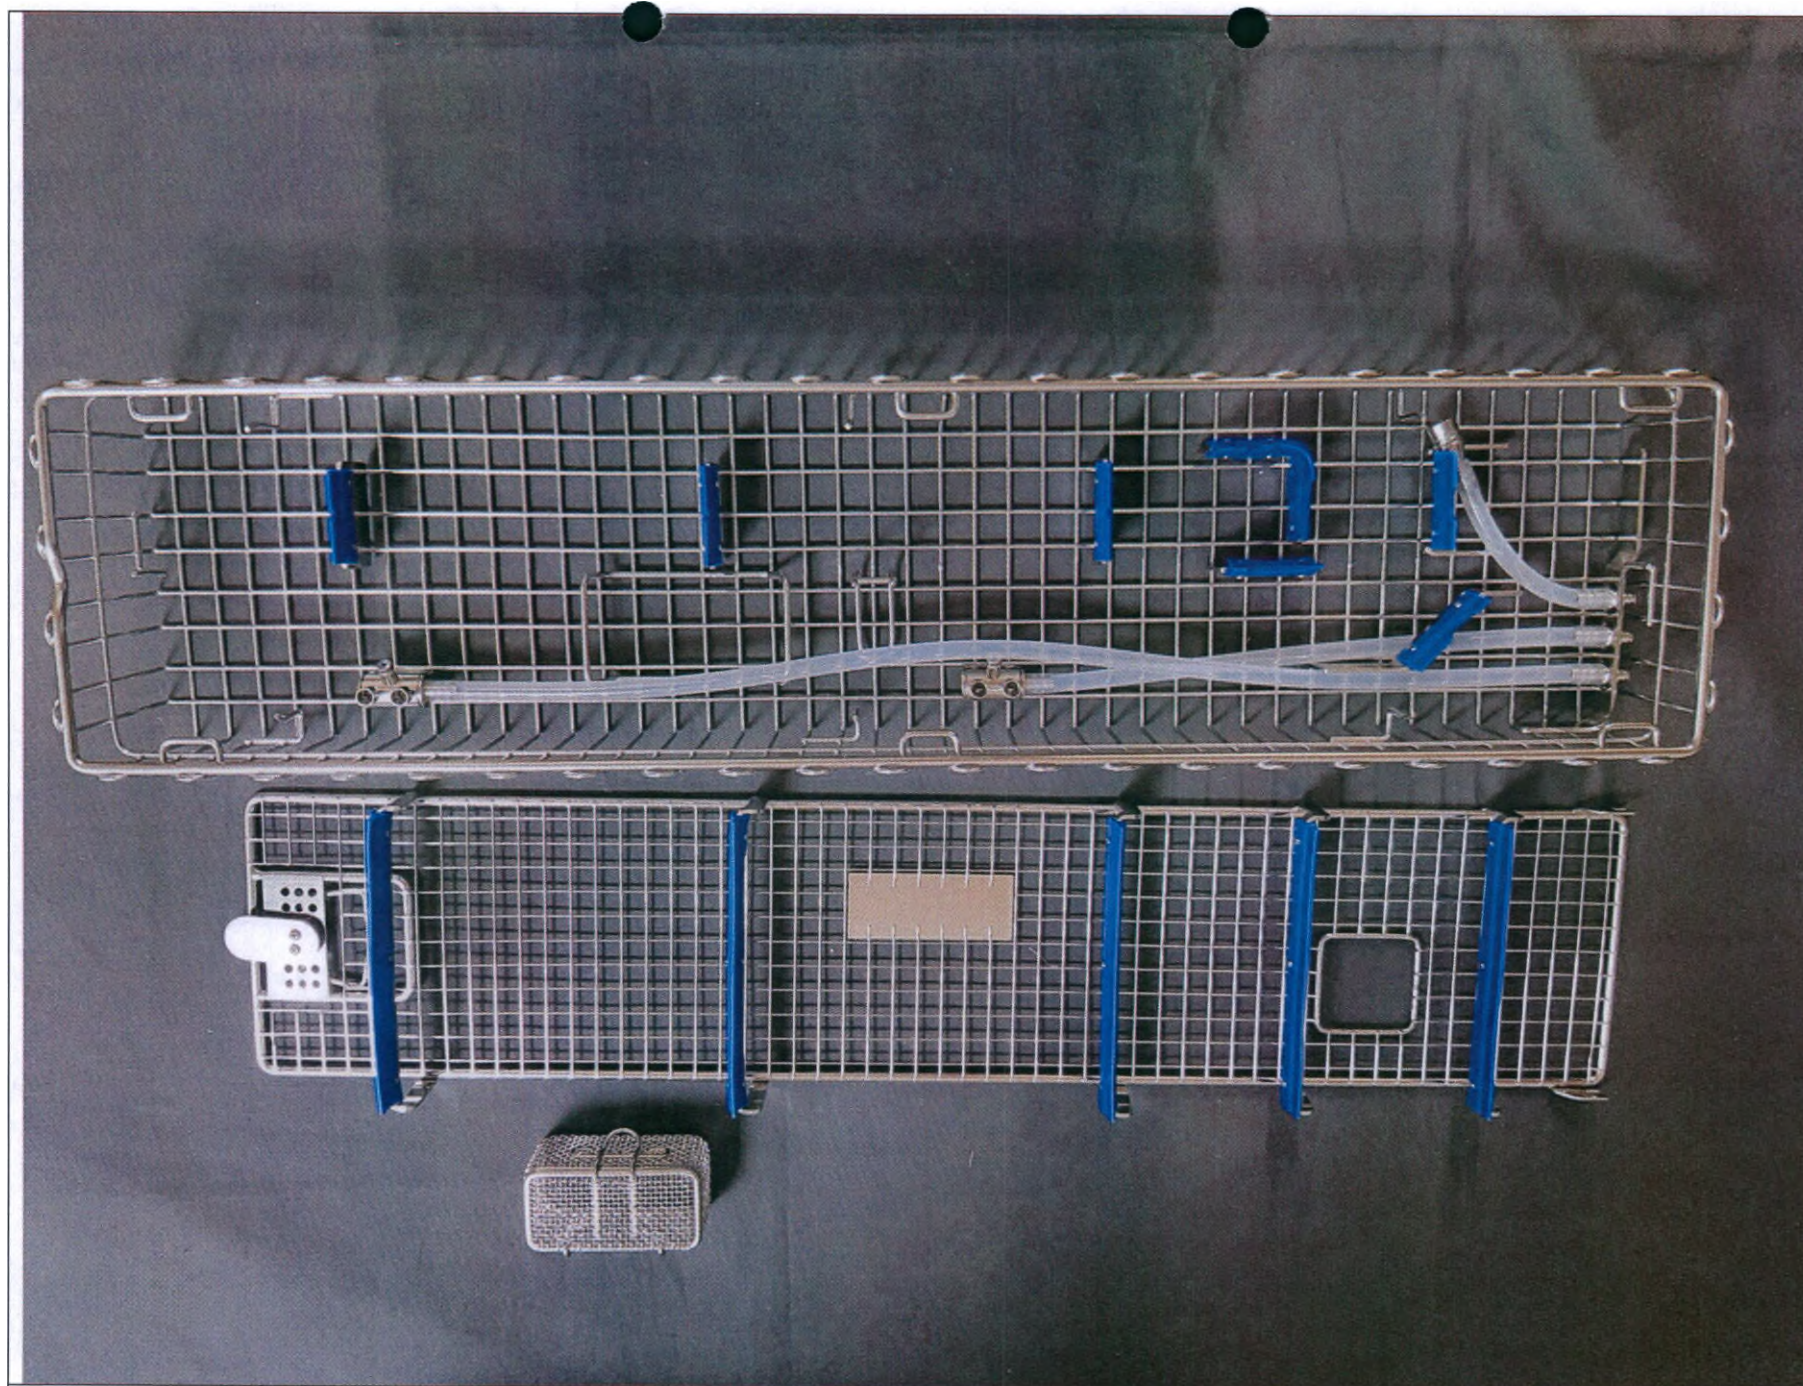


Рис. 137. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 644 x 150 x 80 мм.

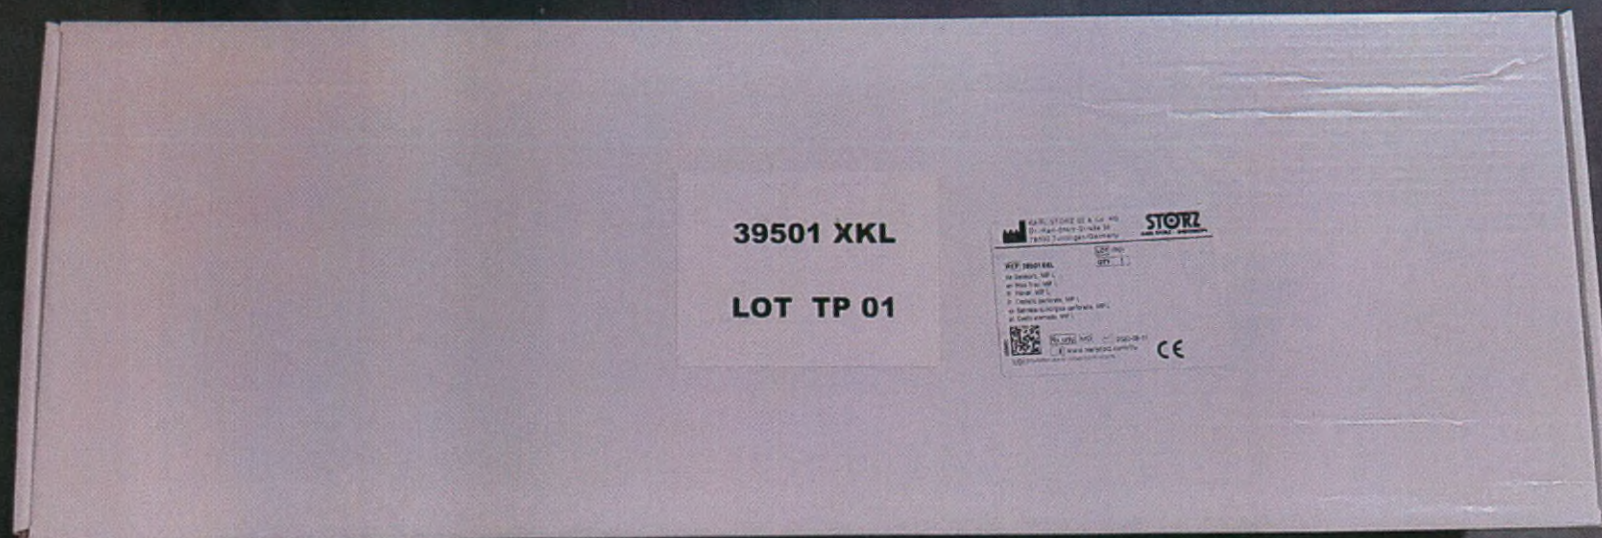


Рис. 138. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 460 x 150 x 87 мм. Упаковка



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSCOPE

LOT TP01

QTY 1

REF 39501XKL

de Siebkorb, MIP L
en Wire Tray, MIP L
fr Panier, MIP L
it Cestello perforato, MIP L
es Bandeja quirúrgica perforada, MIP L
pt Cesto aramado, MIP L



020007

Rx only

MD



2020-06-01



www.karlstorz.com/ifu

[UDI] (01)04048551560415(11)2003601(0)TP01(423278



Рис. 139. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 460 x 150 x 87 мм. Маркировка на упаковке

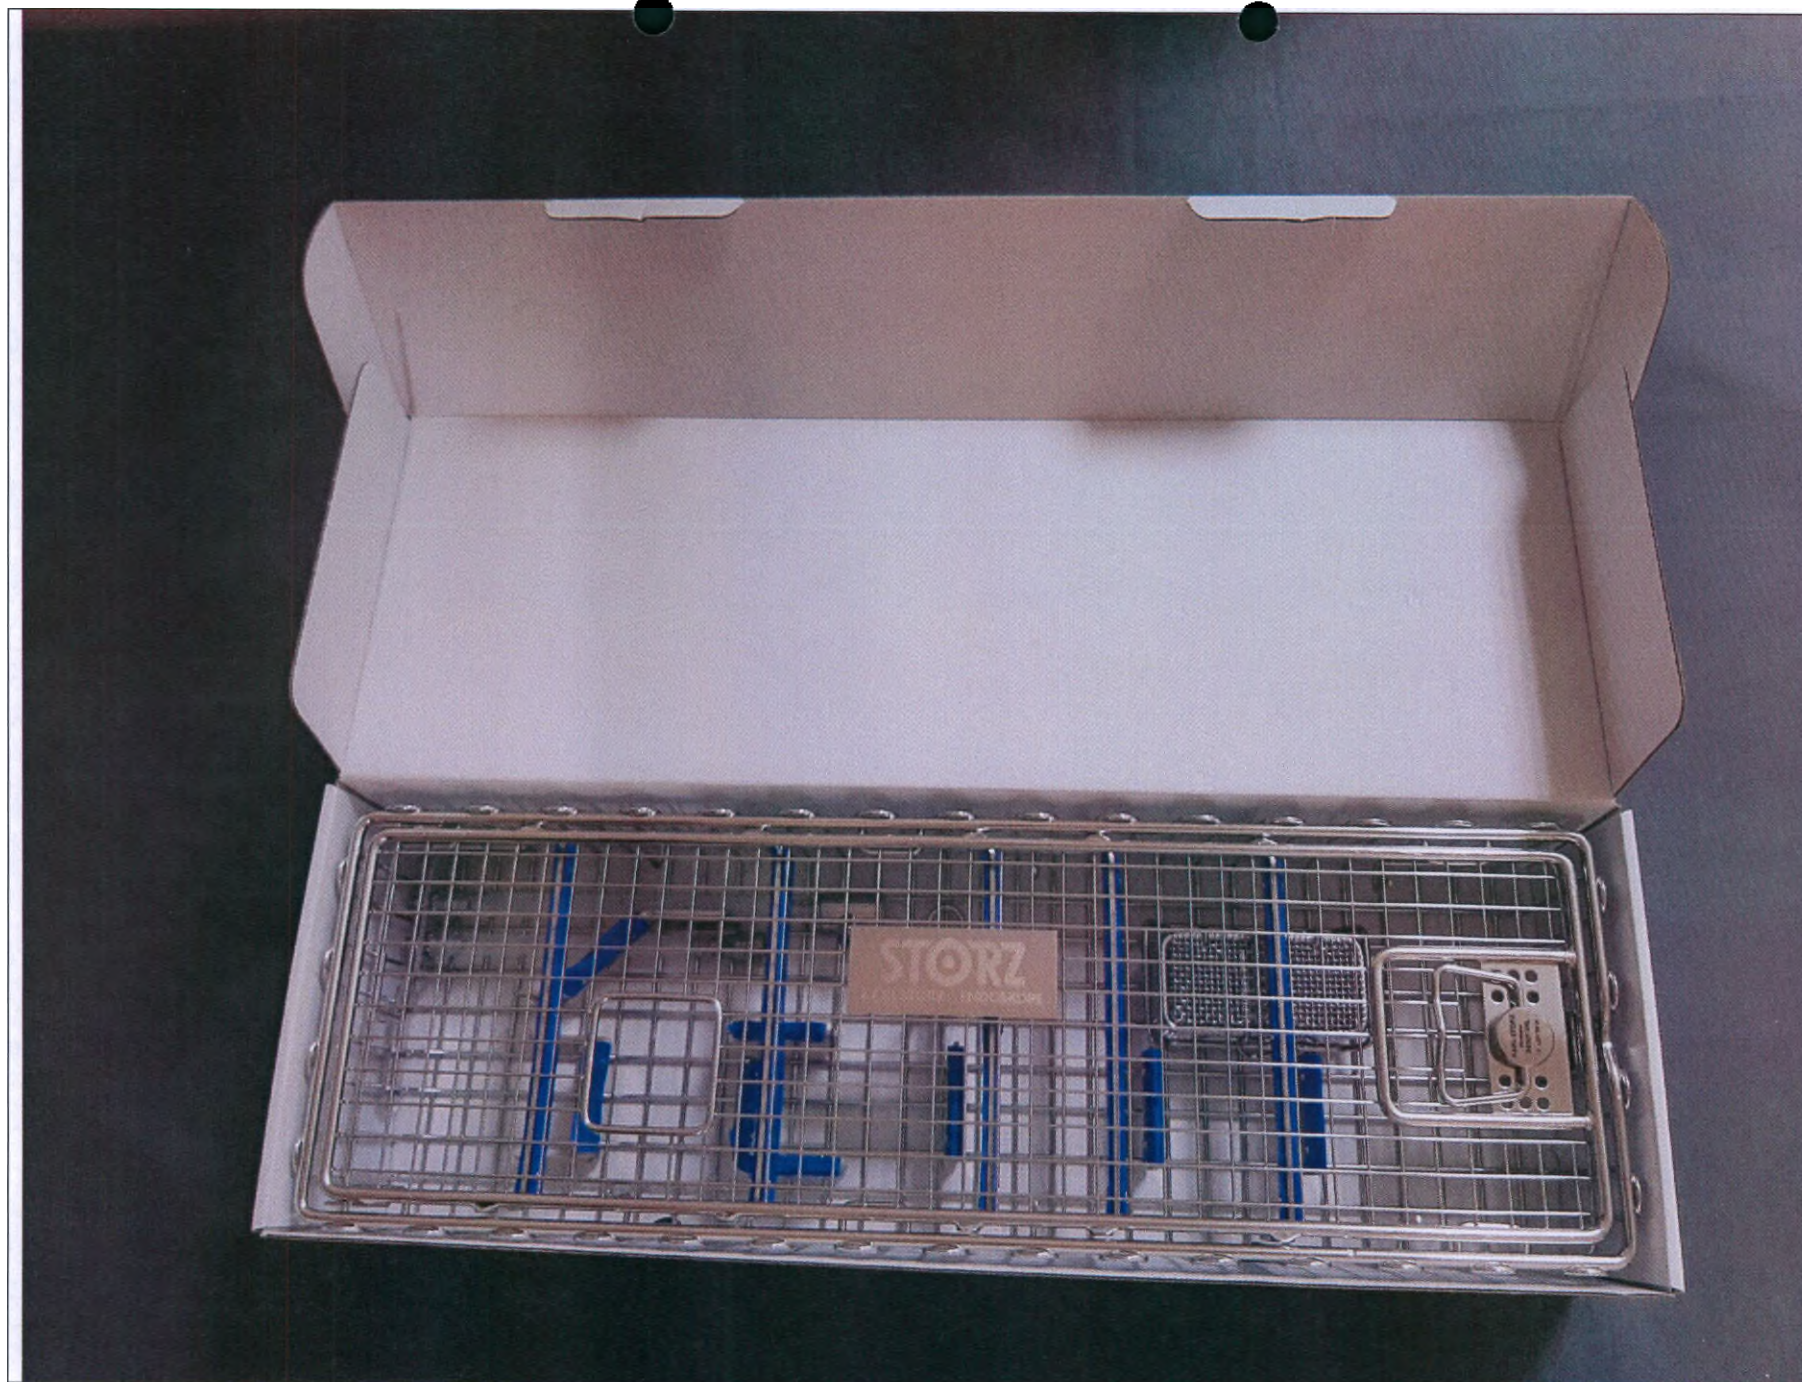


Рис. 140. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 460 x 150 x 87 мм.



Рис. 141. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 460 x 150 x 87 мм.

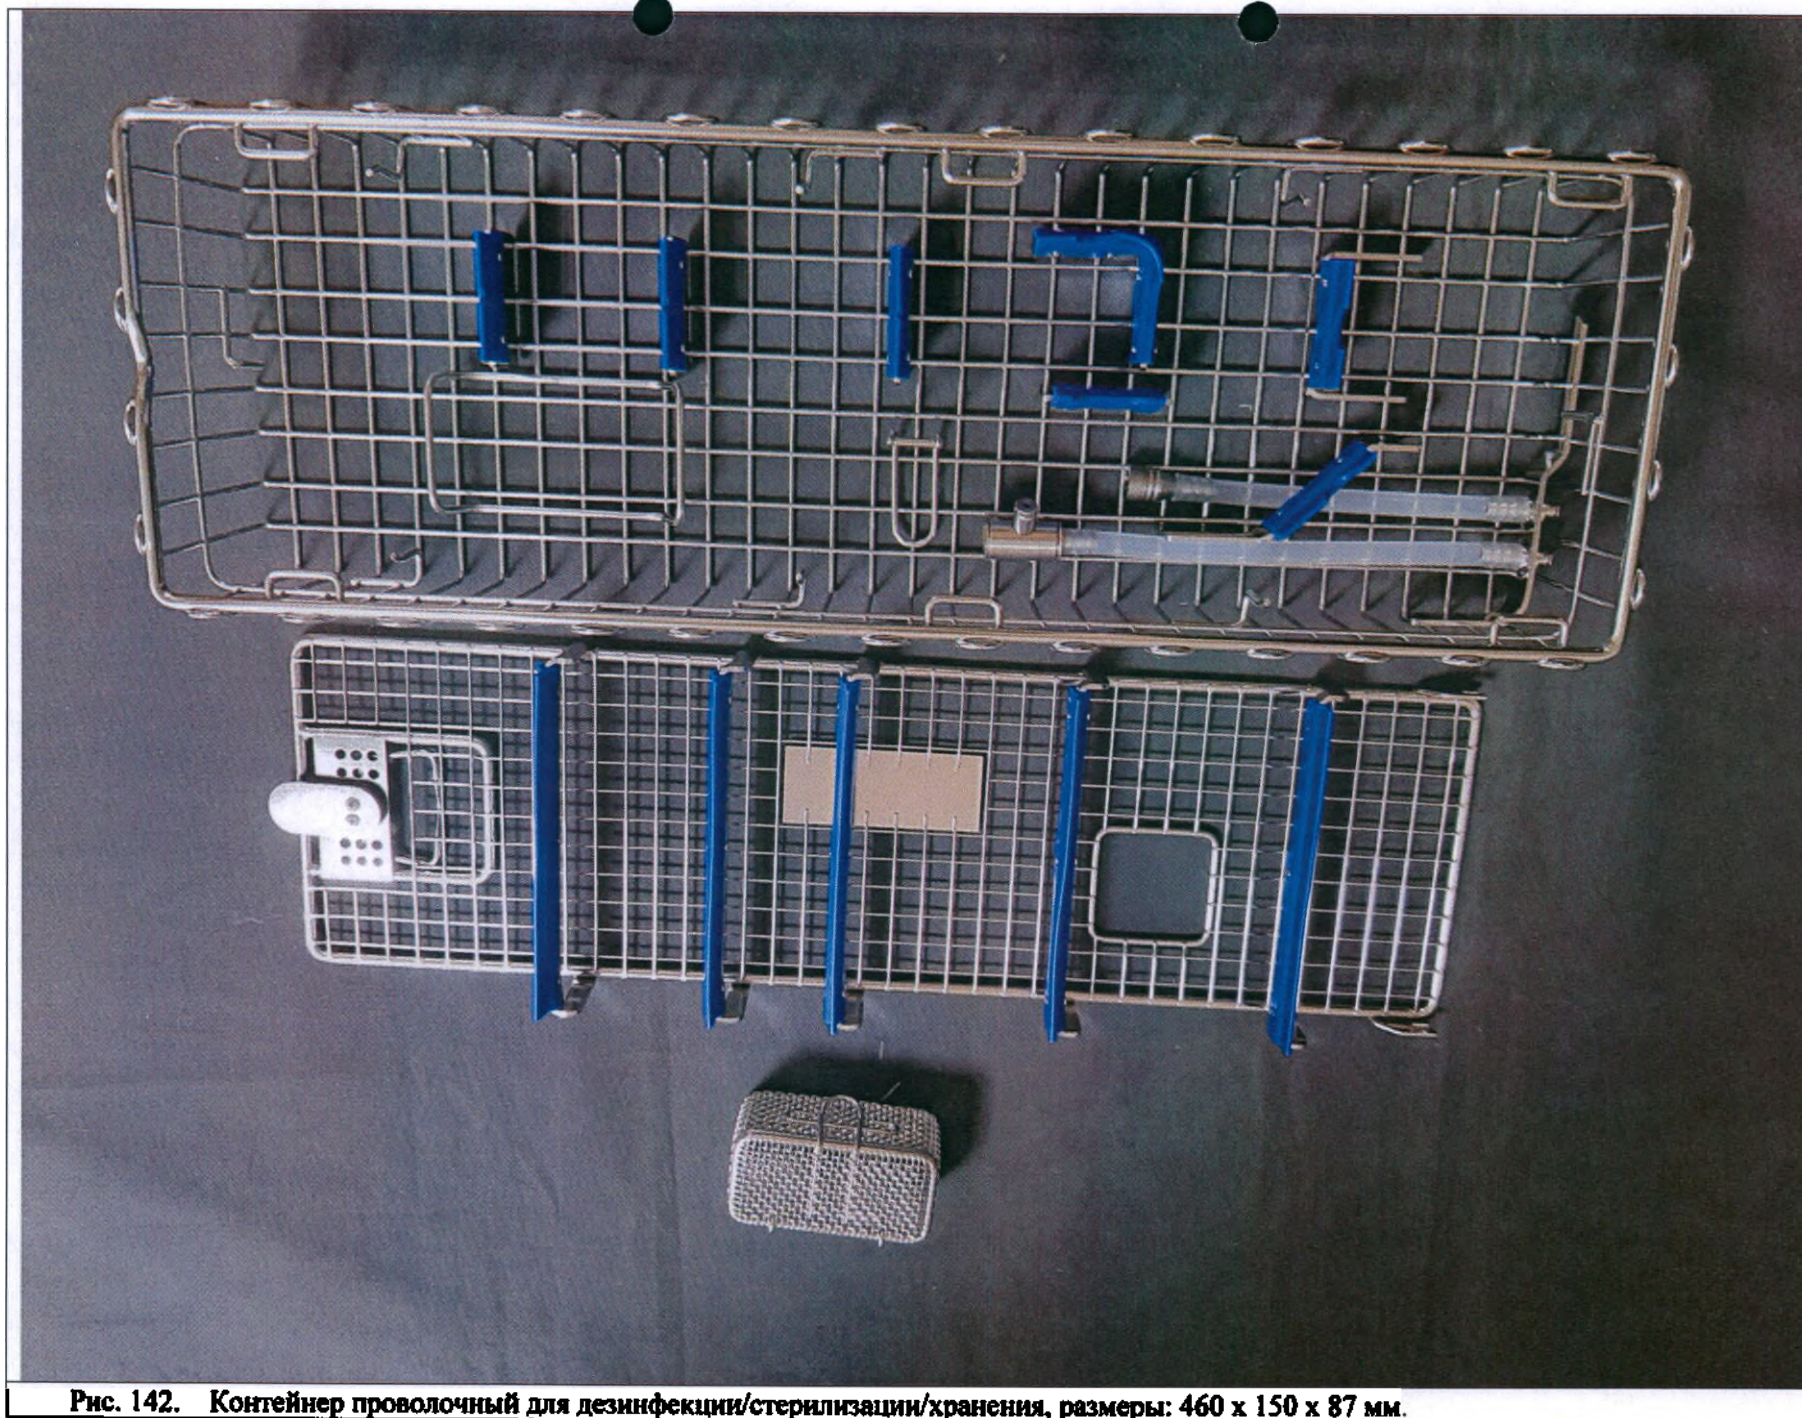


Рис. 142. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 460 x 150 x 87 мм.



Рис. 143. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 460 x 150 x 87 мм.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ ENDOSKOPE

Эндоскоп урологический жесткий HOPKINS в вариантах исполнения с принадлежностями:

Цистоскоп жесткий HOPKINS, типоразмер: направление наблюдения 0°, диаметр 1,9 мм, длина 12 см

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Рис. 144. Пример русскоязычной маркировки на вторичной упаковке, на примере варианта исполнения: Цистоскоп жесткий HOPKINS, типоразмер: направление наблюдения 0°, диаметр 1,9 мм, длина 12 см



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ ENDOSKOPE

Производитель	Karl Storz SE & Co.KG Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Germany (Германия)
Уполномоченный представитель на территории РФ	Общество с ограниченной ответственностью КАРЛ ШТОРЦ – Эндоскопы Восток (ООО КШТЭ ВОСТОК) Россия, 115114, Москва, Дербеневская набережная, 7, стр. 4
Информация о сроке службы	– см. инструкцию по эксплуатации
Сайт	https://www.karlstorz.com/de/ru/index.htm
Сделано в:	Германия

Рис. 145. Пример русскоязычной маркировки на вторичной упаковке, на примере варианта исполнения: Цистоскоп жесткий HOPKINS, типоразмер: направление наблюдения 0°, диаметр 1,9 мм, длина 12 см



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 146
_____ листах