

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

«07» июля 2022 г.




Фотографические изображения изделия:

**Набор реагентов для количественного определения общего тироксина электро-
хемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Total
Thyroxine Kit (Electrochemiluminescence immunoassay) / T4)**



Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd. («Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»),
Китай



Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения общего тироксина электрохемилуминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Total Thyroxine Kit (Electrochemiluminescence immunoassay) / T4))

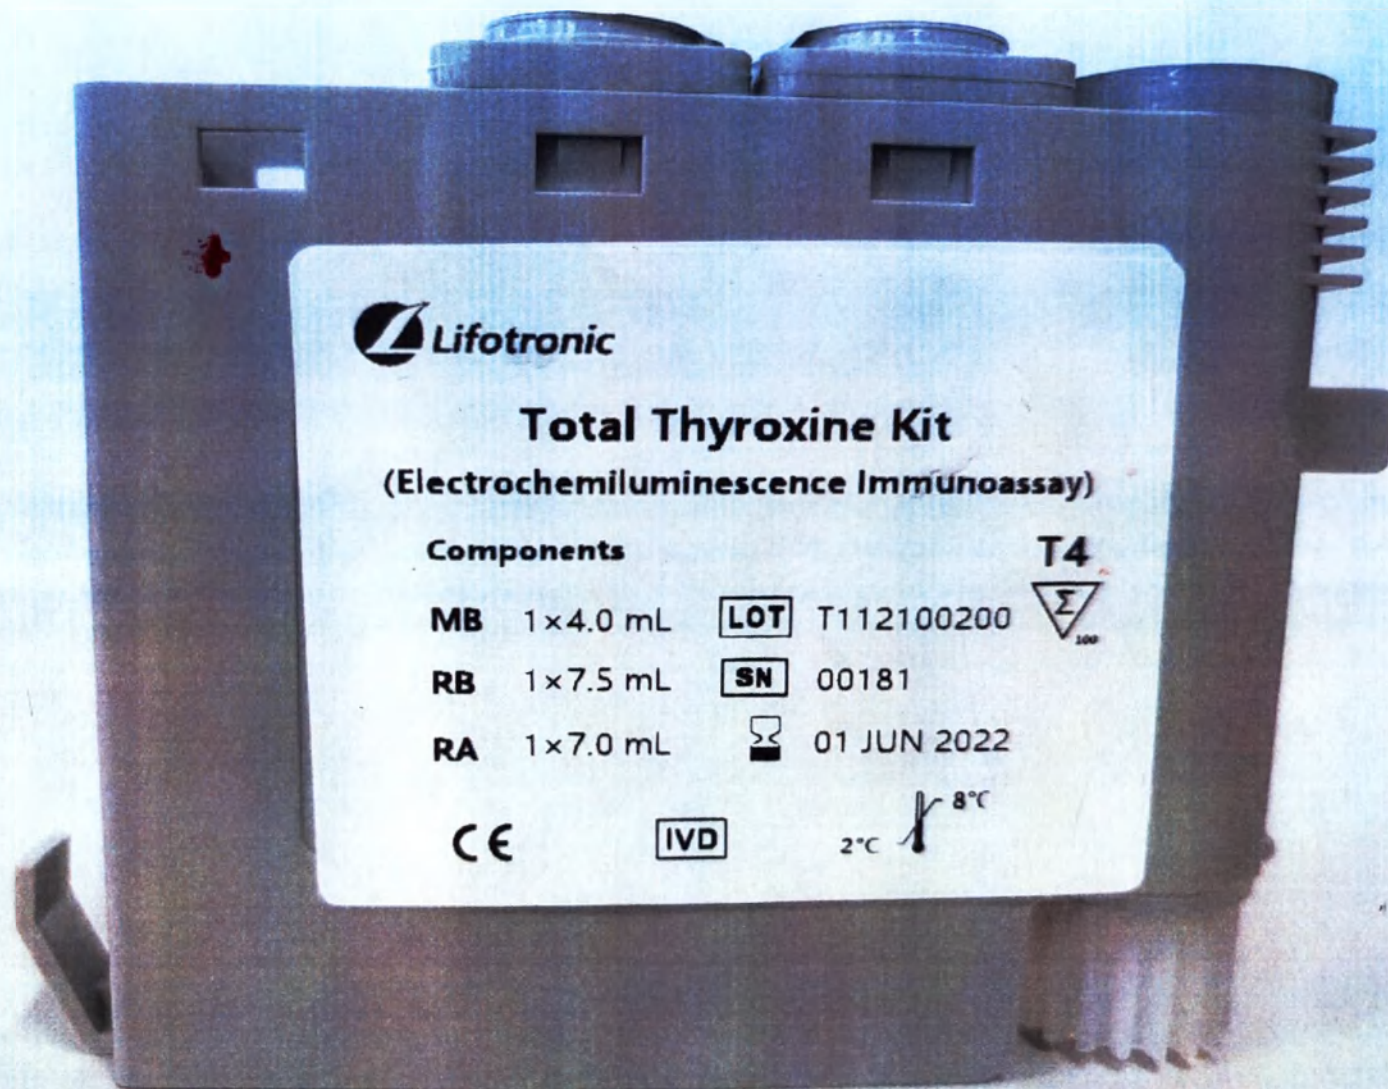


Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения общего тироксина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Total Thyroxine Kit (Electrochemiluminescence immunoassay) / T4))

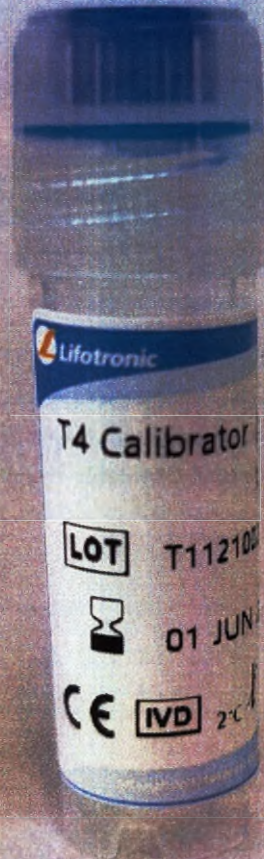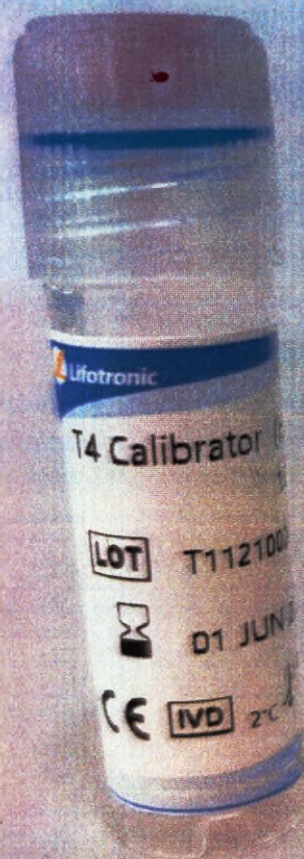



Калибратор (низкий и высокий уровень), Материал контрольный (низкий и высокий уровень) (Набор реагентов для количественного определения общего тироксина электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Total Thyroxine Kit (Electrochemiluminescence immunoassay) / T4))

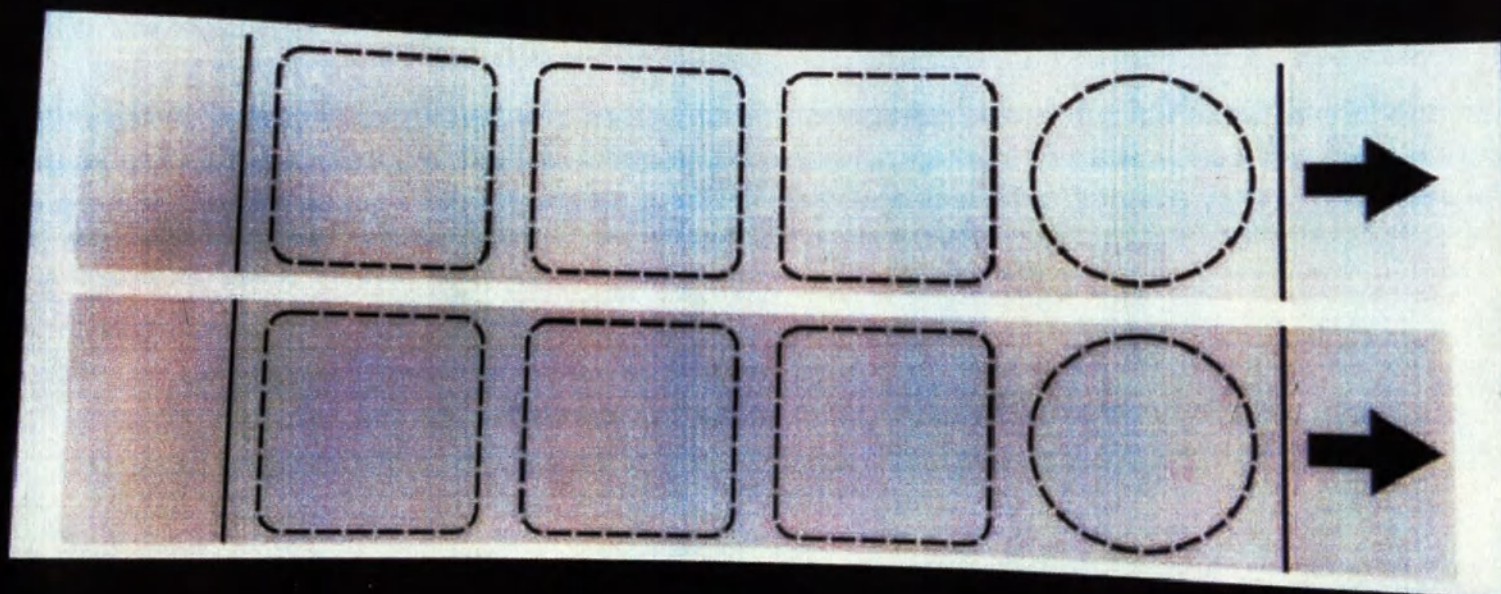


T4 Quality Control

LOT T112100200  01 JUN 2022

QC Range (Low): 36.460-85.080 ng/mL

QC Range (High): 112.100-261.500 ng/mL



Этикетка результатов значений материалов контрольных (Набор реагентов для количественного определения общего тироксина электрохемилюминесцентным методом на

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 7 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А.
М.П.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАЙЛО Р. В.