

«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «Мерит Текнолоджис»**



Шаламов А.В.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**«Набор для ангиографии в вариантах исполнения:
basixTOUCH, basixCOMPAK, Blue Diamond, BIG60, DiamondTOUCH, MAP»**

Merit Medical Systems, Inc. («Мерит Медикал Системз, Инк.»), США


1600 West Merit Parkway South Jordan, Utah, 84095, USA.

1. Набор для ангиографии basixTOUCH, в составе:

1.1. Индефлятор basixTOUCH


1.2. Трехходовой краник

1.3. Инструкция по эксплуатации.

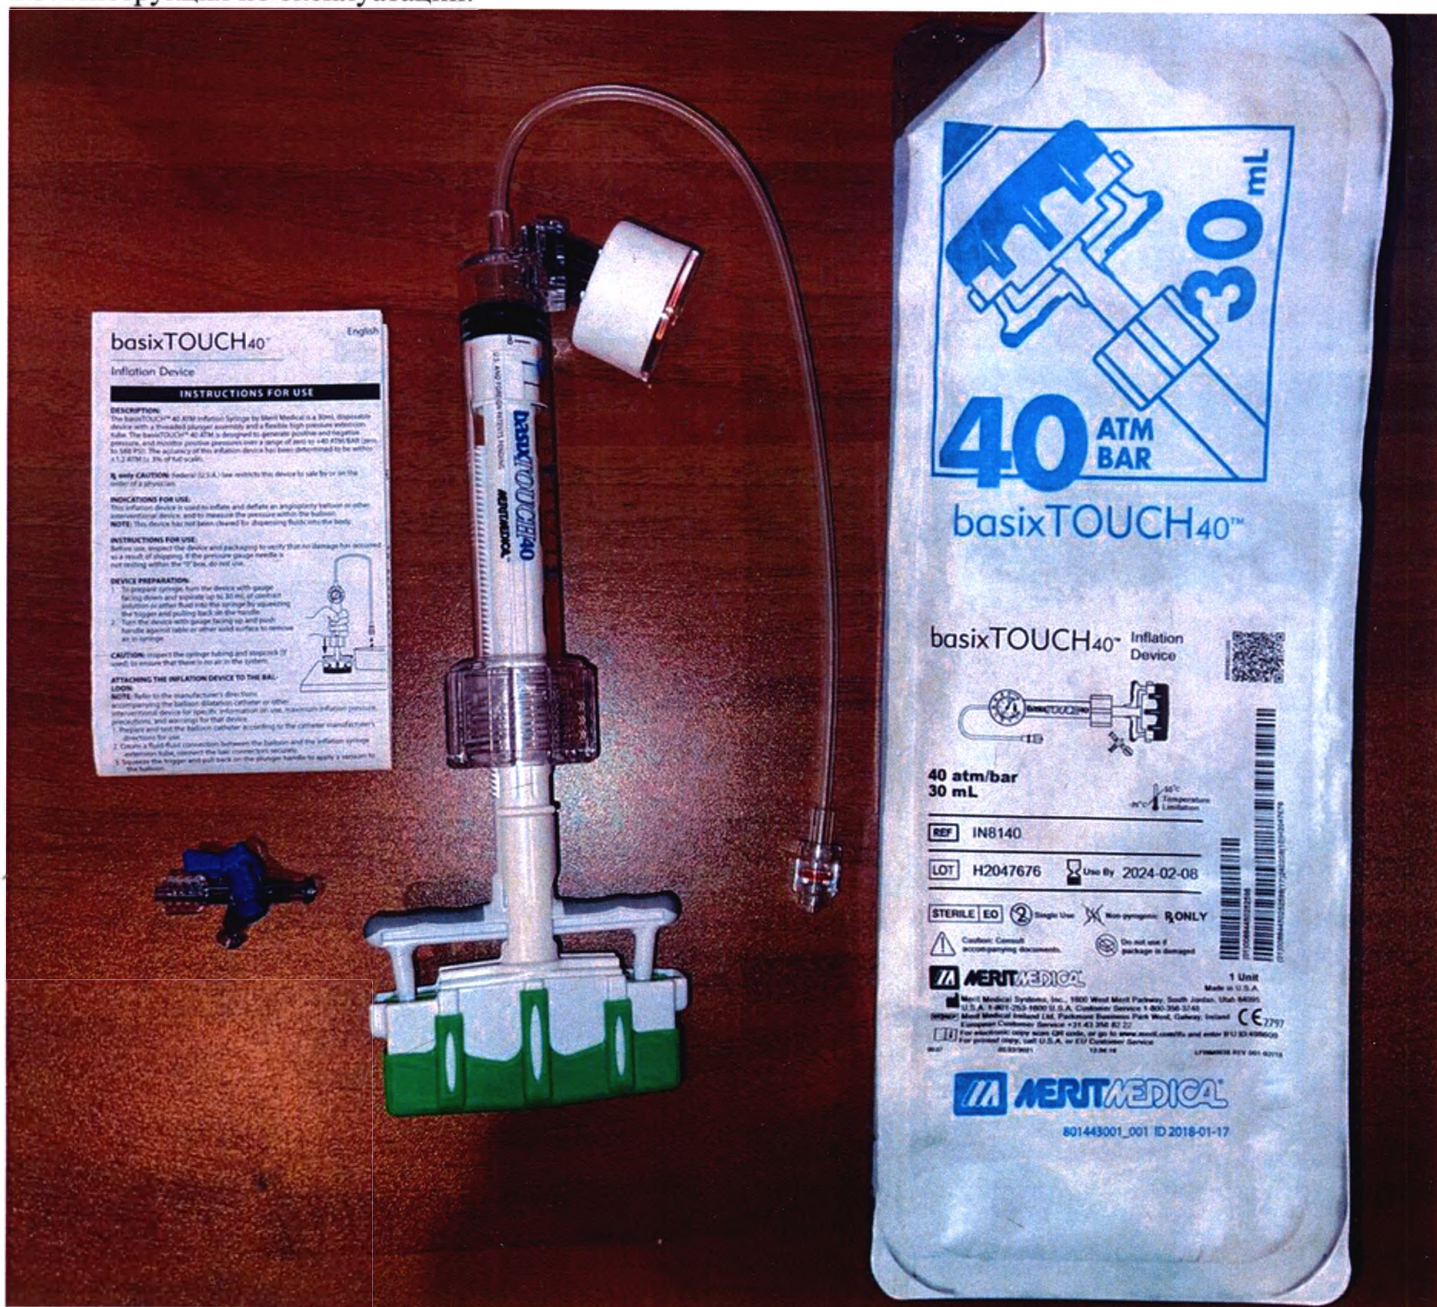


Общий вид изделия

Индефлятор basixTOUCH

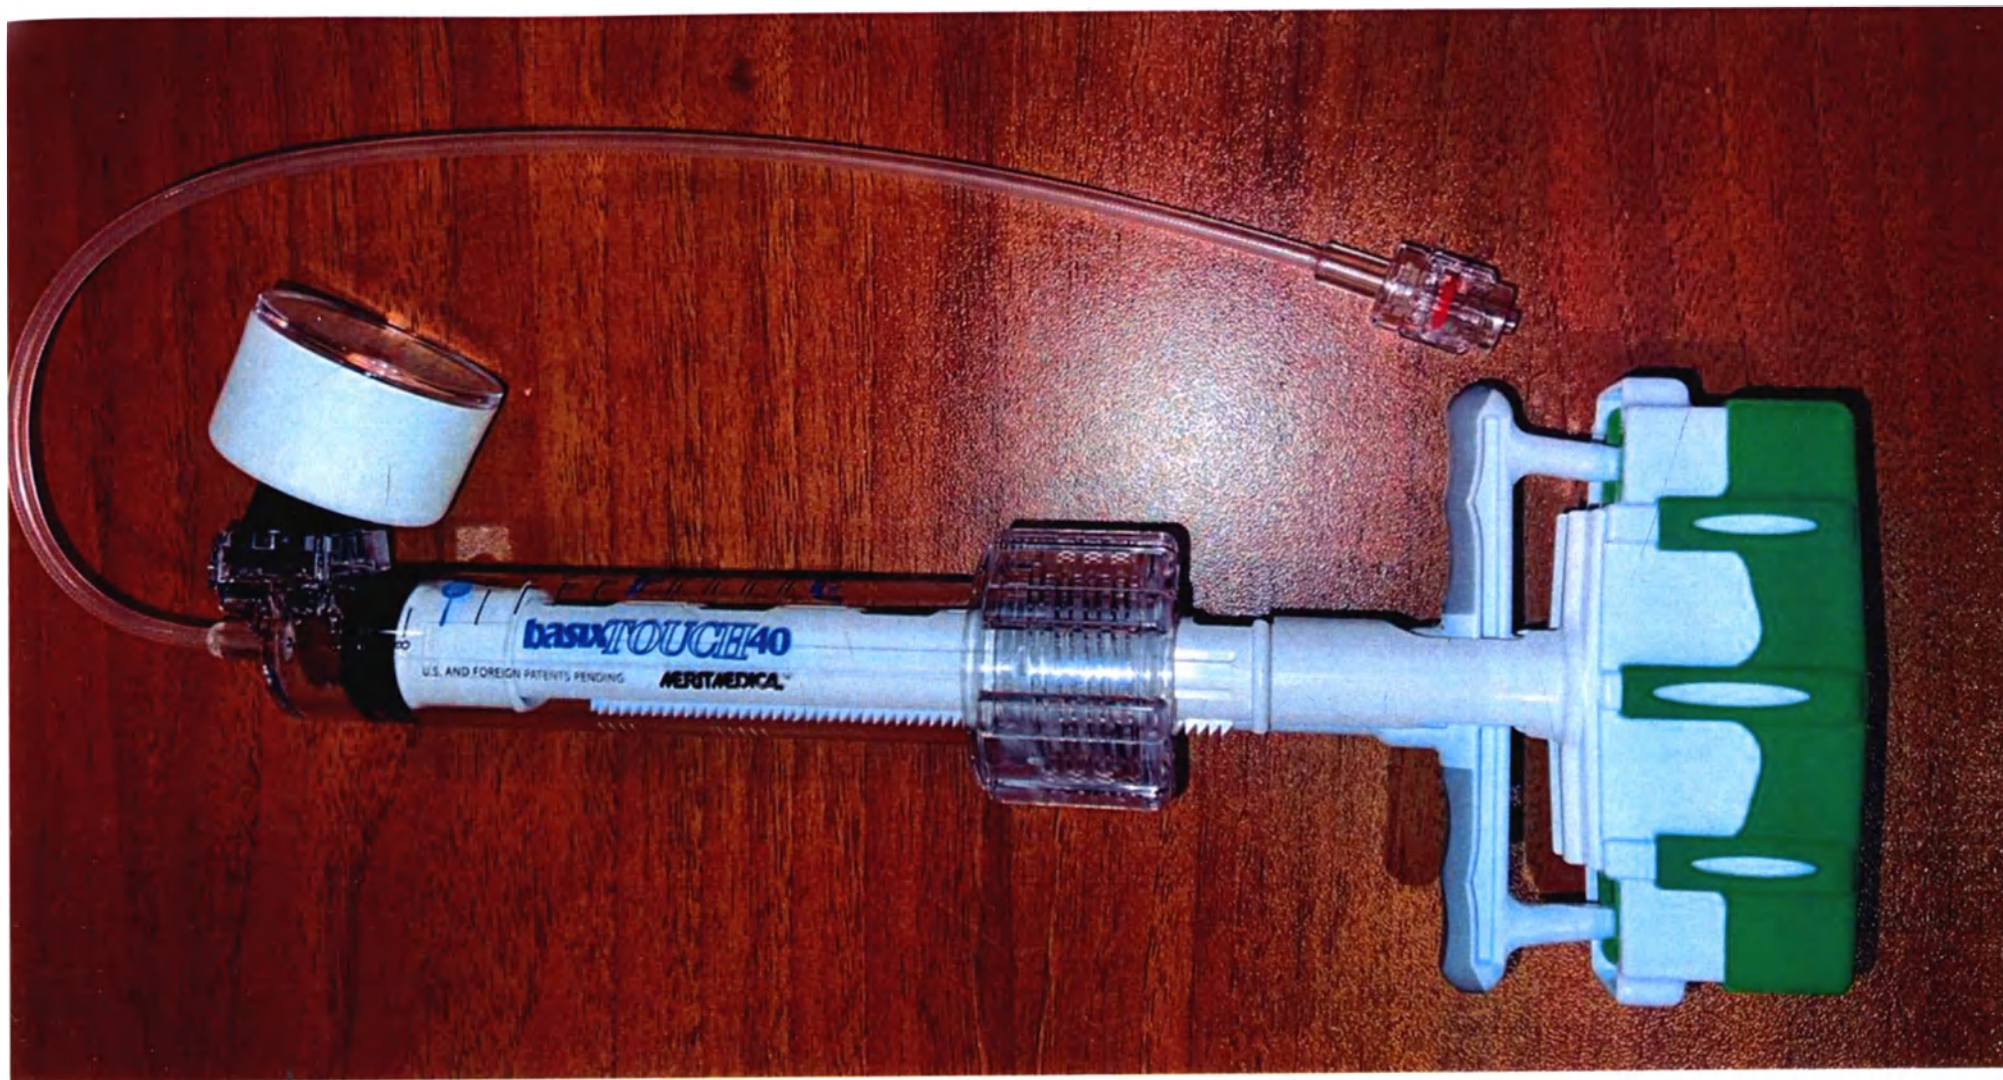


2. Набор для ангиографии basixCOMPAK, в составе:

- 2.1. Индефлятор basixCOMPAK
- 2.2. Трехходовой краник – 2 шт.
- 2.3. Устройство для введения проводника
- 2.4. Устройство для вращения проводника
- 2.5. Гемостатический клапан Honoor
- 2.6. Удлинительная линия
- 2.7. Инструкция по эксплуатации.

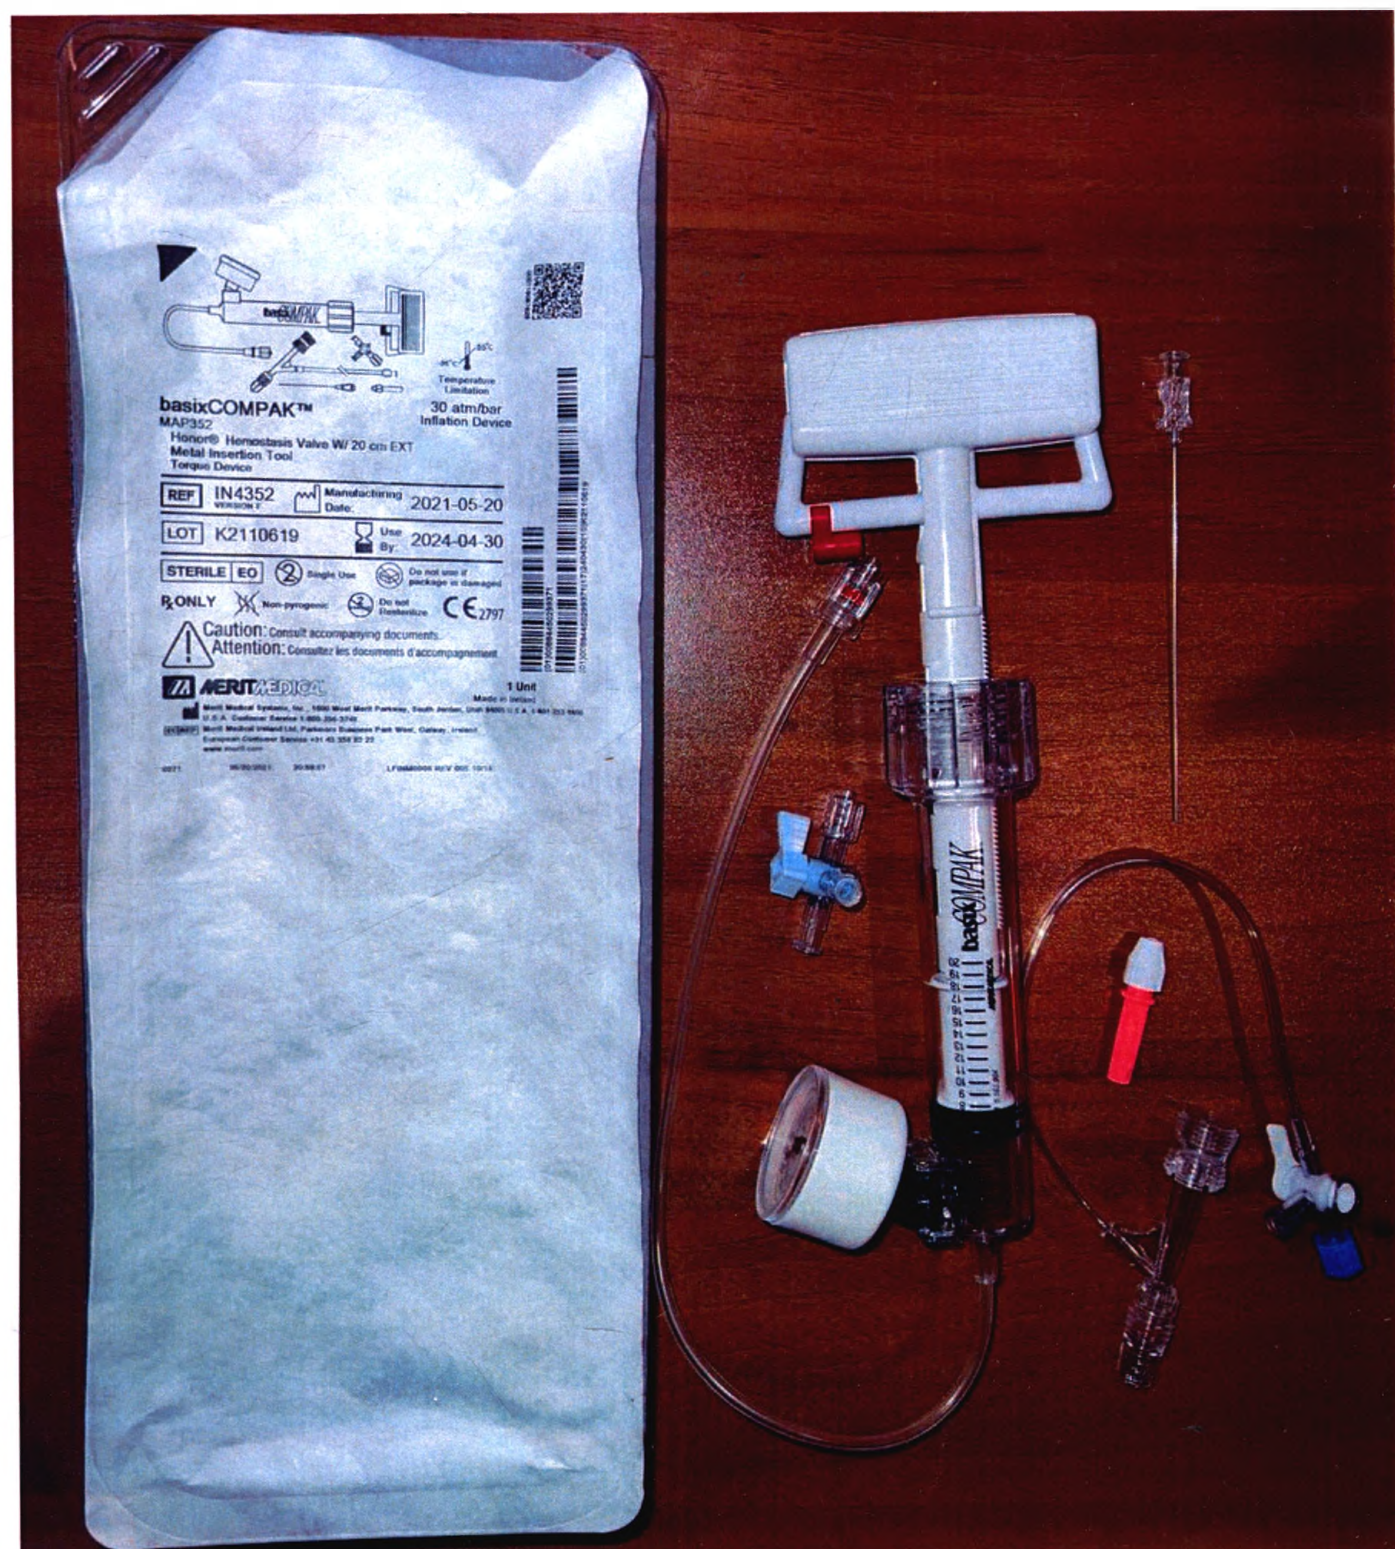

Общий вид изделия

Индефлятор basixCOMPAK

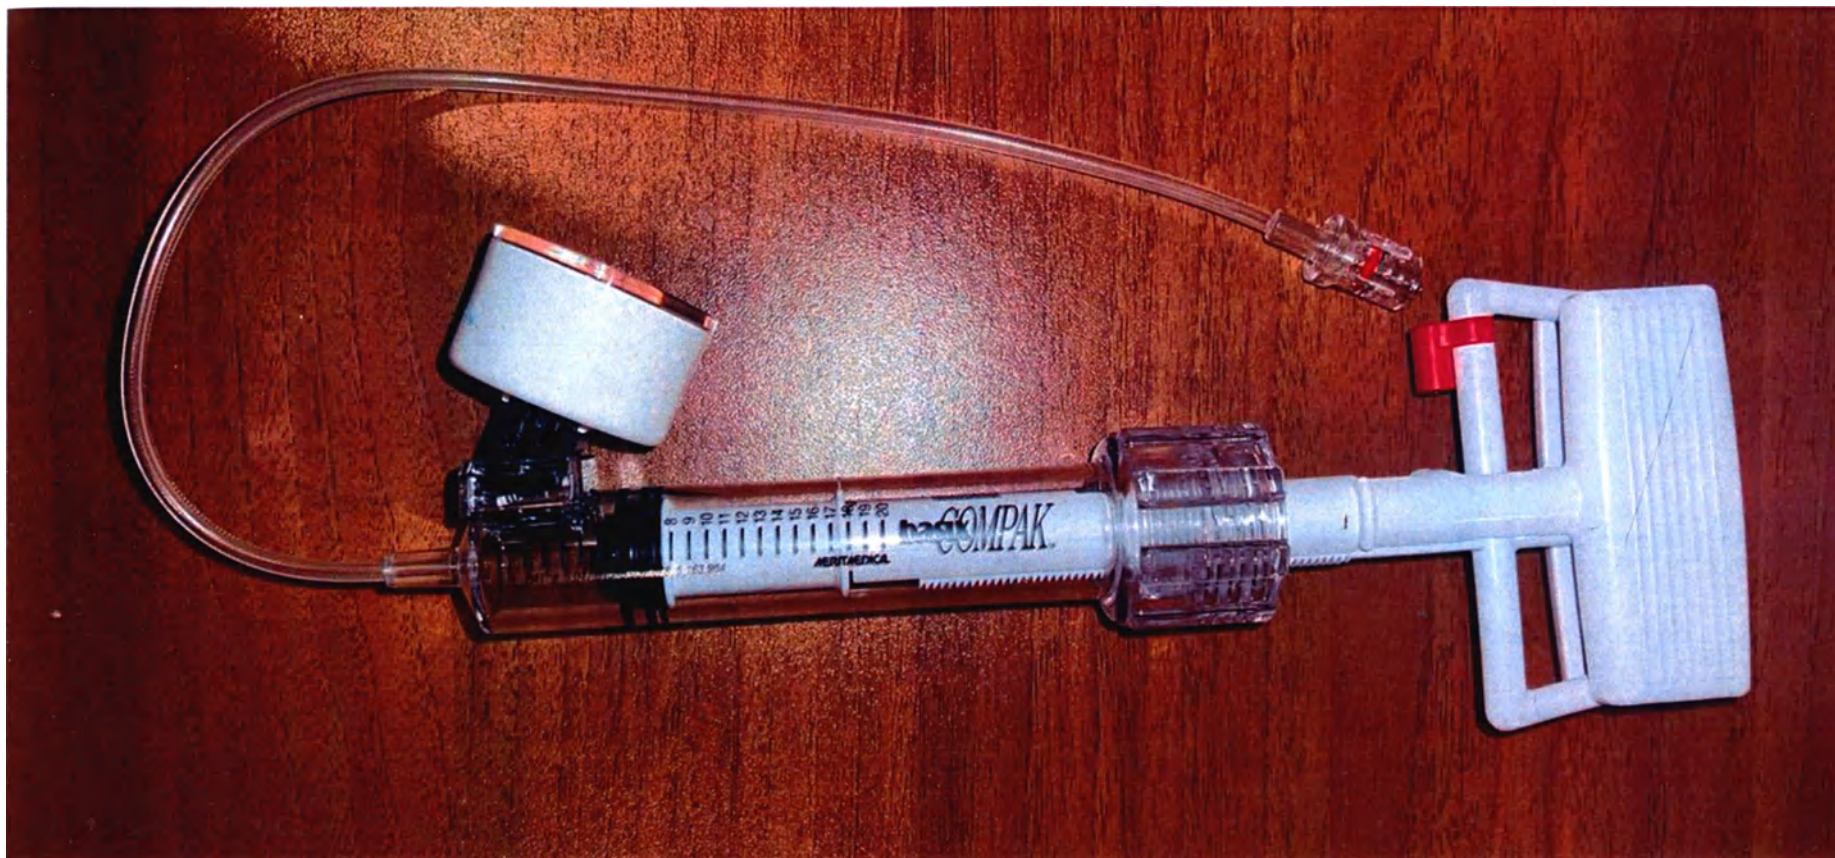

3. Набор для ангиографии Blue Diamond, в составе:

3.1 Индефлятор Blue Diamond

3.2 Гемостатический клапан Access-9


3.3. Устройство для введения проводника

3.4. Устройство для вращения проводника



Общий вид изделия

Индефлятор Blue Diamond

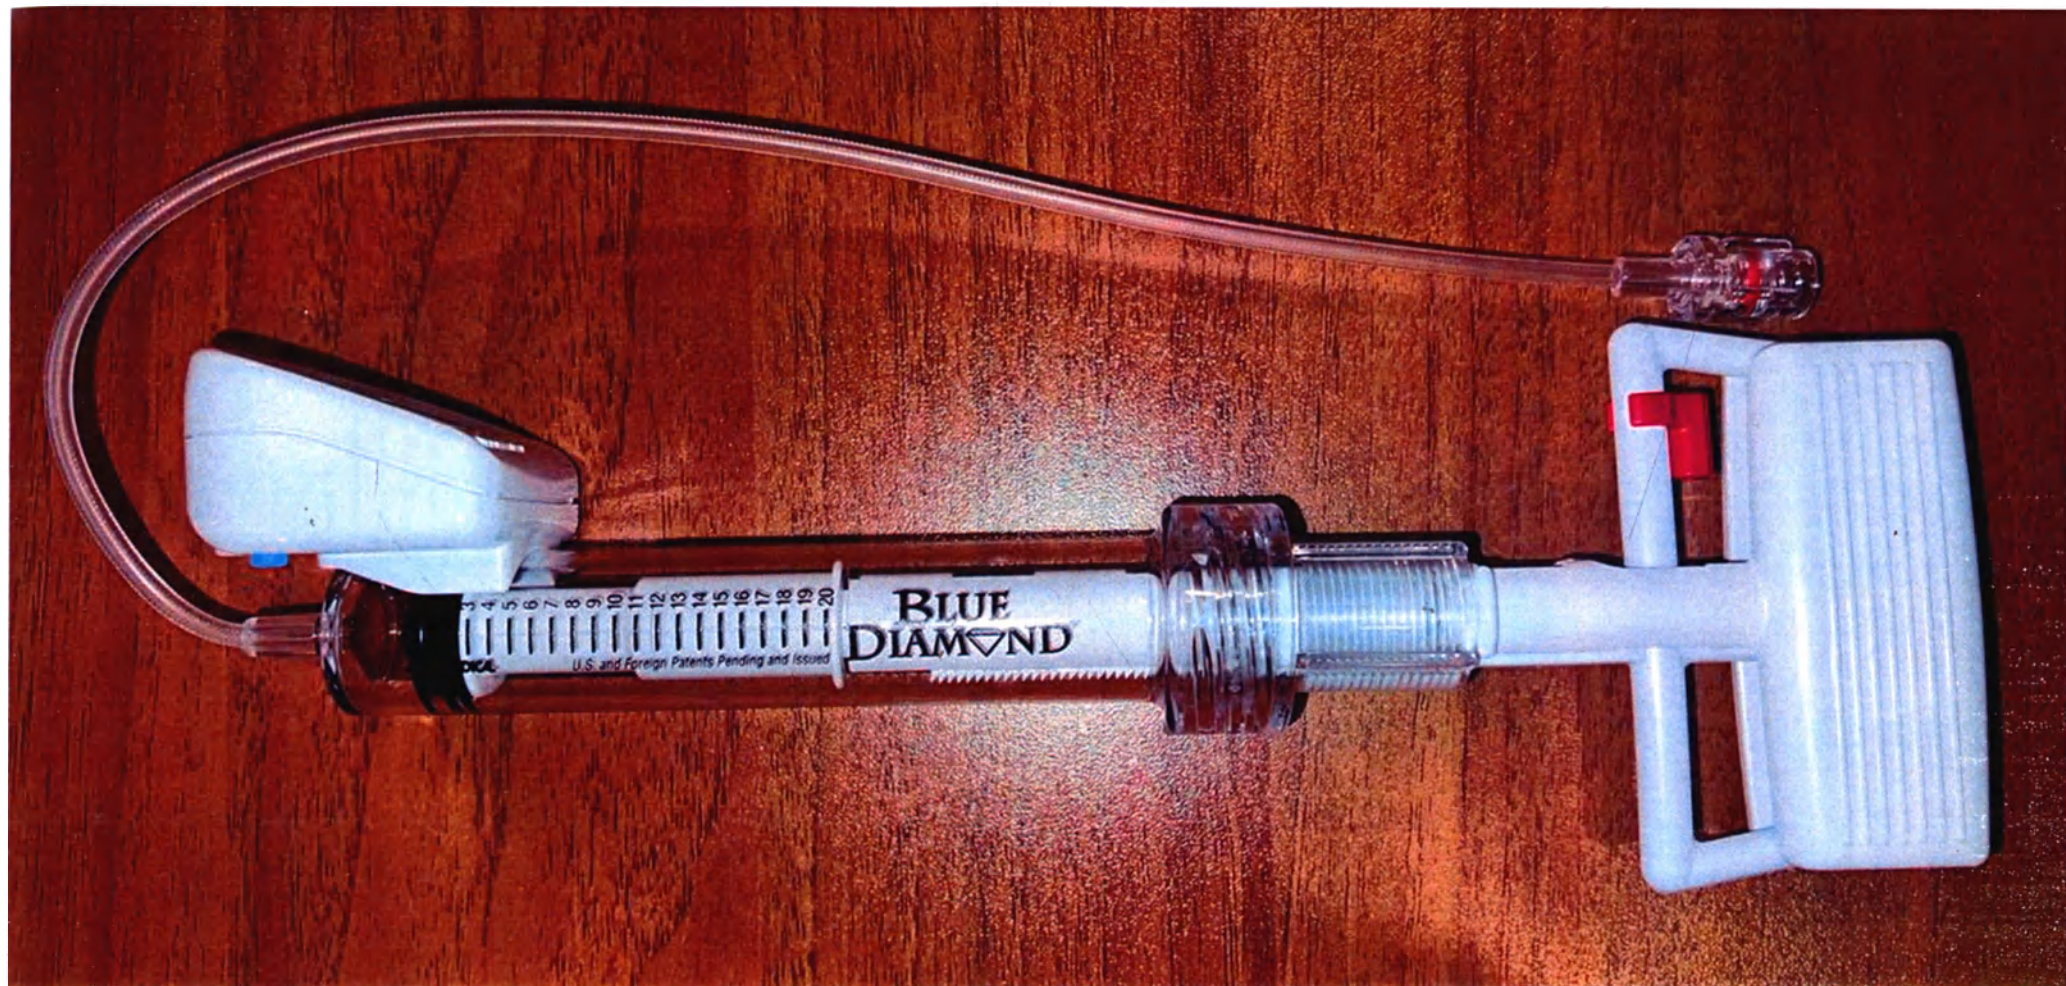

4. Набор для ангиографии BIG60, в составе:

4.1. Индефлятор BIG60

4.2. Трехходовой краник

4.3. Инструкция по эксплуатации.



Общий вид изделия

индефлятор BIG60



5. Набор для ангиографии DiamondTOUCH, в составе:

5.1. Индефлятор DiamondTOUCH


5.2. Трехходовой краник

5.3. Устройство для введения проводника

5.4. Устройство для вращения проводника


5.5. Гемостатический клапан AccessPLUS

5.6. Инструкция по эксплуатации.

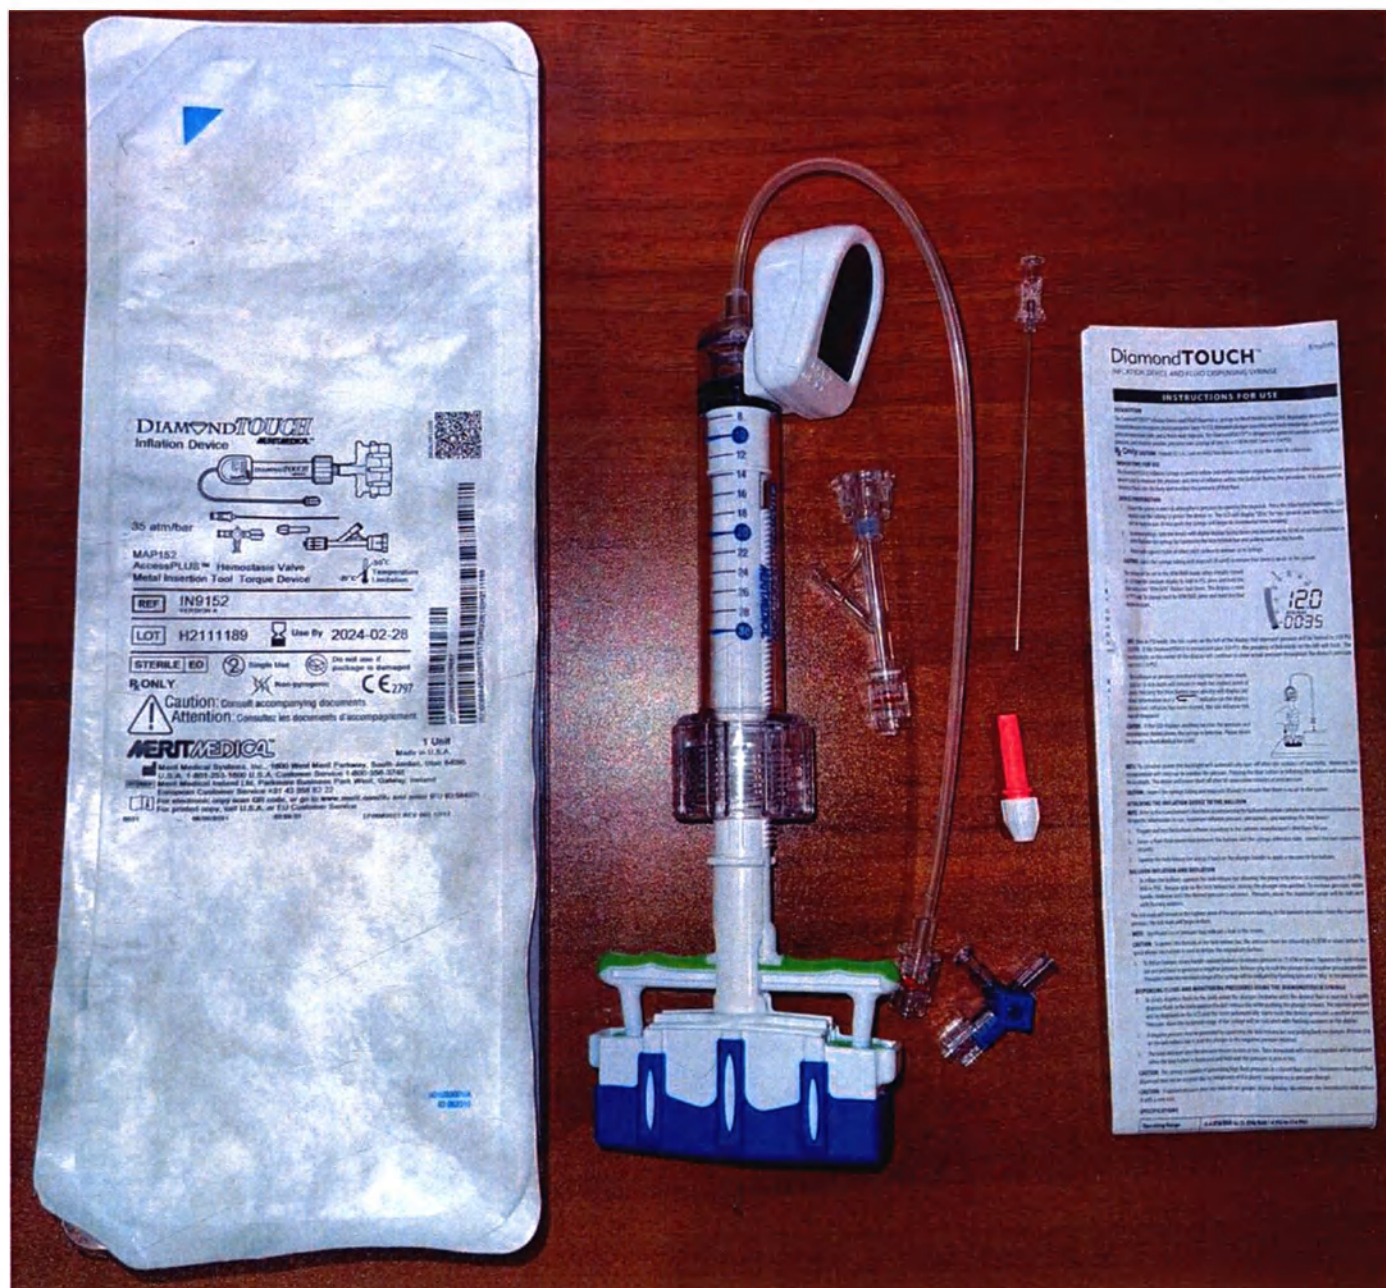

Общий вид изделия

индефлятор DiamondTOUCH

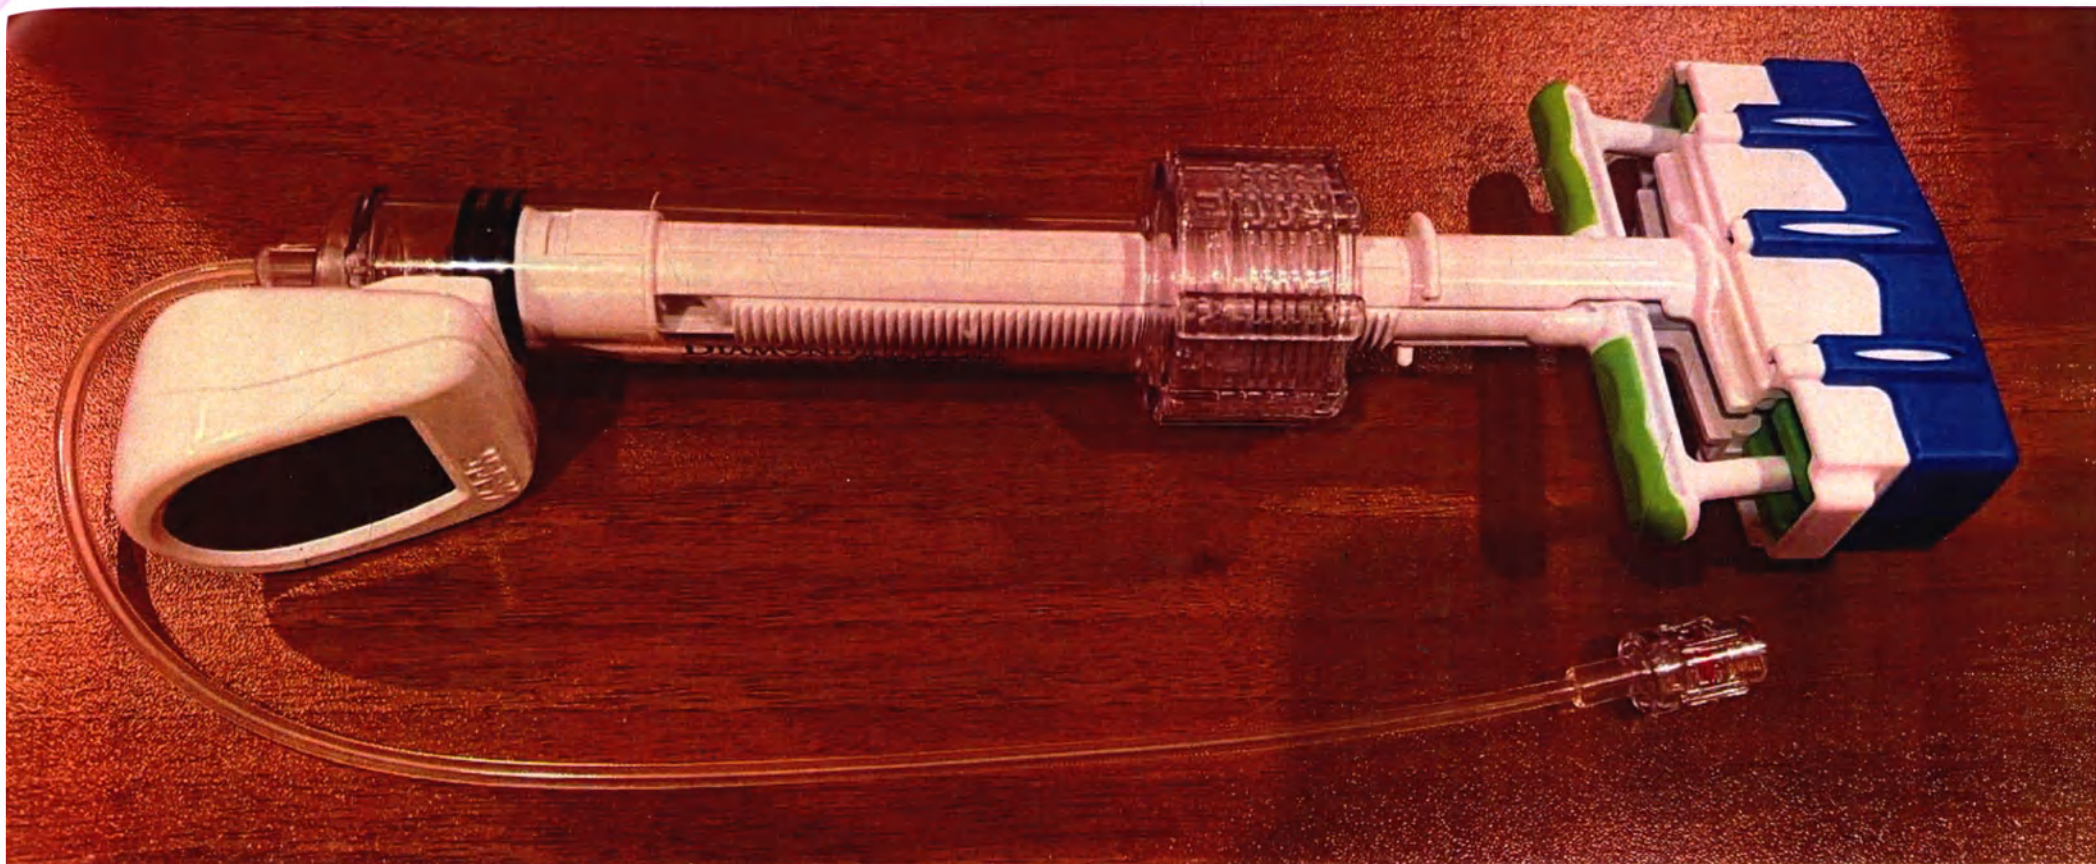


6. Набор для ангиографии MAP, в составе:

6.1. Гемостатический клапан FLO50

6.2. Устройство для введения проводника


6.3. Устройство для вращения проводника

6.4. Инструкция по эксплуатации.

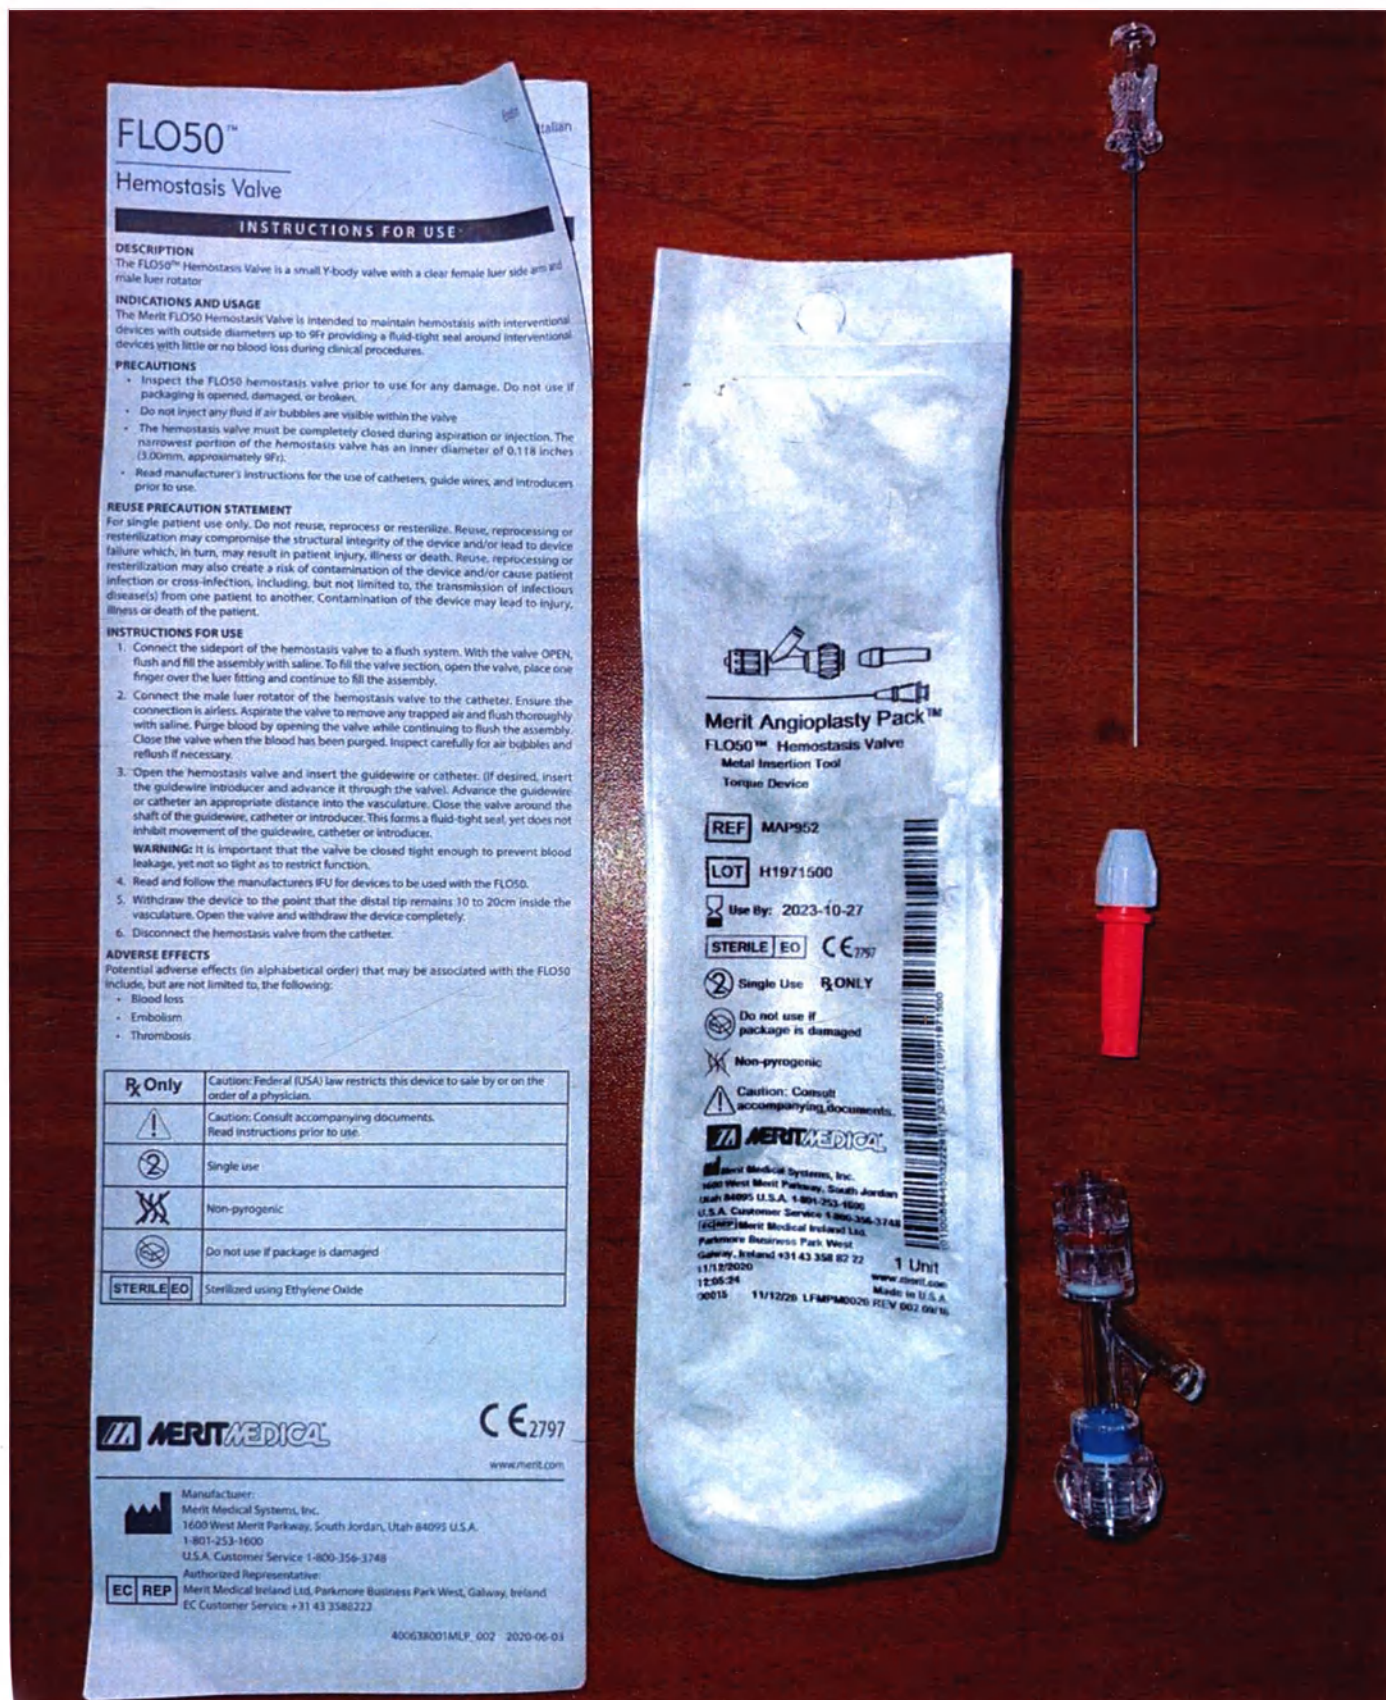


Общий вид изделия

7. Набор для ангиографии MAP, в составе:
 - 7.1. Гемостатический клапан Honor
 - 7.2. Удлинительная линия
 - 7.3. Трехходовой краник
 - 7.4. Устройство для введения проводника
 - 7.5. Инструкция по эксплуатации.

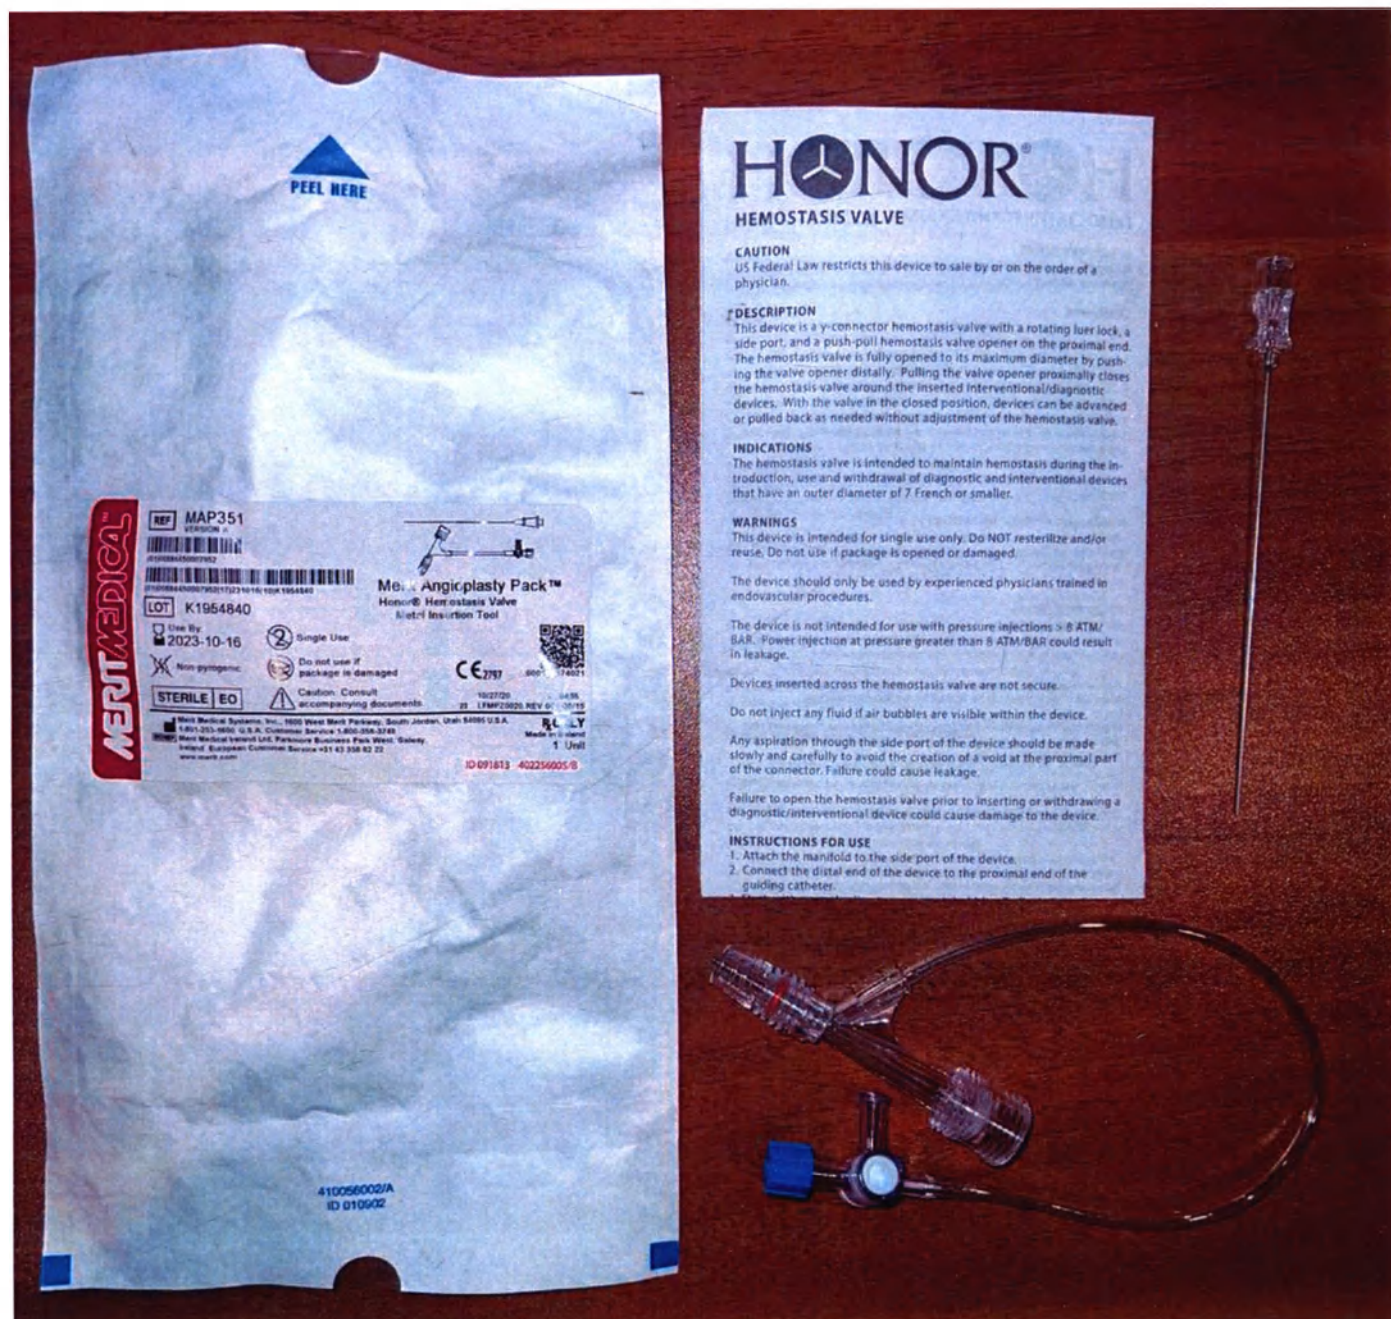

Общий вид изделия

8. Набор для ангиографии MAP, в составе:
 - 8.1. Гемостатический клапан FLO40XR
 - 8.2. Удлинительная линия
 - 8.3. Устройство для введения проводника
 - 8.4. Устройство для вращения проводника
 - 8.5. Инструкция по эксплуатации.

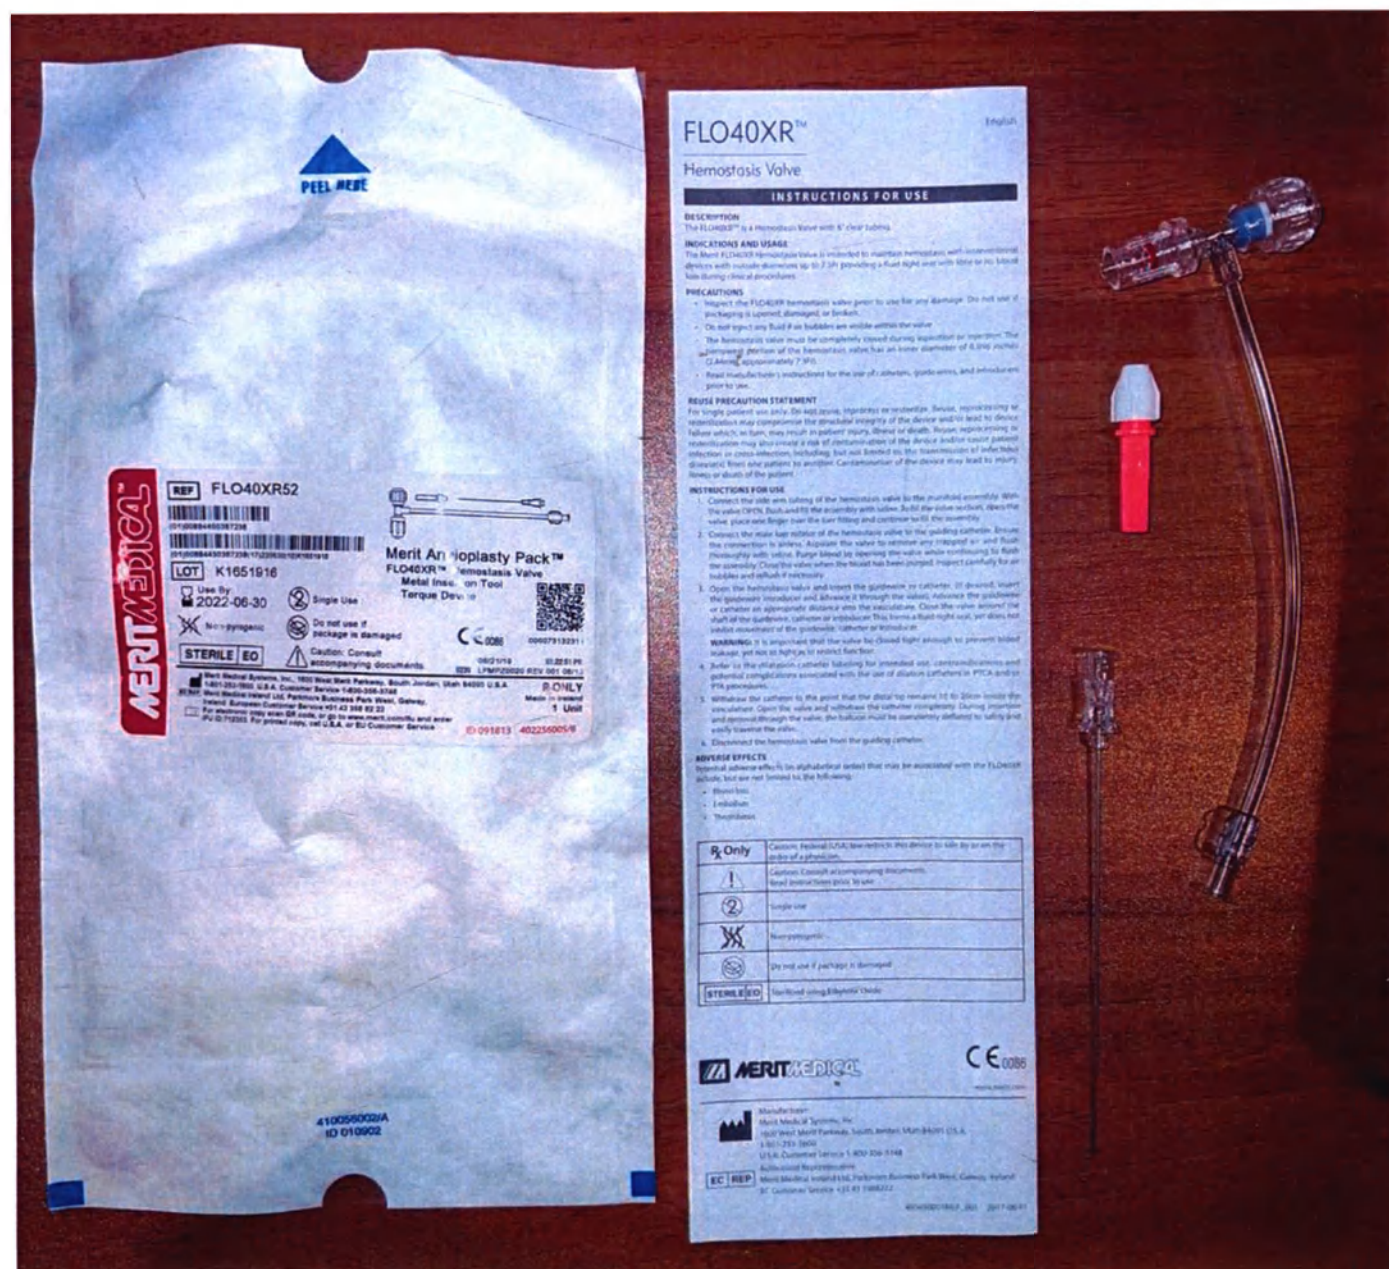

Общий вид изделия

9. Набор для ангиографии МАР, в составе:


9.1. Гемостатический клапан МВА

9.2. Удлинительная линия

9.3. Устройство для введения проводника


9.4. Устройство для вращения проводника

9.5. Инструкция по эксплуатации.

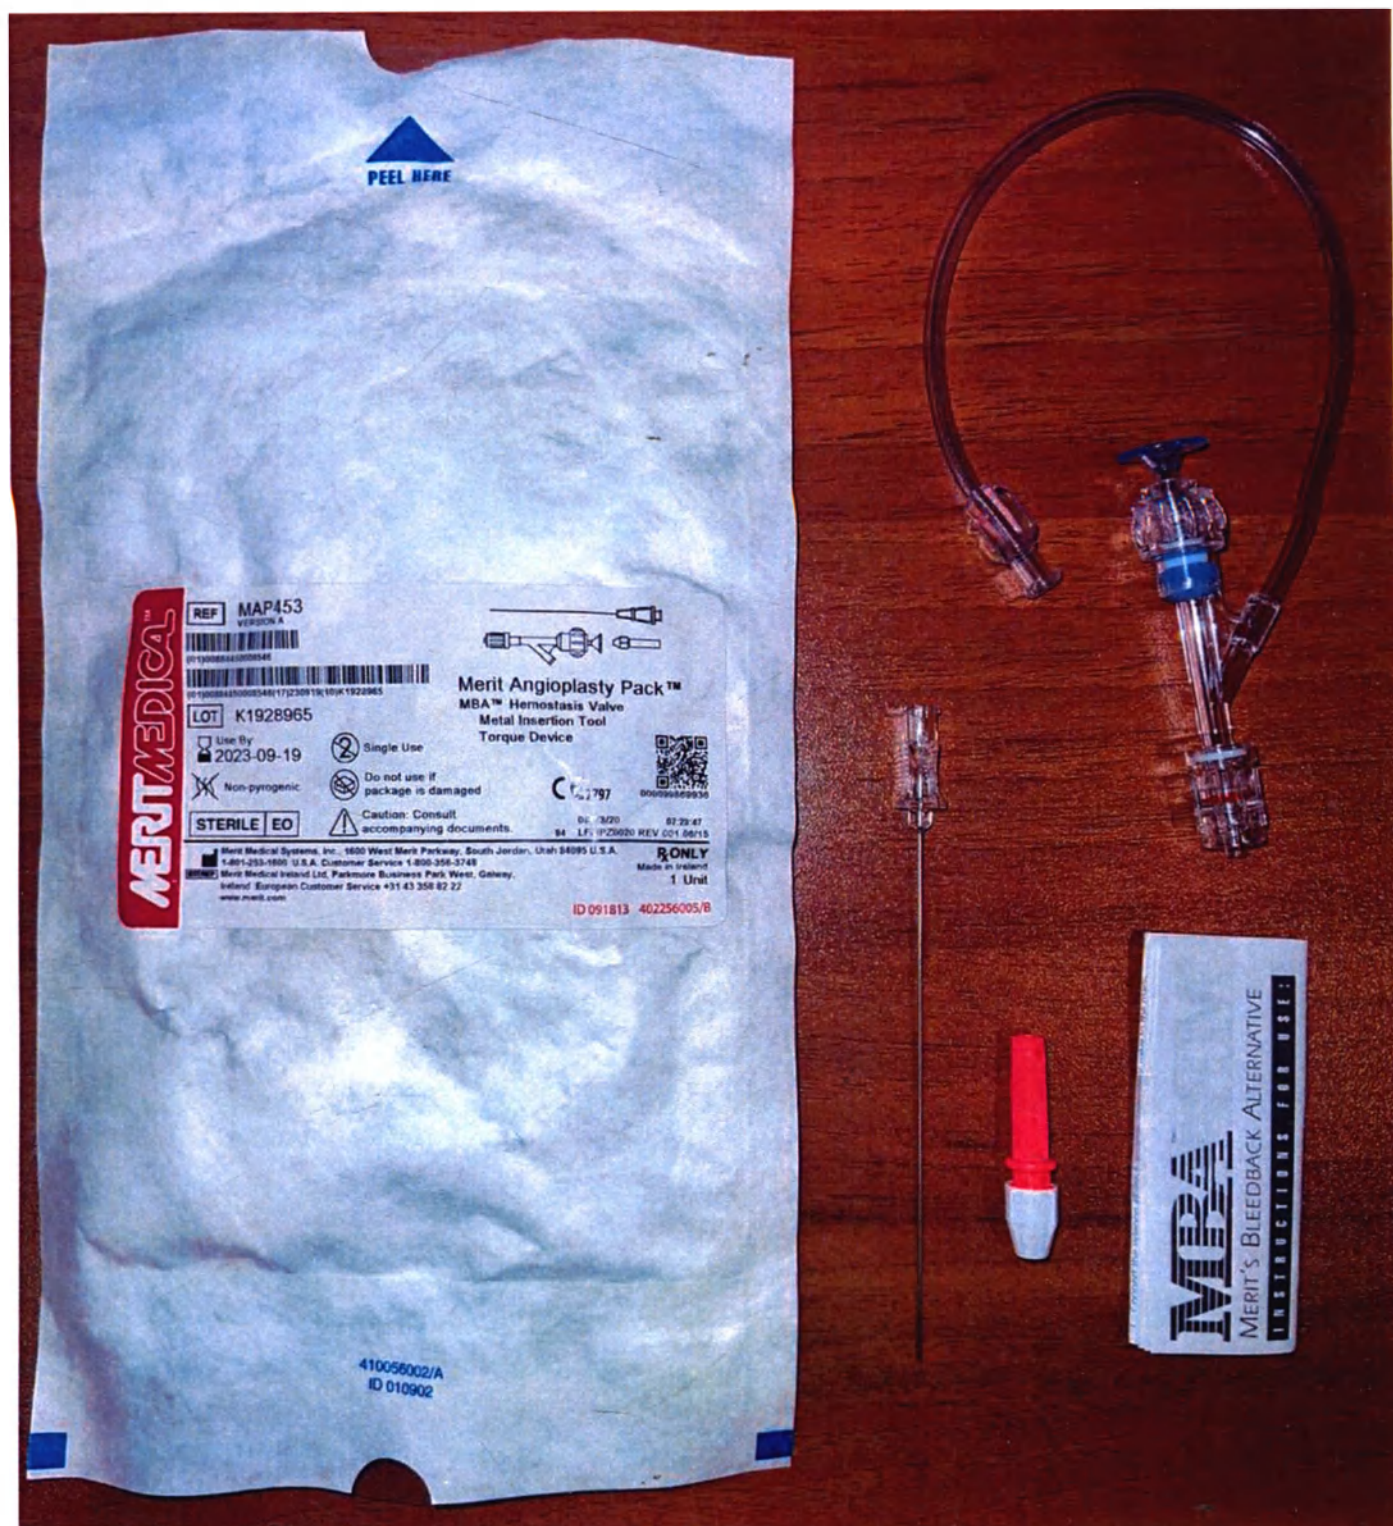

Общий вид изделия

10. Набор для ангиографии MAP, в составе:
- 10.1. Гемостатический клапан Access-9
- 10.2. Устройство для введения проводника
- 10.3. Устройство для вращения проводника
- 10.4. Инструкция по эксплуатации.

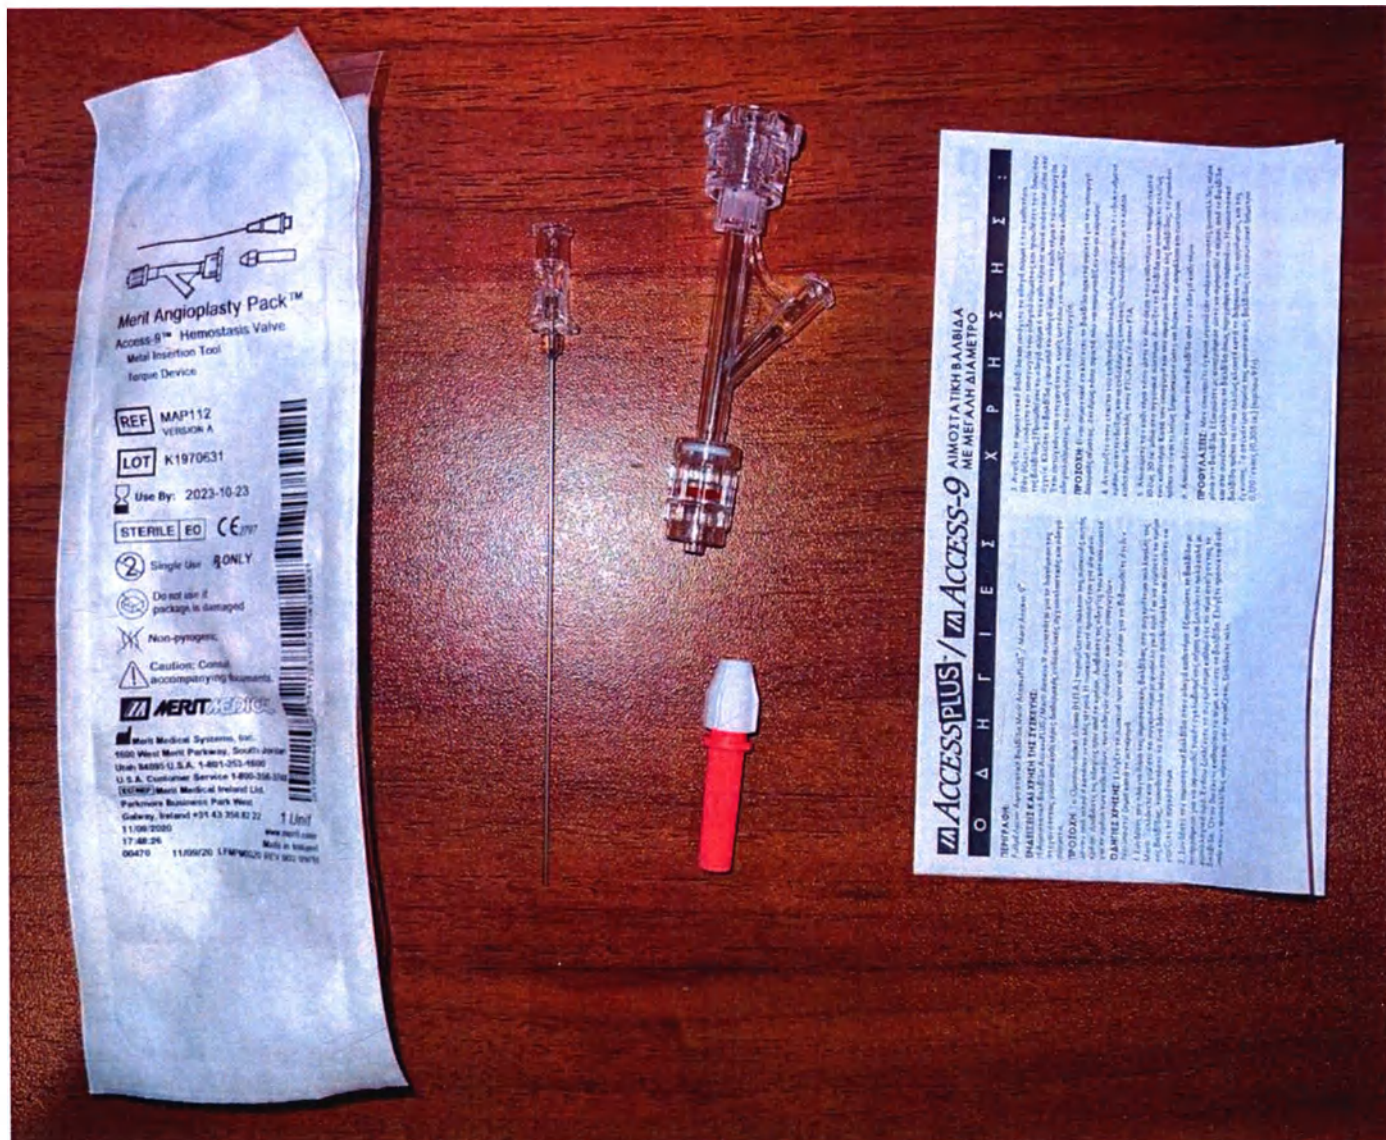


Общий вид изделия

- 11. Набор для ангиографии МАР, в составе:
 - 11.1. Гемостатический клапан МВА
 - 11.2. Устройство для введения проводника
 - 11.3. Устройство для вращения проводника
 - 11.4. Инструкция по эксплуатации.



Общий вид изделия

12. Набор для ангиографии MAP, в составе:
- 12.1. Гемостатический клапан Double Play
 - 12.2. Устройство для введения проводника
 - 12.4. Устройство для вращения проводника – 2шт.
 - 12.5. Инструкция по эксплуатации.

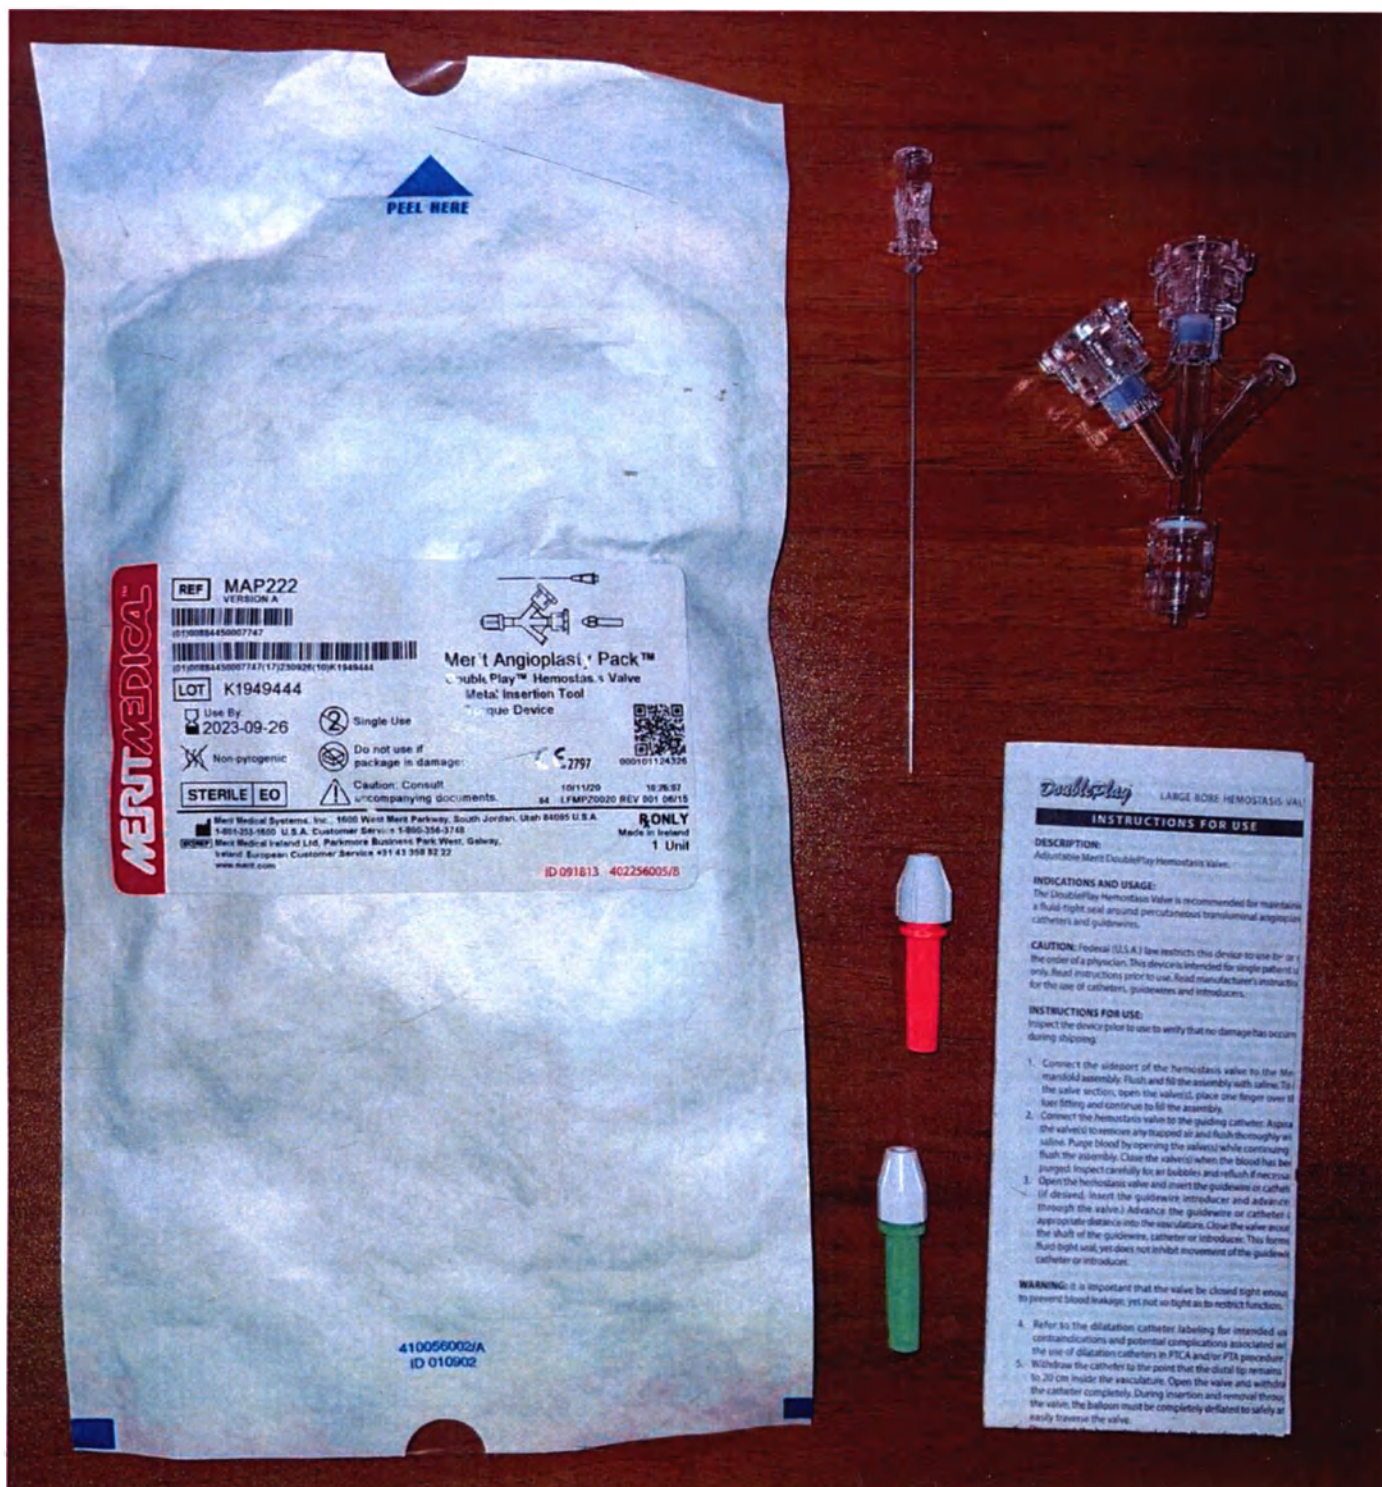


Общий вид изделия

13. Набор для ангиографии MAP, в составе:

13.1. Гемостатический клапан PhD


13.2. Устройство для введения проводника

13.3. Инструкция по эксплуатации.

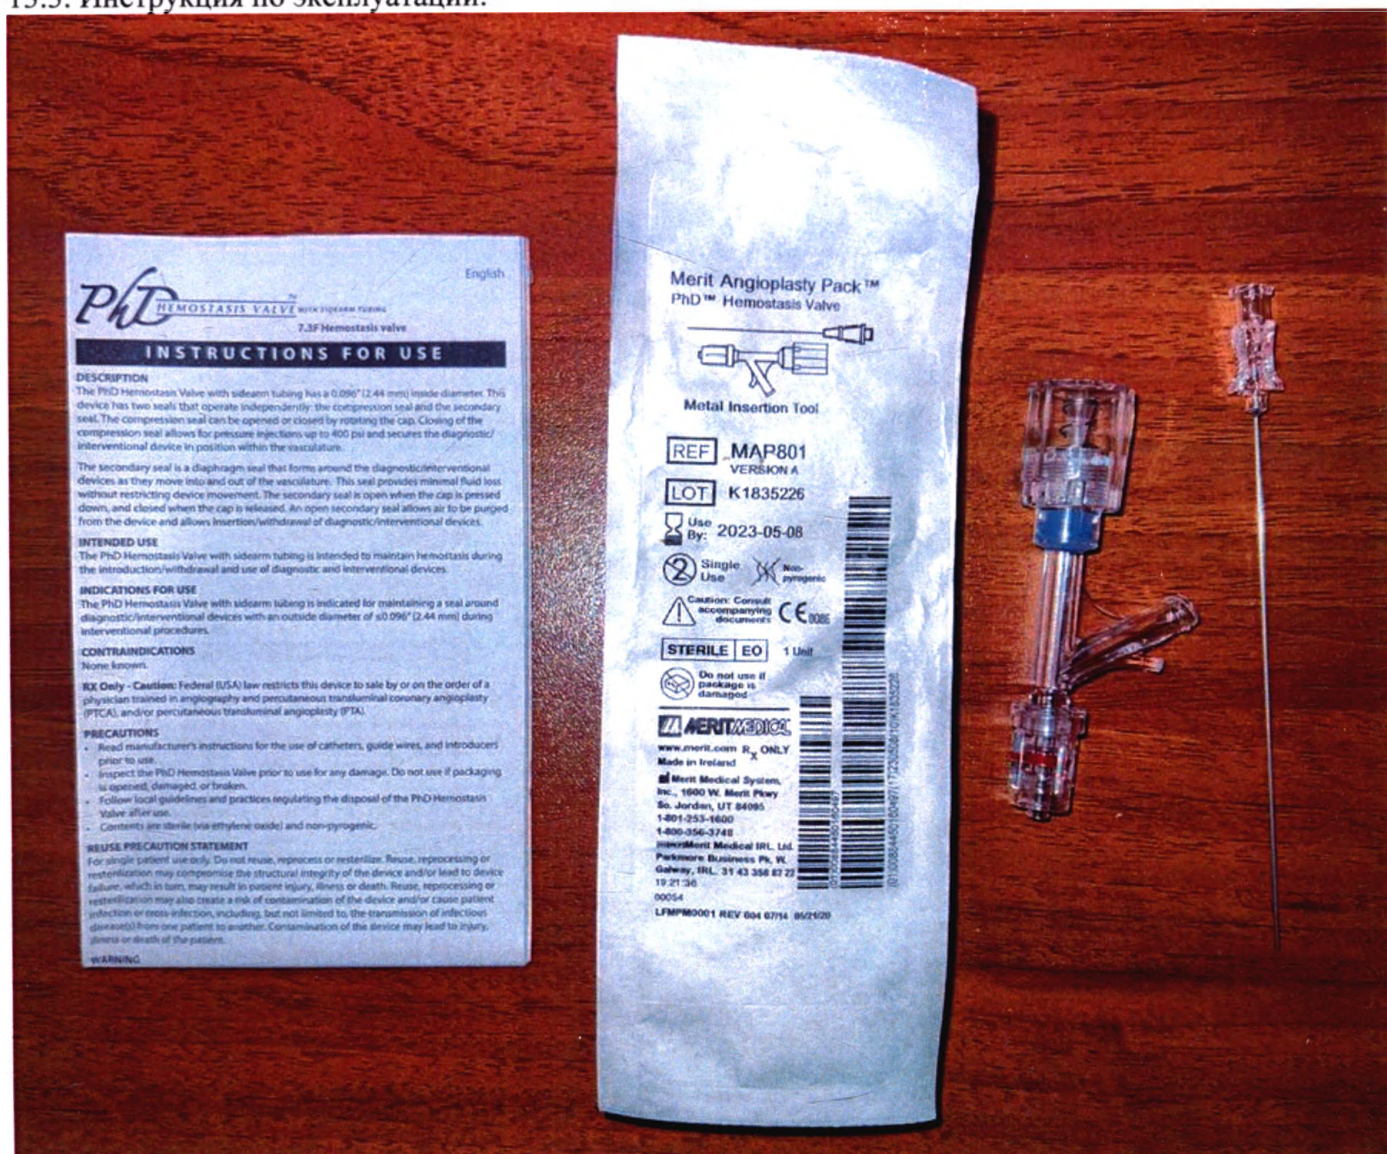

Общий вид изделия

14. Набор для ангиографии MAP, в составе:
- 14.1. Гемостатический клапан Passage
- 14.2. Устройство для введения проводника
- 14.3. Устройство для вращения проводника
- 14.4. Инструкция по эксплуатации.

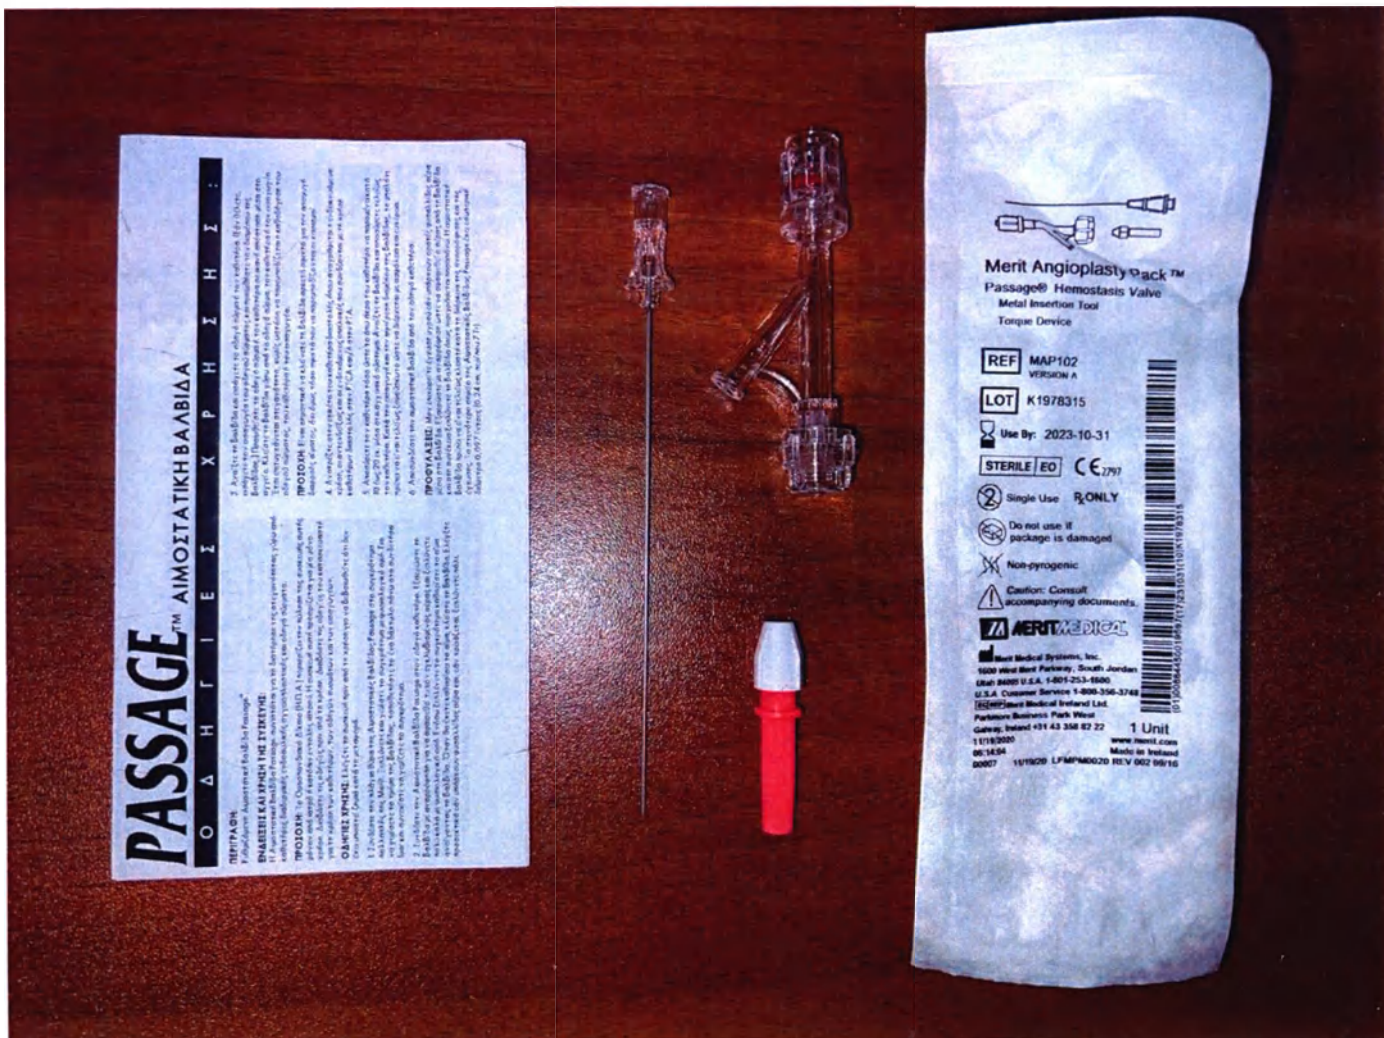

Общий вид изделия

15. Набор для ангиографии MAP, в составе:
 - 15.1. Гемостатический клапан AccessPLUS
 - 15.2. Устройство для введения проводника
 - 15.3. Инструкция по эксплуатации.



Общий вид изделия


16. Набор для ангиографии MAP, в составе:

16.1. Гемостатический клапан Honor

16.2. Устройство для введения проводника

16.3. Устройство для вращения проводника

16.4. Инструкция по эксплуатации.

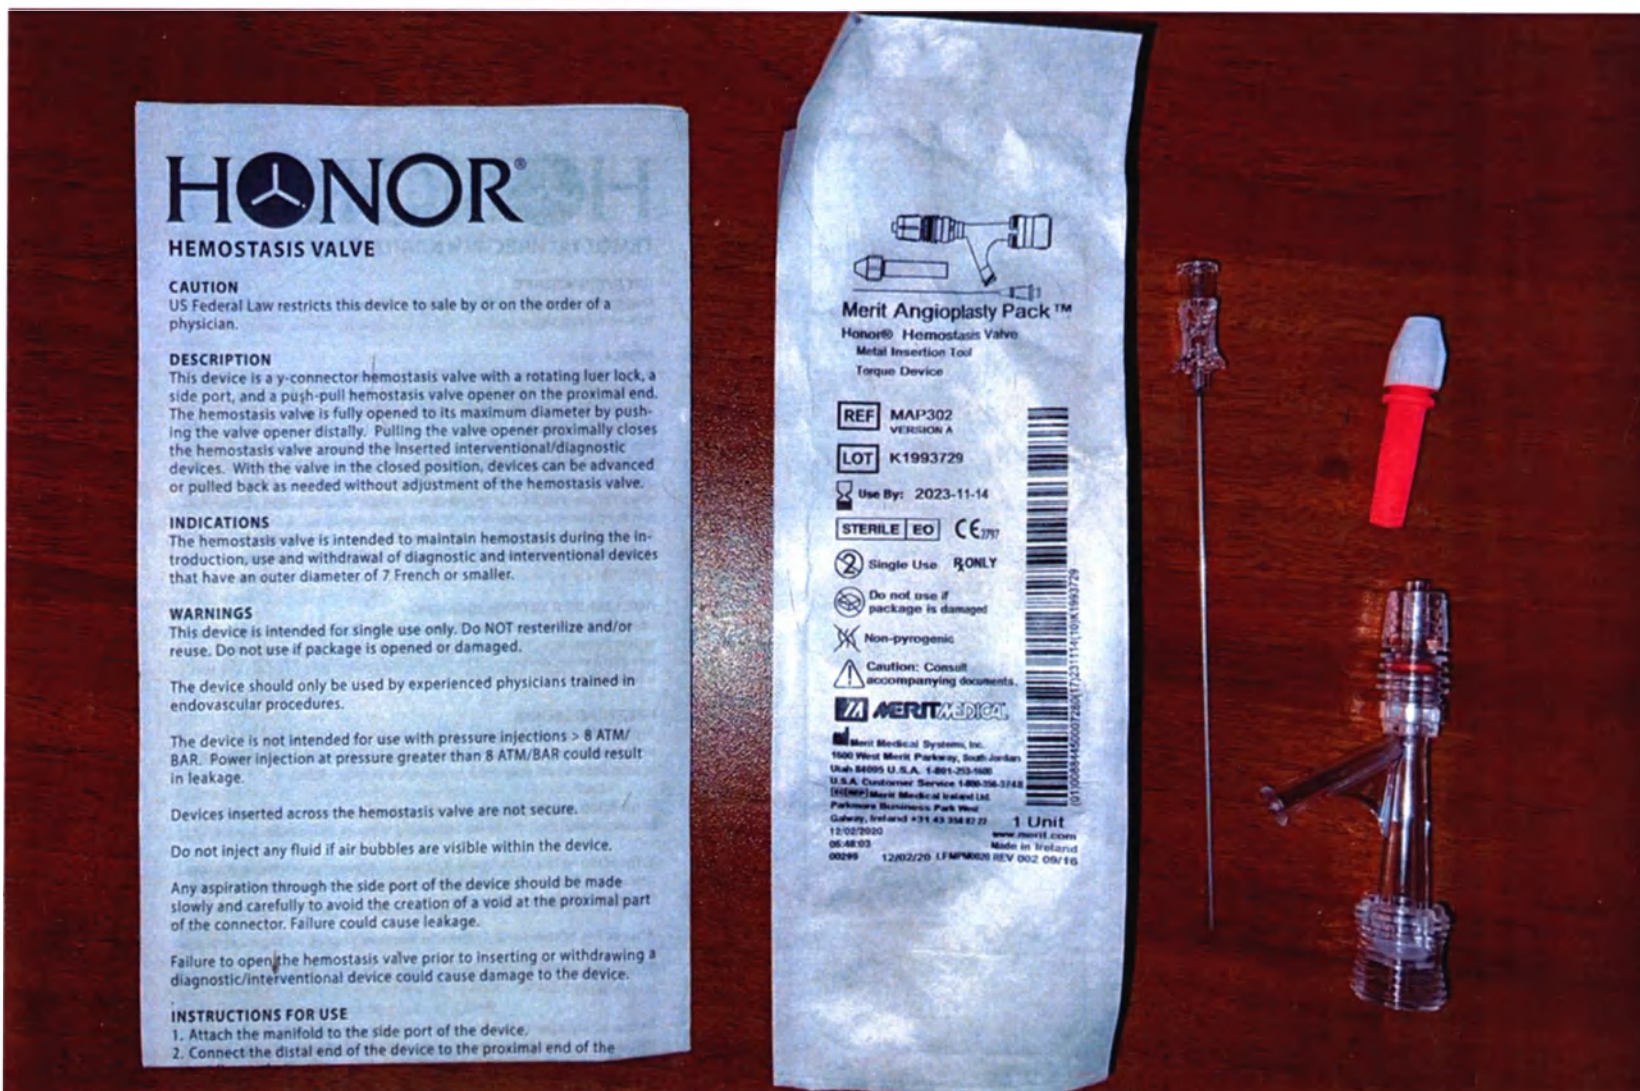

Общий вид изделия


17. Набор для ангиографии MAP, в составе:

17.1. Гемостатический клапан FLO50

17.2. Устройство для введения проводника


17.3. Устройство для вращения проводника

17.4. Инструкция по эксплуатации.

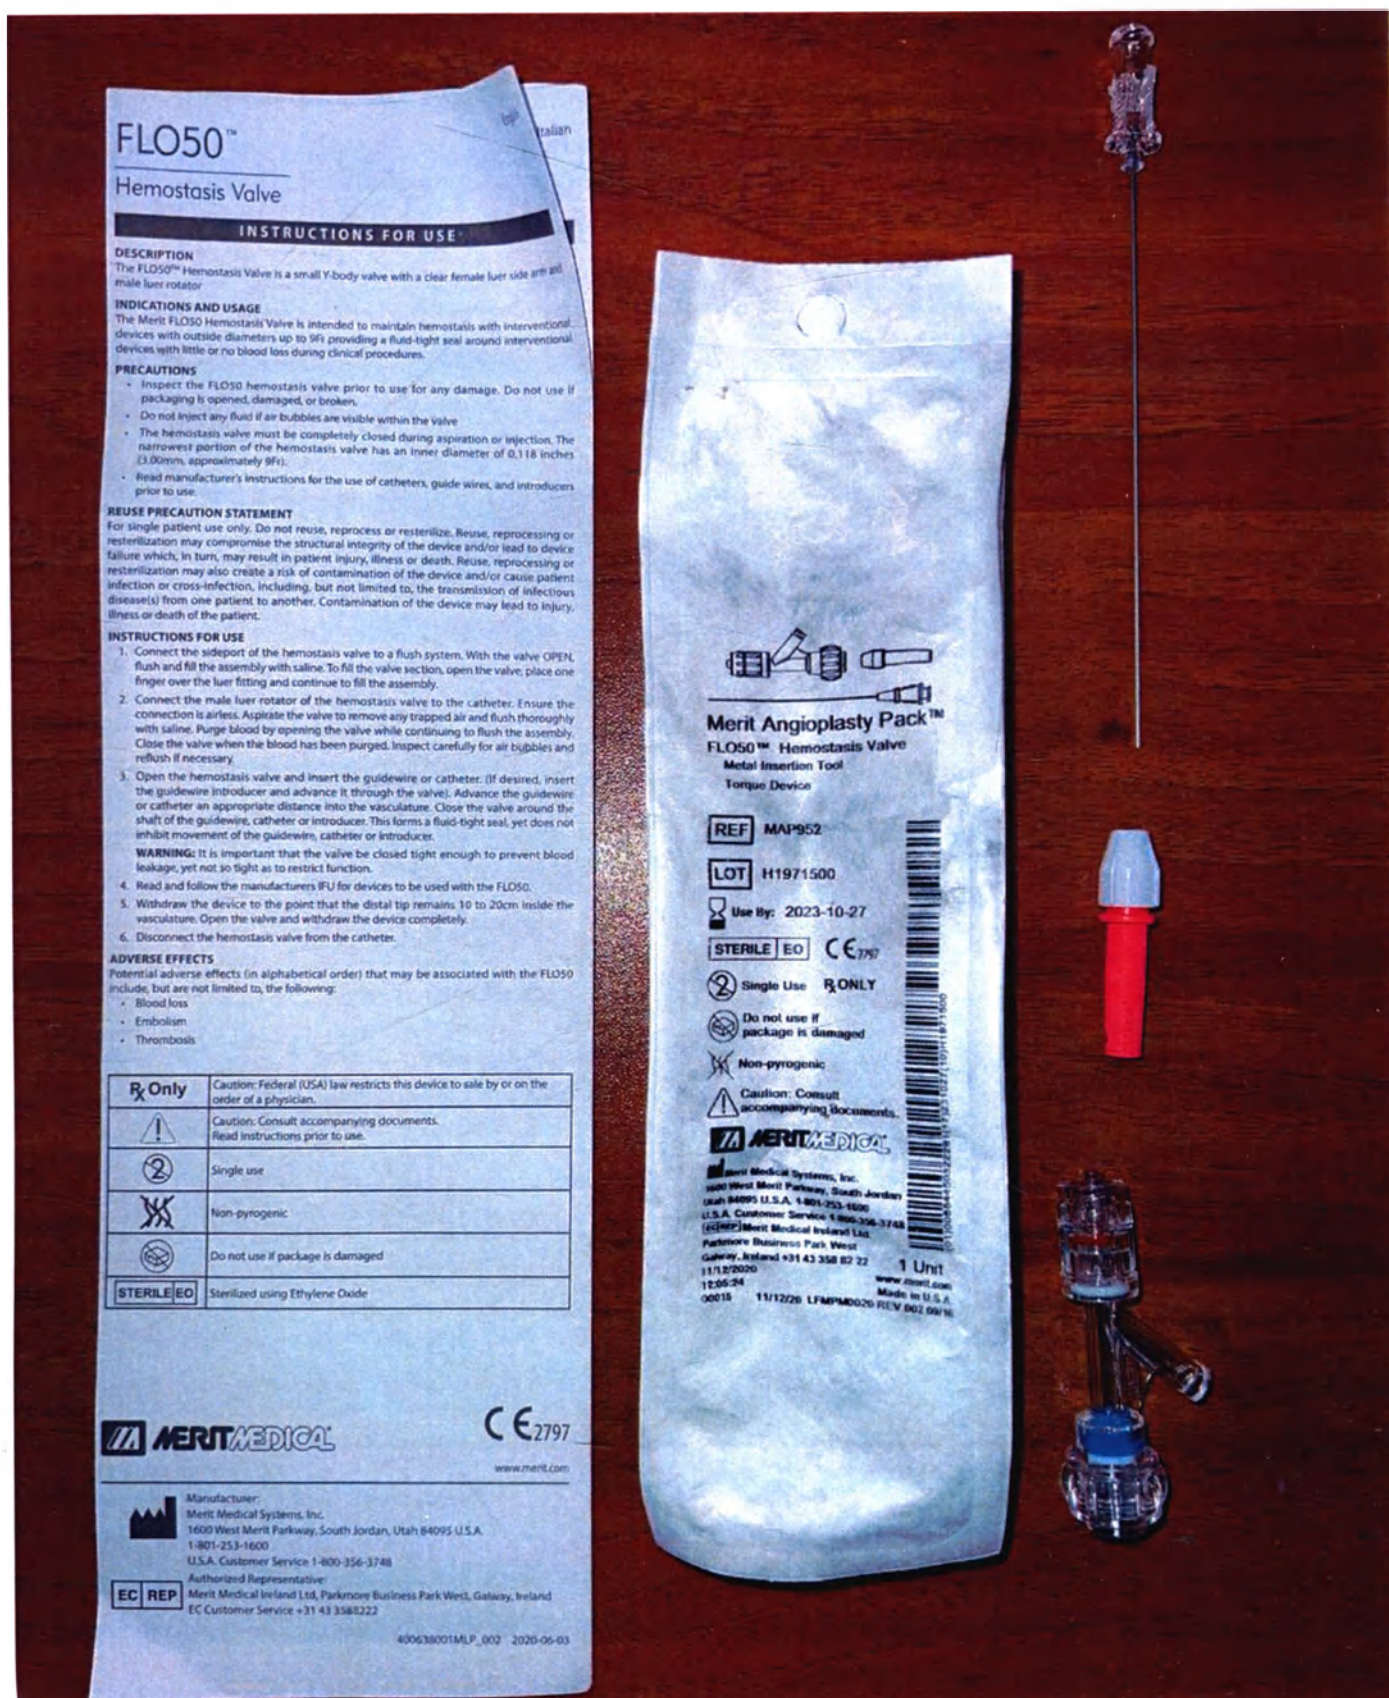

Общий вид изделия

18. Набор для ангиографии MAP, в составе:
- 18.1. Гемостатический клапан PhD
- 18.2. Удлинительная линия
- 18.3. Устройство для введения проводника
- 18.4. Устройство для вращения проводника
- 18.5. Инструкция по эксплуатации.

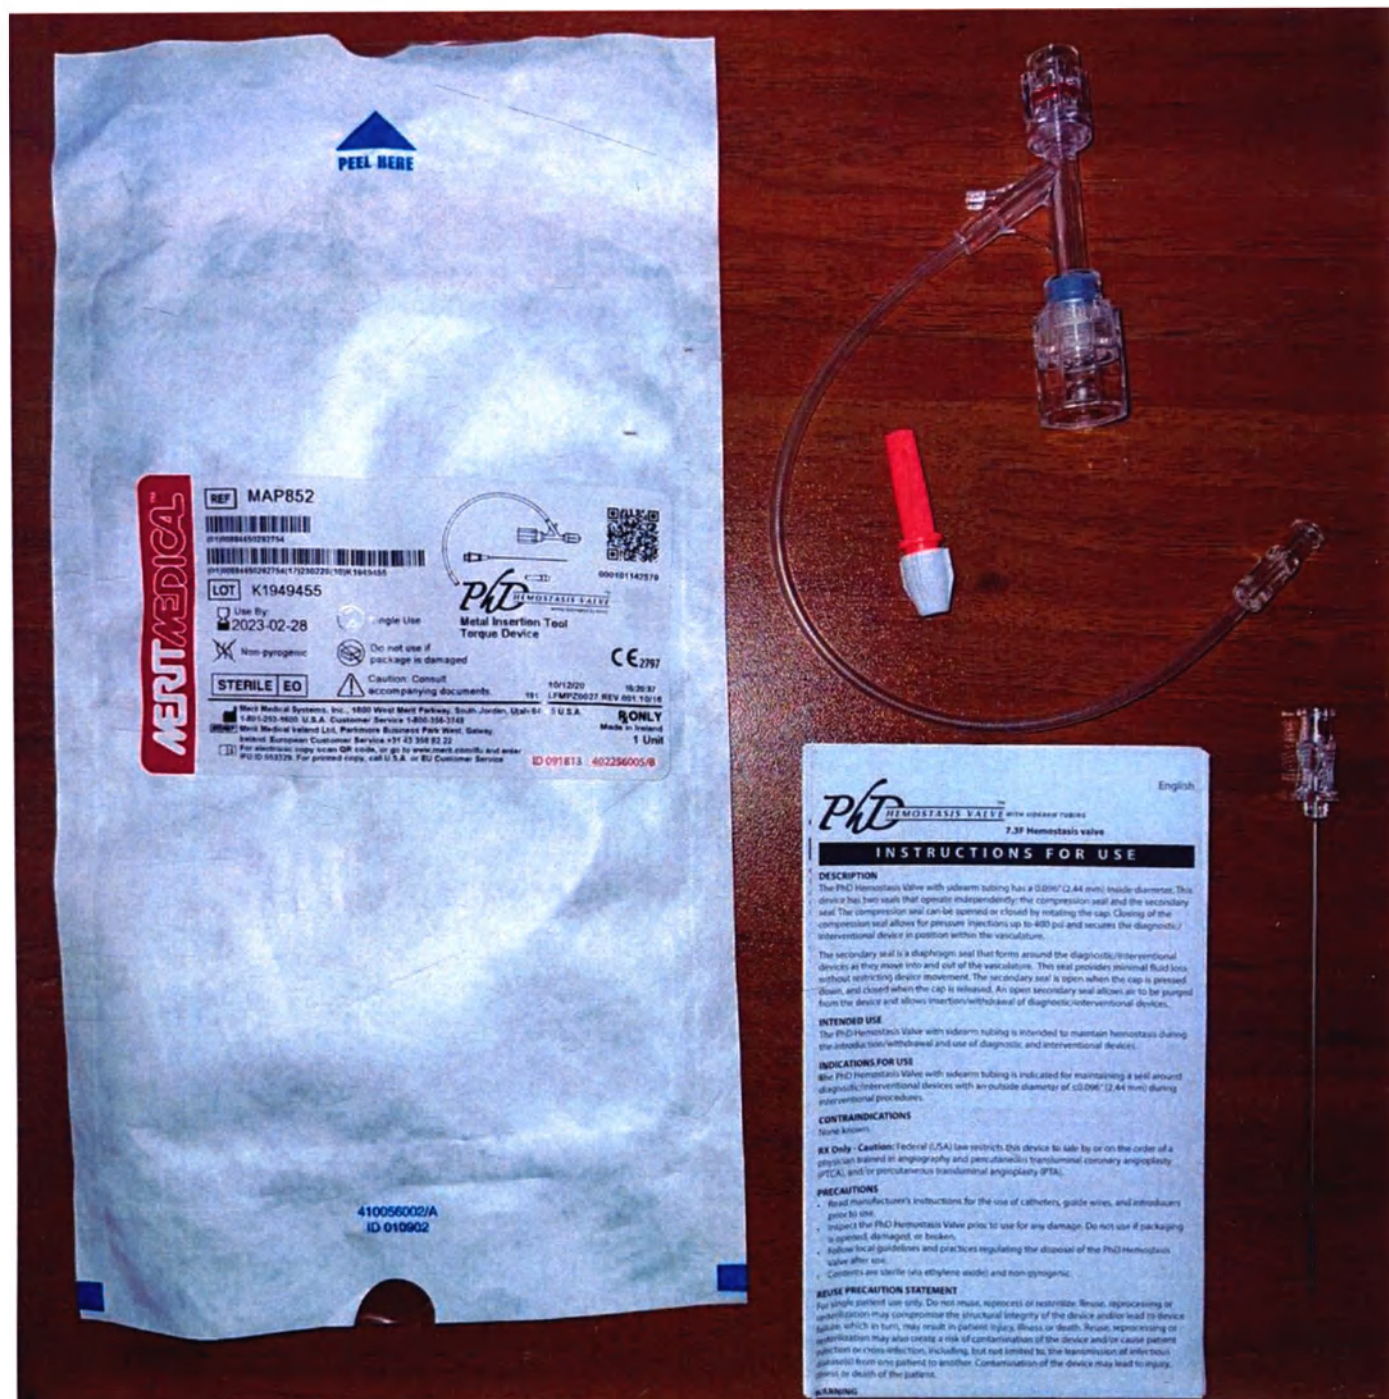

Общий вид изделия

19. Набор для ангиографии MAP, в составе:

19.1. Гемостатический клапан Honor

19.2. Удлинительная линия

19.3. Трехходовой краник

19.4. Устройство для введения проводника


19.5. Устройство для вращения проводника

19.6. Инструкция по эксплуатации.




Общий вид изделия

20. Набор для ангиографии МАР, в составе:
- 20.1. Гемостатический клапан МВАPlus
 - 20.2. Устройство для введения проводника
 - 20.3. Устройство для вращения проводника
 - 20.4. Инструкция по эксплуатации.

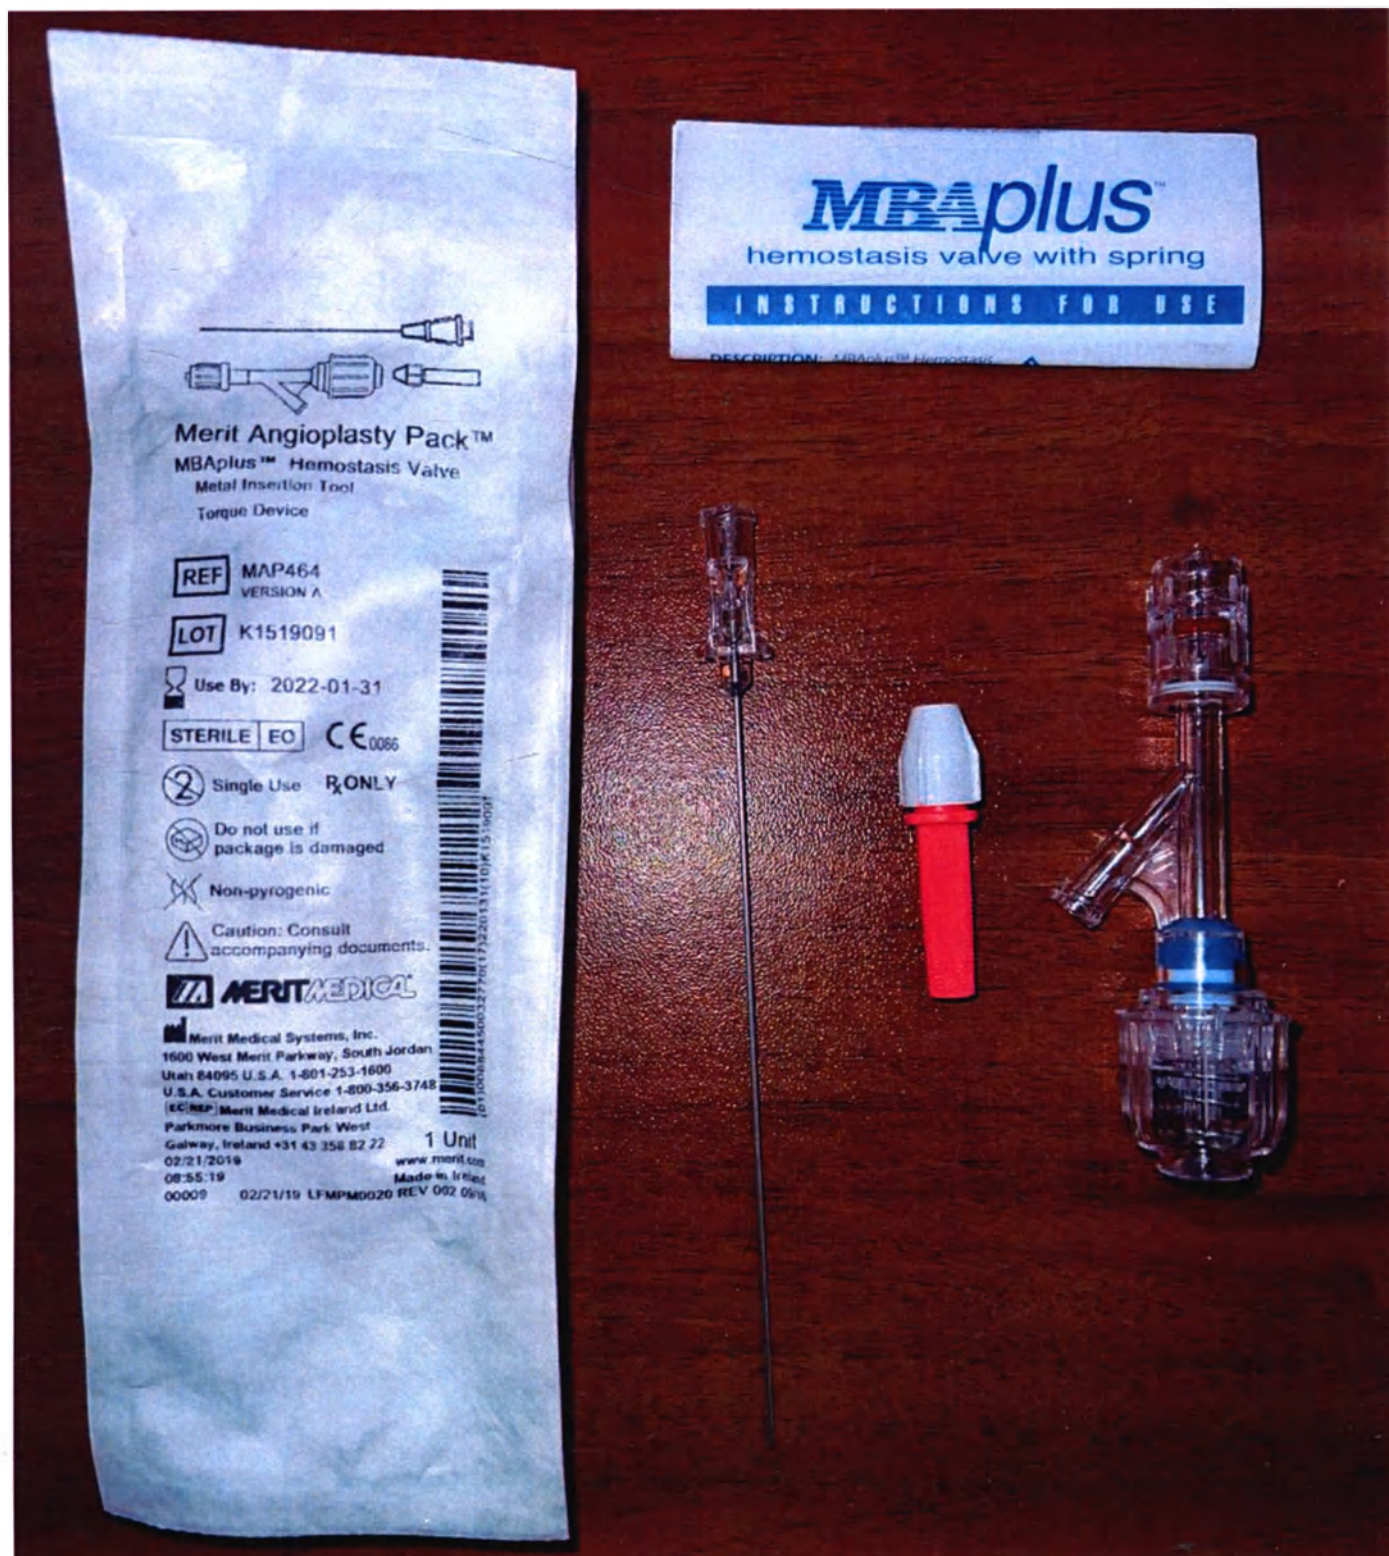


Общий вид изделия

Гемостатические клапаны:

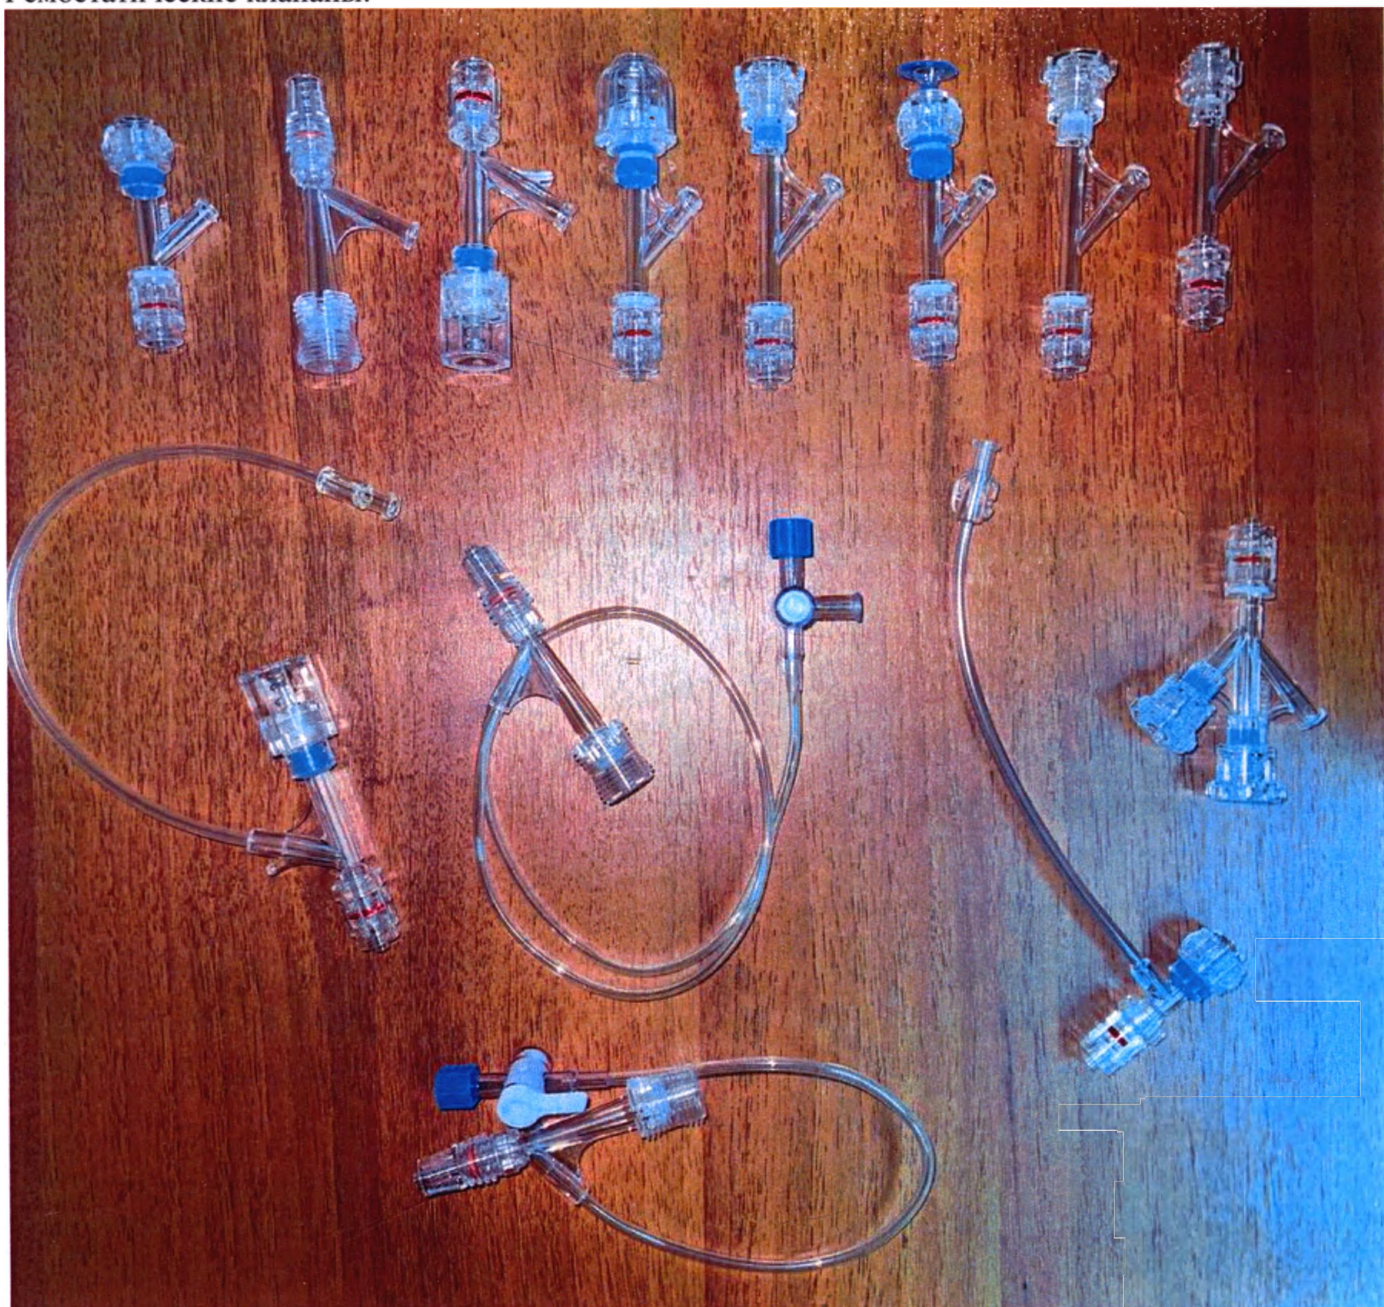

Устройство для введения проводника (металлическое):

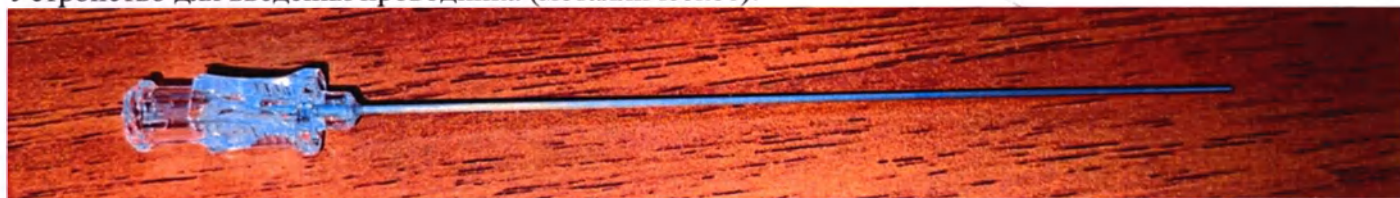


Устройство для введения проводника (пластиковое):



Трехходовой краник:



Устройство для вращения проводника (красное):

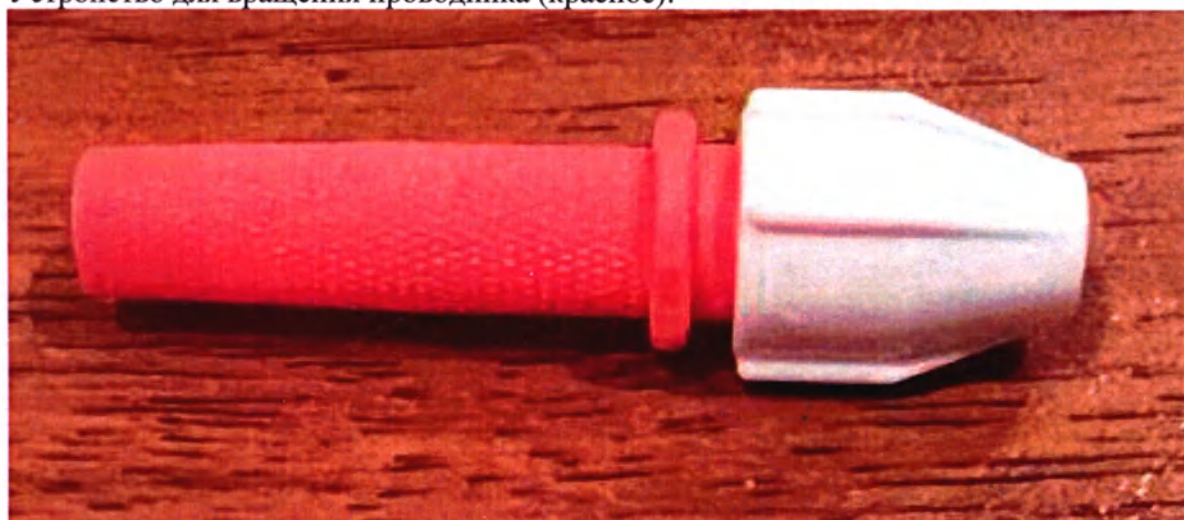

Устройство для вращения проводника (зеленое):



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
ШАЛАМОВ А.В.

