

Согласовано

ООО «Асцензия Диабетическая продукция»

Организация

123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом

12, офис 706

Адрес

Менеджер по регистрации


Должность

Доброва Е.П.

Фамилия. Имя

«5» сентября 2022 года

Дата ДД.ММ.ГГГГ



Подпись/Signature

Фотографические изображения и изображения маркировки медицинского изделия ««Контрольные растворы глюкозы «Контур» (Contour)» для системы контроля уровня глюкозы в крови «Контур» (Contour)», в вариантах исполнения»
(Асцензия Диабитис Кеа Холдингс АГ, Швейцария (Ascensia Diabetes Care Holdings AG), Швейцария)


Contour

Soluzione di controllo • Kontrolna otopina
Solution de contrôle • Controlevloeistof
Kontrolllösung

Units: 12

DA UTILIZZARE CON LE STRISCE REATTIVE CONTOUR®
ZA UPORABU S CONTOUR® TEST SENZORIMA
A UTILISER AVEC LES BANDELETES RÉACTIVES CONTOUR®
VOOR GEBRUIK MET CONTOUR®-TESTSTRIPS
ZUR VERWENDUNG MIT CONTOUR® SENSOREN

© 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.




Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

90005414 Rev. 11/19



06707547-7177A



LOW



1BW1M11



2023-04

85005847

Первичная упаковка. «Контрольный раствор глюкозы «Контур» («Contour») для системы контроля уровня глюкозы в крови «Контур» (Contour)» низкой концентрации (Contour Control Low), 1 × 2,5 мл.







Contour

CONTROL L

IVD



15°C - 30°C



LOT



1BW1M11

2023-04

Made in USA

90005420 Rev. 11/19



Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

CE
2797

www.diabetes.ascensia.com
www.patents.ascensia.com



ASCENSIA
Diabetes Care

Первичная упаковка. «Контрольный раствор глюкозы «Контур» («Contour») для системы контроля уровня глюкозы в крови «Контур» (Contour)» высокой концентрации (Contour Control High), 1 × 2,5 мл.





Contour

CONTROL H

IVD



15°C - 30°C



LOT



1BW3M13

2023-05

Made in USA

90005421 Rev. 11/19



Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

CE
2797

www.diabetes.ascensia.com
www.patents.ascensia.com



ASCENSIA
Diabetes Care

Первичная упаковка. «Контрольный раствор глюкозы «Контур» («Contour») для системы контроля уровня глюкозы в крови «Контур» (Contour)» нормальной концентрации (Contour Control Normal), 1 × 2,5 мл.







Contour

CONTROL N

IVD



15 °C 30 °C



LOT



1BW2P17

2023-04

Made in USA

90005418 Rev. 11/19



Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

CE
2797

www.diabetes.ascensia.com
www.patents.ascensia.com



ASCENSIA
Diabetes Care

Потребительская упаковка. «Контрольный раствор глюкозы «Контур» («Contour») для системы контроля уровня глюкозы в крови «Контур» (Contour)» нормальной концентрации (Contour Control Normal), 1 × 2,5 мл.





Потребительская упаковка. «Контрольный раствор глюкозы «Контур» («Contour») для системы контроля уровня глюкозы в крови «Контур» (Contour)» высокой концентрации (Contour Control High), 1 × 2,5 мл.





Потребительская упаковка. «Контрольный раствор глюкозы «Контур» («Contour») для системы контроля уровня глюкозы в крови «Контур» (Contour)» низкой концентрации (Contour Control Low), 1 × 2,5 мл.





Маркировка флакона Контрольного раствора глюкозы «Контур» («Contour») для системы контроля уровня глюкозы в крови «Контур» (Contour) нормальной концентрации (Contour Control Normal), 1 × 2,5 мл

Contour Контур		Дата утилизации:
Контрольный раствор глюкозы «Контур» («Contour») для системы контроля уровня глюкозы в крови «Контур» (Contour) в вариантах исполнения CONTROL N Нормальная концентрация		Произведено 90005130 в США. Rev. 10/22
Контрольный раствор глюкозы «Контур» («Contour») для системы контроля уровня глюкозы в крови «Контур» (Contour) нормальной концентрации (Contour Control Normal), 1 x 2,5 мл REF 90004209 IVD 2,5 мл		Ascensia Diabetes Care Holdings AG Peter Merian-Strasse 90 4052 Basel, Швейцария
		LOT
		

Contour
CONTROL N

REF 90004209 1 x 2,5 мл

Contour
(Контур)

Контрольные растворы глюкозы «Контур» («Contour») для системы контроля уровня глюкозы в крови «Контур» («Contour») в нормальных значениях.

CONTROL N

Контрольный раствор глюкозы «Контур» («Contour») для системы контроля уровня глюкозы в крови «Контур» («Contour») нормальной концентрации (Contour Control Normal), 1 x 2,5 мл

1 x 2,5 мл
Для самостоятельного проведения теста

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland
Асценсия Дабетис Кар Хоल्дингс АГ,
Швейцария
www.diabetes.ascensia.com
© 2020 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
(Указание Freestyle Neo Holding AG)

ASCENSIA
Diabetes Care

CE
2797

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Асцензия Диабетическая продукция»,
123610, г. Москва, Красноперекопская наб.,
дом 12, офис 706
тел: 8 800 200 44 43

Произведено в США 90005127 Rev. 08/22

5 016003 720307

LOT 90005127

Срок годности (unopened) 1 year from the date of manufacture. Store at room temperature (15°C - 30°C). Do not refrigerate or freeze. See package insert for full storage and handling instructions.

Маркировка флакона Контрольного раствора глюкозы «Контур» («Contour») для системы контроля уровня глюкозы в крови «Контур» (Contour)» низкой концентрации (Contour Control Low), 1 × 2,5 мл

Contour

Контур

Контрольные растворы глюкозы «Контур» («Contour») для системы контроля уровня глюкозы в крови «Контур» (Contour) в вариантах исполнения

CONTROL

L

Низкая концентрация

Контрольные растворы глюкозы «Контур» («Contour») для системы контроля уровня глюкозы в крови «Контур» (Contour) низкой концентрации (Contour Control Low), 1 x 2,5

REF

90004214

IVD

2,5 мл

30°C
15°C

Дата
утилизации:



2797

Произведено 90005129
в США. Rev. 10/22



Ascensia Diabetes Care
Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Швейцария

LOT



Маркировка коробки Контрольного раствора глюкозы «Контур» («Contour») для системы контроля уровня глюкозы в крови «Контур» (Contour) низкой концентрации (Contour Control Low), 1 × 2,5 мл



Маркировка флакона Контрольного раствора глюкозы «Контур» («Contour») для системы контроля уровня глюкозы в крови «Контур» (Contour)» высокой концентрации (Contour Control High), 1 × 2,5 мл

Contour

Контур

Контрольный раствор глюкозы «Контур» («Contour») для системы контроля уровня глюкозы в крови «Контур» (Contour) в вариантах исполнения

CONTROL H

Высокая концентрация

Контрольный раствор глюкозы «Контур» («Contour») для системы контроля уровня глюкозы в крови «Контур» (Contour) высокой концентрации (Contour Control High), 1 × 2,5 мл

15°C — 30°C

REF

90004215

IVD

2,5 мл

Дата
утилизации:



Произведено 90005128
в США. Rev. 10/22




Ascensia Diabetes Care
Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Швейцария


LOT



Маркировка коробки Контрольного раствора глюкозы «Контур» («Contour») для системы контроля уровня глюкозы в крови «Контур» (Contour)» высокой концентрации (Contour Control High), 1 x 2,5 мл

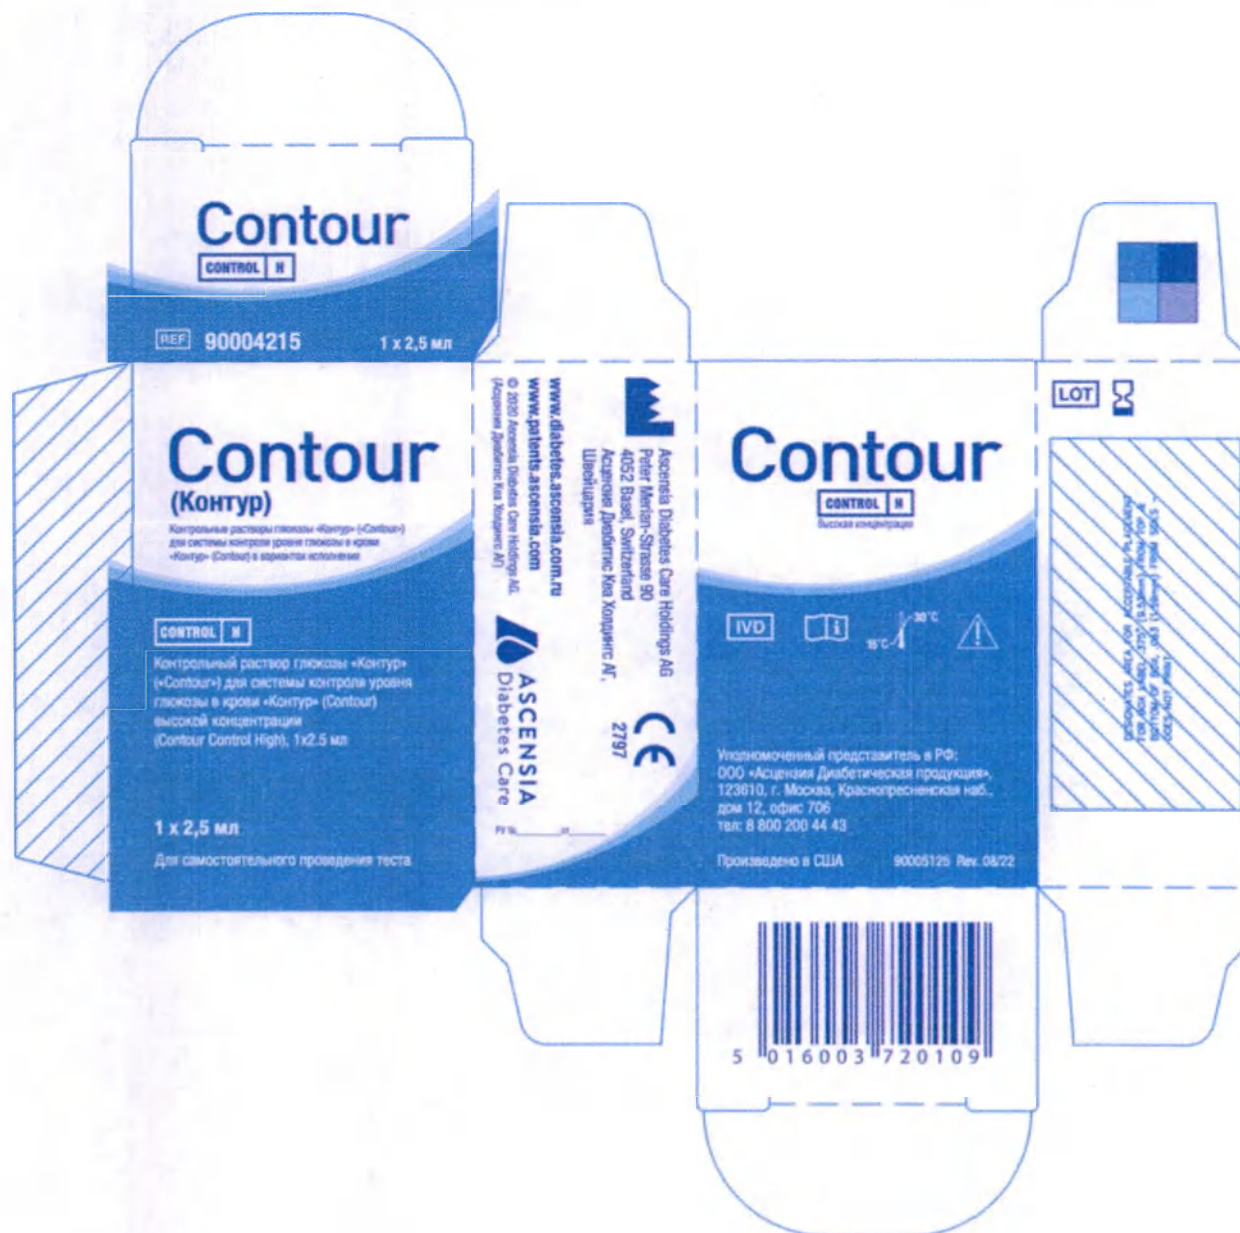

Маркировка групповой упаковки Контрольных растворов глюкозы «Контур» («Contour») для системы контроля уровня глюкозы в крови «Контур» (Contour), в вариантах исполнения

 Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Асцензия Диабетическая продукция» 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, офис 706 тел. 8 800 200 44 43 www.diabetes.ascensia.com	REF XXXXXXXX-XXXX XXXXXXX
Contour КОНТУР Контрольные растворы глюкозы «Контур» («Contour») для системы контроля уровня глюкозы в крови «Контур» (Contour), в вариантах исполнения Упаковка: 12 Для использования с тест-полосками «Контур» (Contour) © 2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Все права защищены.  Ascensia Diabetes Care Holdings AG Peter Merian-Strasse 90 4052 Basel, Switzerland Асцензия Диабетичес Кеа Холдингс АГ, Швейцария 00005131 Rev. 10/21	REF XXXXXXXX-XXXX NDC XXXX-XXXX-XX XXXXXXX LOT XXXXXXXXXXXX YYYY-MM XXXXXXX

Маркировка транспортной упаковки Контрольных растворов глюкозы «Контур» («Contour») для системы контроля уровня глюкозы в крови «Контур» (Contour)», в вариантах исполнения

Contour Контрольные растворы глюкозы «Контур» («Contour») для системы контроля уровня глюкозы в крови «Контур» (Contour), в вариантах исполнения		REF	XXXXXXXX-XXXX
 15°C 30°C		LOT	NDC XXXX-XXXX-XX
IVD			XXXXXXXXXX
 ASCENSIA Diabetes Care			XXXXXXXXXX
 Ascensia Diabetes Care Holdings AG Peter Merian-Strasse 90 4052 Basel, Switzerland Асцензия Диабитис Кеа Холдингс АГ, Швейцария			YYYY-MM-DD
 CE 2797			(01) XXXXXXXXXXXXXXXX (17) YYMMDD (10) XXXXXXXXXXXX
90005132 Rev, 10/21			XXXXXXXXXX

Символы на маркировке

	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Маркировка соответствия CE
	Обратитесь к инструкции
	Изготовитель
	Температурный диапазон
	Нормальный контрольный диапазон
	Нижний контрольный диапазон
	Верхний контрольный диапазон
	Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Номер по каталогу
	Код партии
	Использовать до

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 31 листов (-а)
Менеджер по регистрации ООО «Асцензия
Диабетическая продукция»
Доброва Е.П. 