


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ»



 Татаринов А.М.
«23» декабря 2021 г.

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Имплантаты интрадермальные с гиалуронатом натрия 24 мг/мл
для контурной пластики FILOTI в вариантах исполнения»**

производства
Jetema Co., Ltd., Republic of Korea



Рисунок 1 – Изображение двойной наклейки,
(для варианта исполнения FILOTI Fine)



Рисунок 2 – Изображение двойной наклейки,
(для варианта исполнения FILOTI Deep)



Рисунок 3 – Изображение двойной наклейки,
(для варианта исполнения FILOTI Sub-Q)

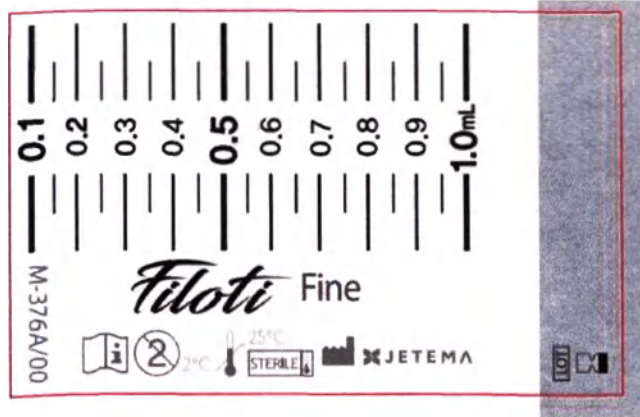


Рисунок 4 – Изображение этикетки для шприца,
(для варианта исполнения FILOTI Fine, объем 1,0 мл)

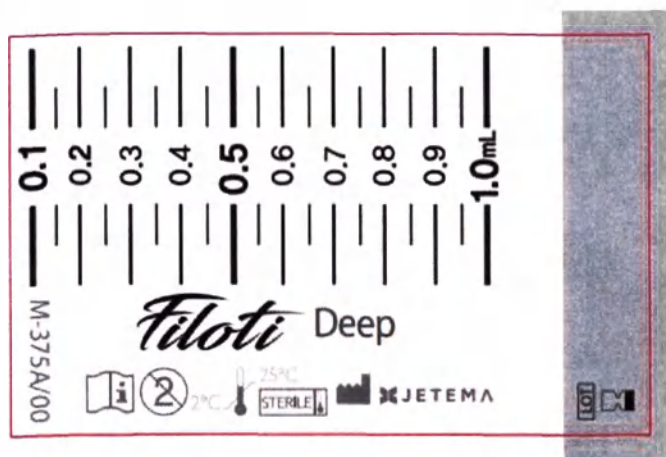


Рисунок 5 – Изображение этикетки для шприца,
(для варианта исполнения FILOTI Deep, объем 1,0 мл)

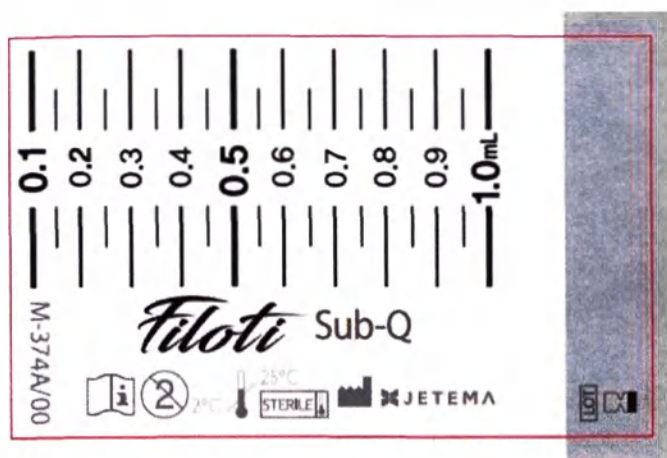


Рисунок 6 – Изображение этикетки для шприца,
(для варианта исполнения FILOTI Sub-Q, объем 1,0 мл)

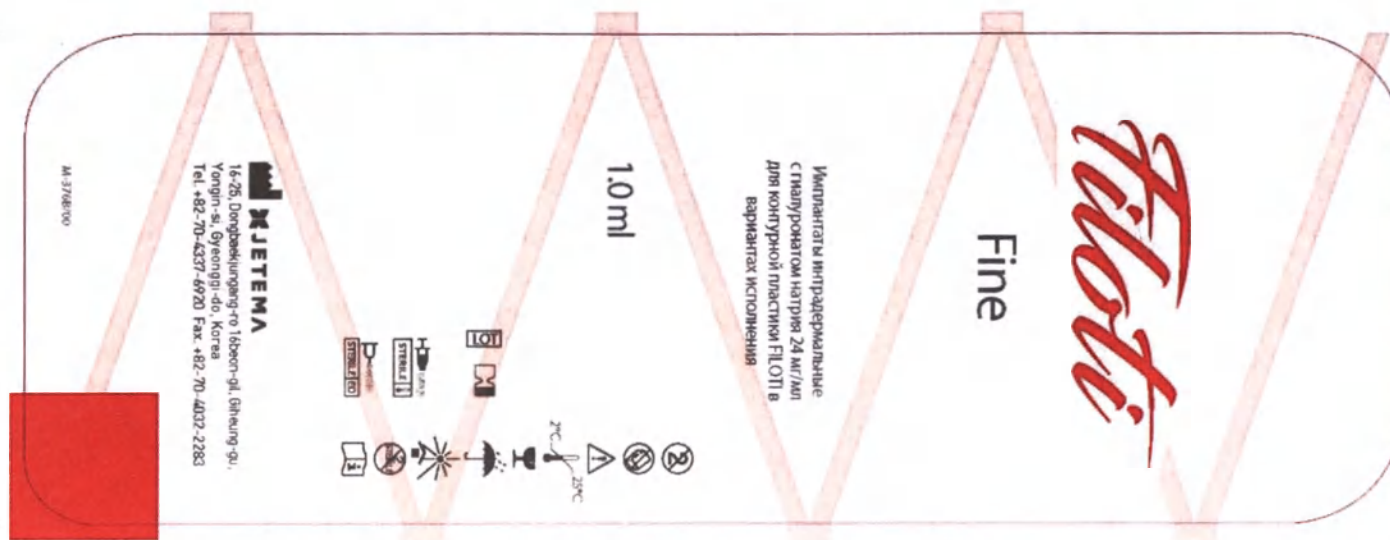


Рисунок 7 – Изображение этикетки для вторичной упаковки (блистера),
(для варианта исполнения FILOTI Fine, объем 1,0 мл)

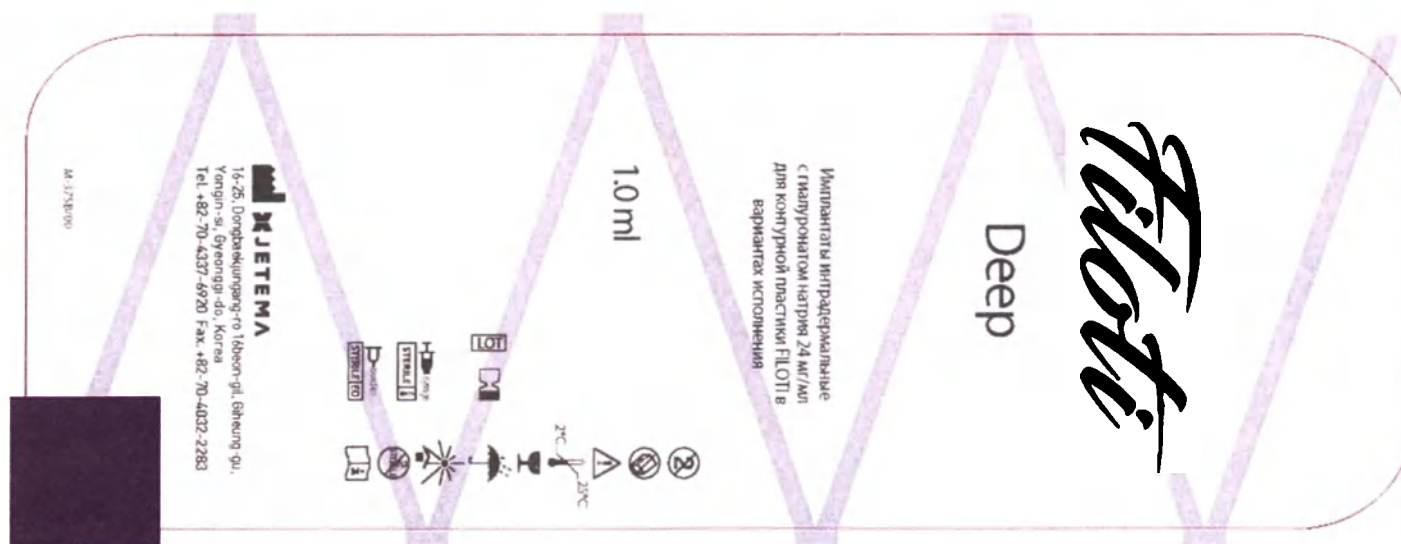


Рисунок 8 – Изображение этикетки для вторичной упаковки (блистера),
(для варианта исполнения FILOTI Deer, объем 1,0 мл)

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 8 лис

Генеральный директор
ООО «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ»
А.М. Татар

2021 г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ»



Татаринов А.М.
«23» декабря 2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Имплантаты интрадермальные с гиалуронатом натрия 24 мг/мл
для контурной пластики FILOTI в вариантах исполнения»**

производства
Jetema Co., Ltd., Republic of Korea

Filoti

Sub-Q

Имплантаты интрадермальные с
гиалуронатом натрия 24 мг/мл
для контурной пластики FILOTI в
вариантах исполнения

1.0 ml

Рис. 1. Лицевая сторона пачки из картона FILOTI Sub-Q

Filati
Sub-Q

Список опубликованных трудов автора

Серьезно. Не только.

 $0T + 2A0 + 25^{\circ}C$

Апартаменты в негос. здании для детей местр.

Удмуртская Республика

[illegible]

© 1995 by the American Psychological Association. 0893-3200/95/0000-0000\$05.00/0

ДОКЛАД

TEL: +82-70-4032-2283 EMAIL: global@jetema.com






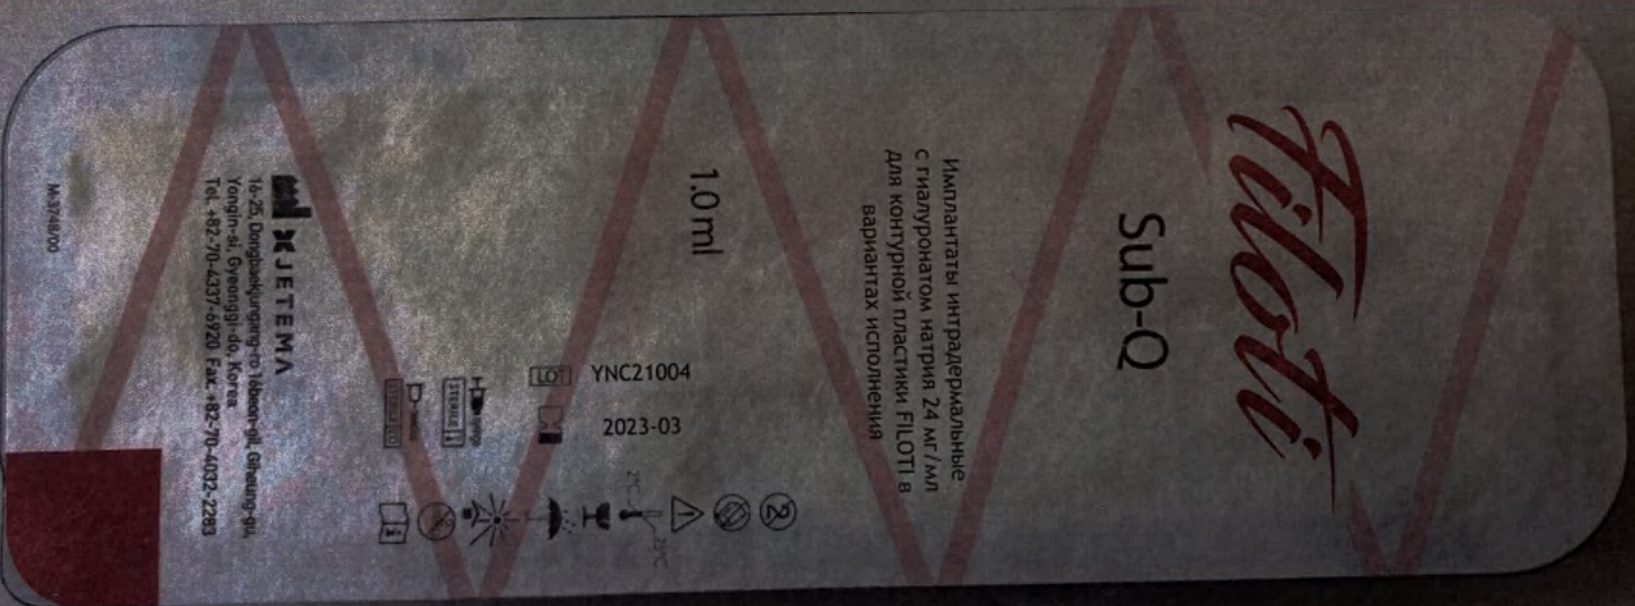


Рис. 4. Обратная сторона блистера со шприцом FILOTI Sub-Q



Рис. 5. Лицевая сторона пачки из картона FILOTI Deep

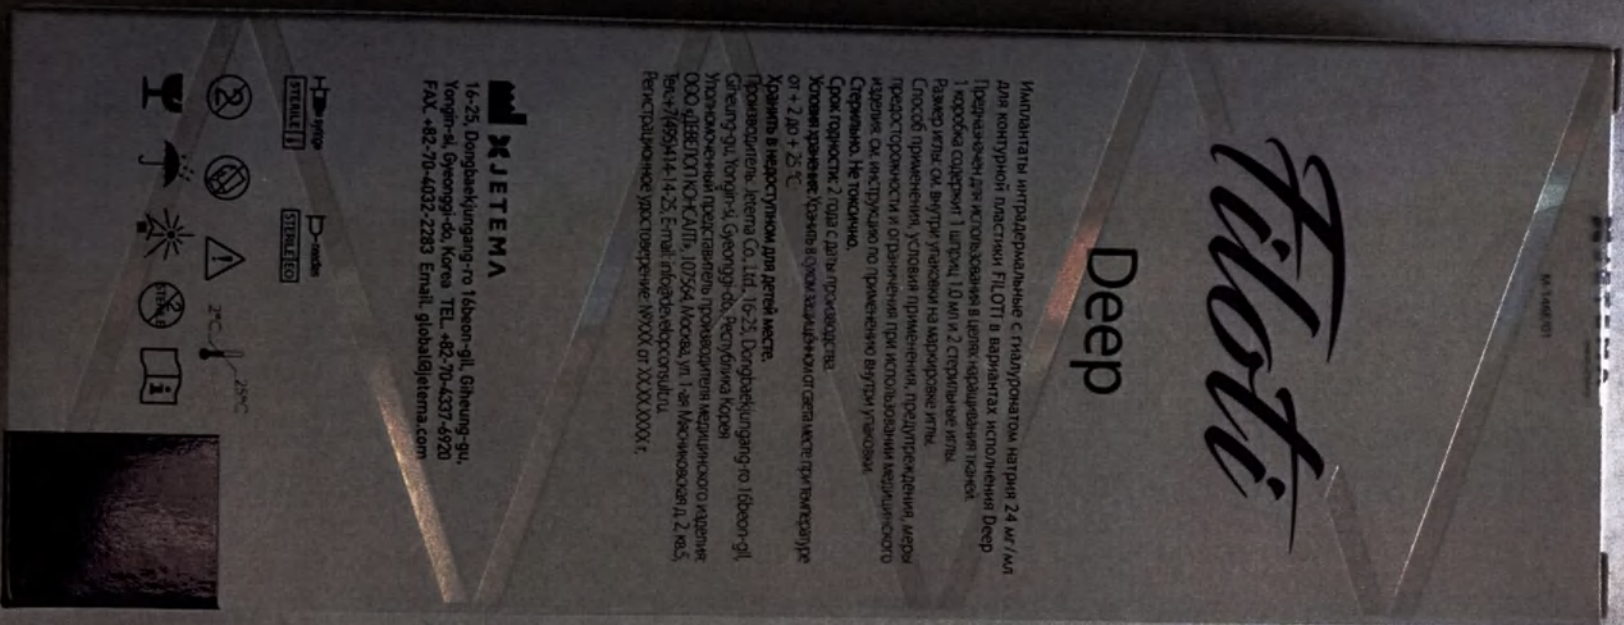

FILOTI

Deer

Импантаты интрадермальные с гиалуронатом натрия 24 мг/мл для контурной пластики FILOTI в вариантах исполнения Deer

Предназначен для использования в целях наращивания тканей.

1 коробка содержит 1 шприц 1,0 мл и 2 стерильные иглы.

Размер иглы: 0,5 мм, 1,0 мм и 2,0 мм.

Способ применения, условия применения, предупреждения, меры предосторожности и отрывания при использовании интрадермального и дермального инъектора по применению внутри ушной.

Стерильно. Не токсично.

Срок годности: 2 года с даты производства.

Хранить в сухом месте. Хранить в сухом месте при температуре от +2 до +25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Производитель: Jellena Co., Ltd., 16-25, Dongdaekilgung-ro 16beon-gil, Gyeonggi-do, Yongin-si, Gyeonggi-do, Республика Корея

Уполномоченный представитель производителя медицинского изделия ООО «ДБЕЛТОК-САЙТ», 105064, Москва, ул. 1-ая Мещинская д. 2, кв. 5, тел: +7 (495) 14-14-25, E-mail: info@dbelto.com.ru

Регистрационное удостоверение №000 от 00.00.0000X.

ЖЕЛЕНА

16-25, Dongdaekilgung-ro 16beon-gil, Gyeonggi-do, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea TEL: +82-70-4537-6920 FAX: +82-70-4032-2283 E-mail: global@jelena.com


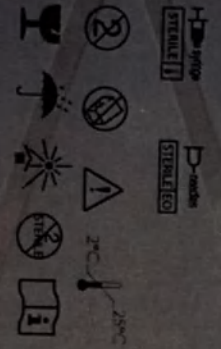


Рис. 6. Обратная сторона пачки из картона FILOTI Deer

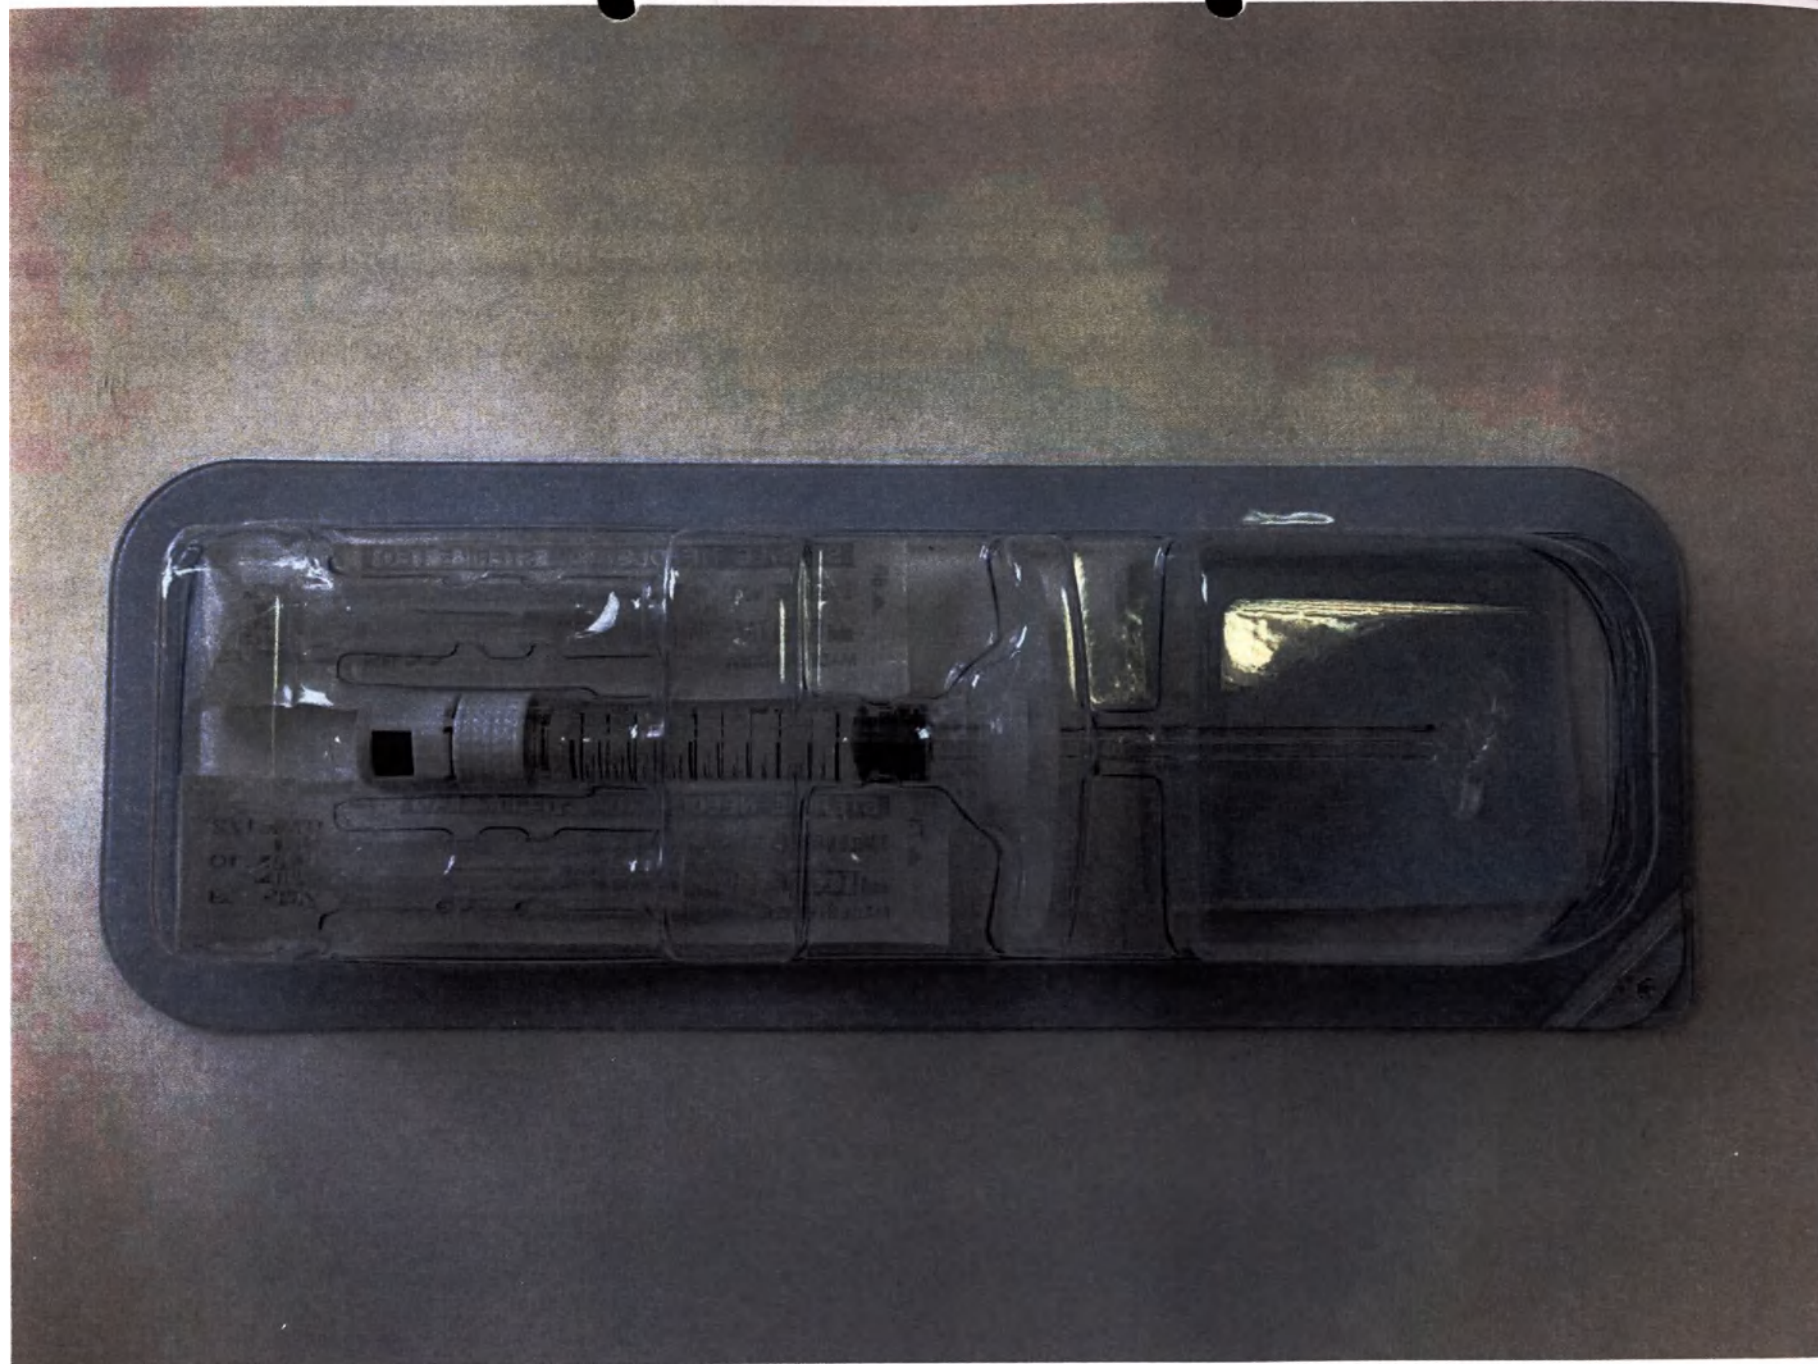

Filoti

Fine

Имплантаты интрадермальные с
гиалуронатом натрия 24 мг/мл
для контурной пластики FILOTI в
вариантах исполнения

1.0 ml

Рис. 9. Лицевая сторона пачки из картона FILOTI Fine

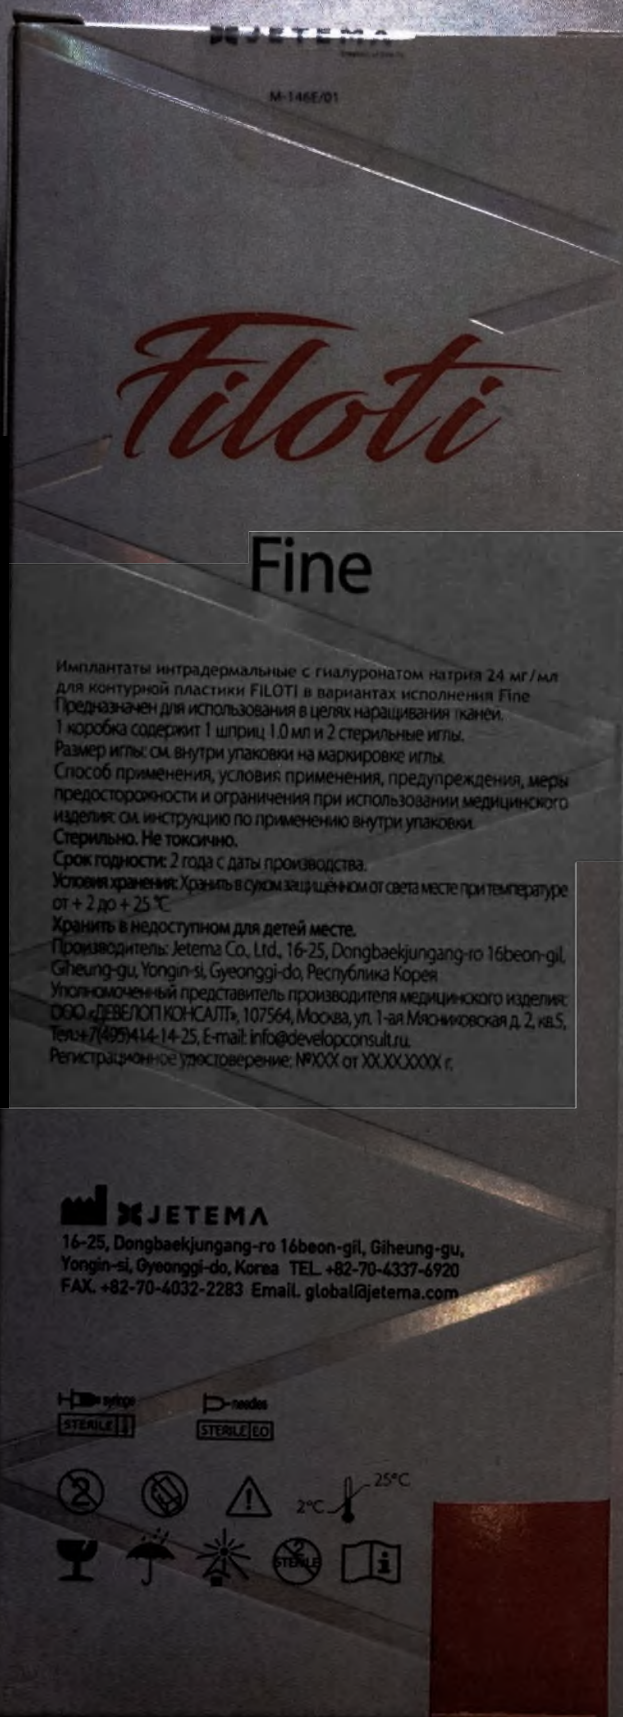
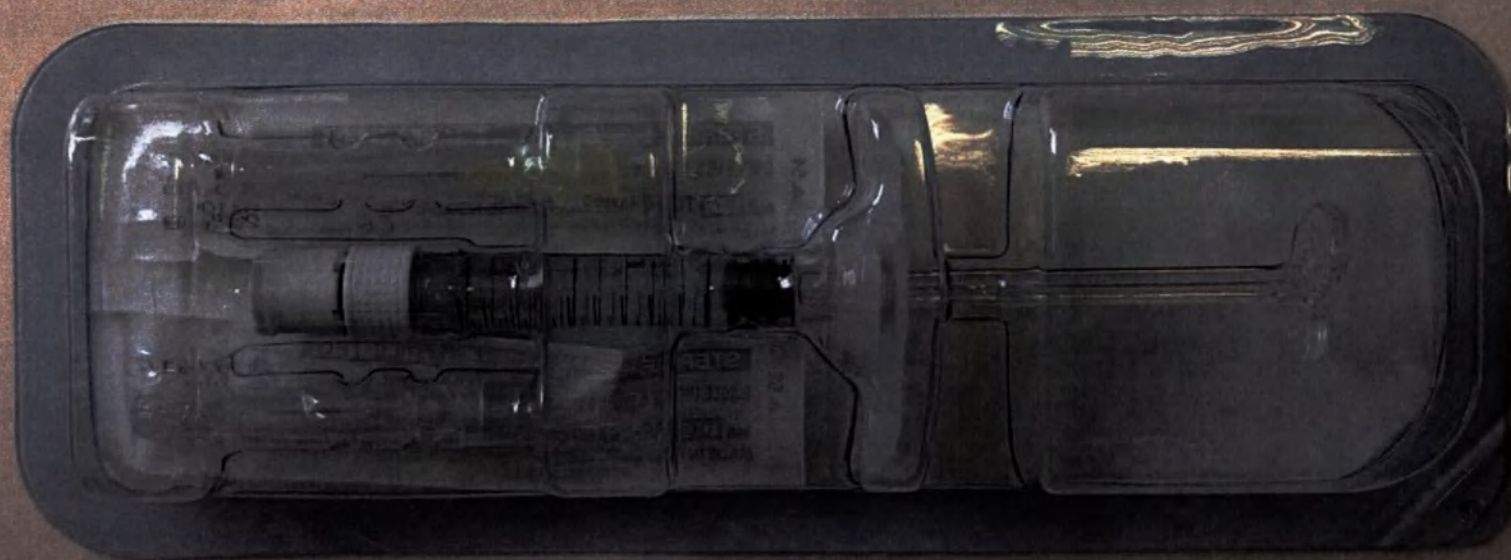


Рис. 10. Обратная сторона пачки из картона FILOTI Fine



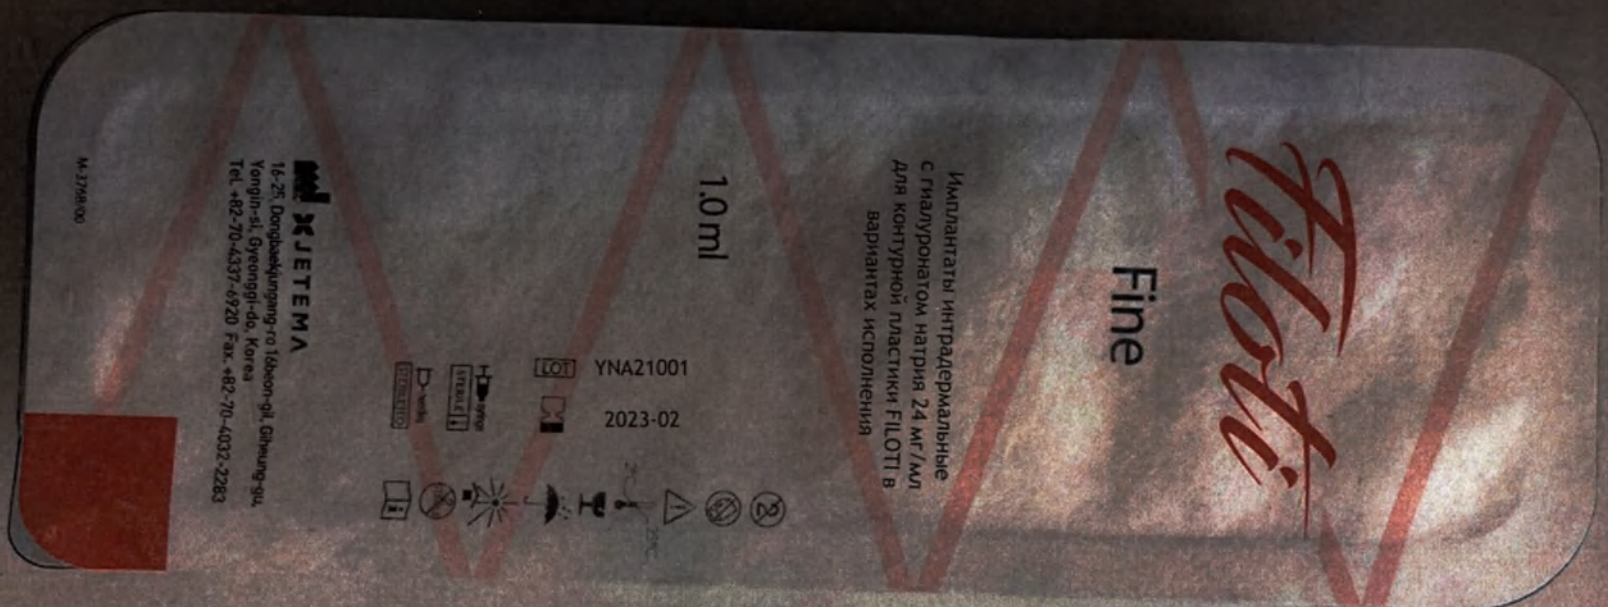


Рис. 12. Обратная сторона блистера со шприцом FILOTI Fine

Прошито и пронумеровано
скреплено печатью 12 л

Генеральный директор

ООО «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ»

А.М. Тата

МП

«3» декабря 2021 г.

