

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

«*ВВ*» *нояб* 2022 г.





ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789

КУСАЙЛО Р. В.

Фотографические изображения изделия:


**Набор реагентов для количественного определения белка 4 эпидидимиса человека
электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro
(Human Epididymal Protein 4 (eCLIA) / HE4)**

Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.
(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай

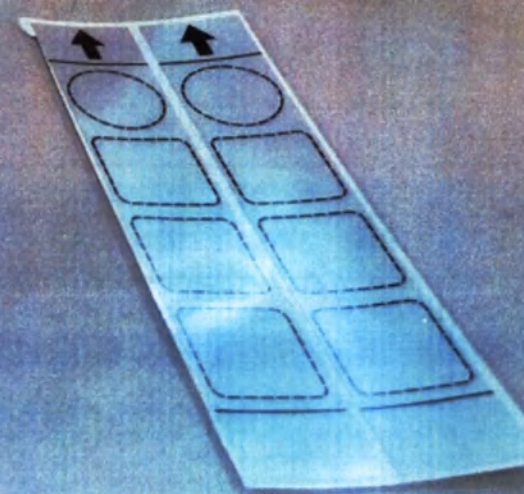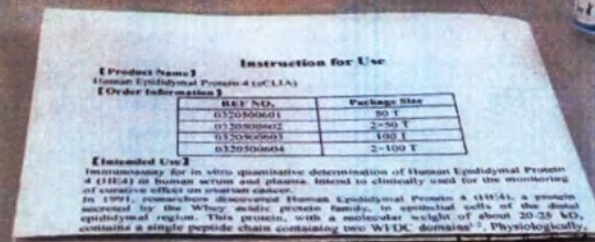




Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения белка 4 эпидидимиса человека электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Human Epididymal Protein 4 (eCLIA) / HE4))

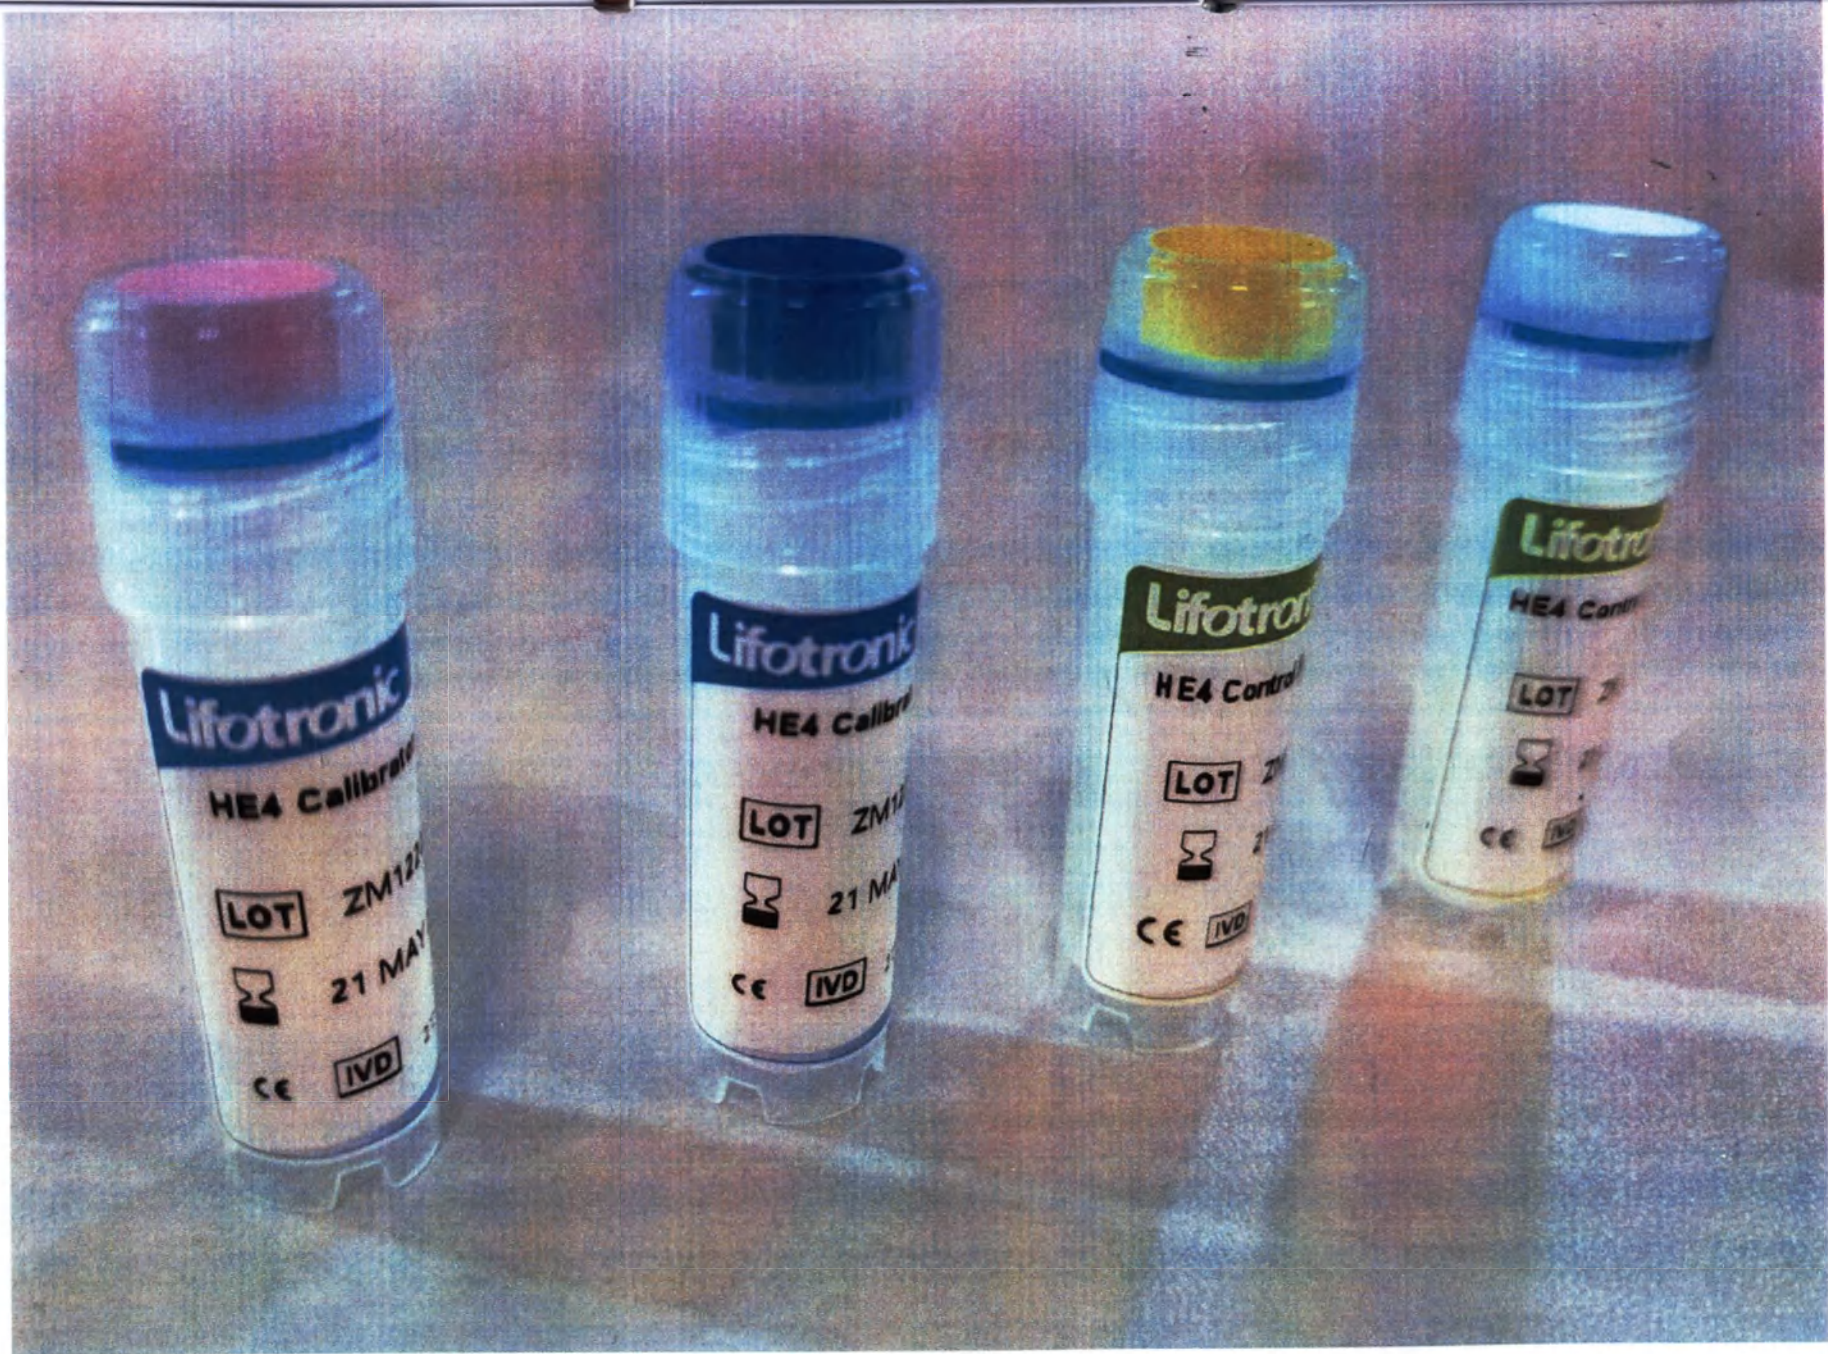



Калибратор (низкий и высокий уровень), Материал контрольный (низкий и высокий уровень) (Набор реагентов для количественного определения белка 4 эпидидимиса человека электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Human Epididymal Protein 4 (eCLIA) / HE4))

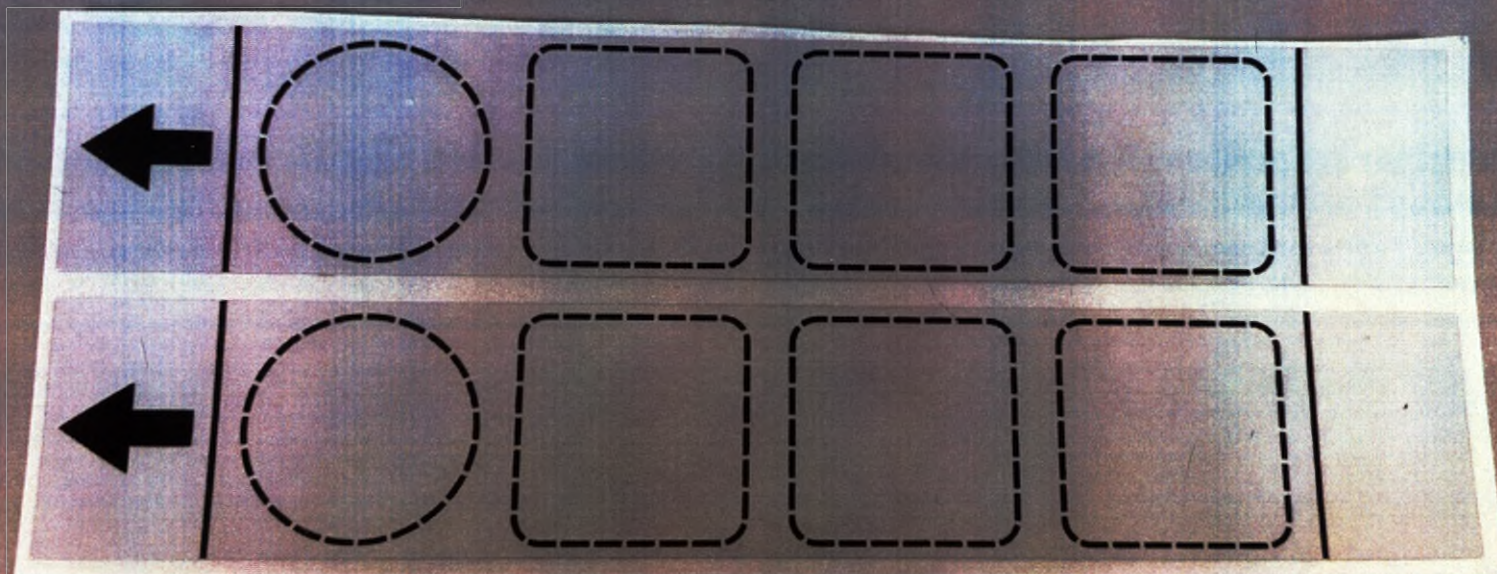

Этикетки для запечатывания флаконов (Набор реагентов для количественного определения белка 4 эпидидимиса человека электрохемилюминесцентным методом на анализаторах

ECL для диагностики in vitro (Human Epididymal Protein 4 (eCLIA) / HE4))

HE4 Quality Control Card

LOT ZM1220001




21 MAY 2022

QC Range(Low): 26.825-70.715 pmol/L

QC Range(High): 103.300-272.300 pmol/L

Lifotronic

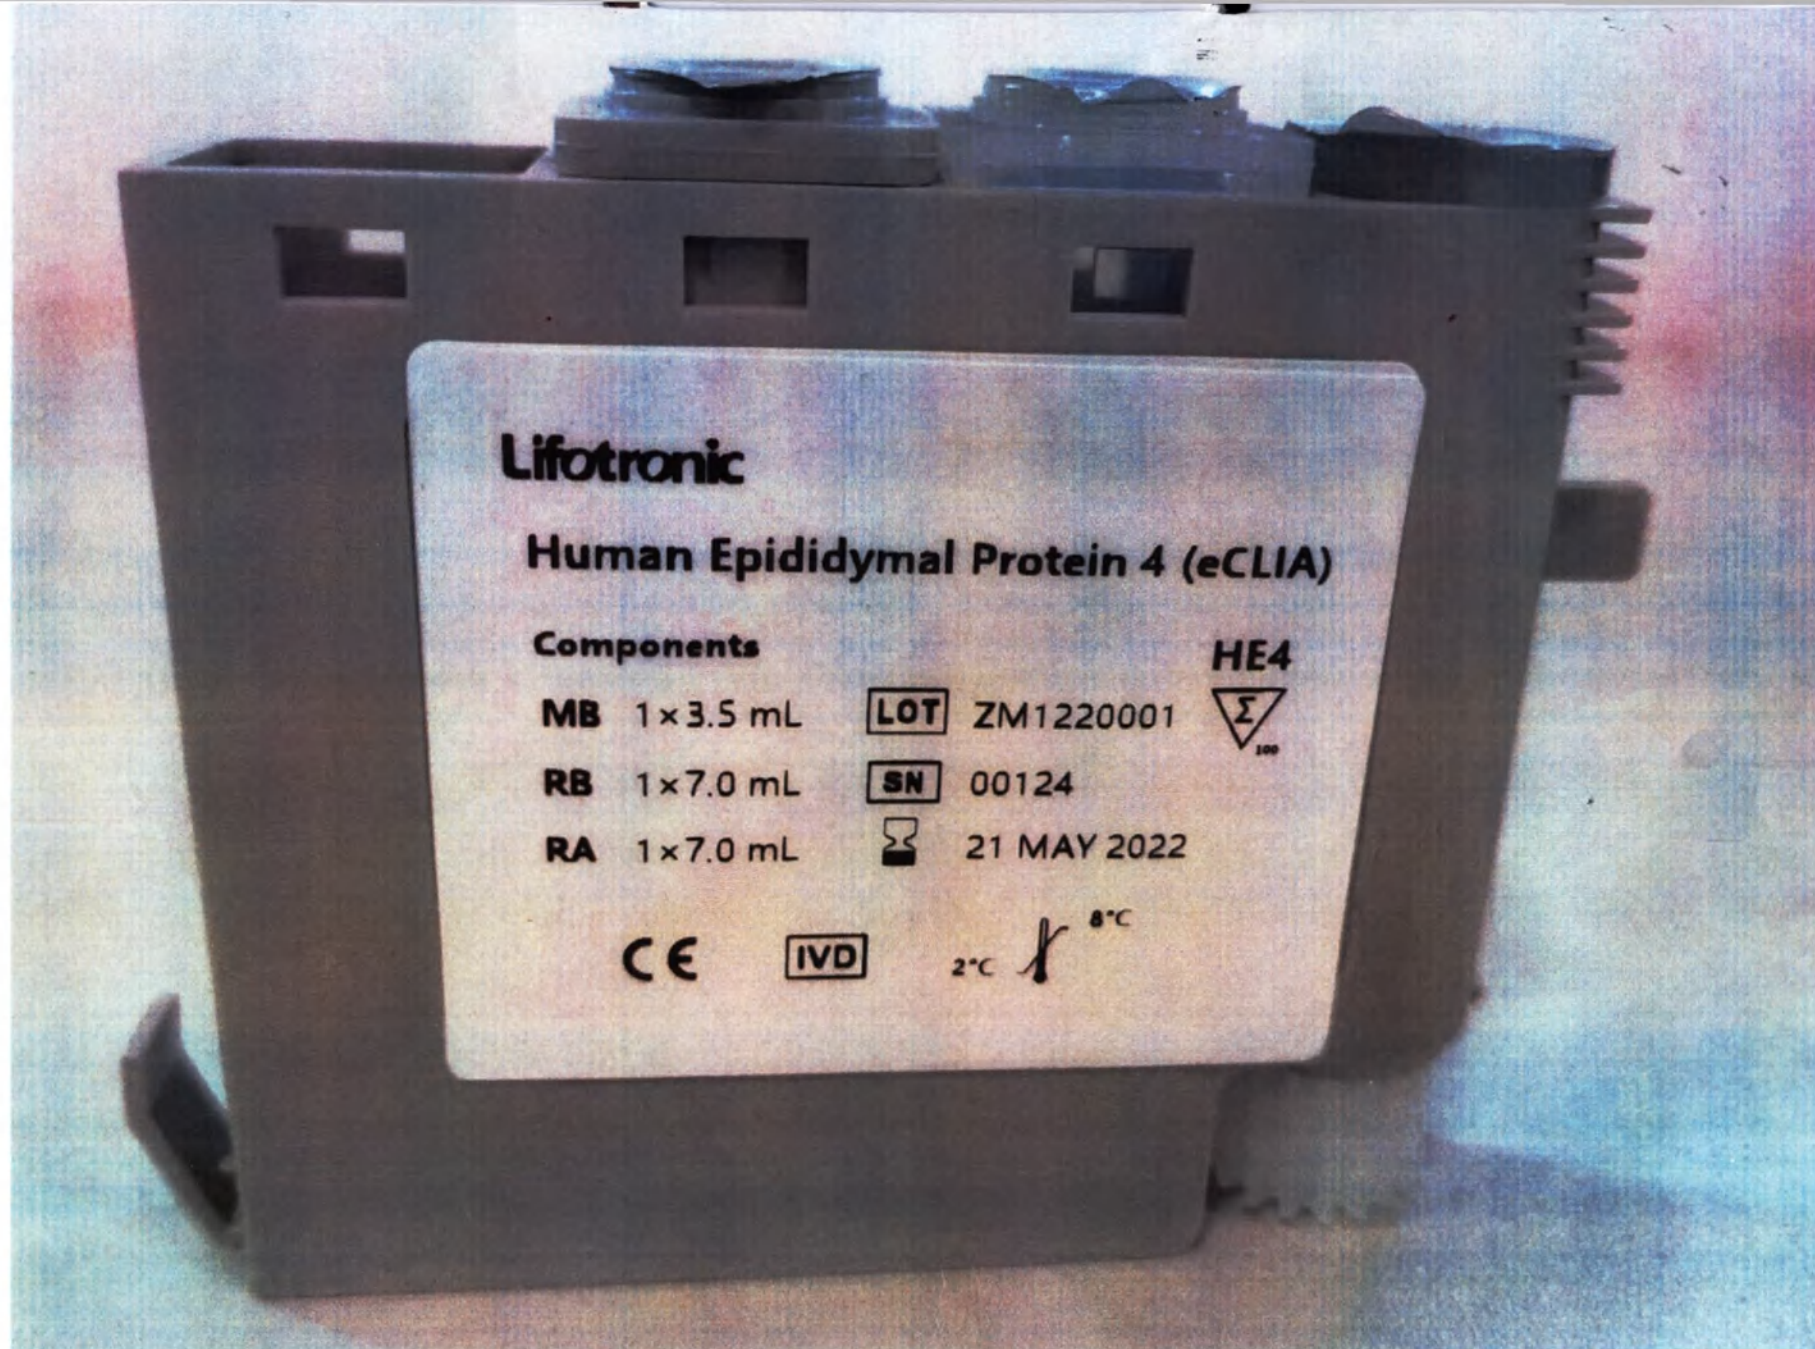

Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения белка 4 эпидидимиса человека электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Human Epididymal Protein 4 (eCLIA) / HE4))

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 8 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАЙЛО Р. В

