

LOGEEKS^S MS

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ЛОГИКС
Медицинские Системы»



И.Б. Красовский
М.П. 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЛОГИКС МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ»
РОССИЯ, Г. НОВОСИБИРСК

«17» августа 2022 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ TUBERLOCK LOGEEKS MS
по ТУ 32.50.22-001-28724805-2019
производства ООО «ЛОГИКС Медицинские системы»

1. Общий вид Чашка ревизионная Tuberlock Multi-hole


Общий вид – Чашка ревизионная Tuberlock Multi-hole распространяется и применим для общего вид Чашка ревизионная Tuberlock Multi-hole всех вариантов моделей. Вид сбоку.

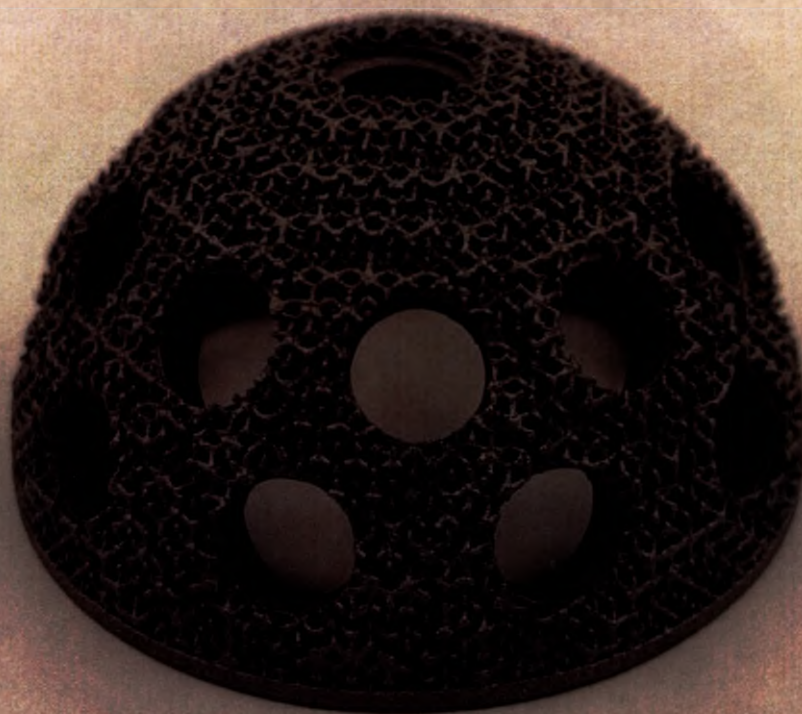

Чашка ревизионная Tuberlock Multi-hole, вид снизу

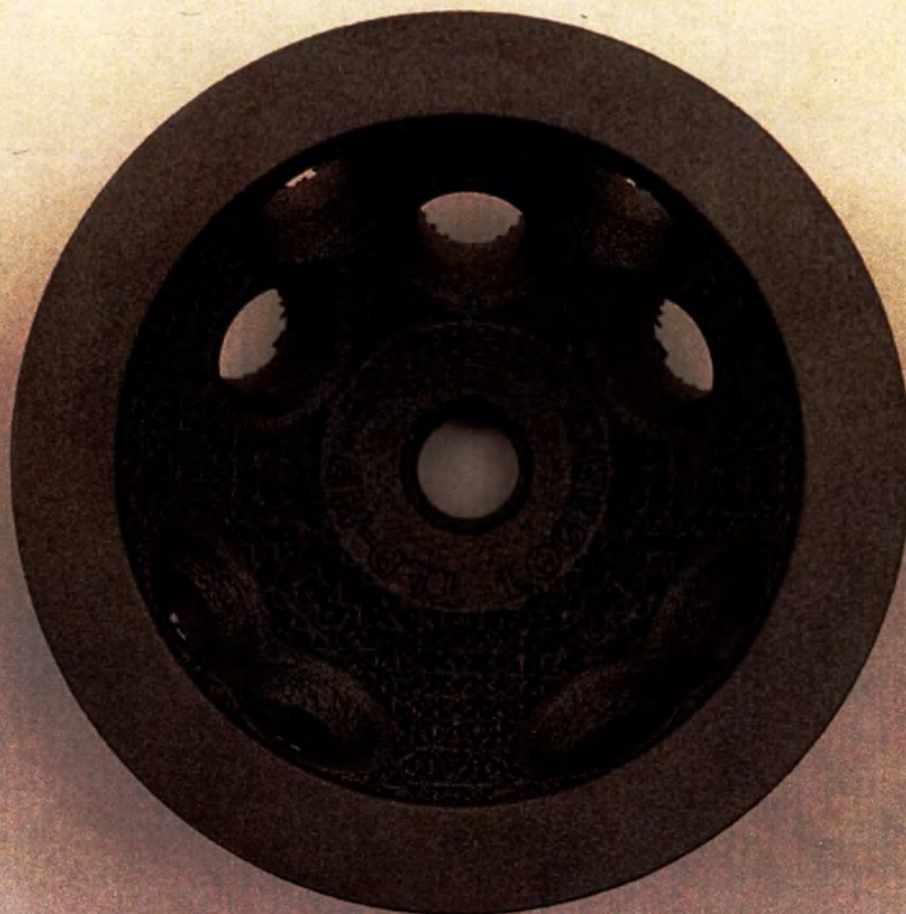

Чашка ревизионная Tuberlock Multi-hole, вид сверху

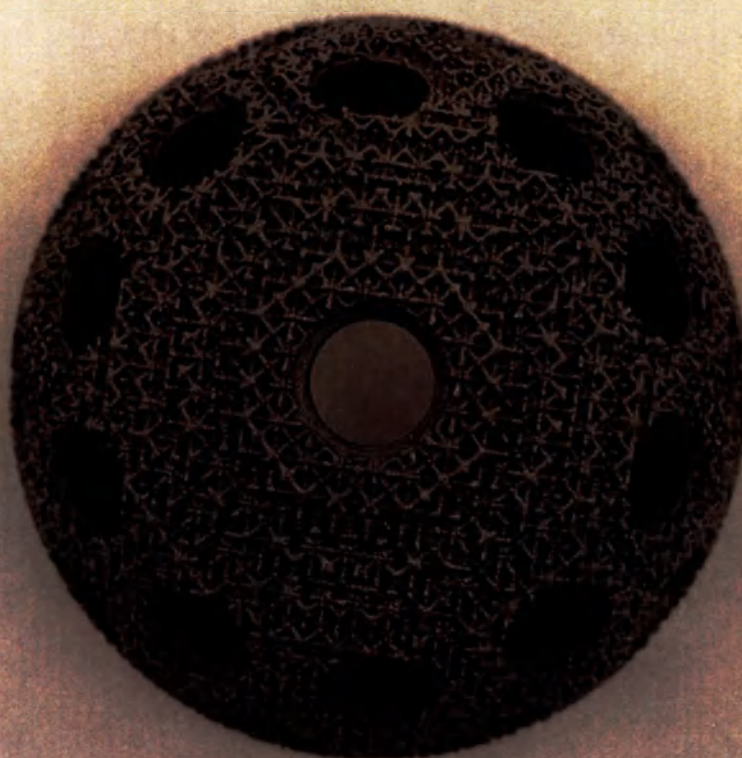


Электронная версия этого документа поддерживается на сервере организации представителем руководства по качеству. Действующая версия документа находится на
\\Fileserver\logEEKS\ISO_LOGEEKS_MS\СМК\Досье_Tuberlock LOGEEKS MS

2. Вид Чашки ревизионной Tuberlock Multi-hole в индивидуальной блистерной упаковке, наружная картонная коробка, наклейки с индивидуальной маркировкой. Распространяются и применимы для Чашки ревизионной Tuberlock Multi-hole всех вариантов моделей.




3. Общий вид Чашка ревизионная Tuberlock Direct-hole


Общий вид – Чашка ревизионная Tuberlock Direct-hole распространяется и применим для общего вида Чашка ревизионная Tuberlock Direct-hole всех вариантов моделей, вид сбоку.

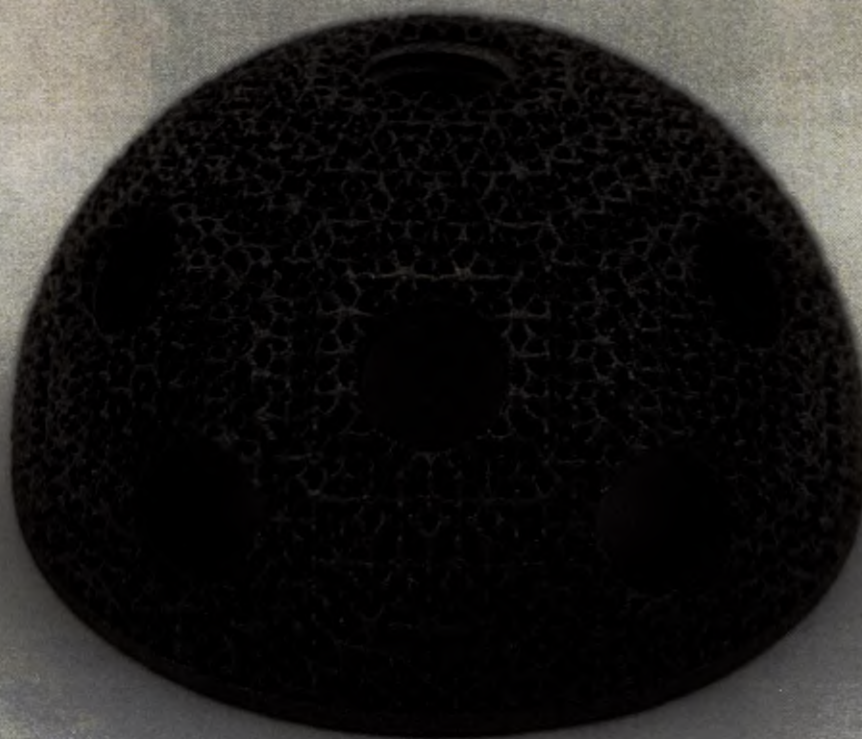

Чашка ревизионная Tuberlock Direct-hole, вид снизу

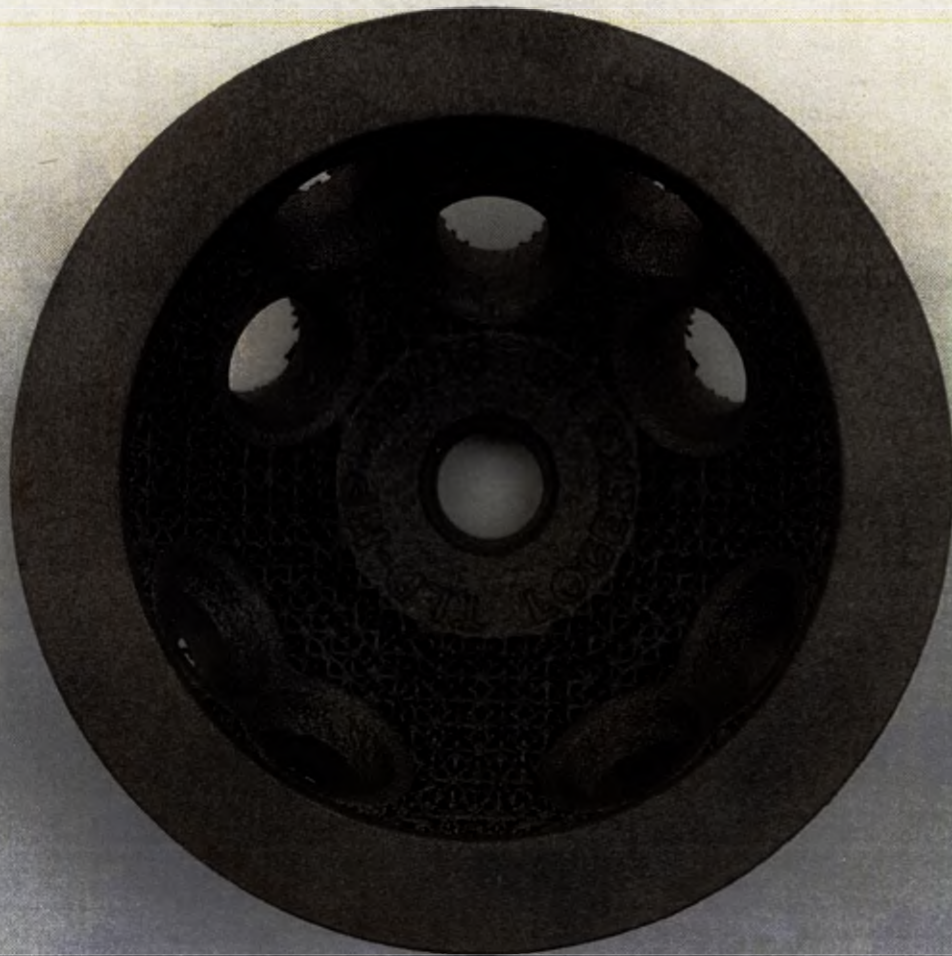

Чашка ревизионная Tuberlock Direct-hole, вид сверху

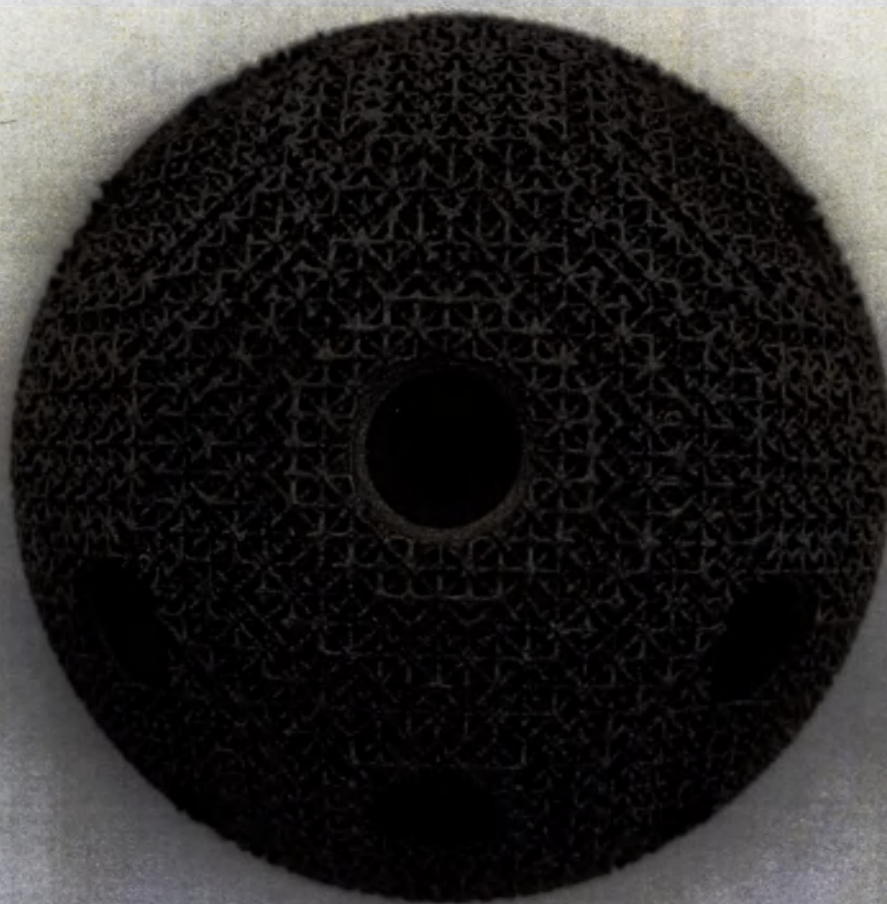

4. Вид Чашки ревизионной Tuberlock Direct-hole в индивидуальной блистерной упаковке, наружная картонная коробка, наклейки с индивидуальной маркировкой. Распространяются и применимы для Чашки ревизионной Tuberlock Direct-hole всех вариантов моделей.




5. Общий вид Пробка чашки Tuberlock, вид сверху




Пробка чашки Tuberlock, вид сбоку



Пробка чашки Tuberlock, вид снизу



6. Вид **Пробки чашки Tuberlock** в индивидуальной упаковке, наружная картонная коробка, наклейки с индивидуальной маркировкой.

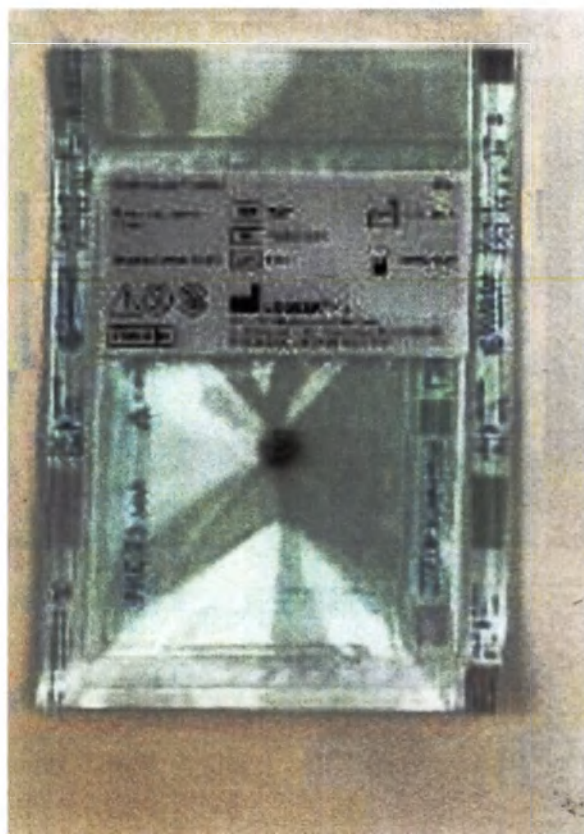

7. Общий вид Аугмента ацетабулярного Tuberlock


Общий вид – Аугмента ацетабулярного Tuberlock распространяется и применим для общего вида Аугмента ацетабулярного Tuberlock всех вариантов моделей, вид сбоку




Аугмент ацетабулярный Tuberlock, вид снизу



Аугмент ацетабулярный Tuberlock, Вид сверху

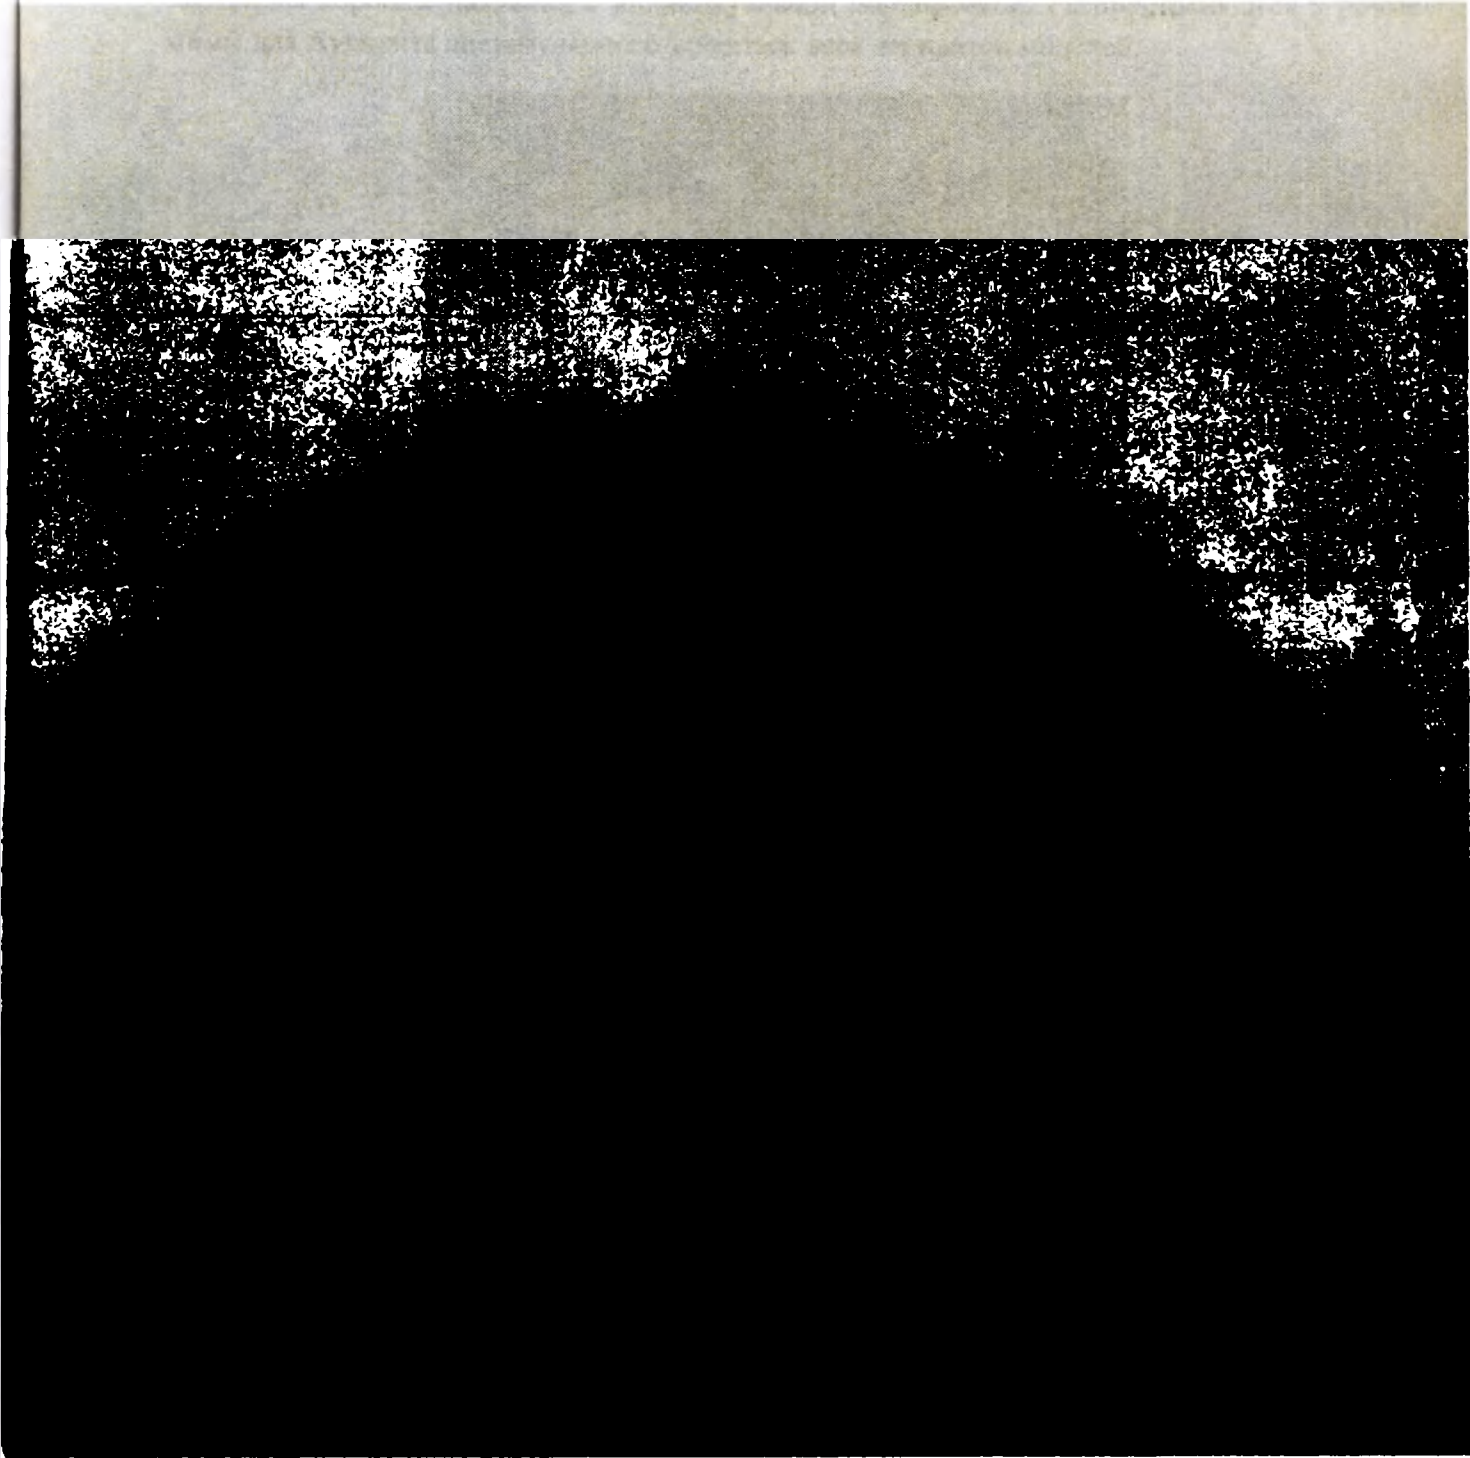


8. Вид Аугмента ацетабулярного Tuberlock в индивидуальной блистерной упаковке, наружная картонная коробка, наклейки с индивидуальной маркировкой. Распространяются и применимы для Аугмента ацетабулярного Tuberlock всех вариантов моделей.

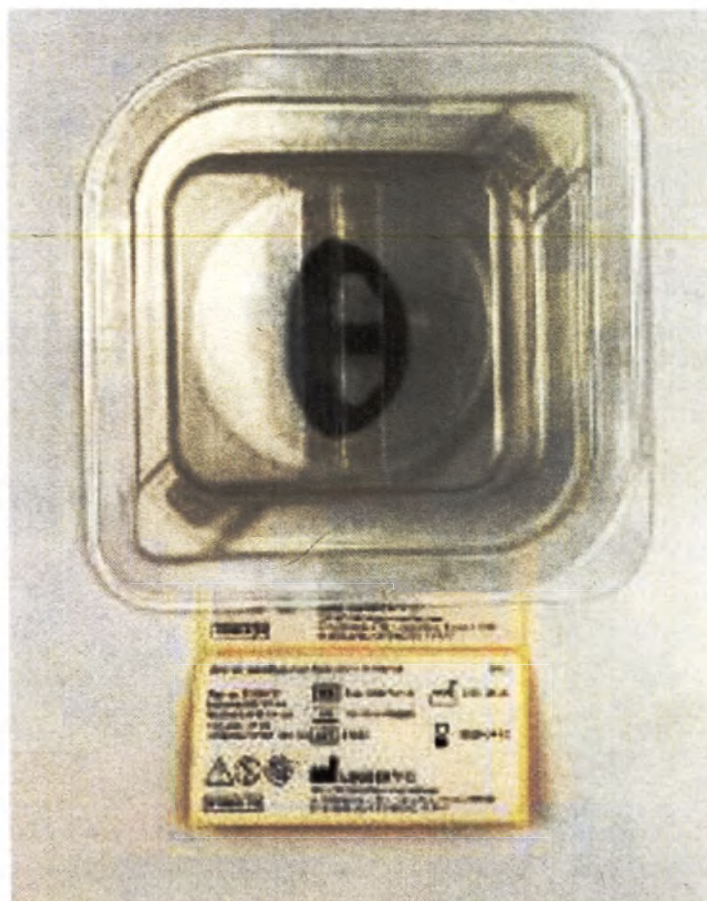

9. Общий вид Колонна Tuberlock

Общий вид – Колонна Tuberlock распространяется и применим для общего вида Колонна Tuberlock всех вариантов моделей, вид сверху

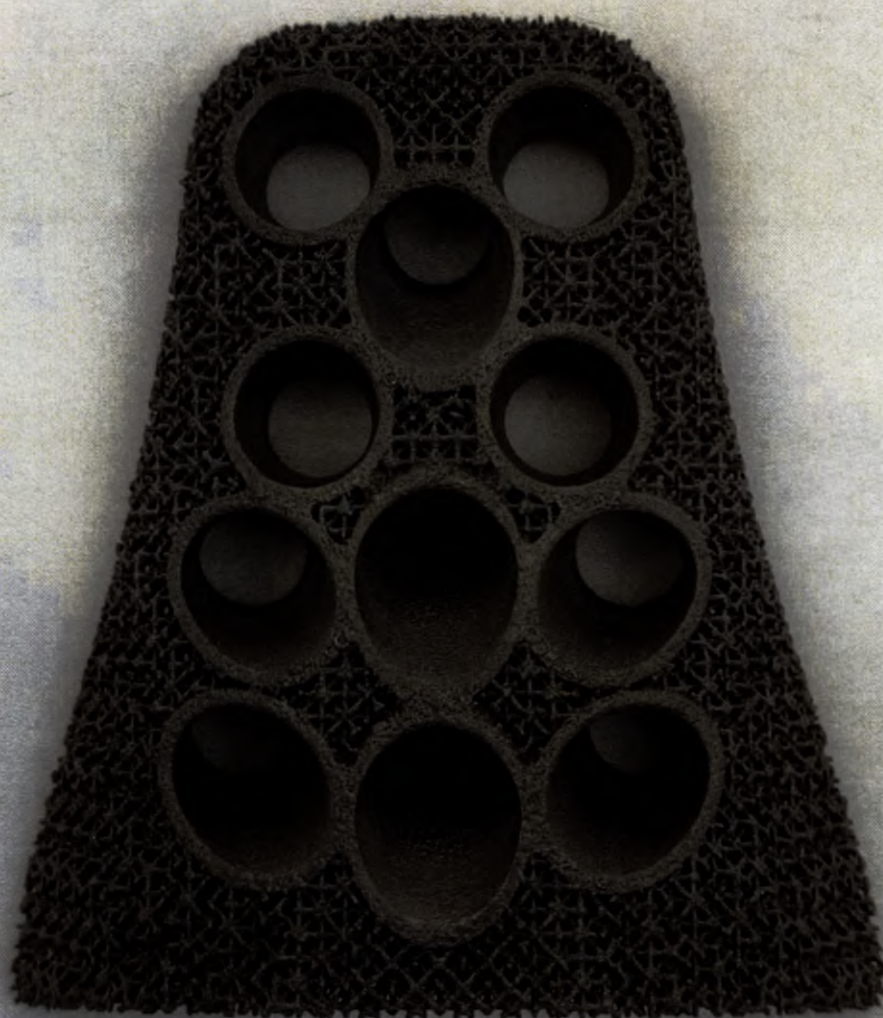

Колонна Tuberlock, вид снизу



Колонна Tuberlock, вид сбоку




10. Вид Колонны Tuberlock в индивидуальной блистерной упаковке, наружная картонная коробка, наклейки с индивидуальной маркировкой. Распространяются и применимы для Колонны Tuberlock всех вариантов моделей.




11. Общий вид Вкладыш колонны Tuberlock


Общий вид – Вкладыш колонны Tuberlock распространяется и применим для общего вида Вкладыша колонны Tuberlock всех вариантов моделей, вид сбоку

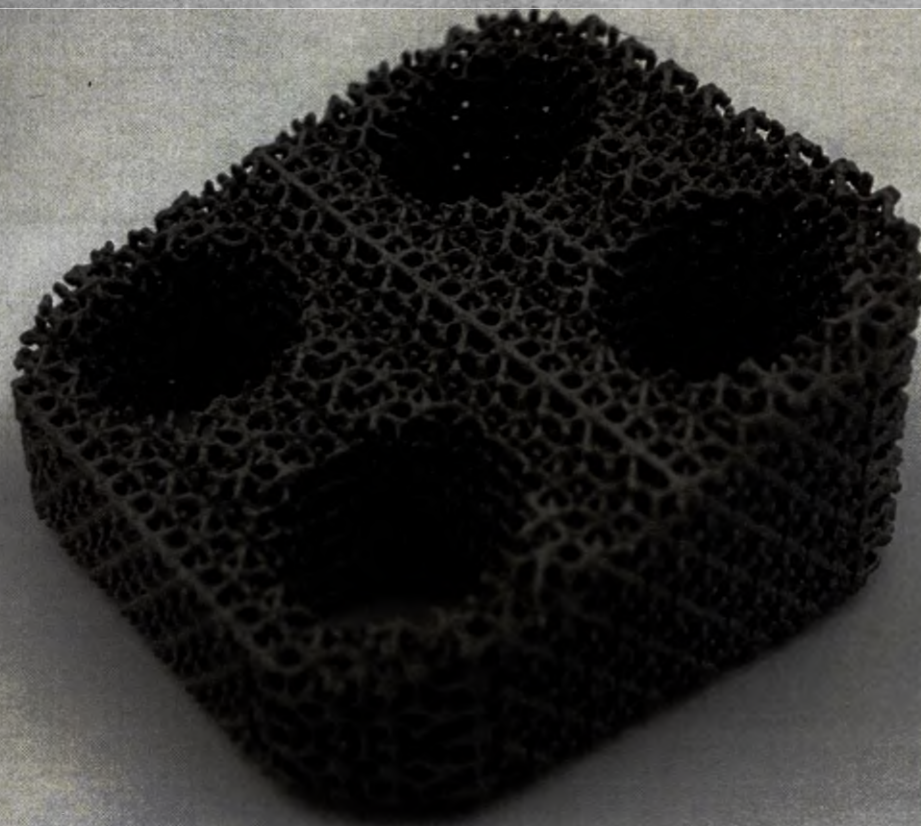

Вкладыш колонны Tuberlock, вид снизу

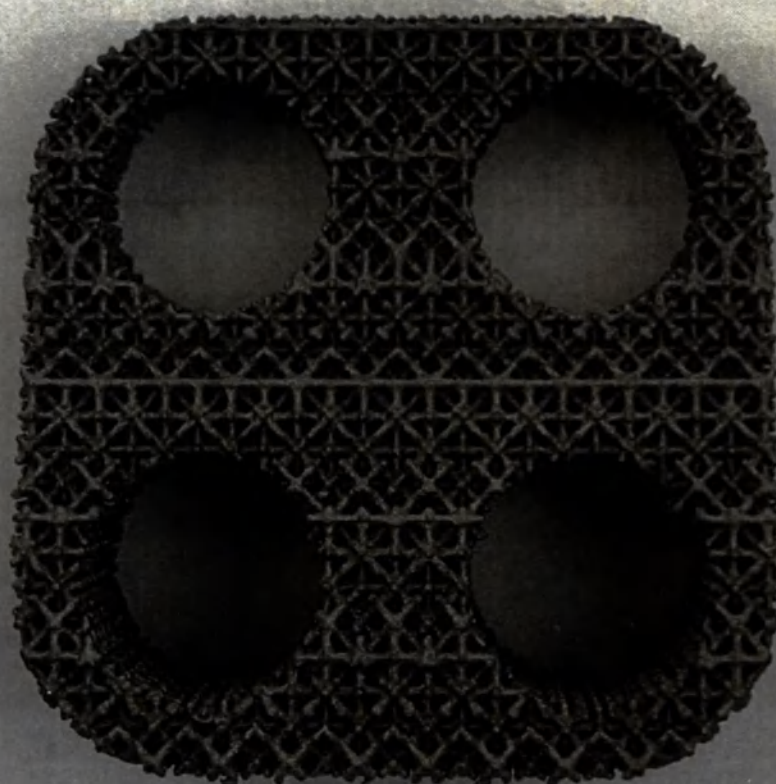

Вкладыш колонны Tuberlock, вид сверху

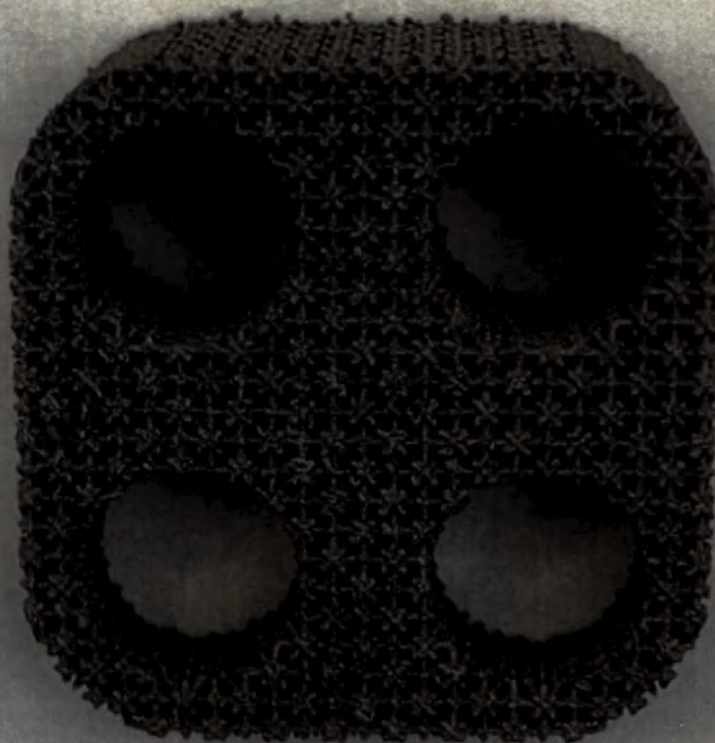

12. Вид Вкладыша колонны Tuberlock в индивидуальной блистерной упаковке, наружная картонная коробка, наклейки с индивидуальной маркировкой. Распространяются и применимы для Вкладыша колонны Tuberlock всех вариантов моделей.



Электронная версия этого документа поддерживается на сервере организации представителем руководства по качеству. Действующая версия документа находится на
\\Fileserver\logEEKS\ISO_LOGEEKS_MS\CMK\Досье_Tuberlock LOGEEKS MS

13.Общий вид транспортной упаковки с маркировкой для Компонентов для эндопротезирования вертлужной впадины Tuberlock LOGEEKS MS. Распространяется и применим для компонентов для эндопротезирования вертлужной впадины Tuberlock LOGEEKS MS.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

26 (двадцать шесть) листов

Директор ООО «ЛОГИКС Медицинские системы»
Красовский И.Б.

М.П. «17» августа 2022 год

