

ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КС-Проф»

Евдокимов С.П.



27 декабря 2021 г.

Фотографические изображения


Сканер стоматологический 3D Ceramill Map 600+
производства

Amann Girrbach AG (Аманн Гиррбах АГ), Австрия


2021 г.




Сканер стоматологический 3D Ceramill Map 600+. Вид спереди.

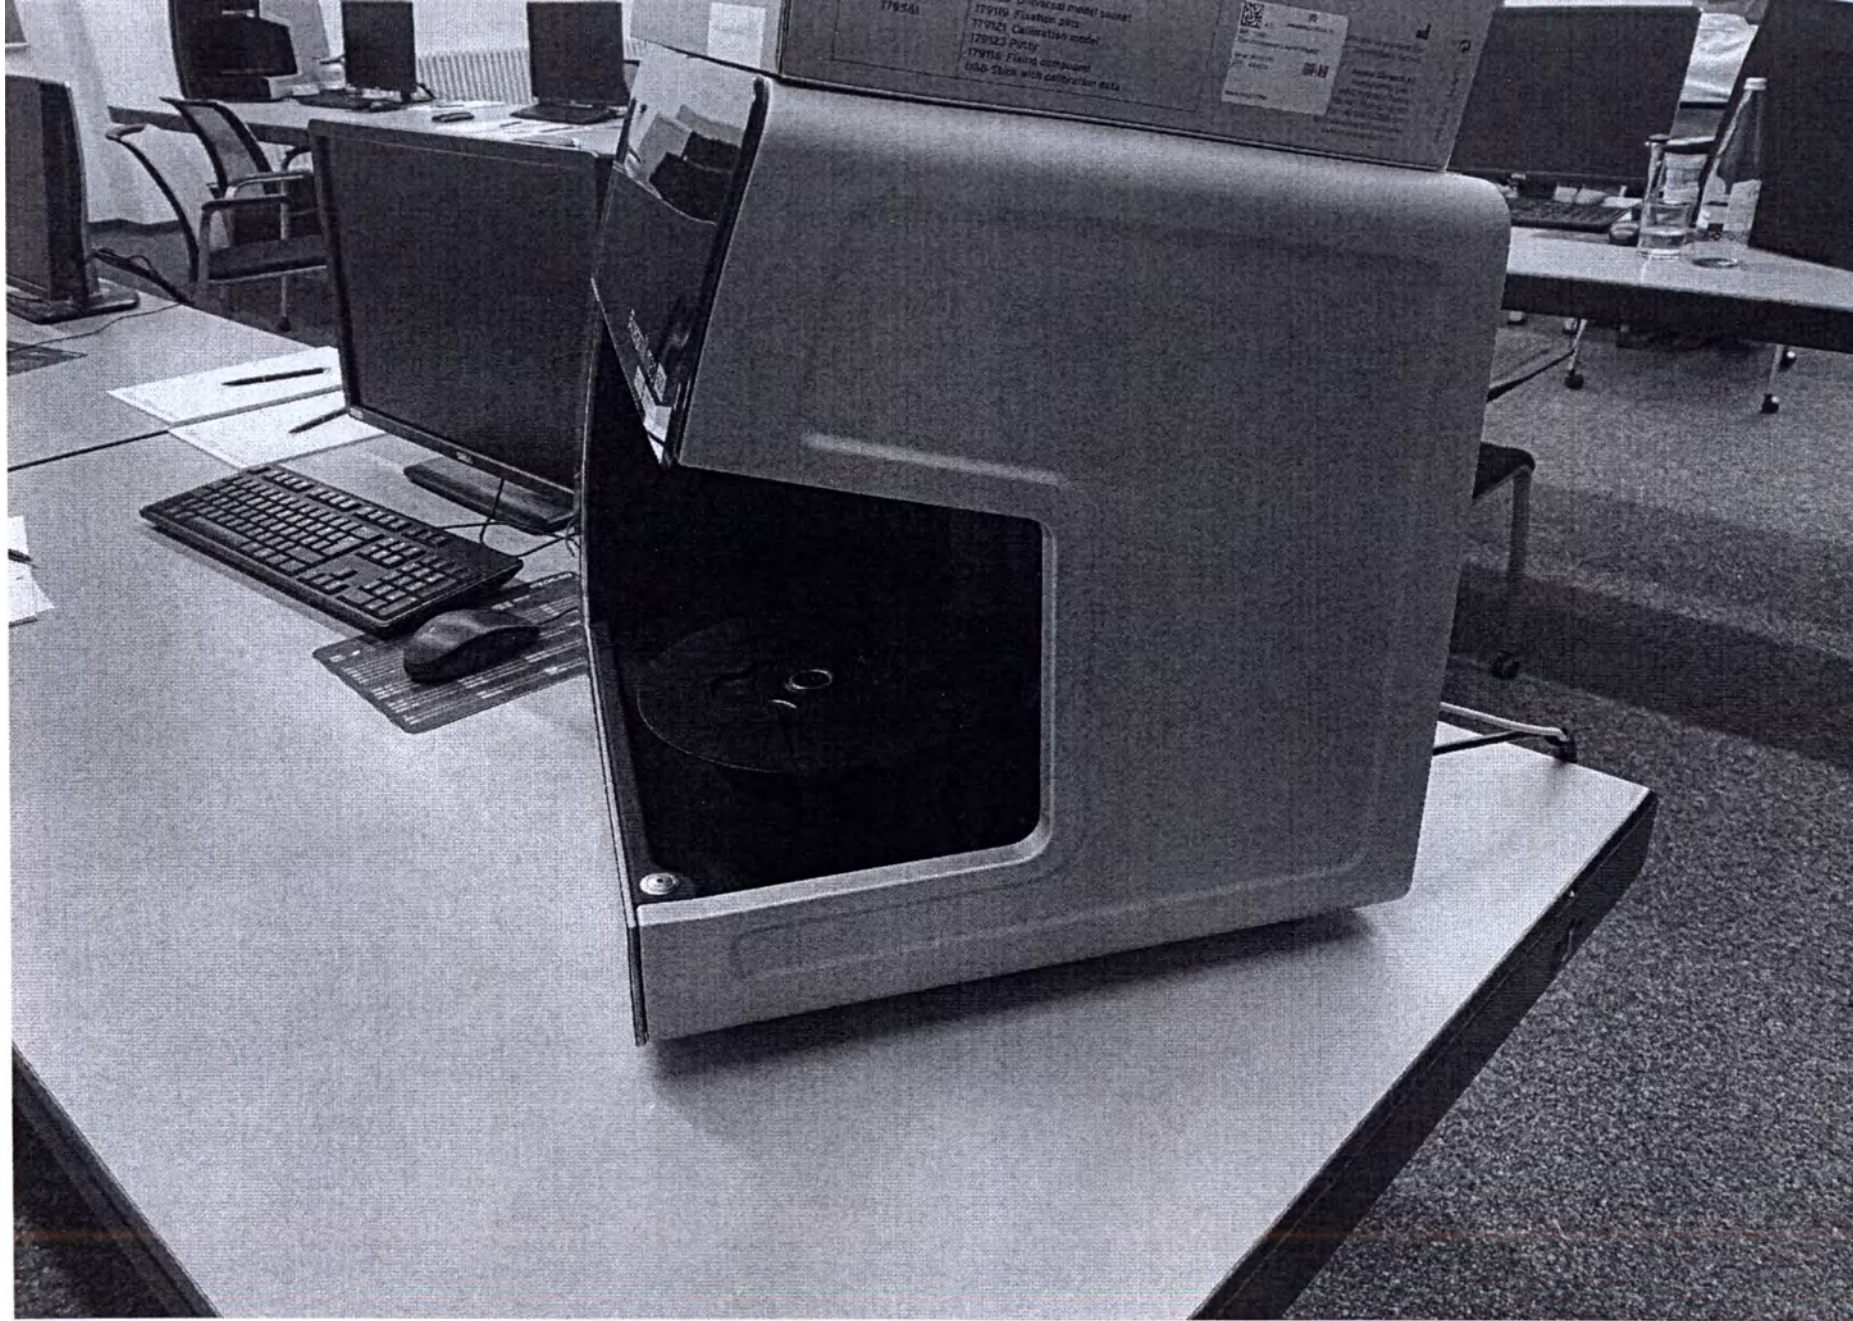


Сканер стоматологический 3D Ceramill Map 600+. Вид сбоку.

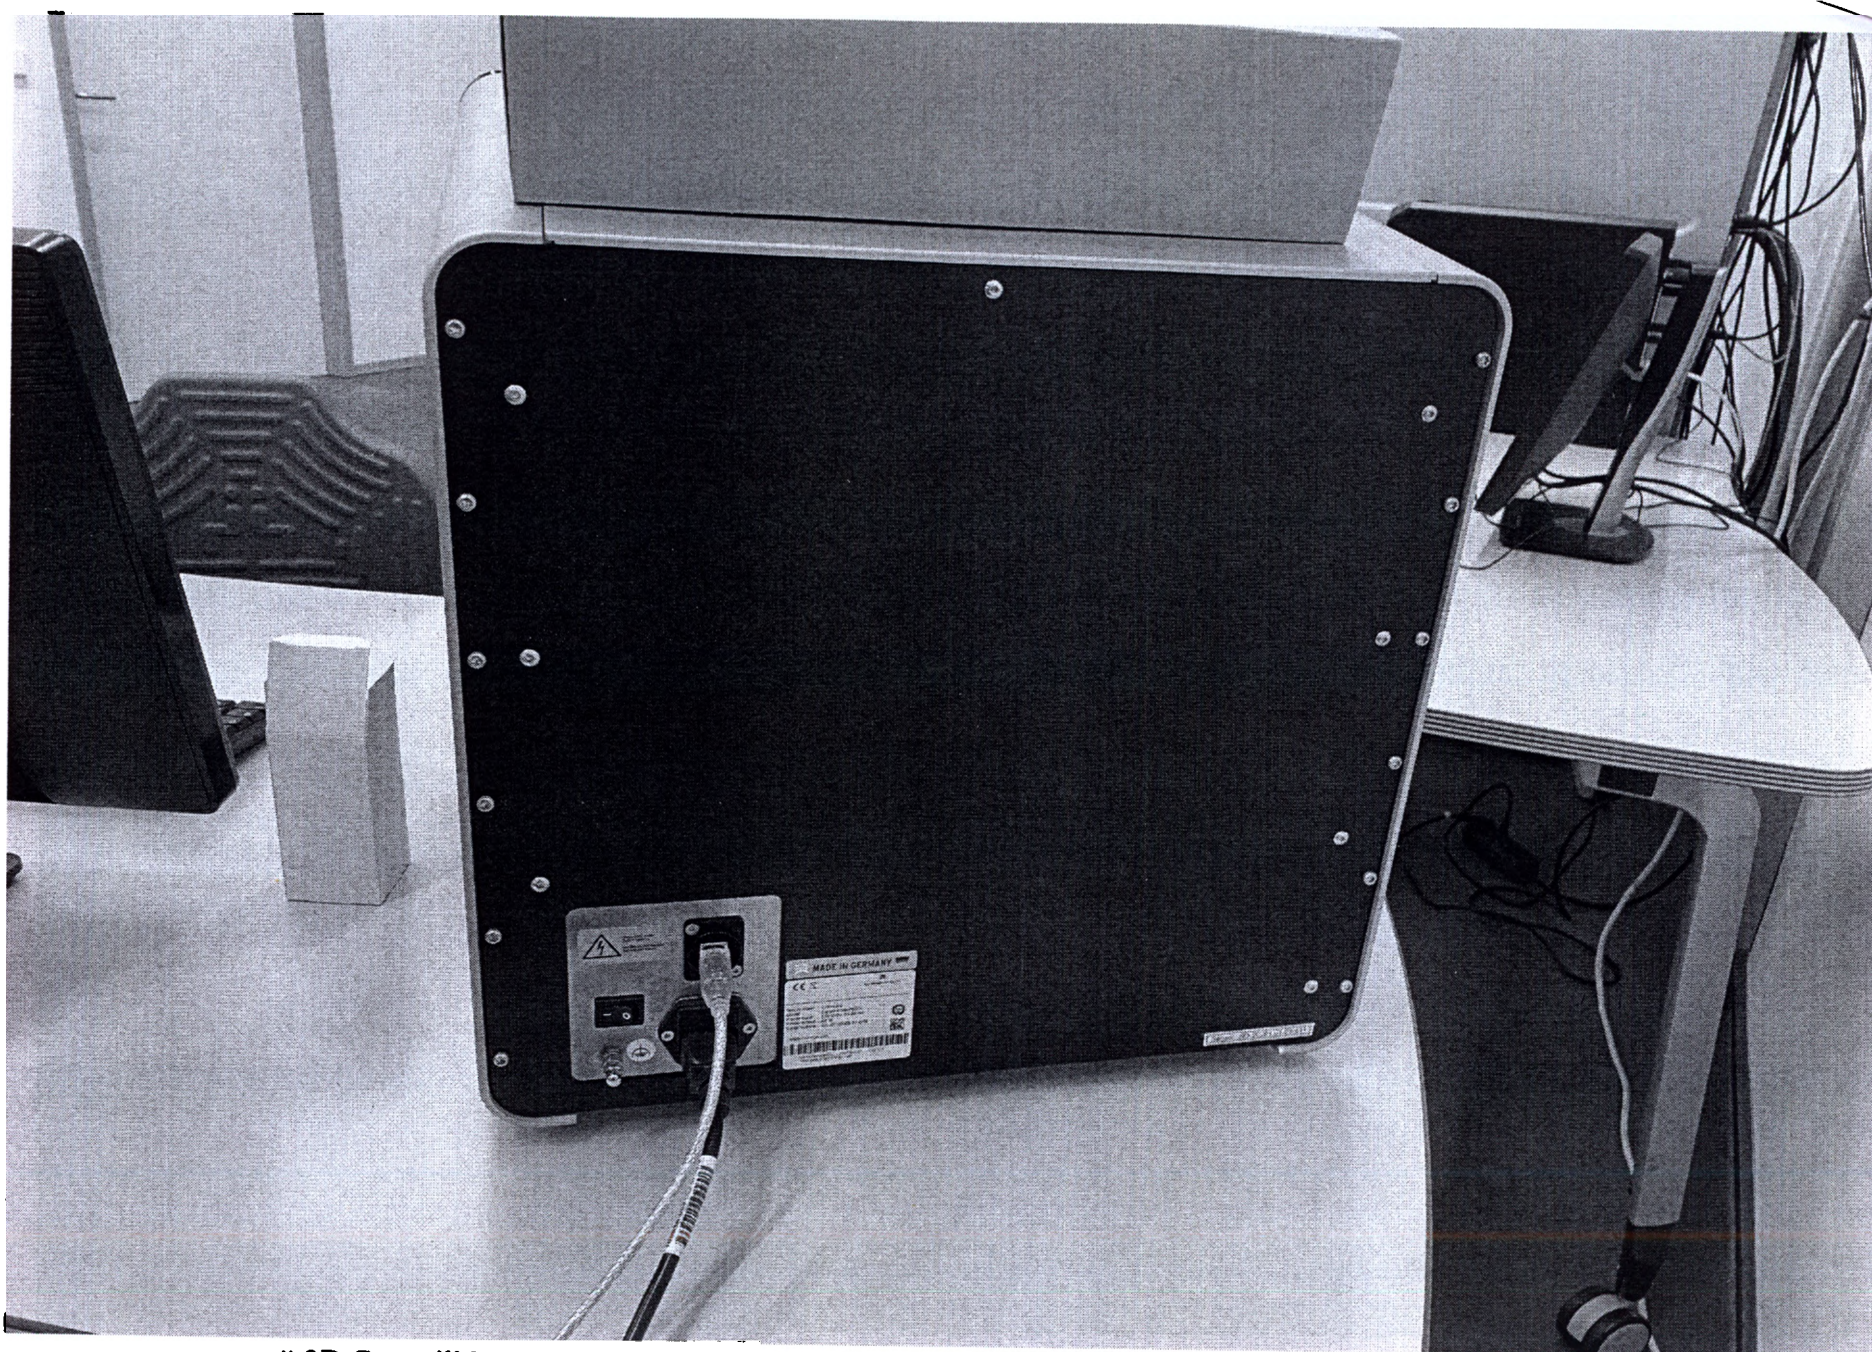


Сканер стоматологический 3D Ceramill Map 600+. Вид сбоку

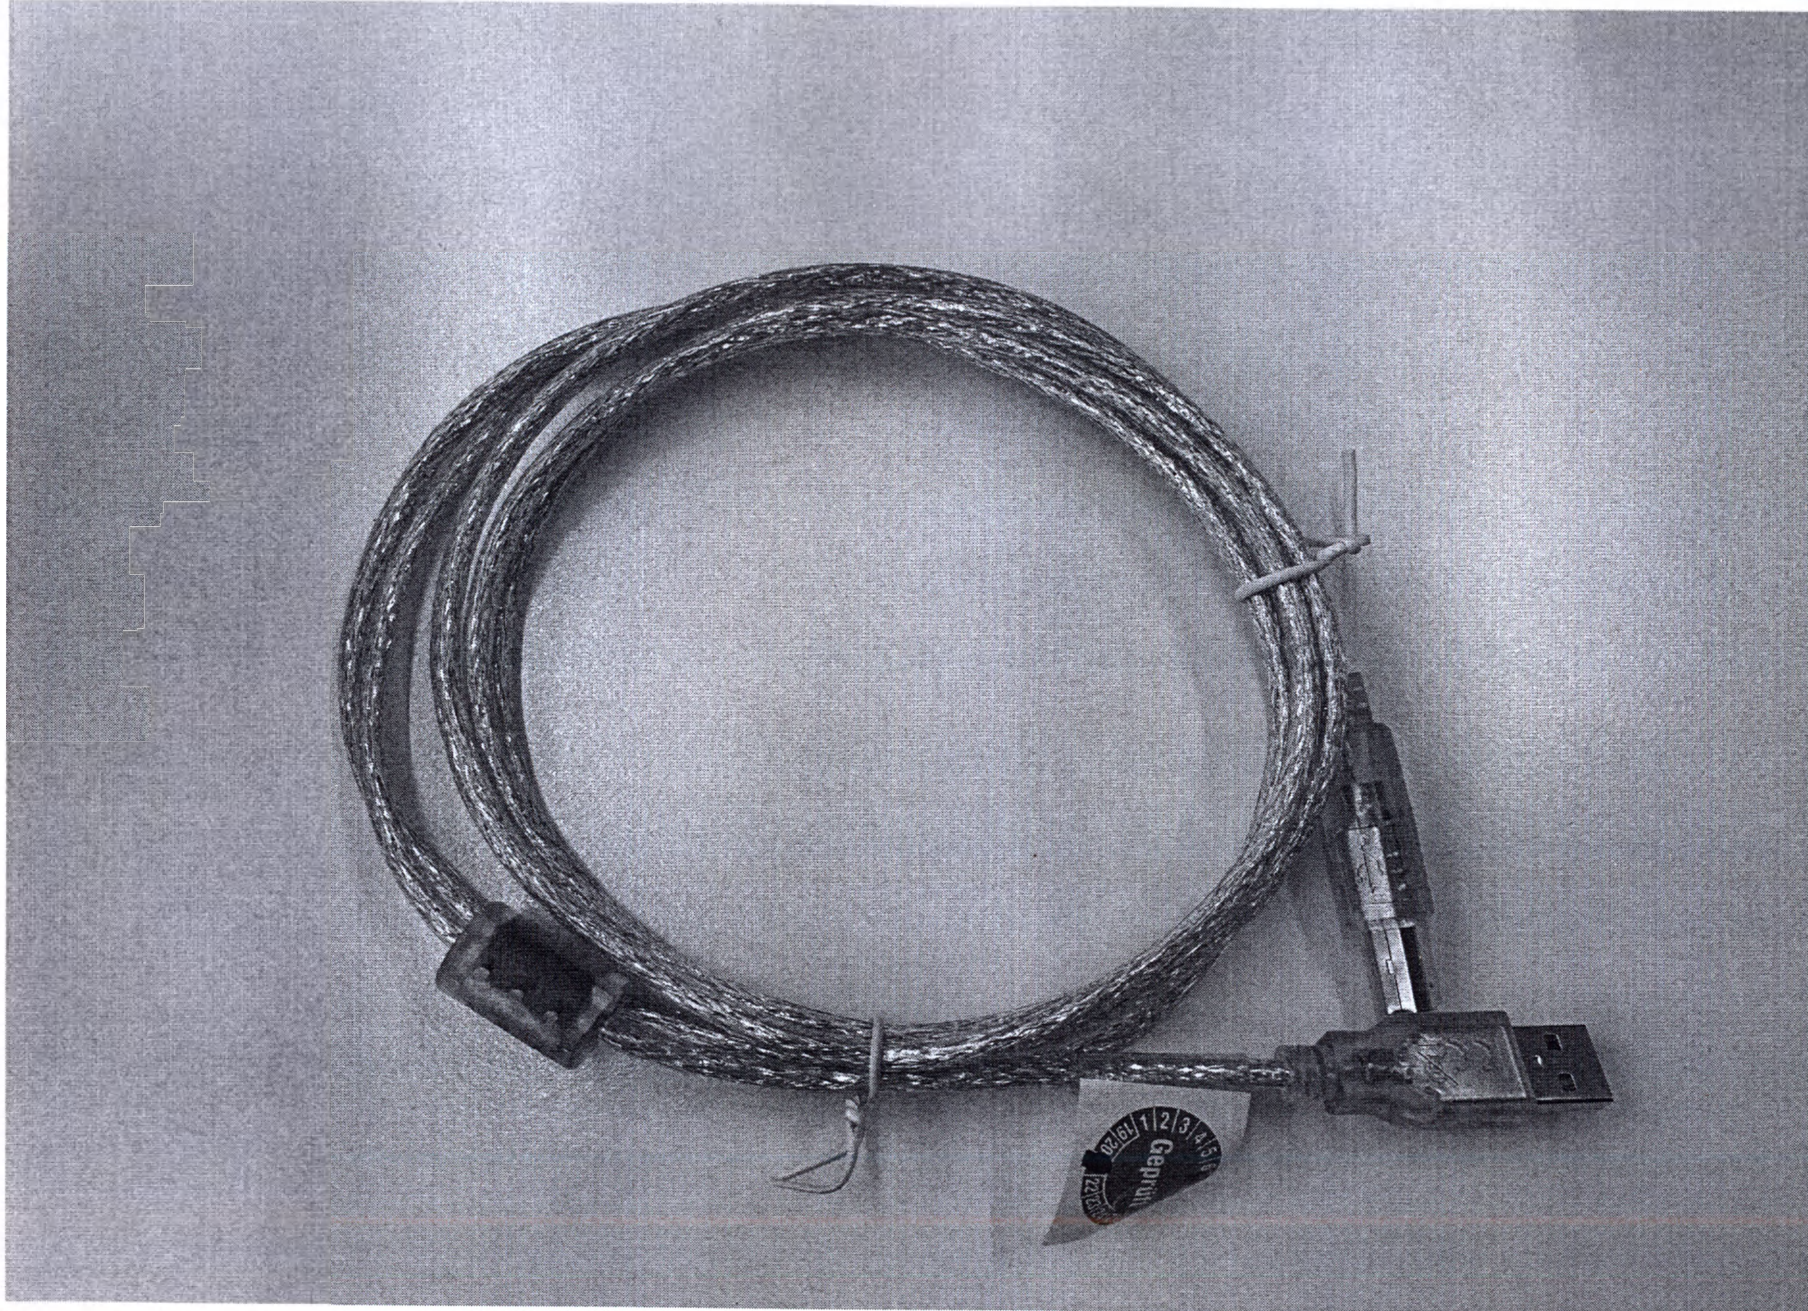


USB-кабель

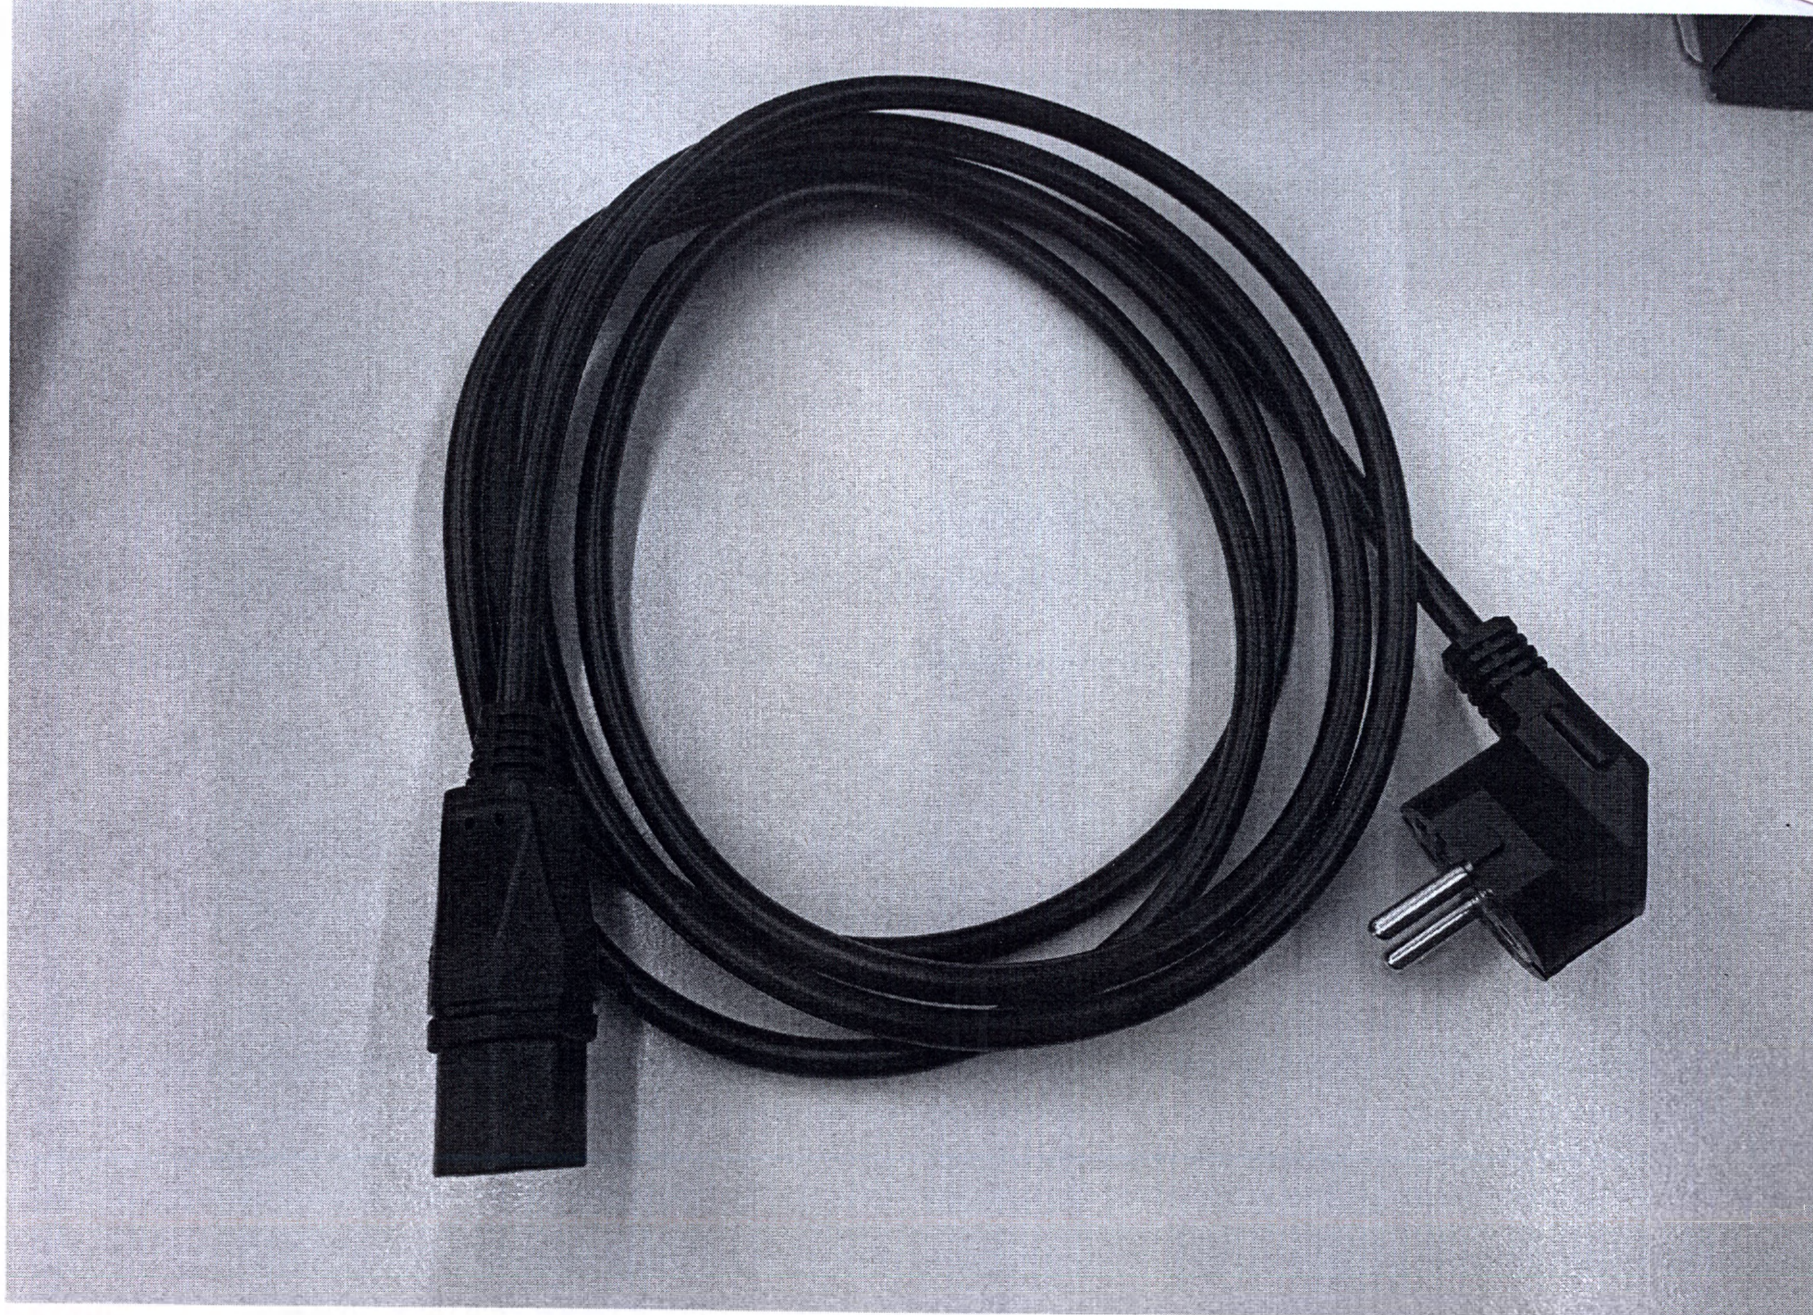


Кабель питания

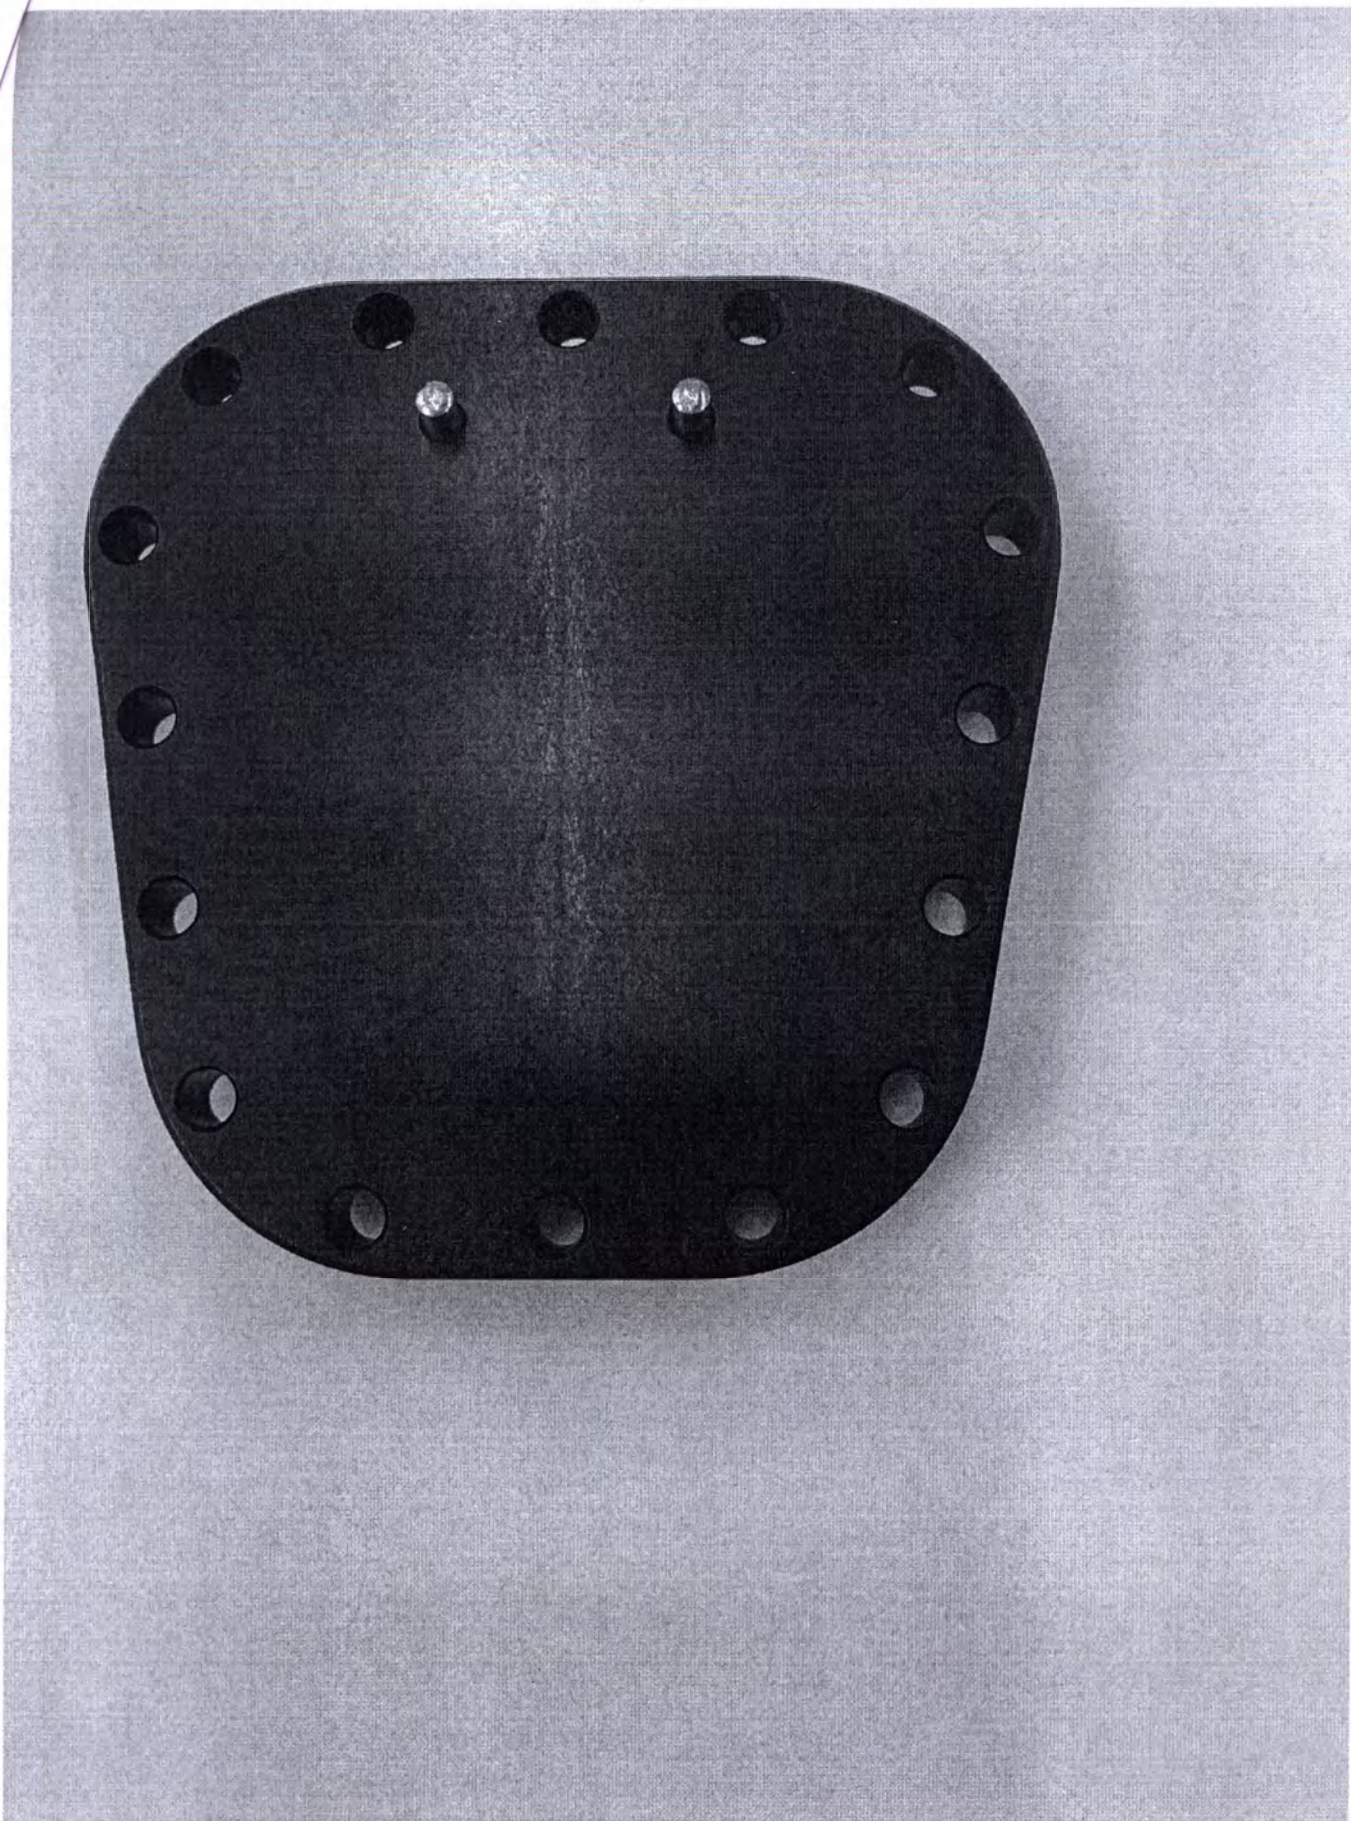

Универсальная крепежная платформа. Вид снизу

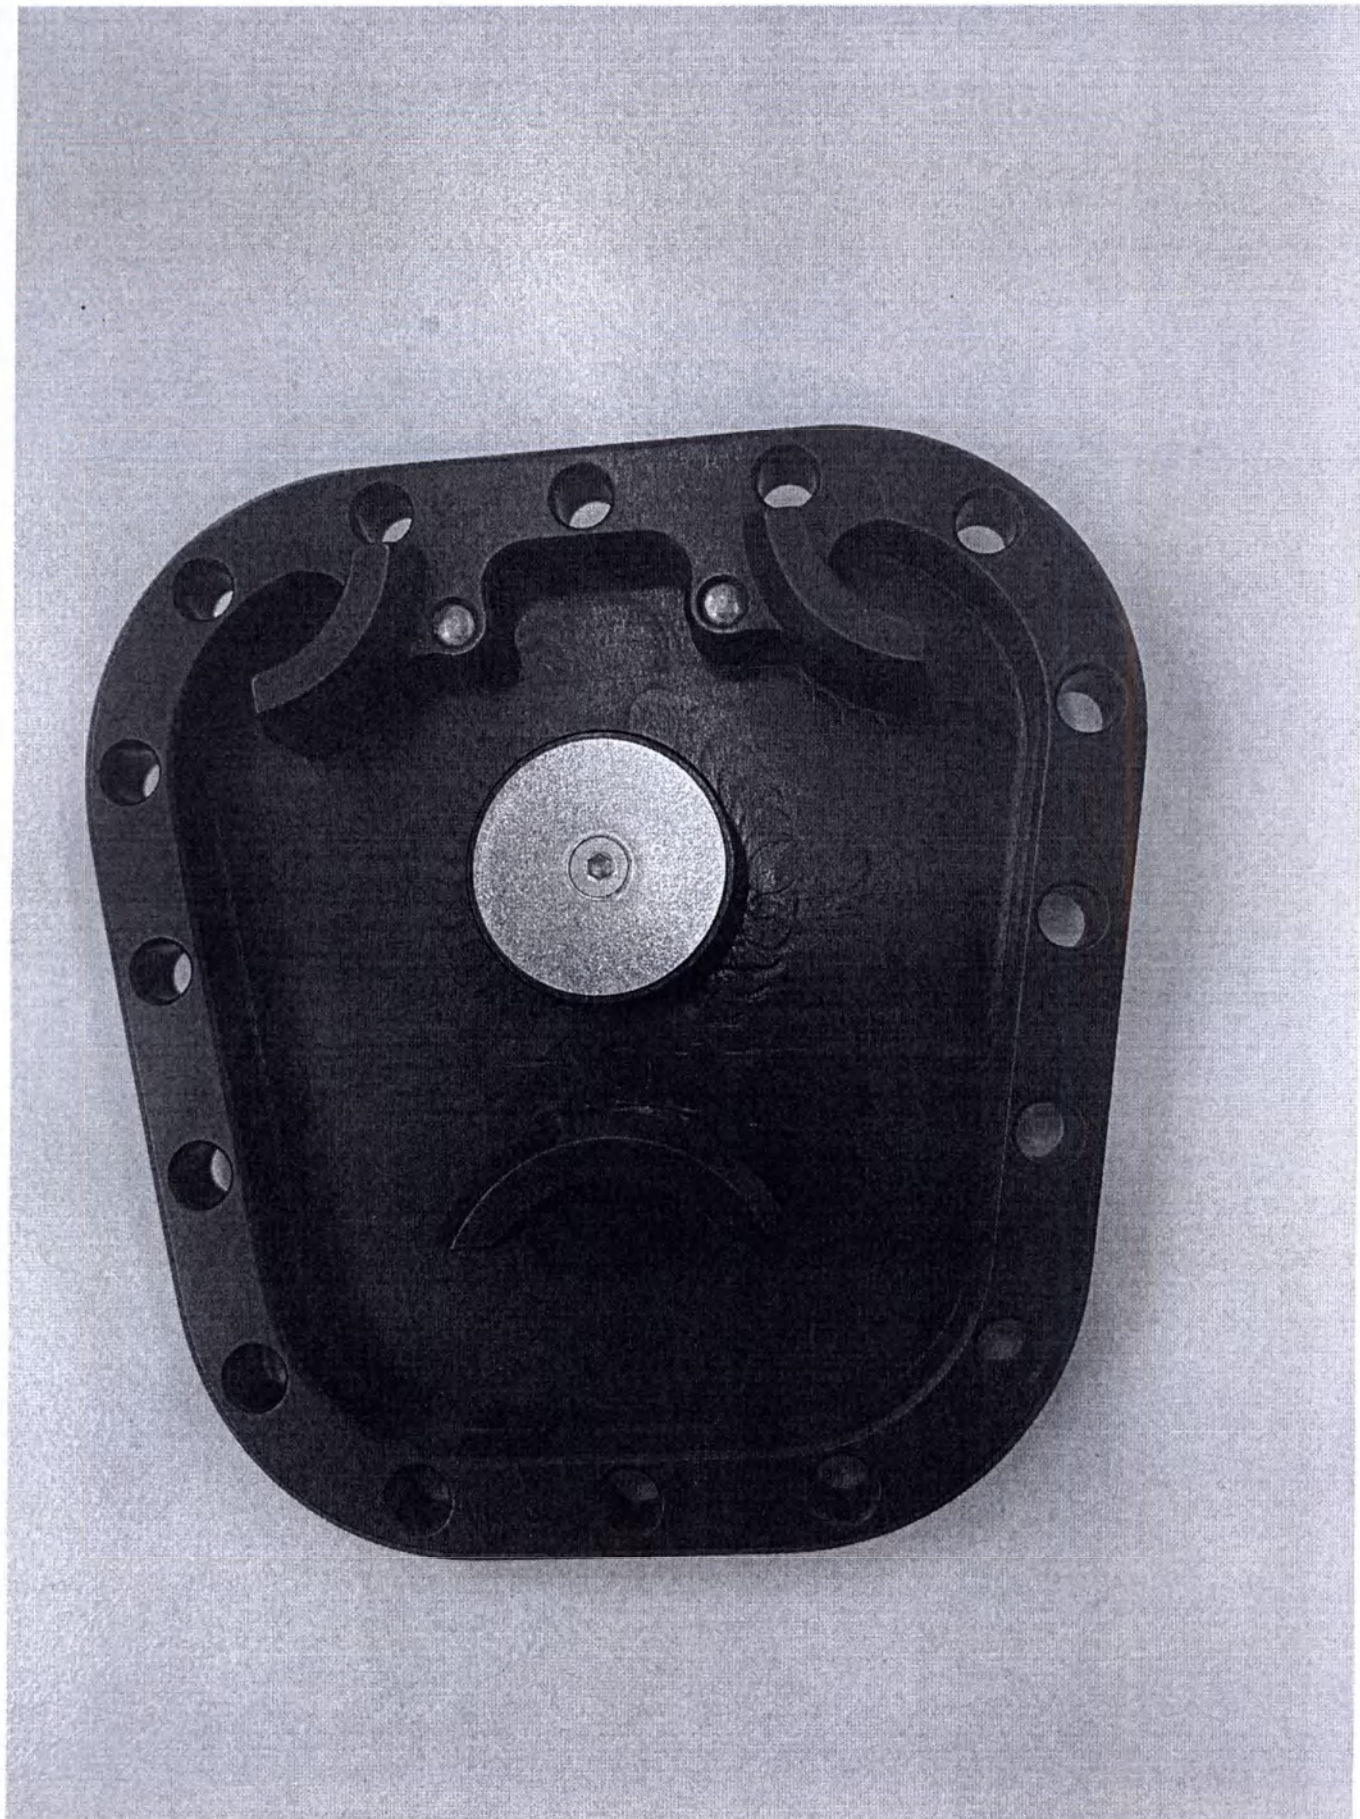


Универсальная крепежная платформа. Вид снизу

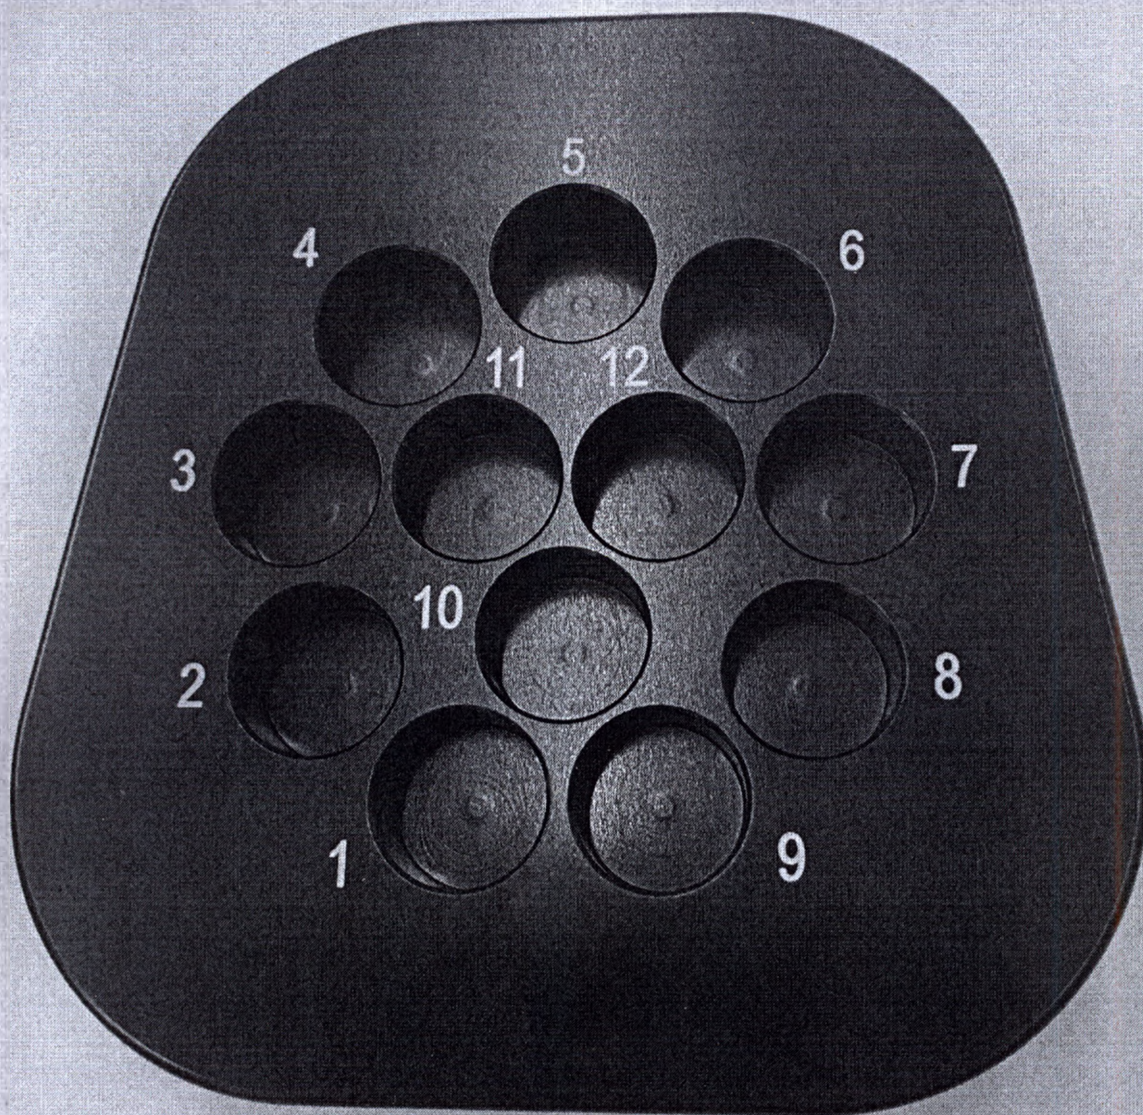


Держатель многофункциональный M-Die. Вид сверху




Держатель многофункциональный M-Die. Вид снизу

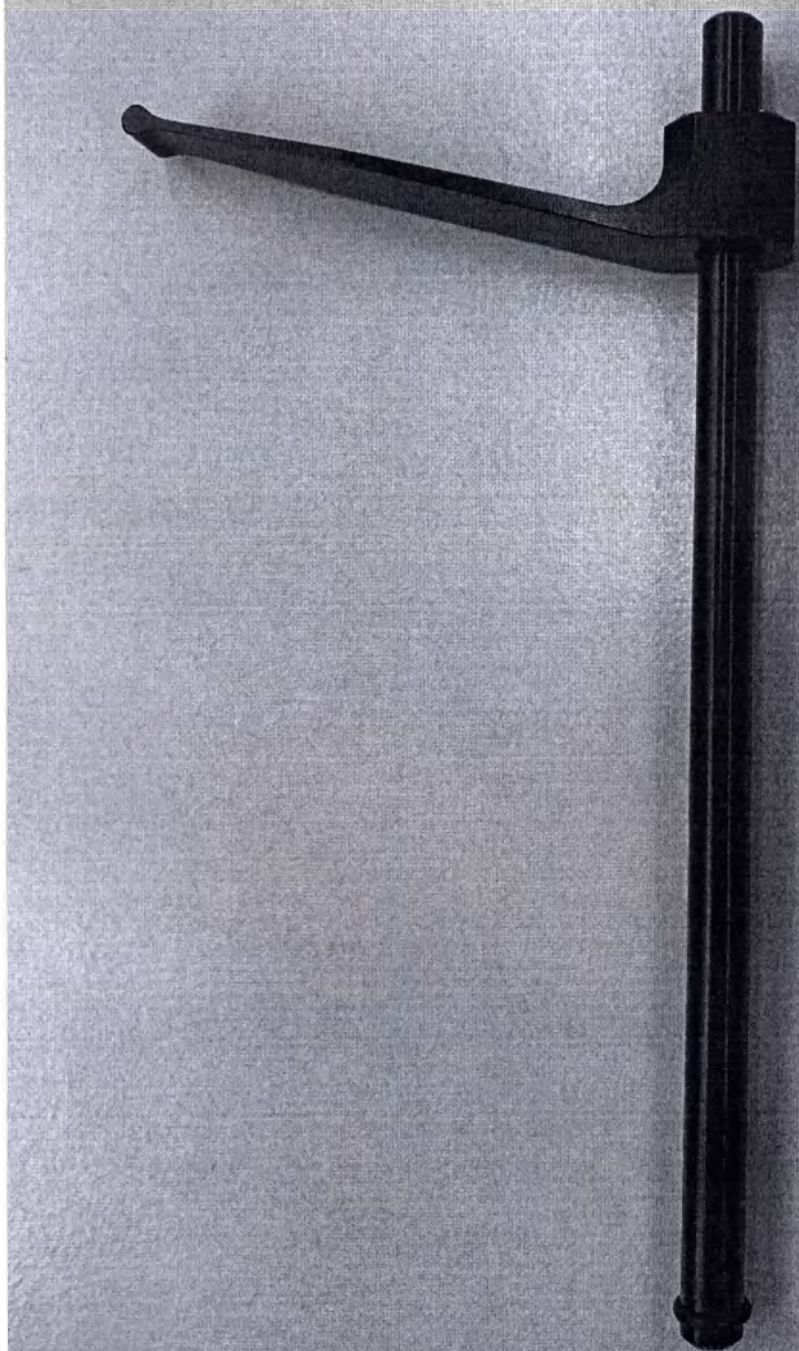


Крепёжный штифт с фиксирующими пружинами

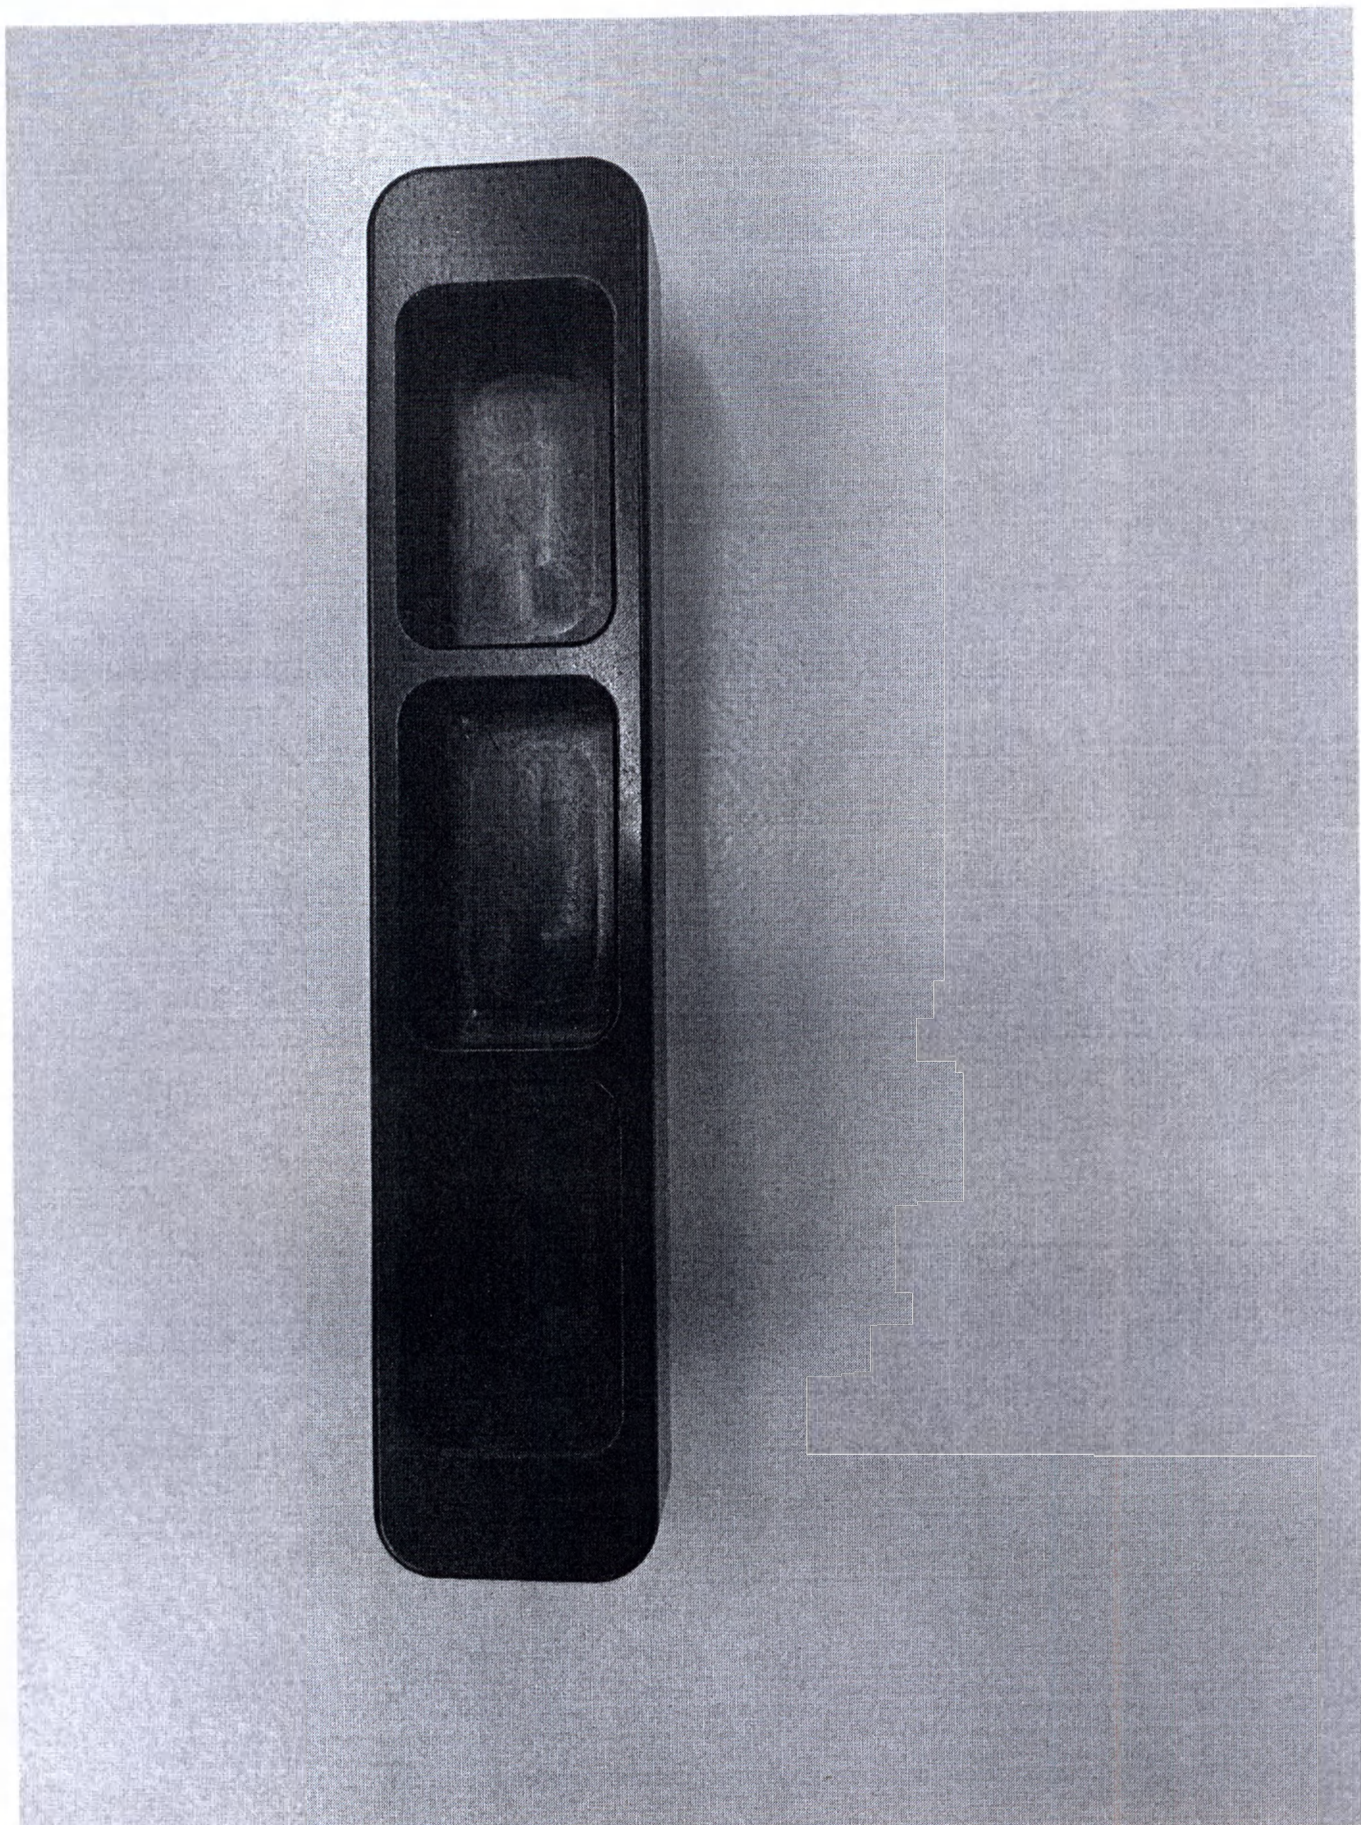


Крепёжный штифт с фиксирующими пружинами. Вид сверху.

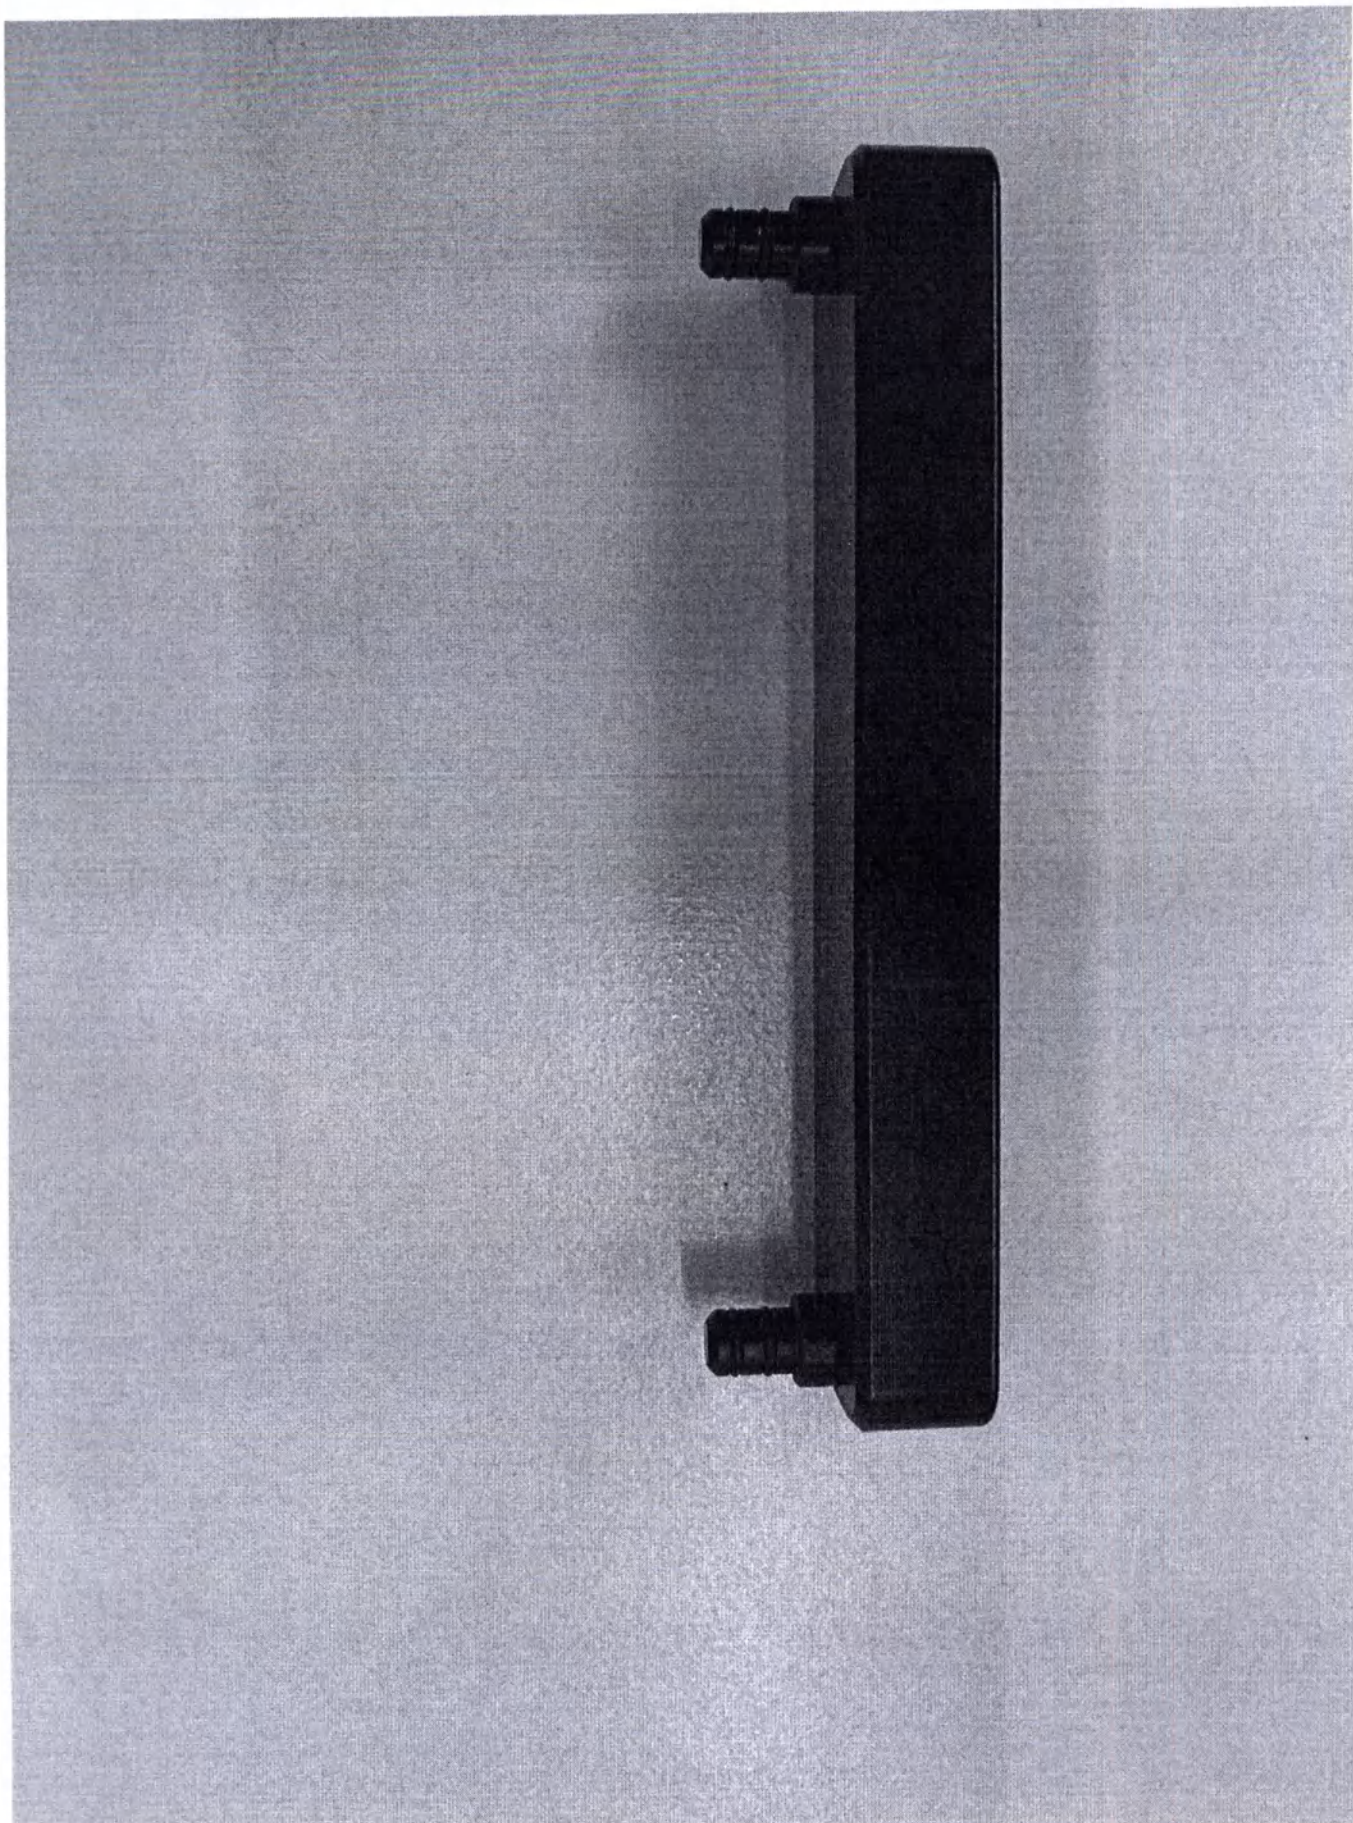


Крепёжный штифт с фиксирующими пружинами. Вид с боку.

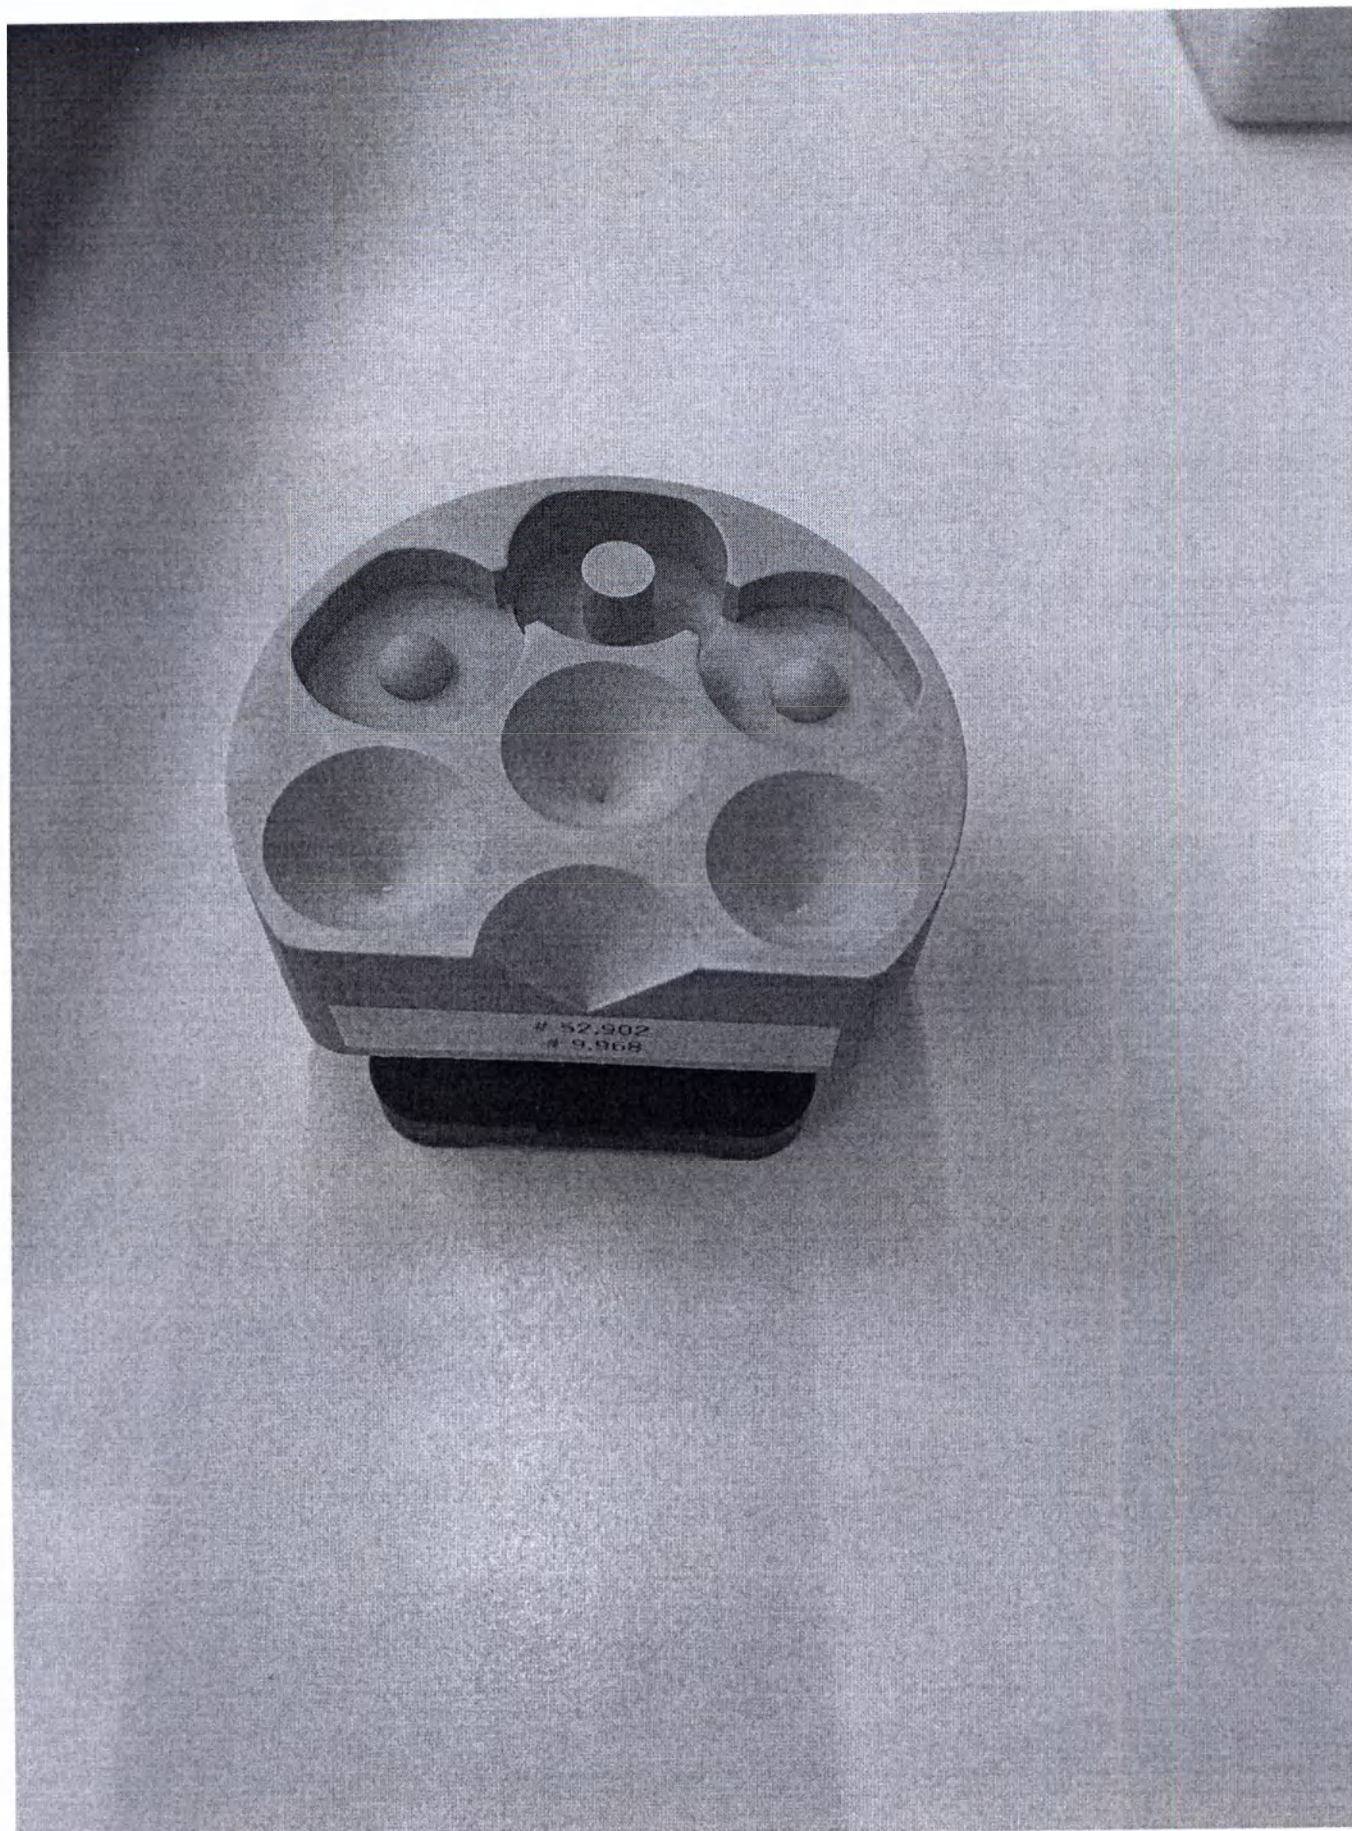


Калибровочная модель. Вид сверху.

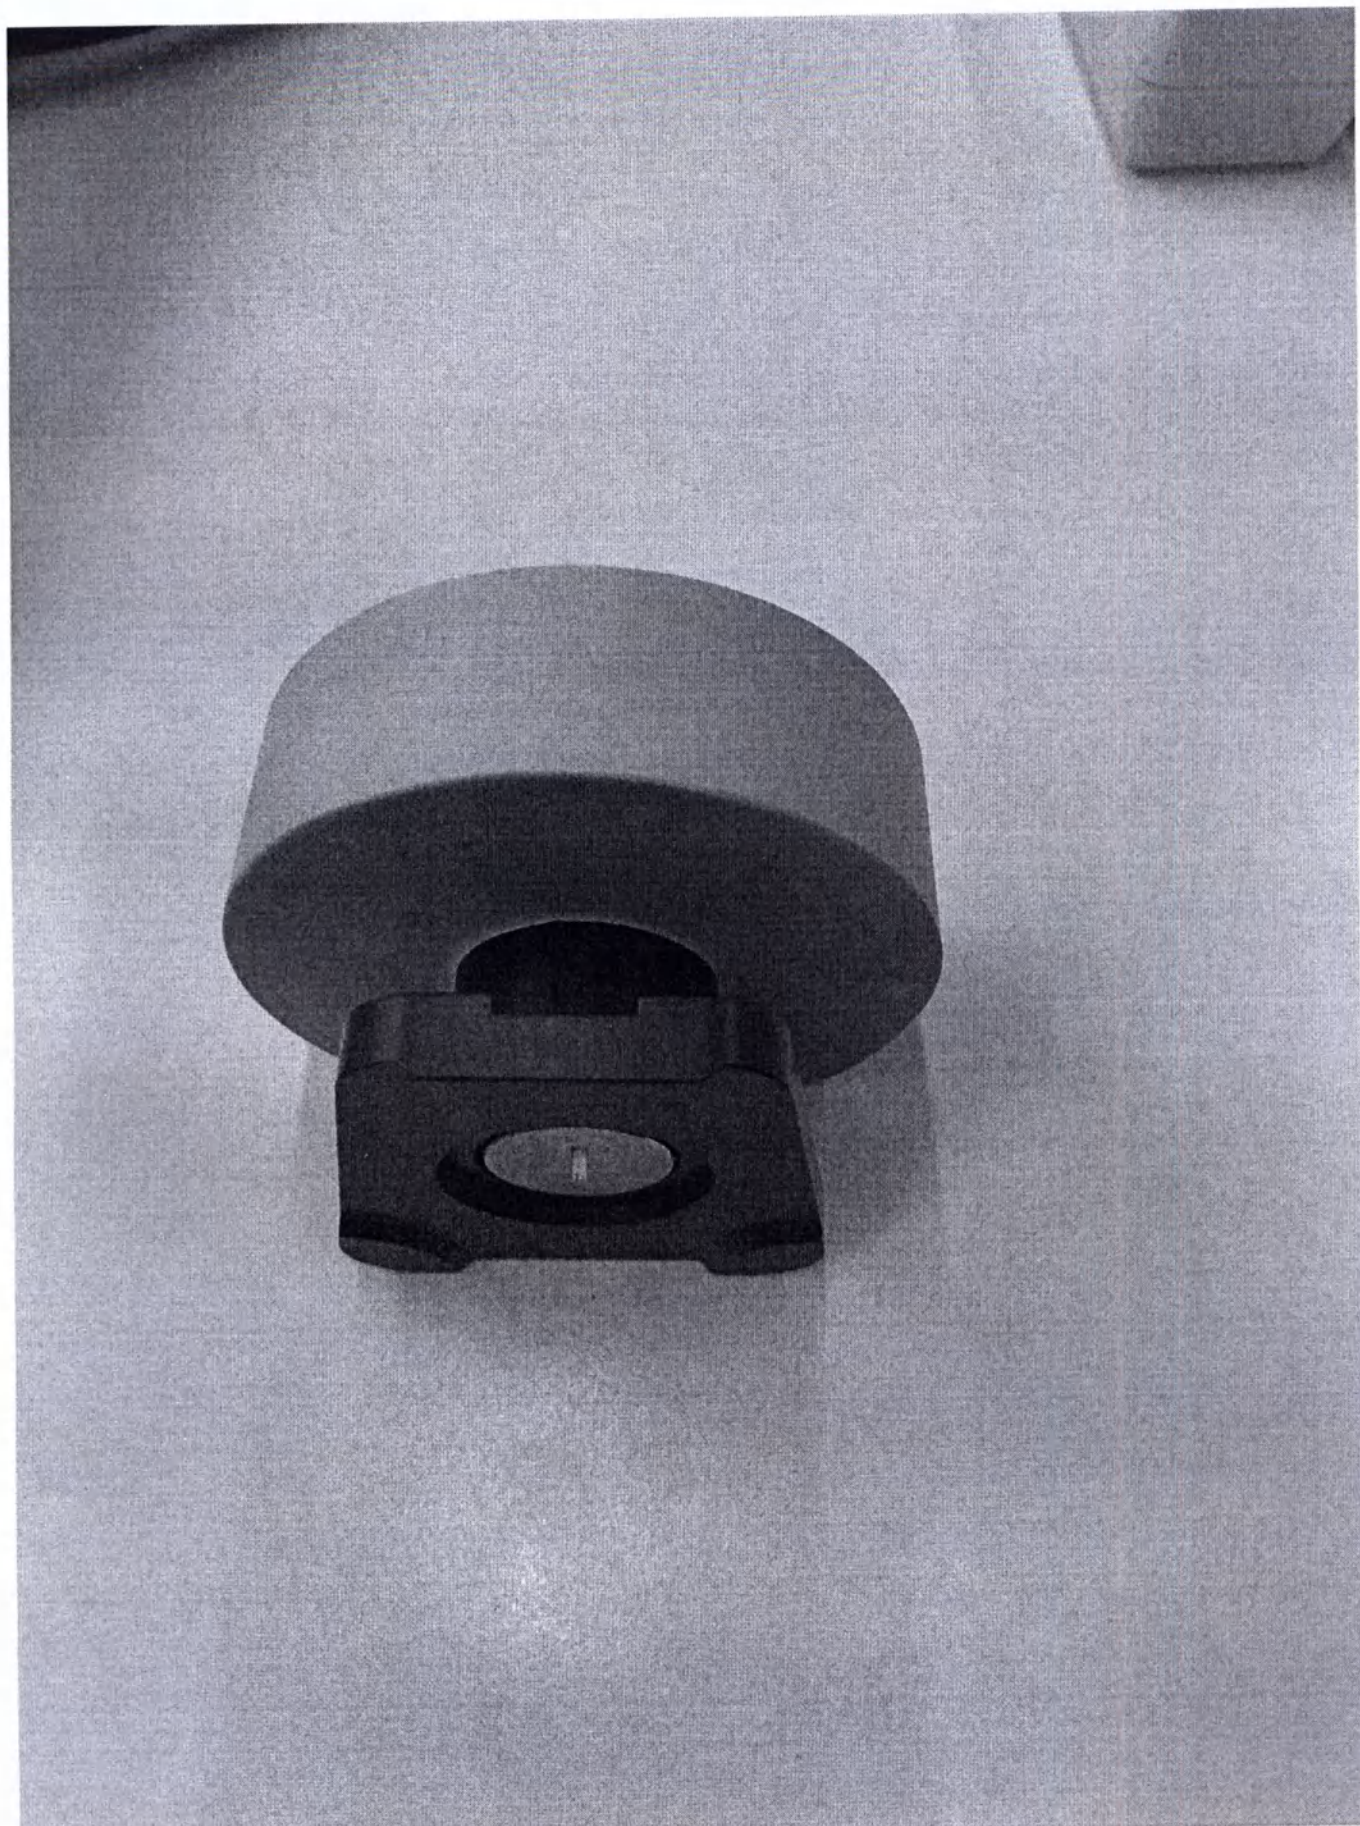


Калибровочная модель. Вид снизу

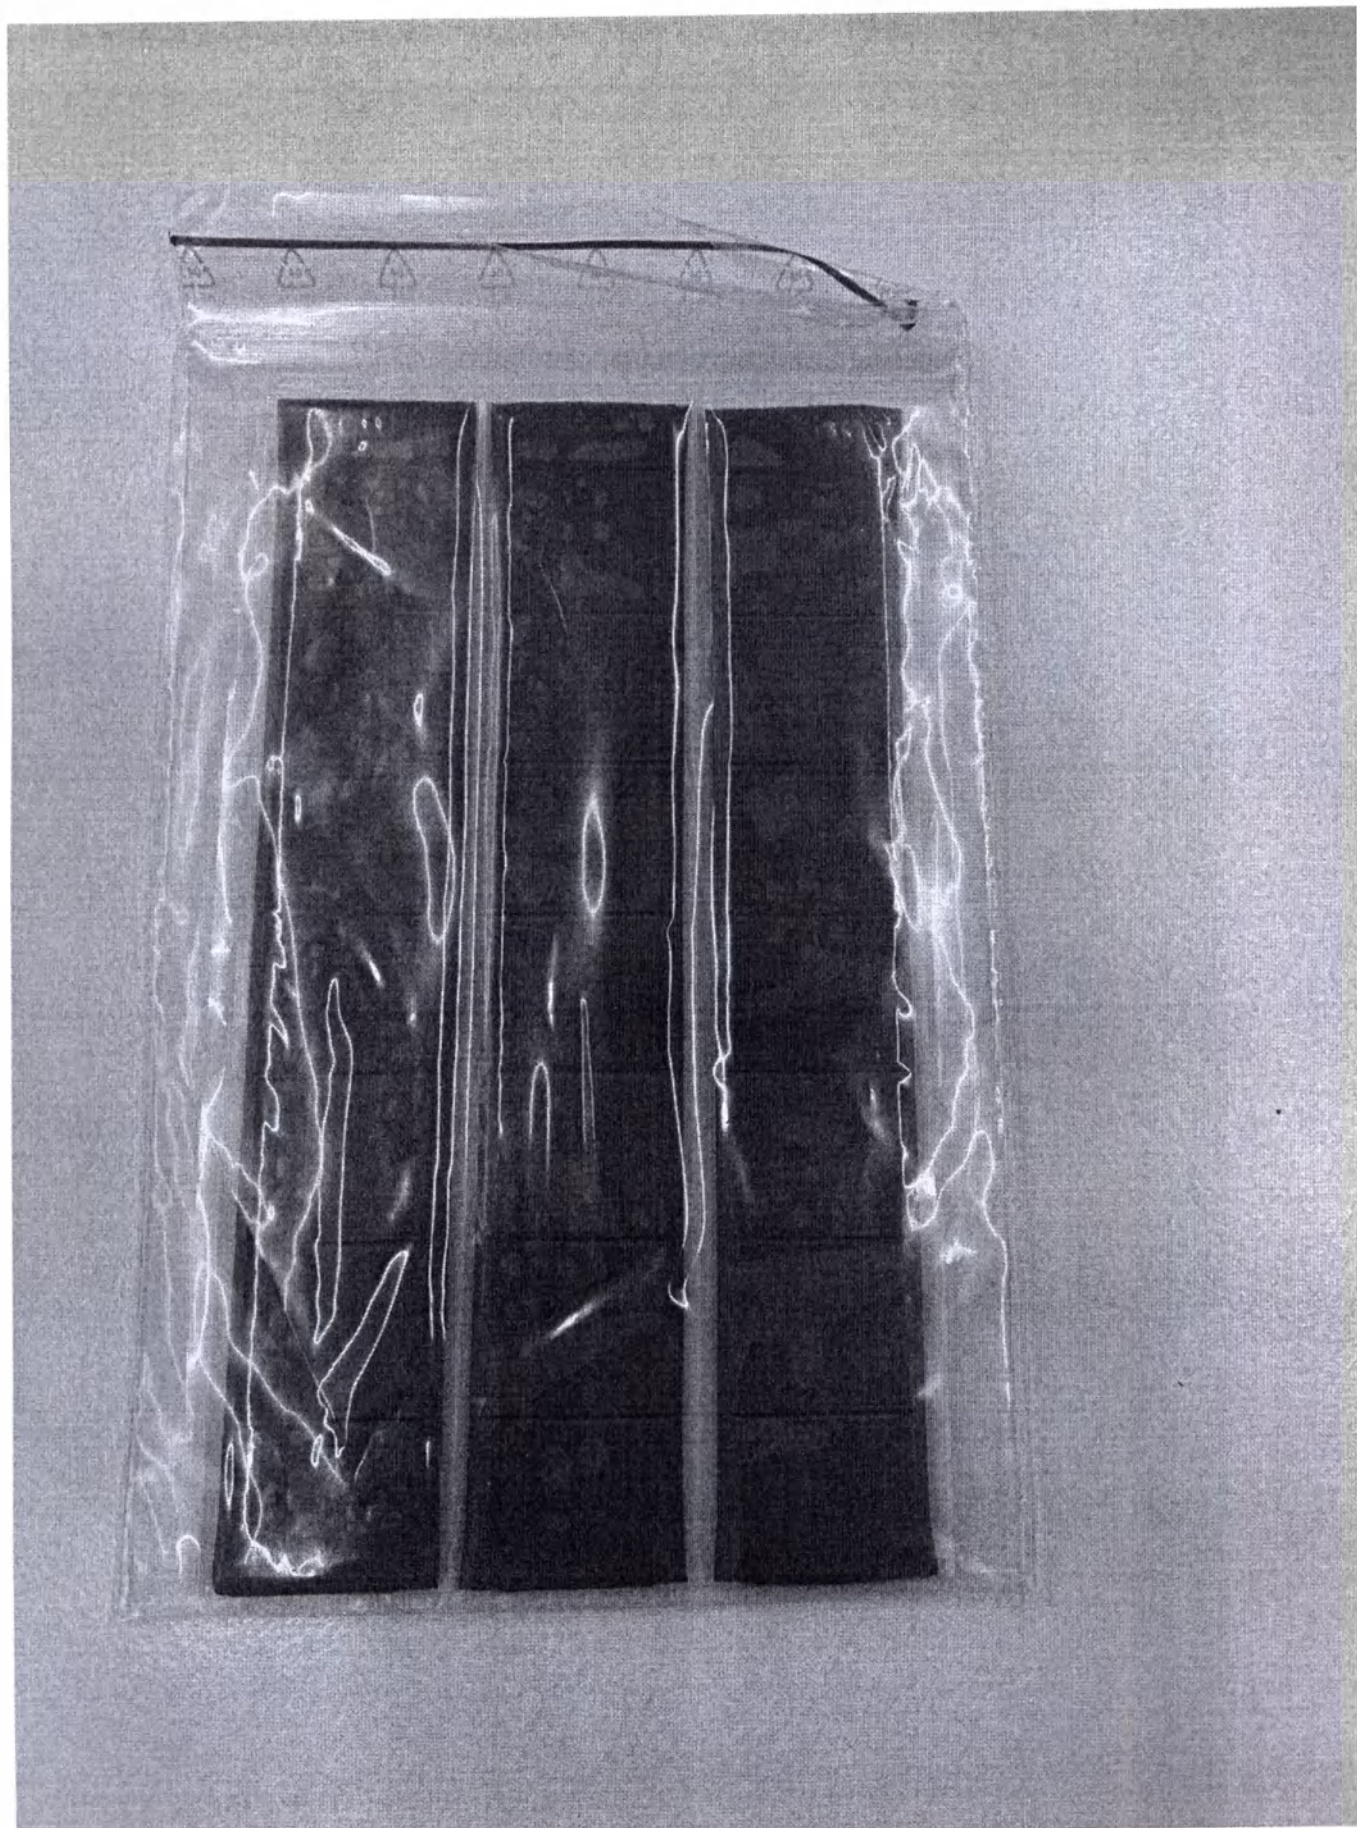


Клеящие подушечки

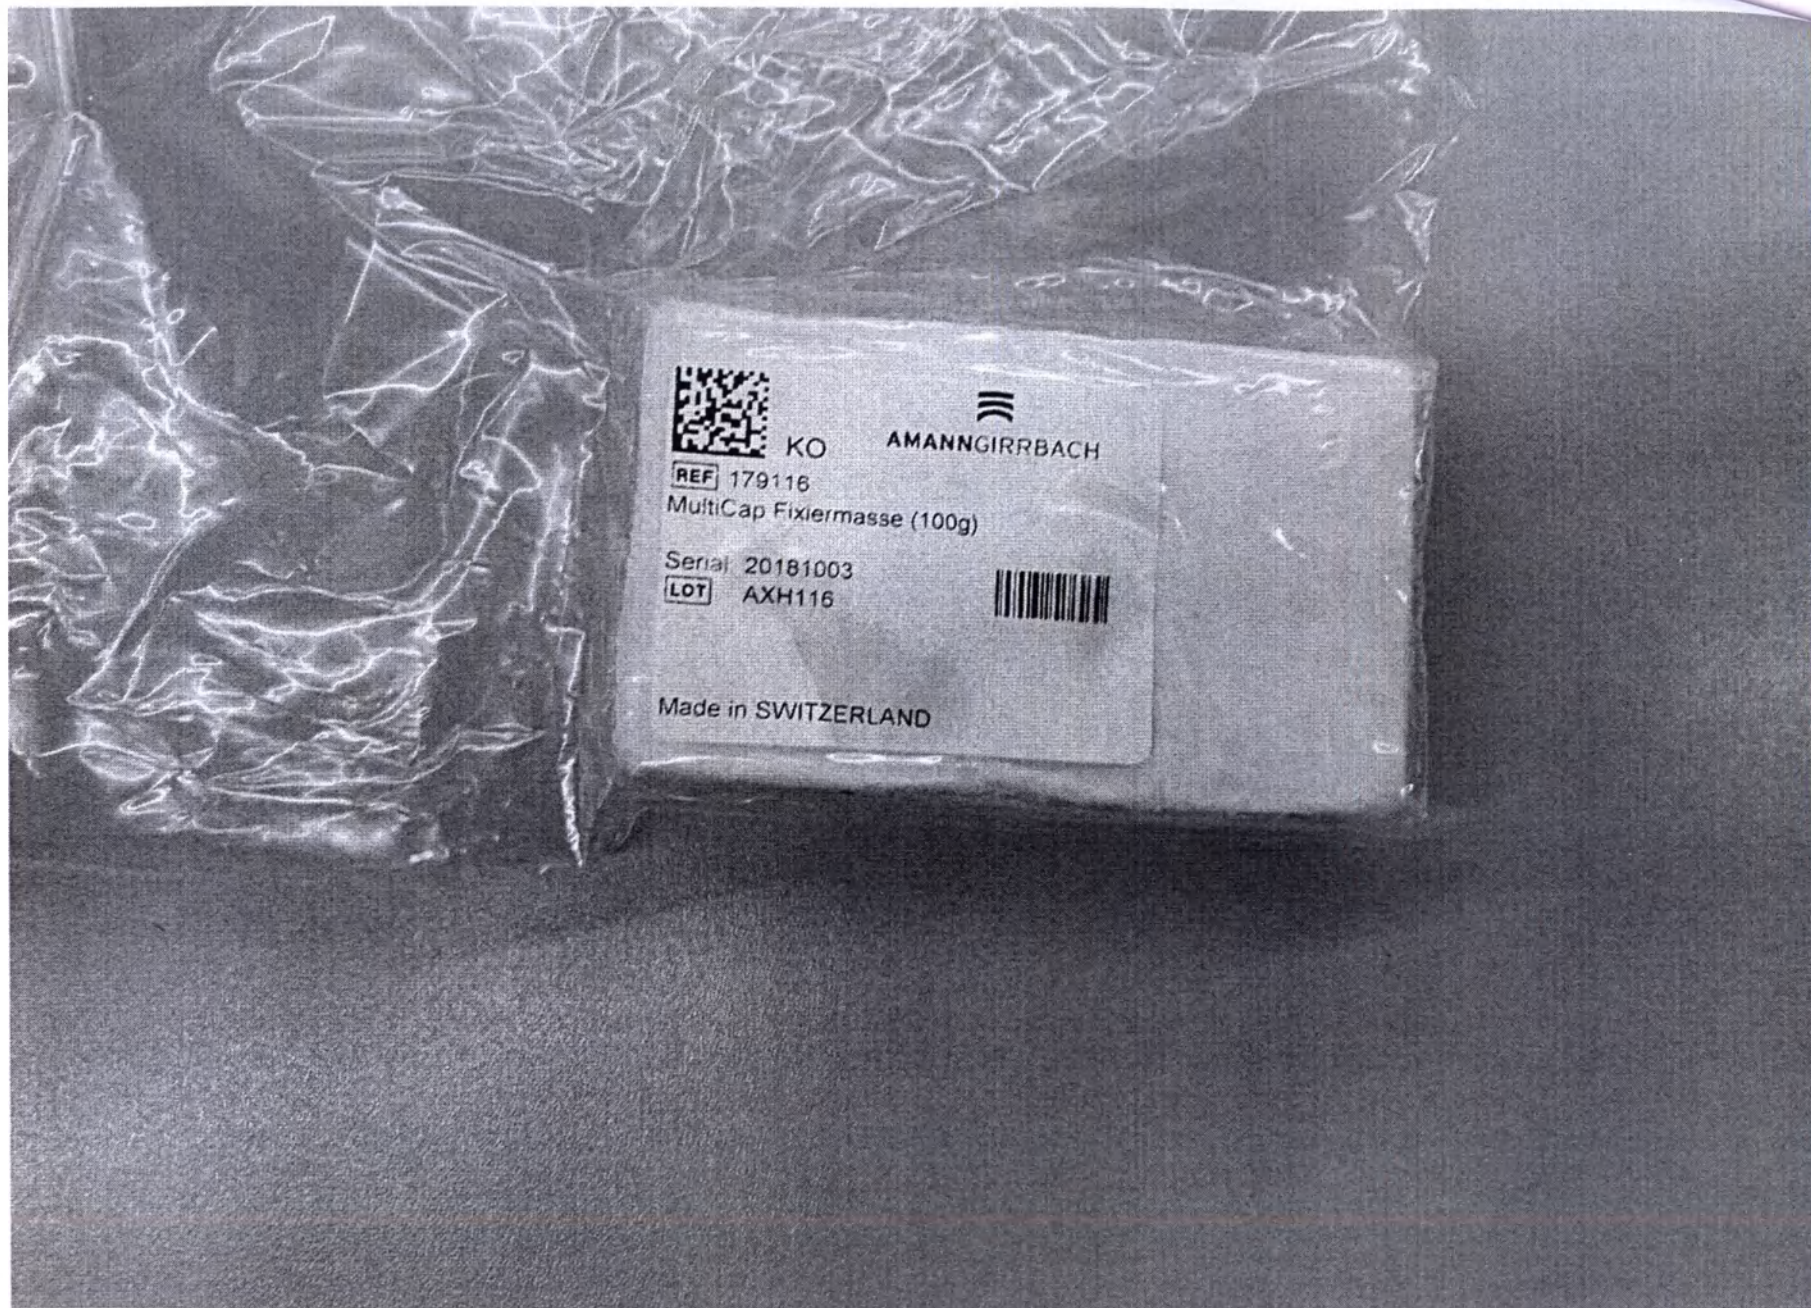


Фиксирующая масса

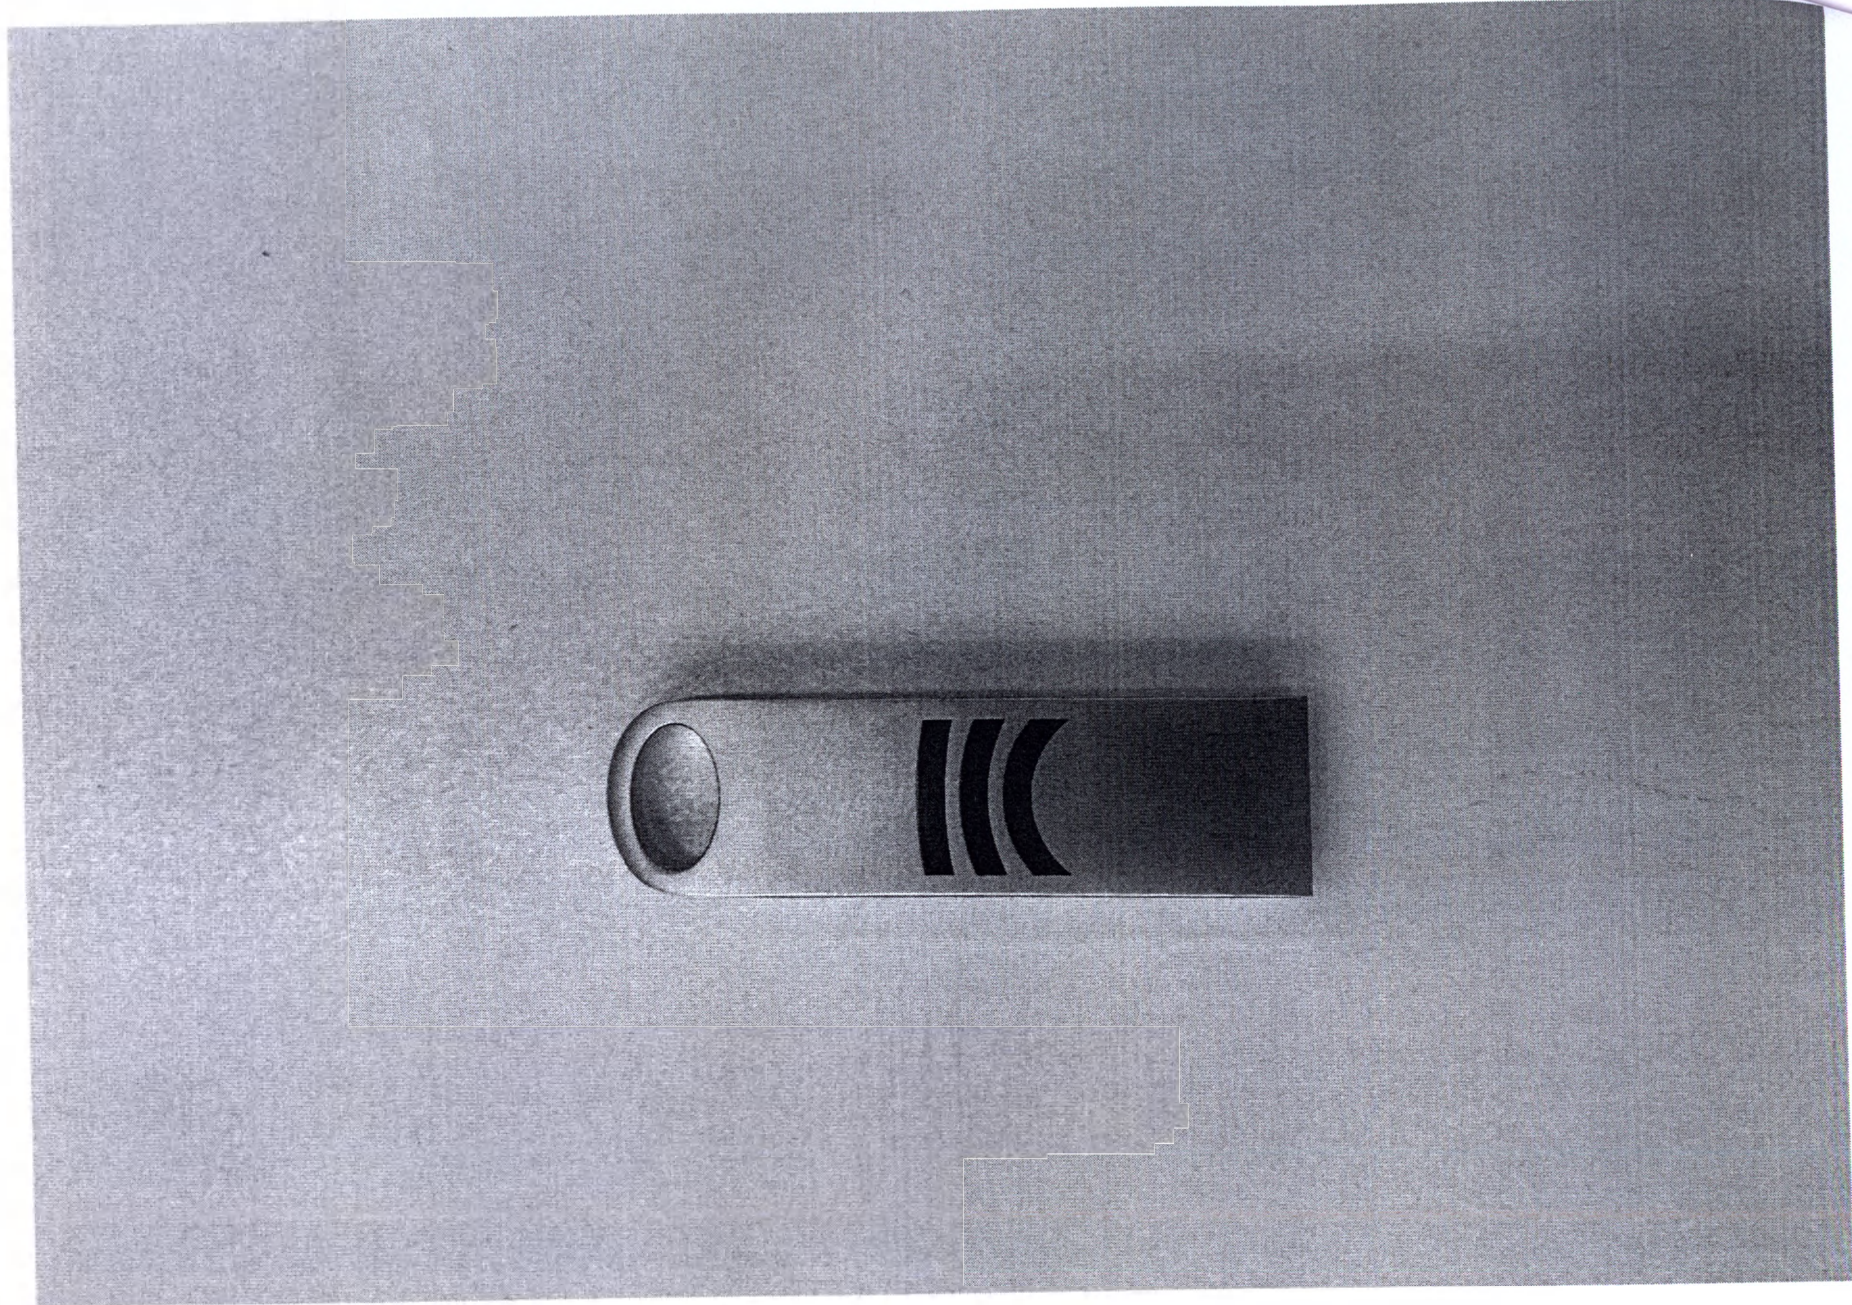

USB – накопитель

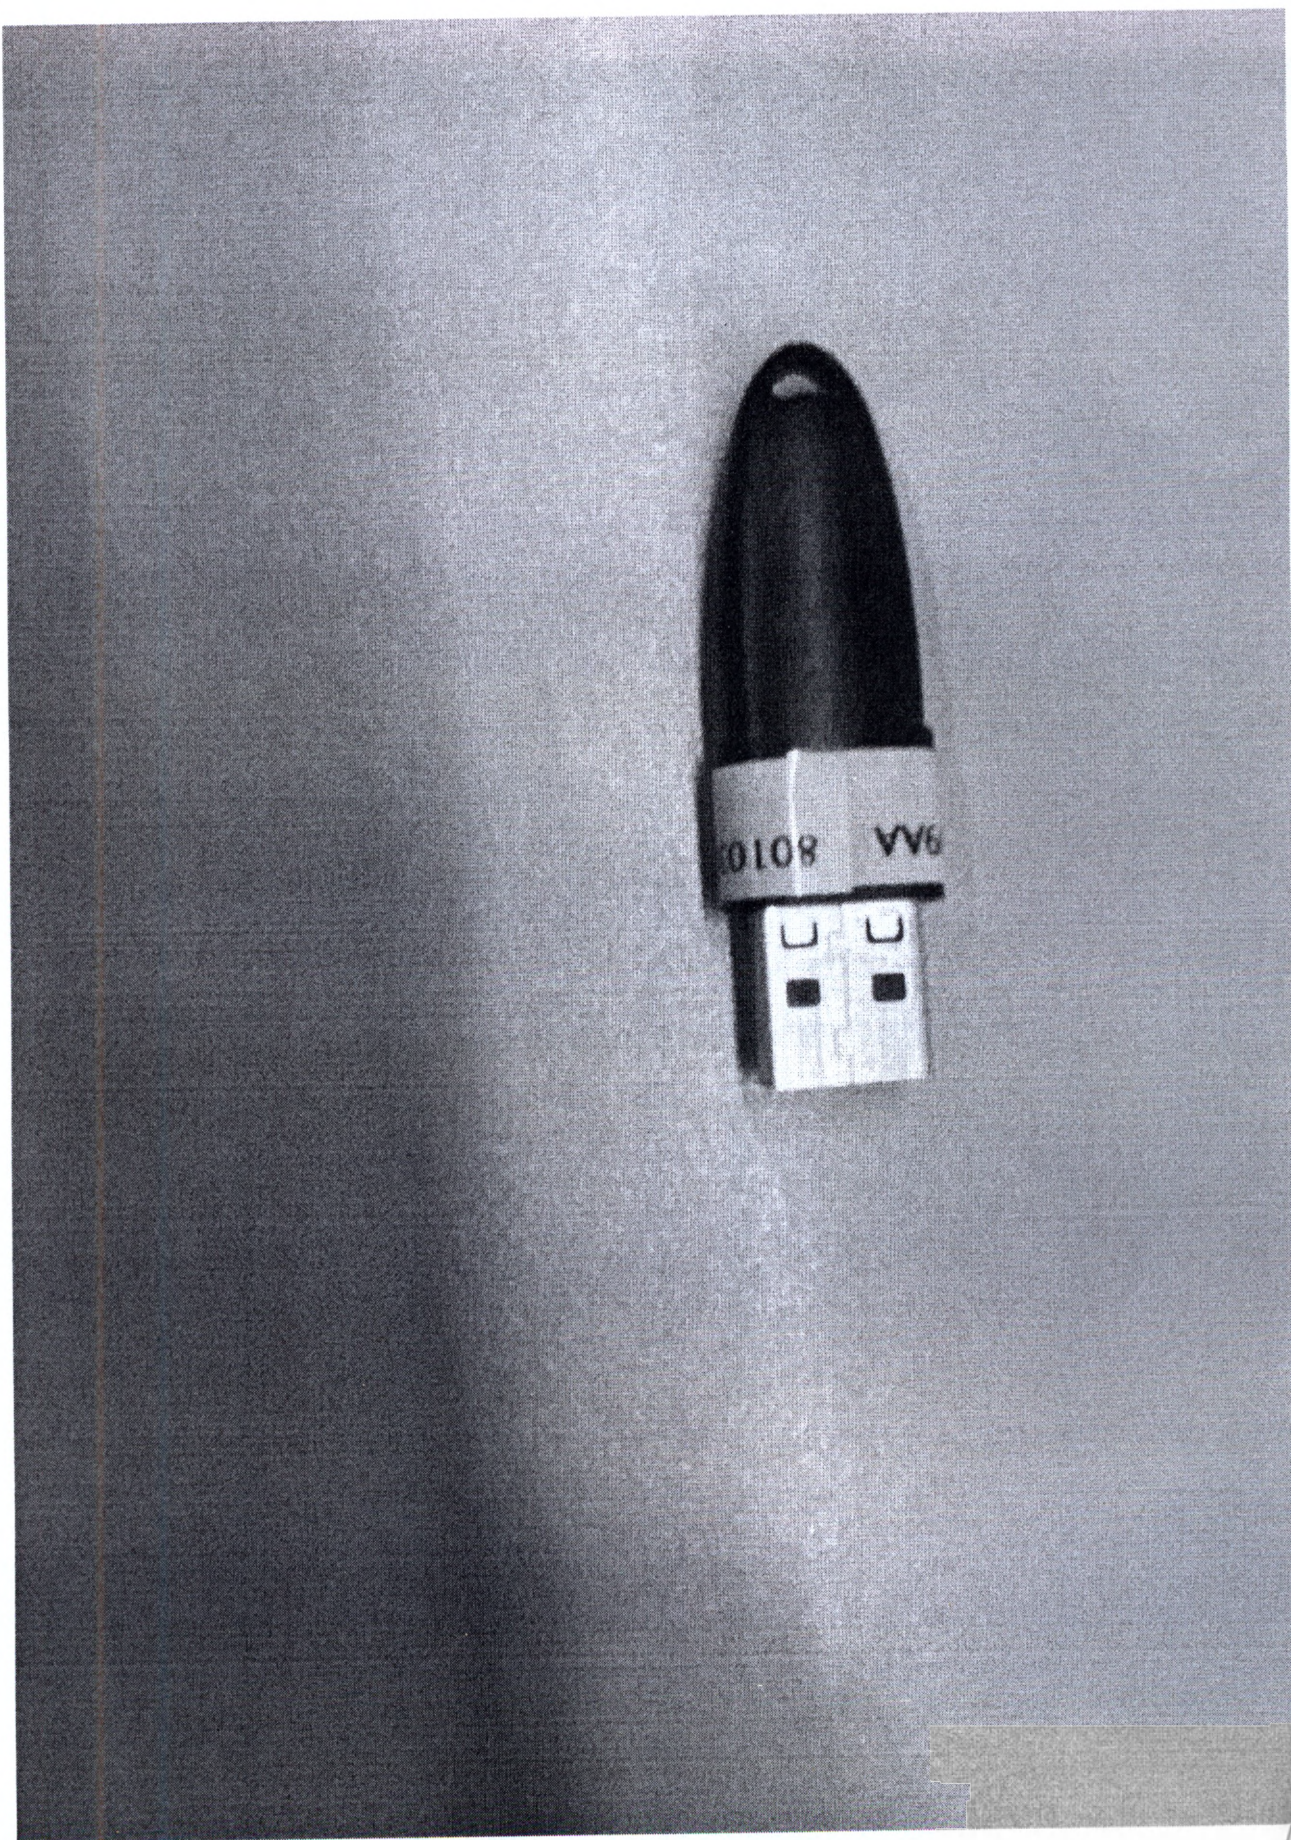


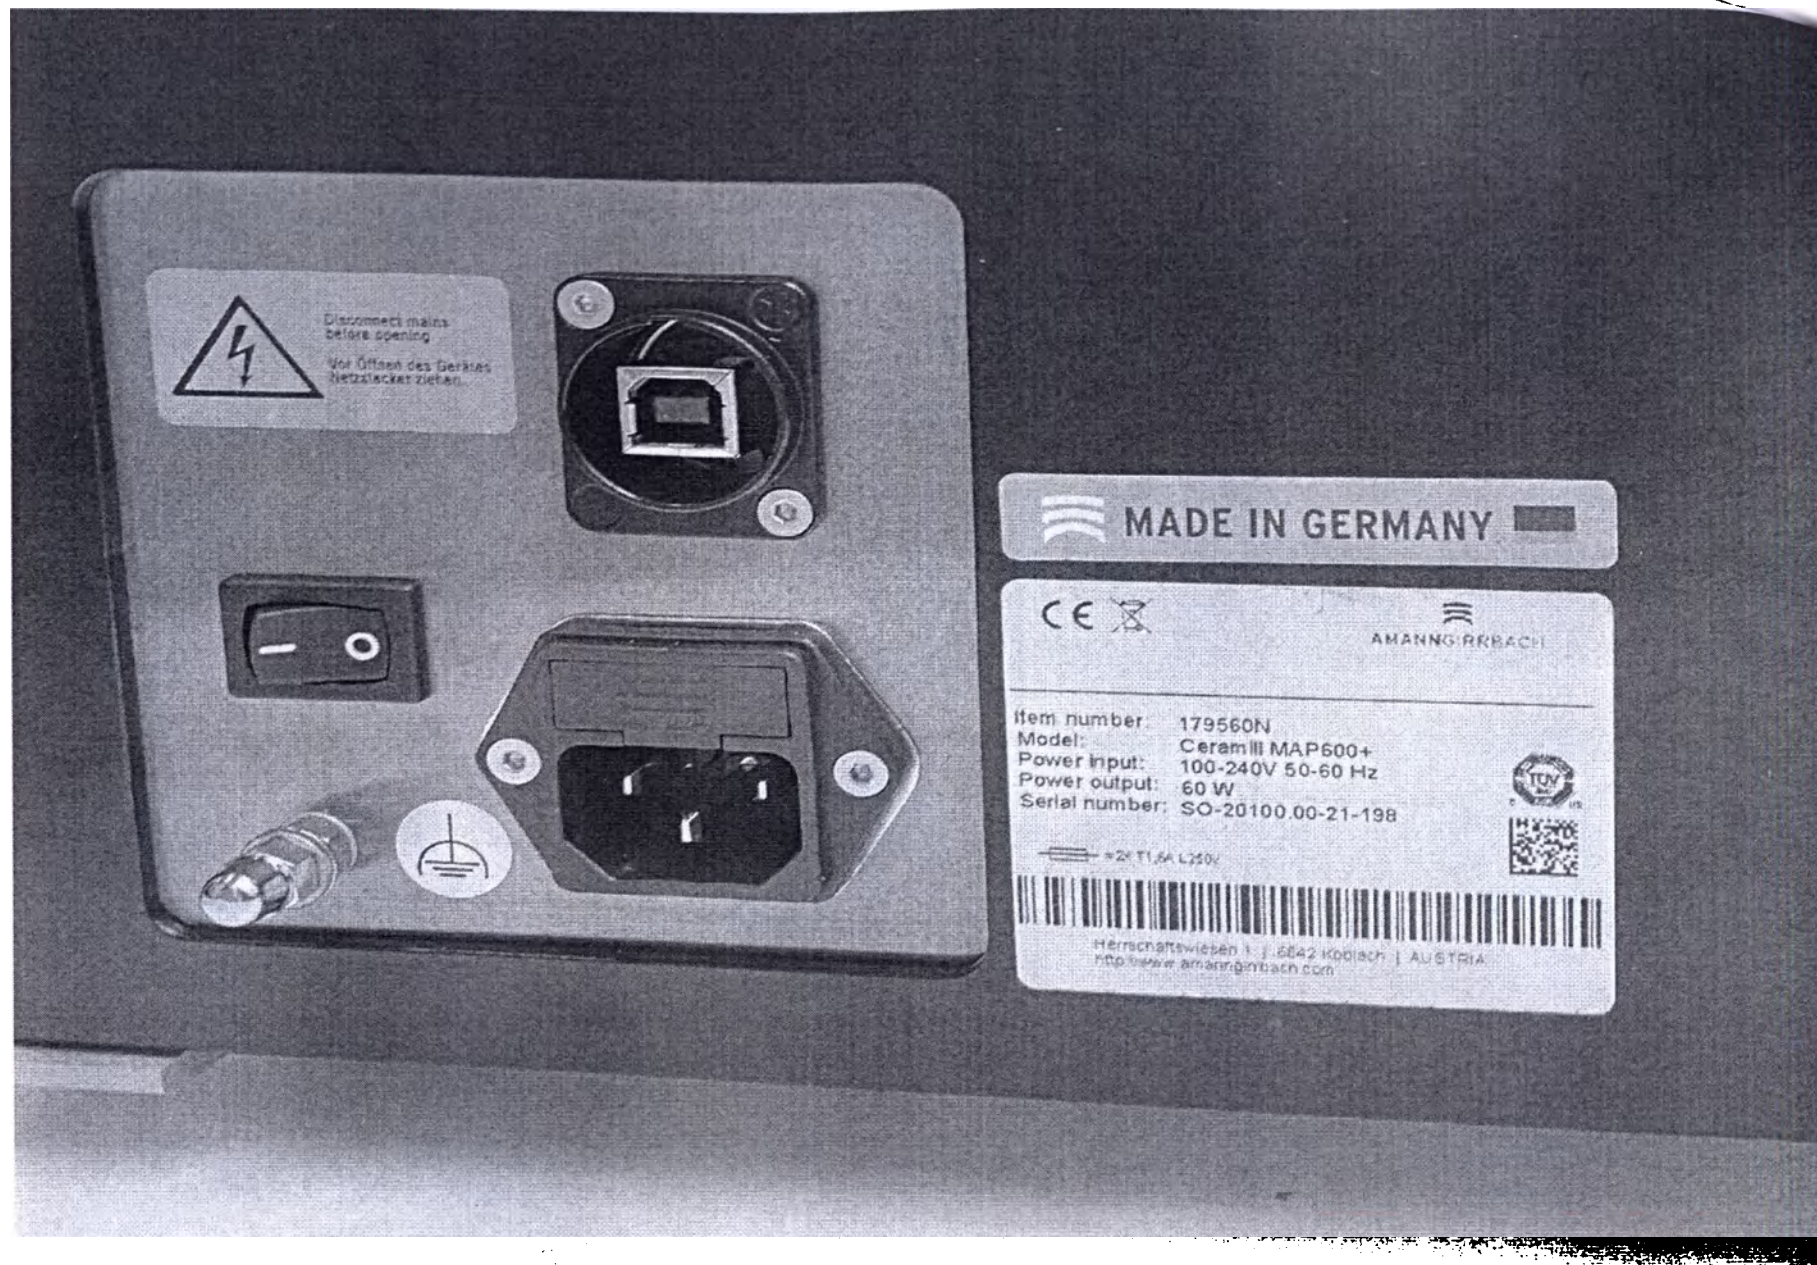

Сканер стоматологический 3D Ceramill Map 600+. Заводская табличка



Потребительская (транспортная) упаковка сканера стоматологического 3D Ceramill Map 600+.

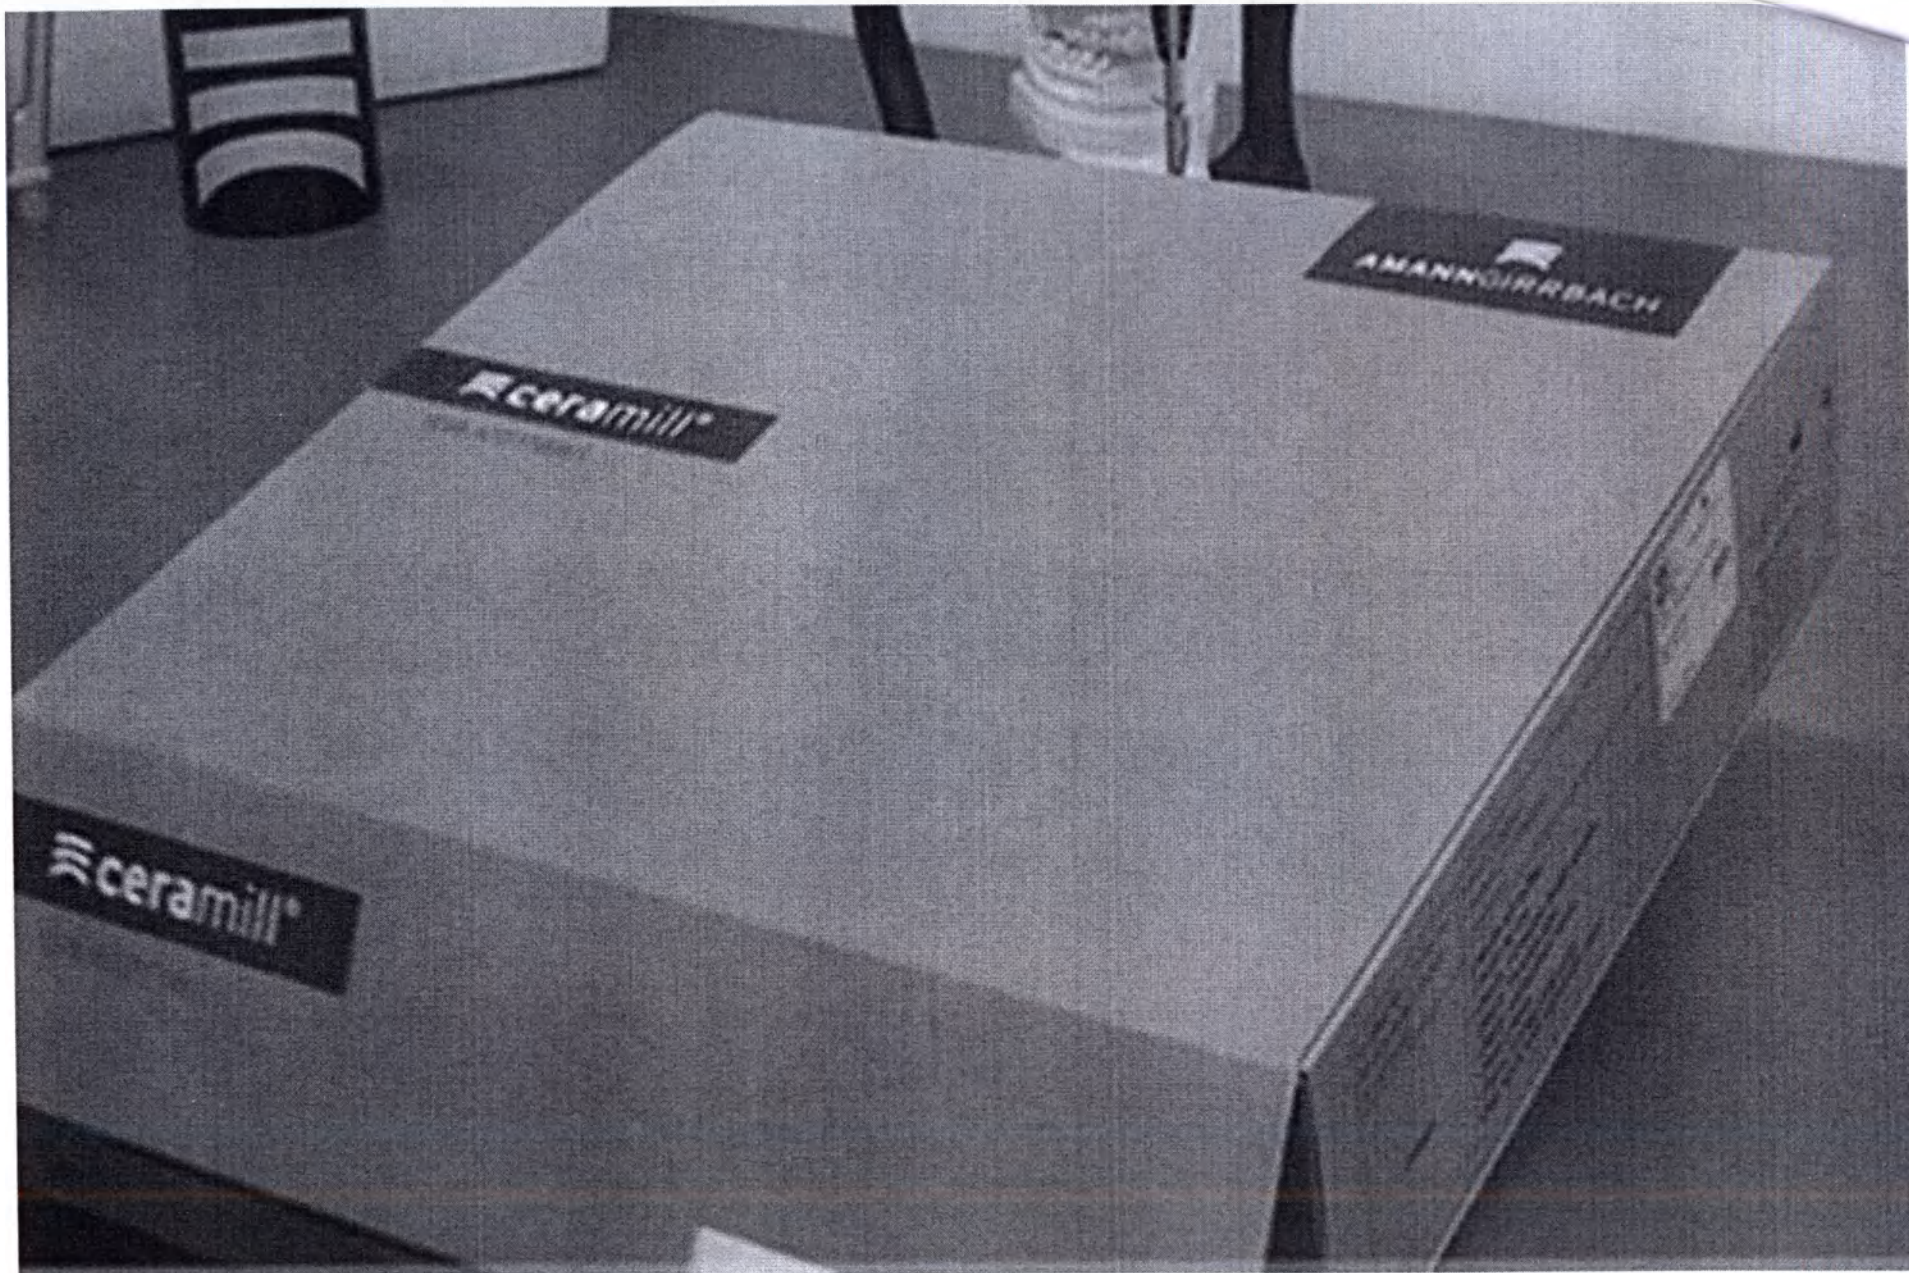

Потребительская упаковка комплектующих МИ

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 22 листа(ов).
Должность, ФИО директор по качеству

Иванов И.В.
(подпись) _____ Место печати _____

«12» декабря 2021 года

