

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова





«27» *декабря* 2021 г.



Фотографические изображения ~~изделия~~

**Набор реагентов для количественного определения тропонина I
электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro
(Troponin I (Electrochemiluminescence Immunoassay) / cTnI)**

Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.
(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай

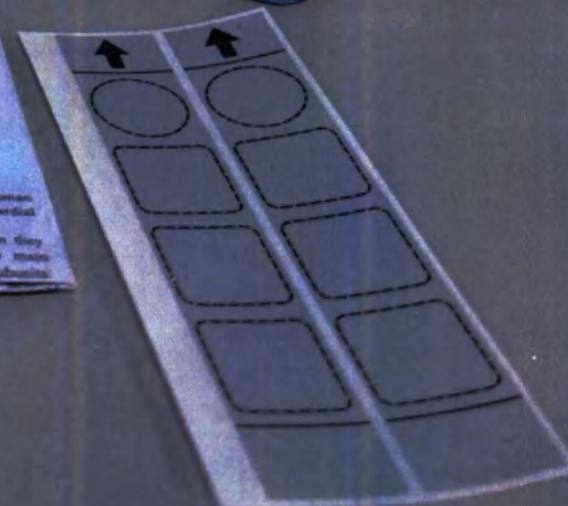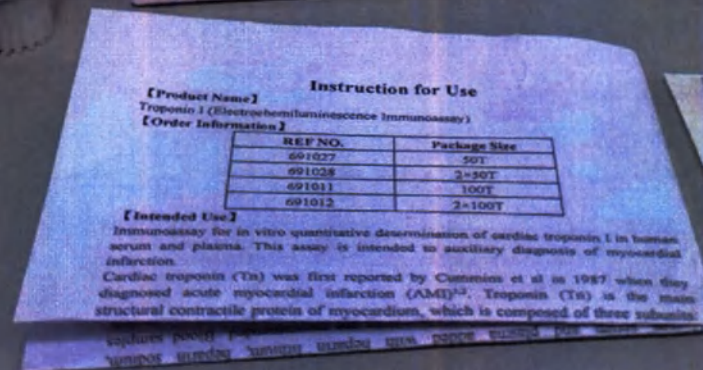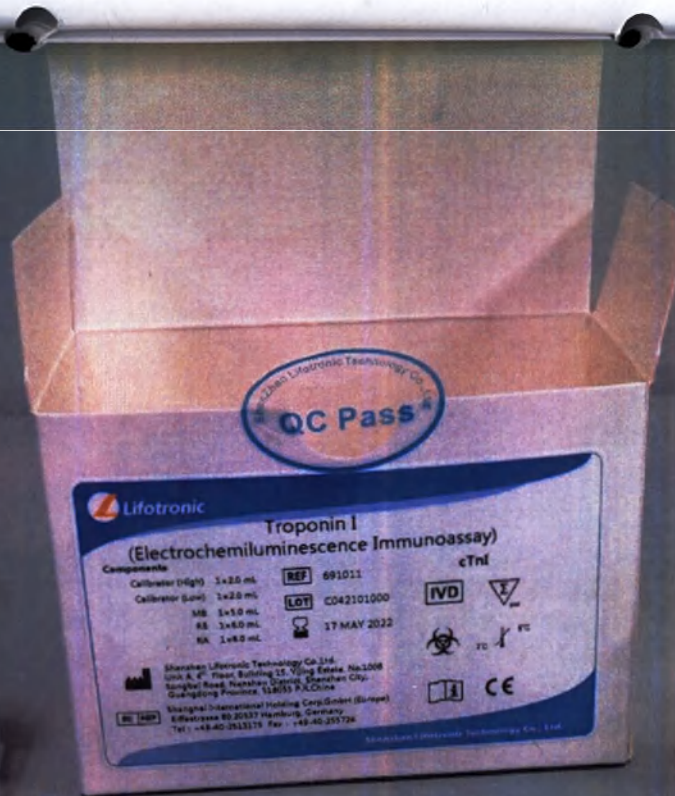




Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения тропонина I электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Troponin I (Electrochemiluminescence Immunoassay) / cTnI), в варианте исполнения 100 тестов)






Калибратор (низкий и высокий уровень) (Набор реагентов для количественного определения тропонина I электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для

тестов in vitro (Troponin I (Electrochemiluminescence Immunoassay) / cTnI), в варианте исполнения 100 тестов)

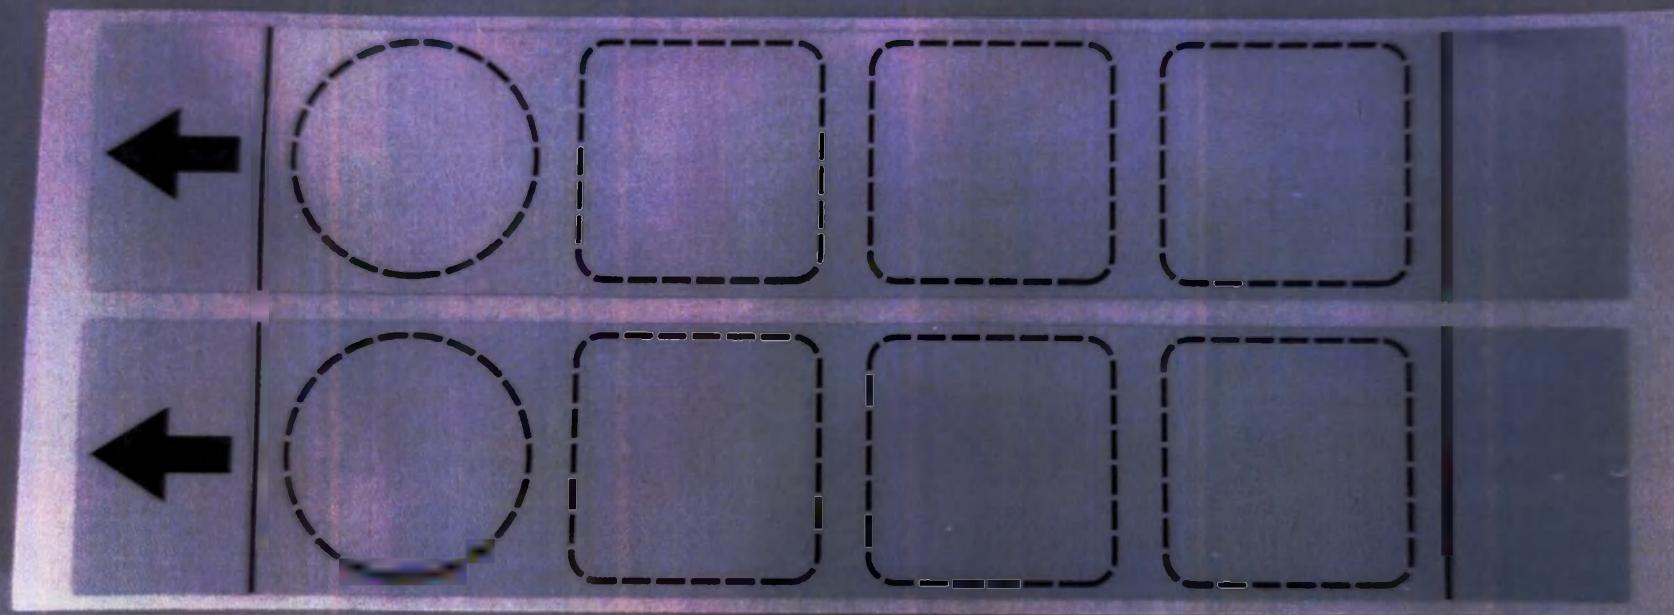



Troponin I
(Electrochemiluminescence Immunoassay)

cTnI



Components

MB 5.0 mL

RB 6.0 mL

RA 6.0 mL

LOT

C042101000

SN

00010






17 MAY 2022




IVD

2°C 8°C


Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения тропонина I электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Troponin I (Electrochemiluminescence Immunoassay) / cTnI), в варианте исполнения 100 тестов)

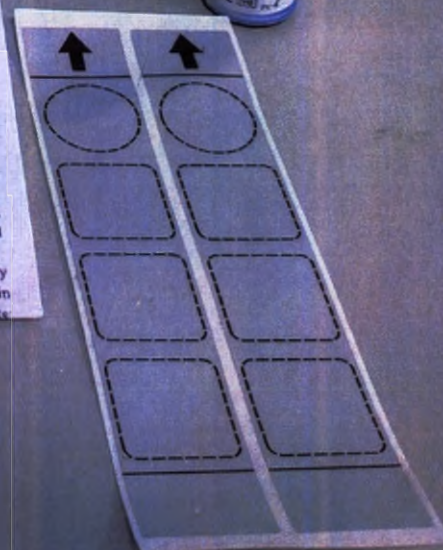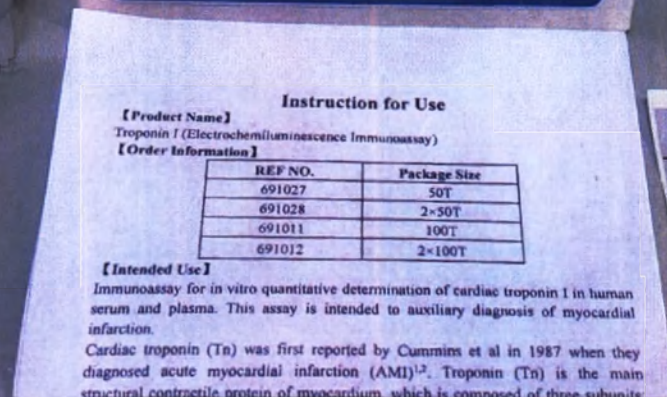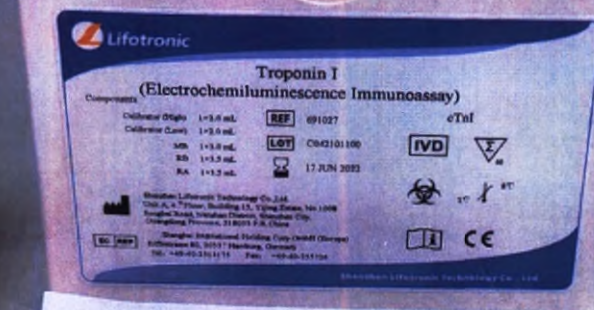

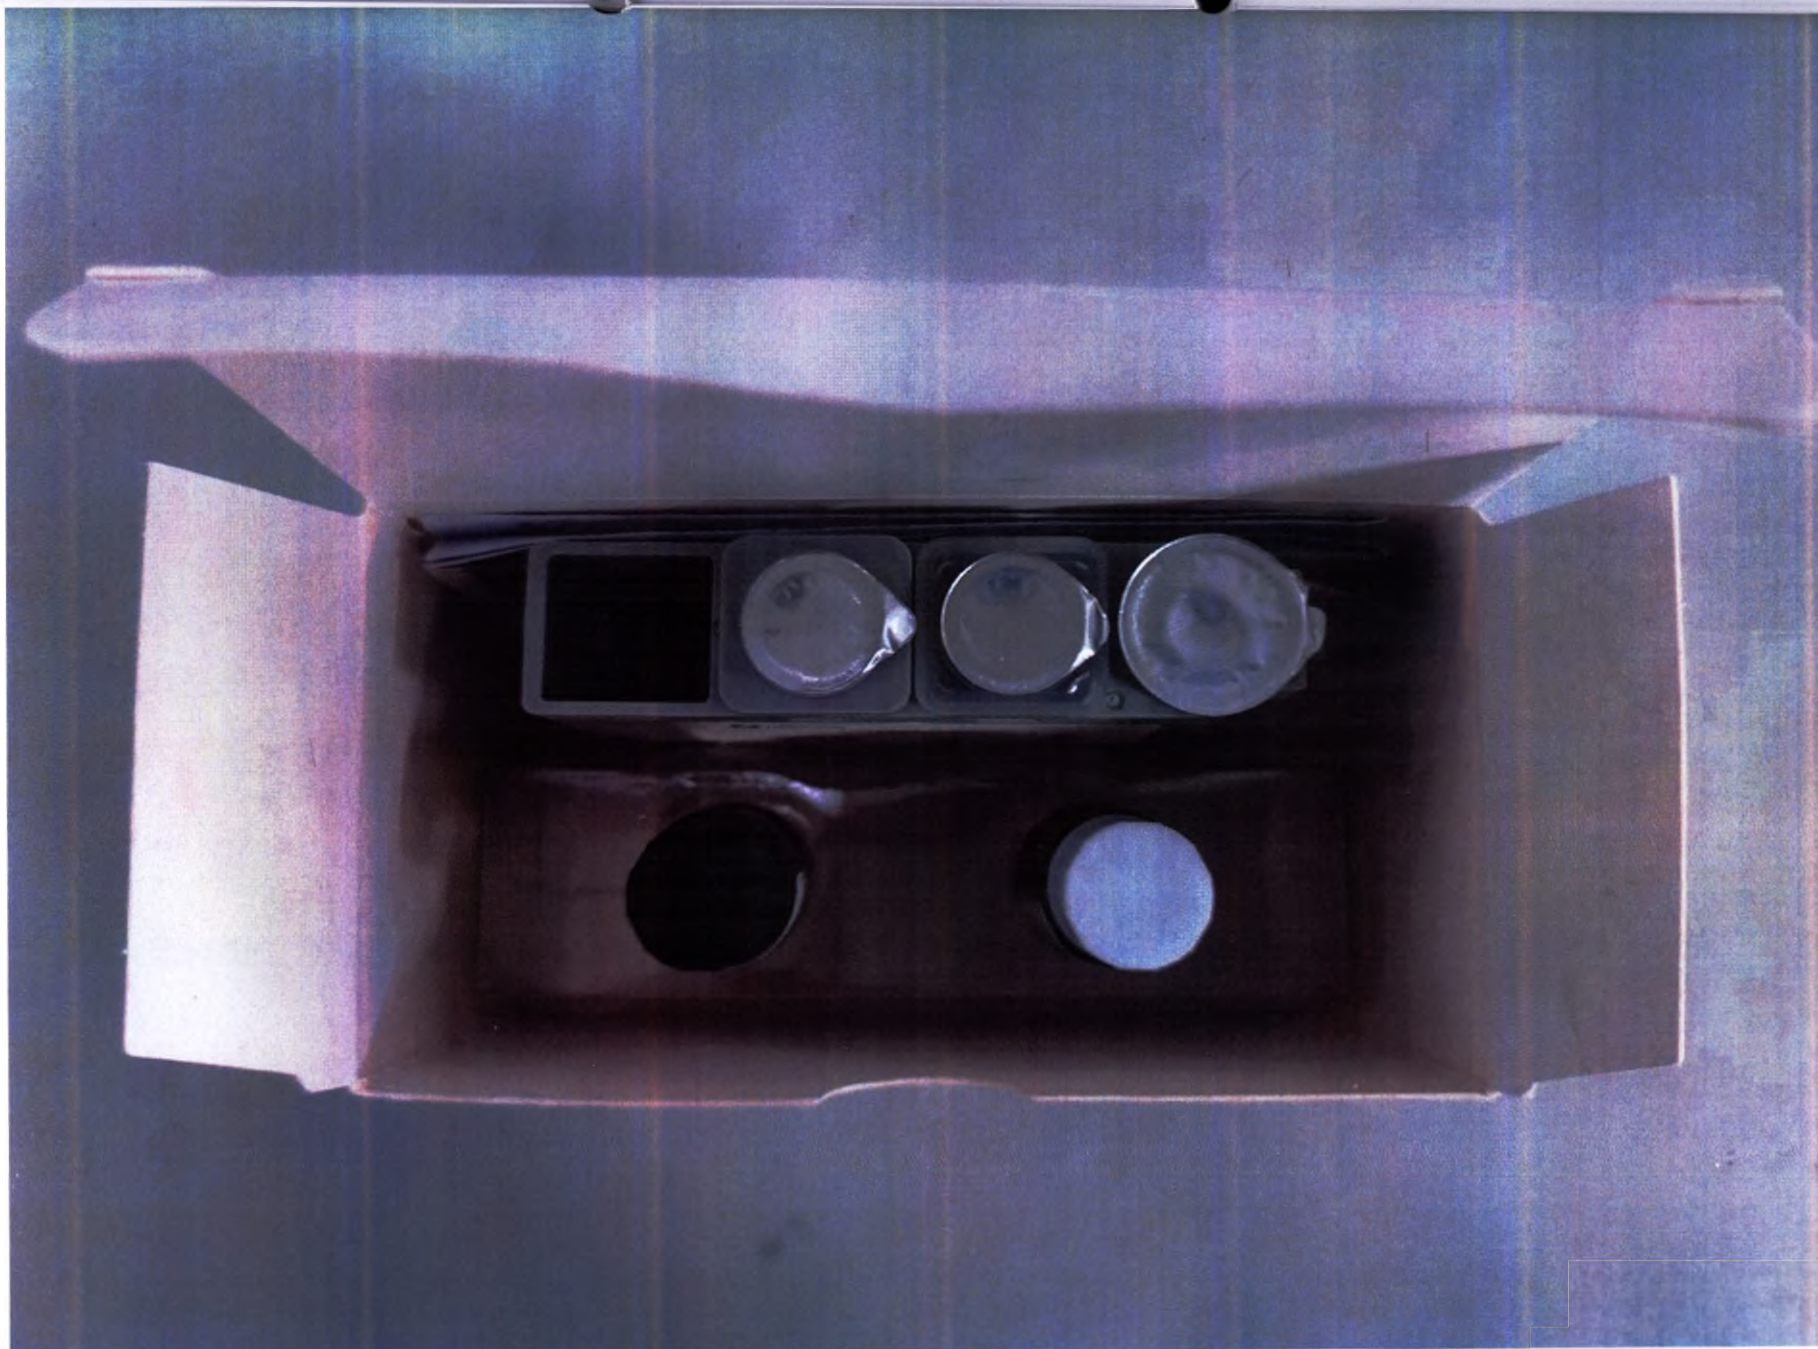


Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения тропонина I электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Troponin I (Electrochemiluminescence Immunoassay) / cTnI), в варианте исполнения 50 тестов)



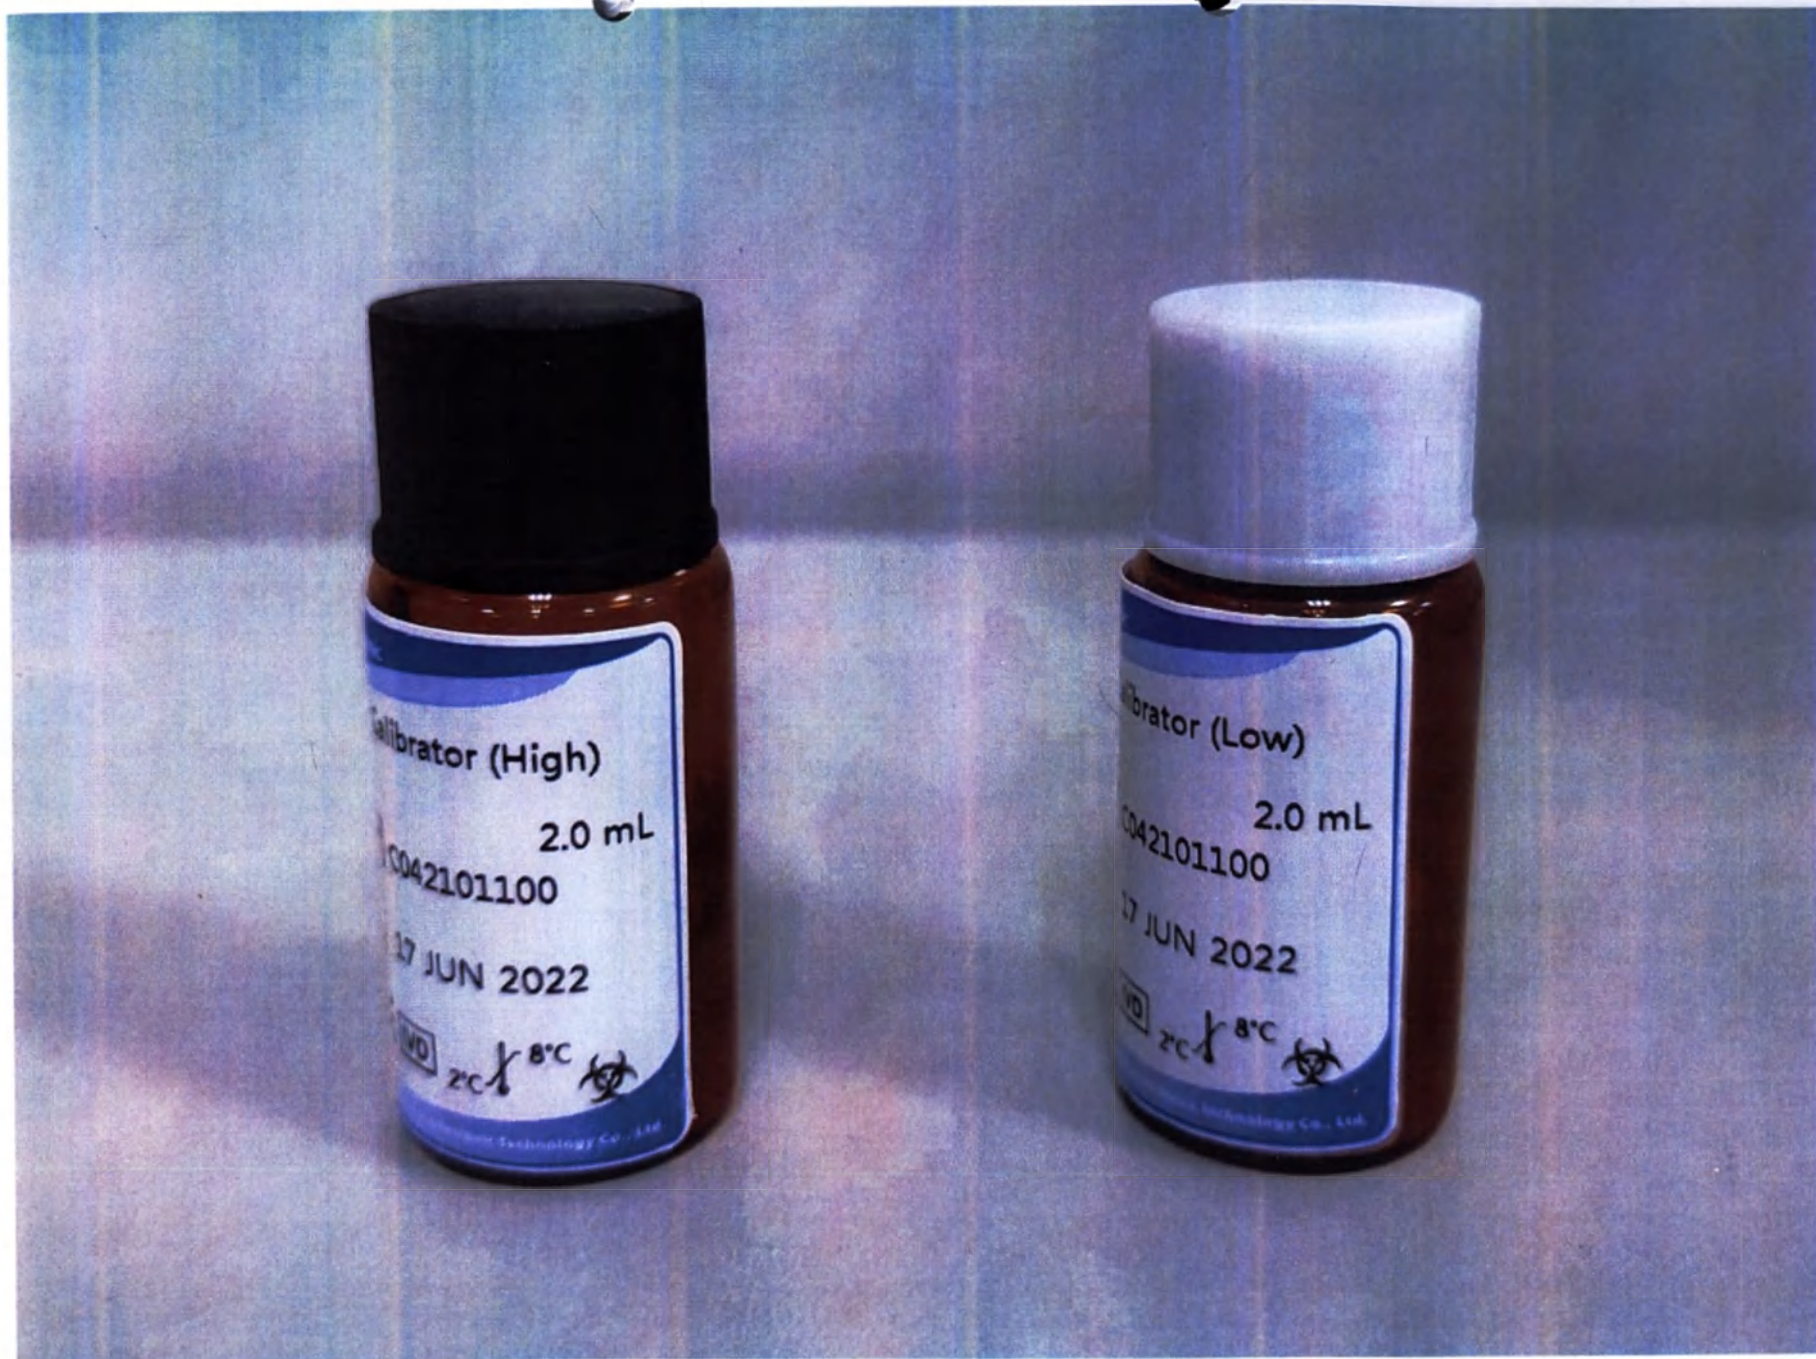


Калибратор (низкий и высокий уровень) (Набор реагентов для количественного определения тропонина I электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для

анализа в лаборатории in vitro (Troponin I (Electrochemiluminescence Immunoassay) / cTnI), в варианте исполнения 50 тестов)

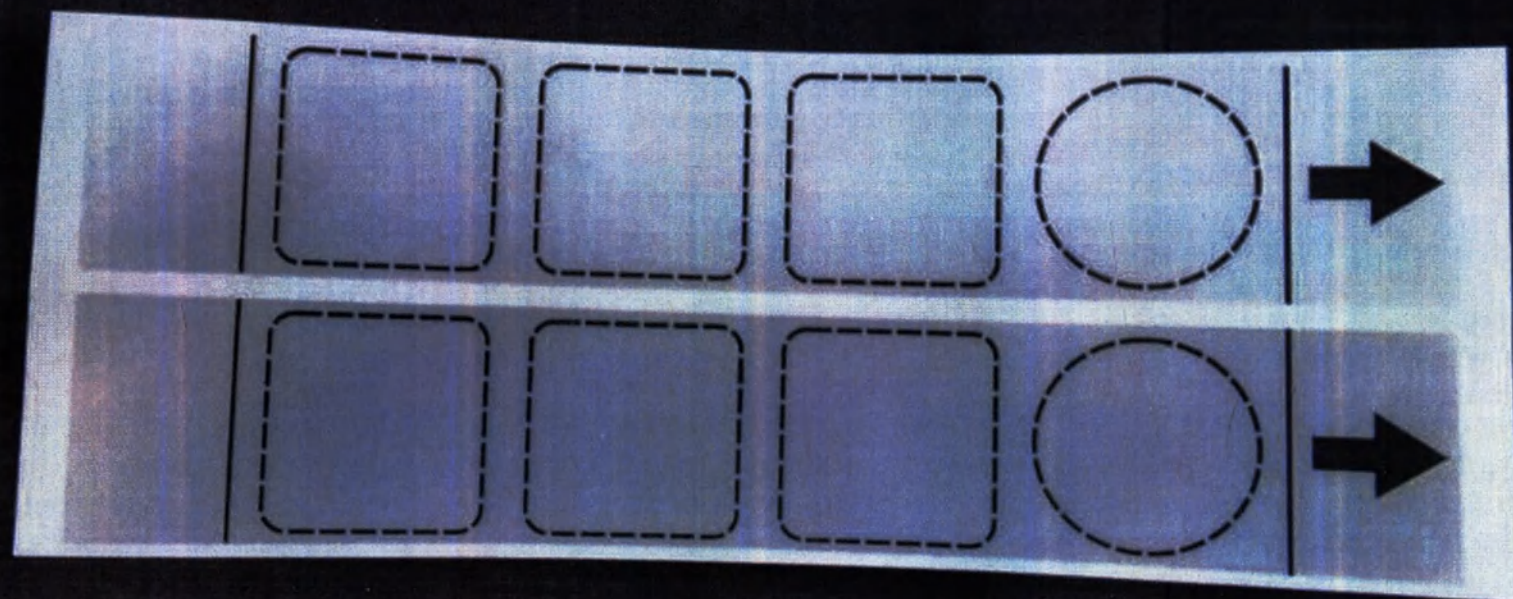

Этикетки для запечатывания флаконов (Набор реагентов для количественного определения тропонина I электрохемилюминесцентным методом на анализаторах ECL для диагностики
ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru itro (Troponin I (Electrochemiluminescence Immunoassay) / cTnI), в варианте исполнения 50 тестов)



Troponin I
(Electrochemiluminescence Immunoassay)

cTnI



Components

MB 3.0 mL

LOT C042101100

RB 3.5 mL

SN 00002

RA 3.5 mL

17 JUN 2022



2°C 8°C

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 13 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А.
М.П.

ПО ДОВЕРИЮ
77 АГ 55-178
КУСАИЛО Р.А.

