

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»»

Носова Т.А.

«2» июля 2022 г.




ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987789
КУСАЙЛО Р. В.

Фотографические изображения изделия:

**Набор реагентов для количественного определения ферритина
электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на
анализаторах ECL для диагностики in vitro (Ferritin (Electrochemiluminescence
Immunoassay)/Ferritin)**

Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.
(«Шэньчжэнь Лайфотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай

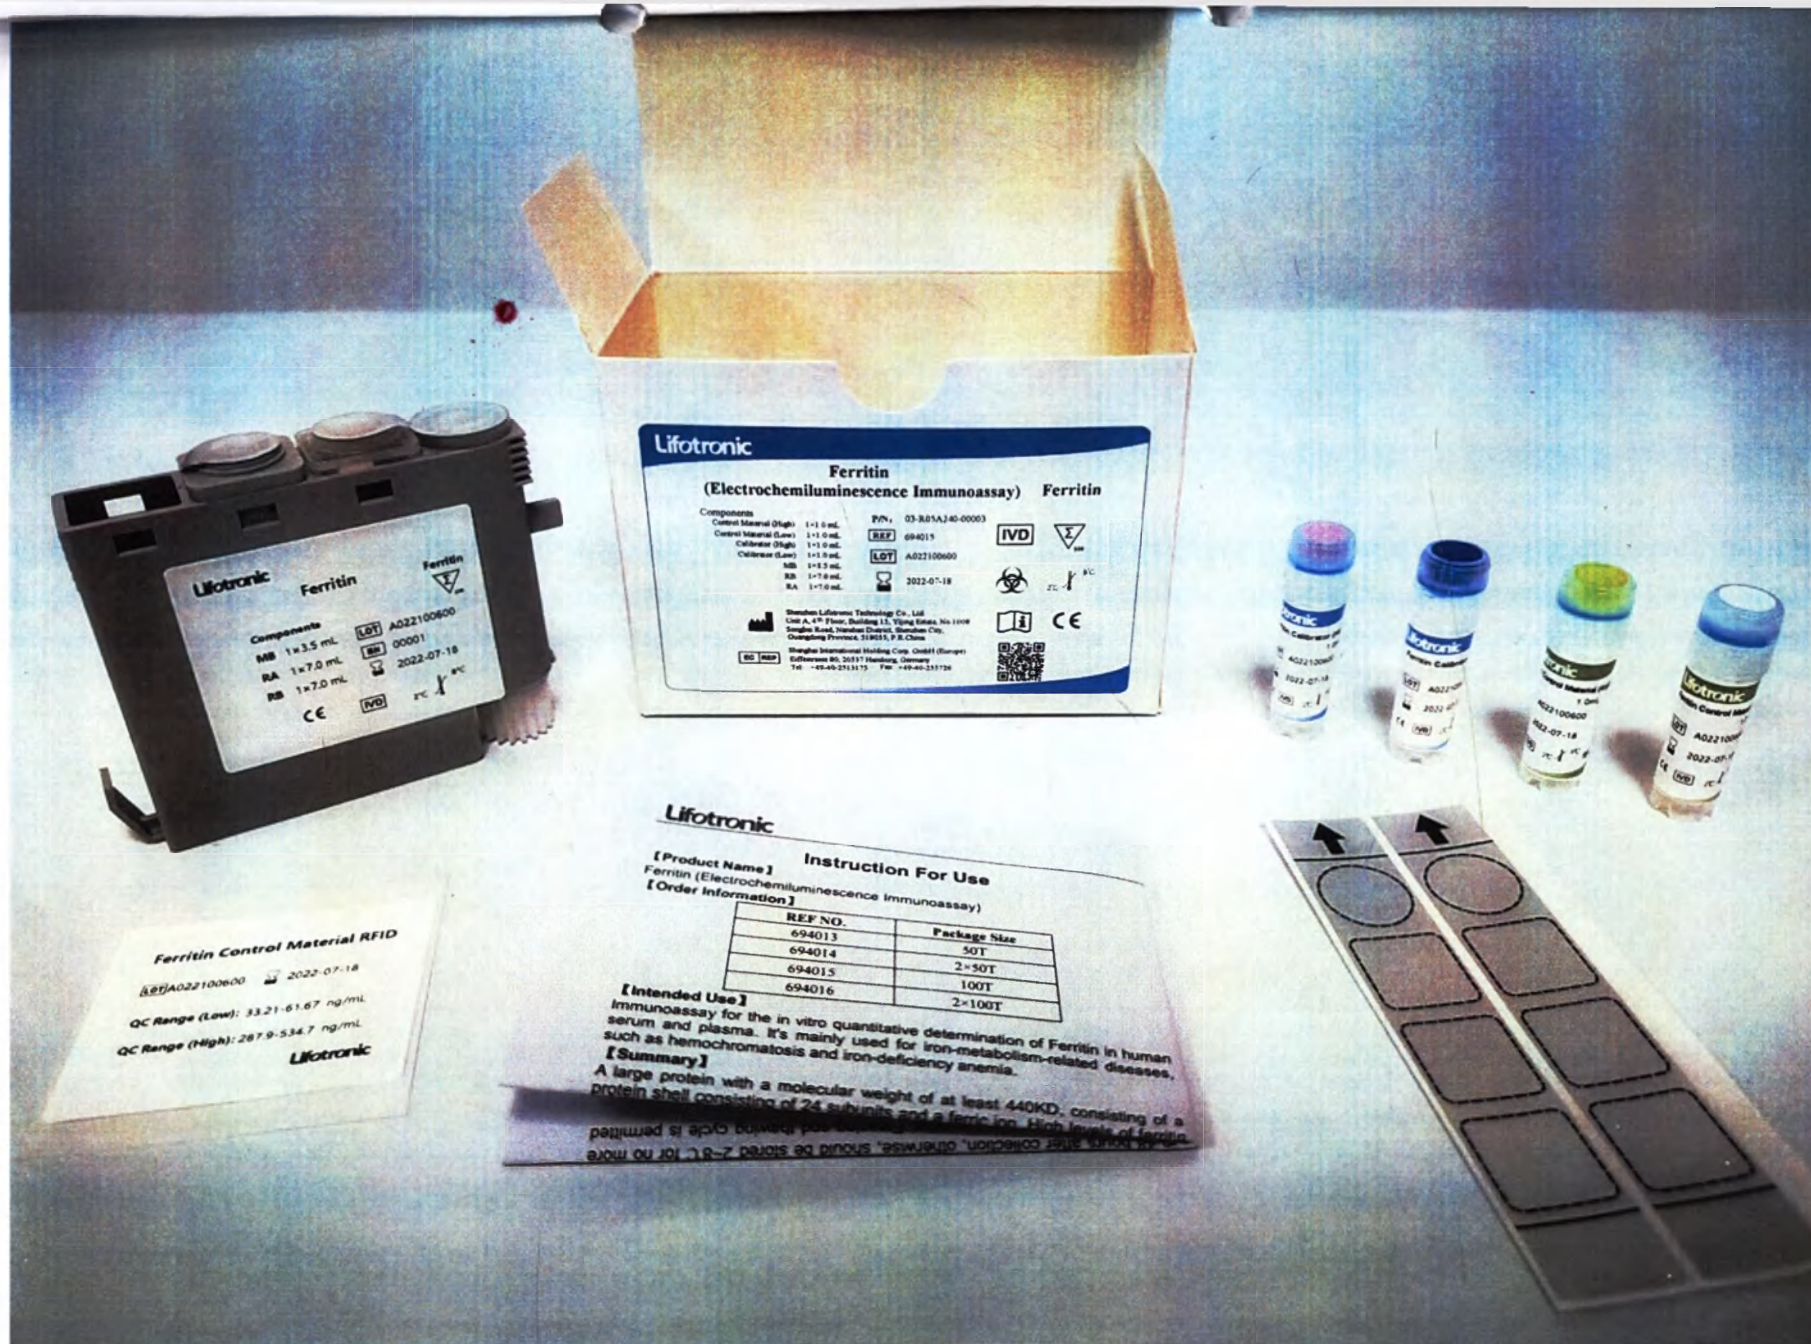

Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения ферритина электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме

используемых на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Ferritin (Electrochemiluminescence Immunoassay)/Ferritin)



Общий вид медицинского изделия (Набор реагентов для количественного определения ферритина электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Ferritin (Electrochemiluminescence Immunoassay)/Ferritin)

Lifotronic

Ferritin

Ferritin



Components

MB 1×3.5 mL

LOT

A022100600

RA 1×7.0 mL

SN

00001

RB 1×7.0 mL



2022-07-18

CE

IVD


2°C  8°C

Кассета с реагентами (Набор реагентов для количественного определения ферритина электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека

для анализаторов ECL для диагностики in vitro (Ferritin (Electrochemiluminescence Immunoassay)/Ferritin)




Калибратор (высокий уровень), Калибратор (низкий уровень), Материал контрольный (высокий уровень), Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов для количественного определения ферритина электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Ferritin (Electrochemiluminescence Immunoassay)/Ferritin)

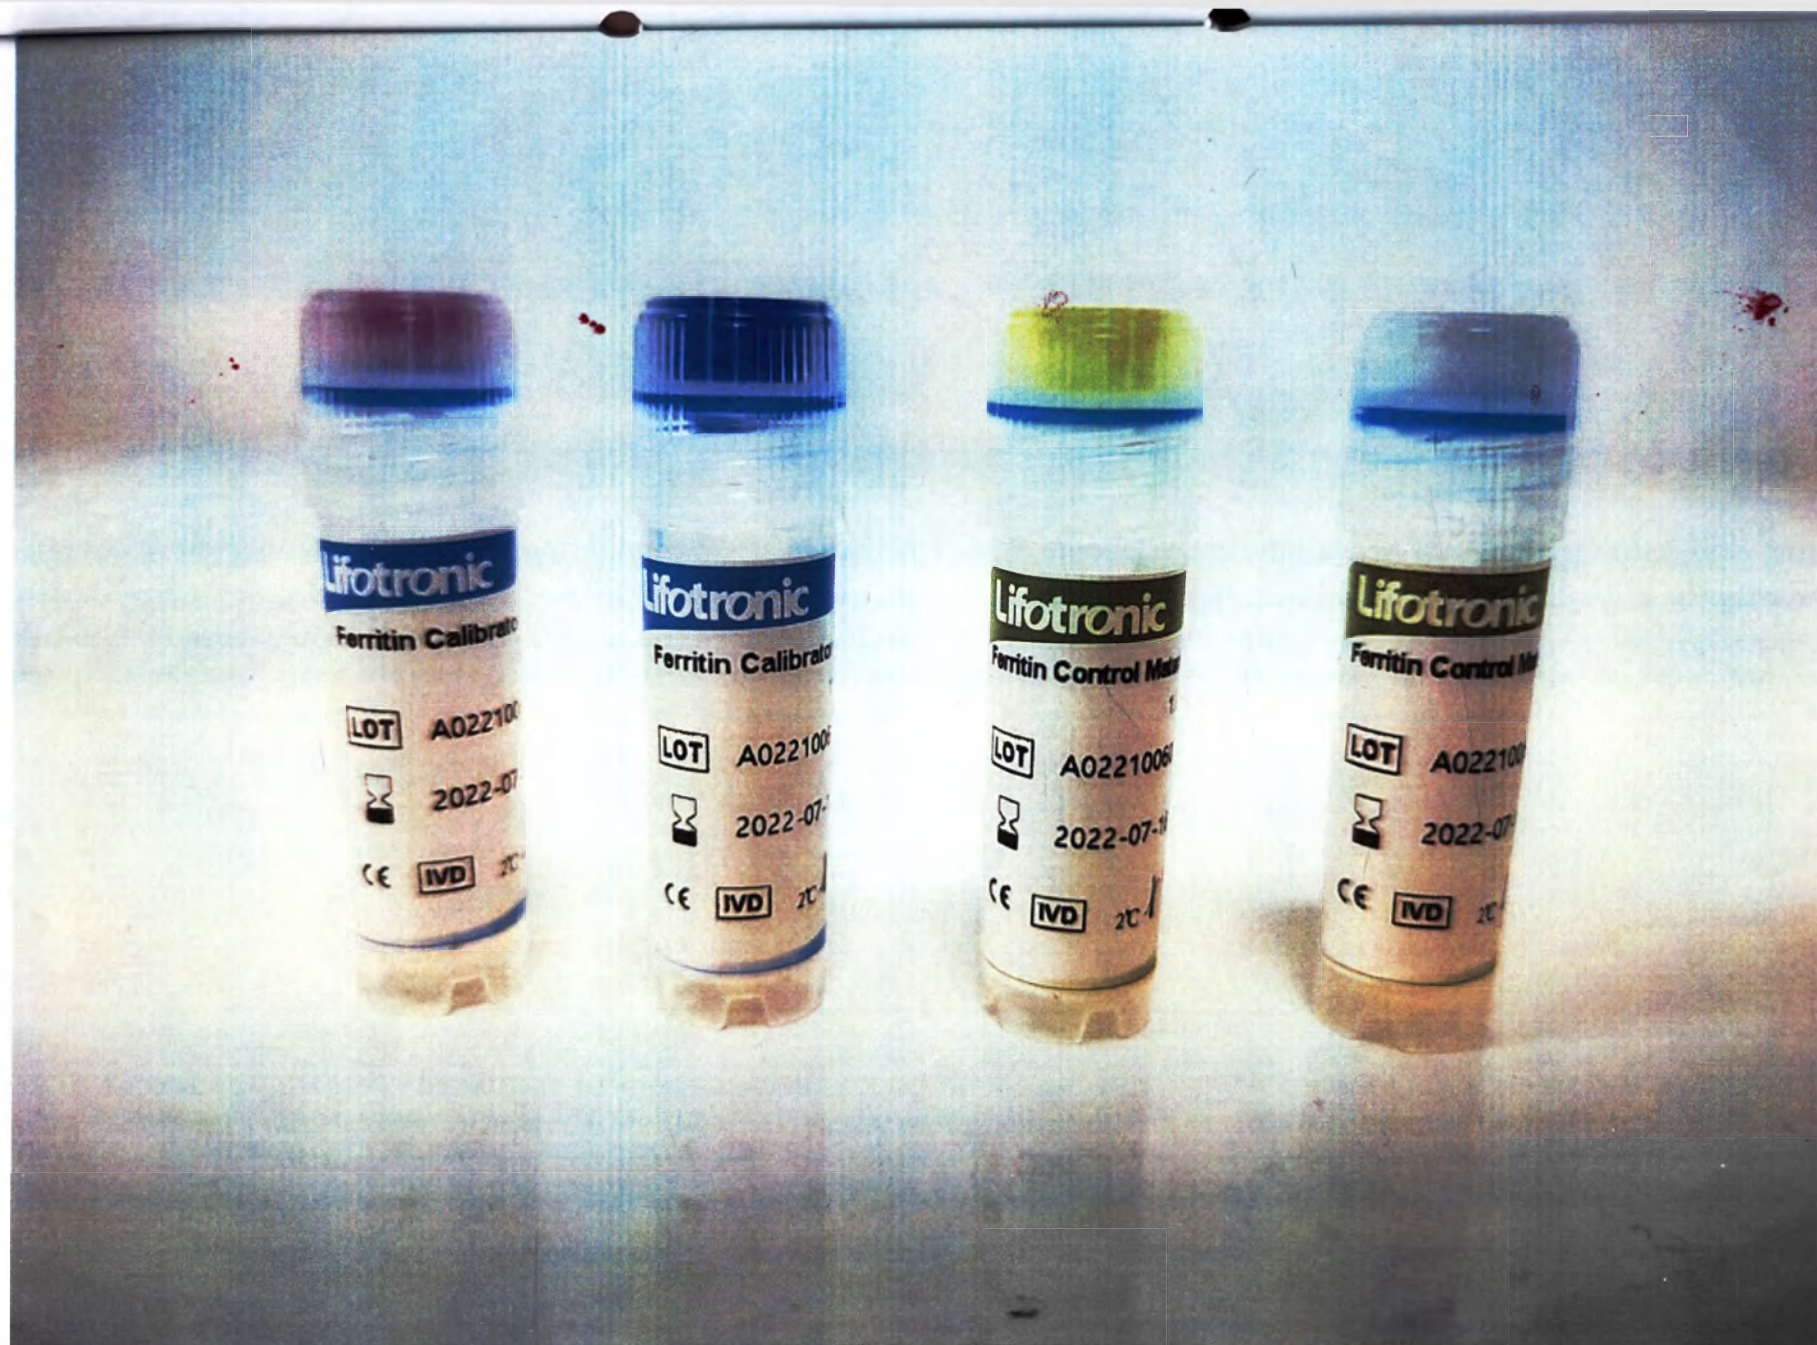

Калибратор (высокий уровень), Калибратор (низкий уровень), Материал контрольный (высокий уровень), Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов для количественного определения ферритина электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Ferritin (Electrochemiluminescence Immunoassay)/Ferritin)



Калибратор (высокий уровень), Калибратор (низкий уровень), Материал контрольный (высокий уровень), Материал контрольный (низкий уровень) (Набор реагентов для количественного определения ферритина электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на анализаторах ECL для диагностики in vitro (Ferritin (Electrochemiluminescence Immunoassay)/Ferritin)

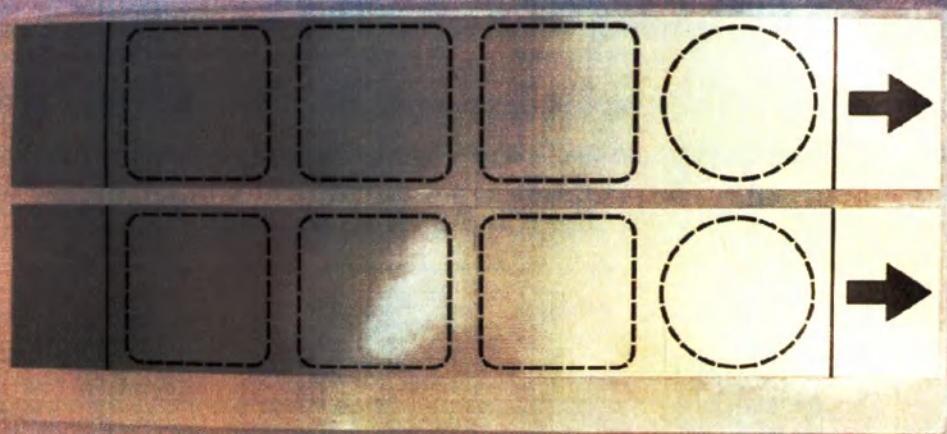

Этикетки для запечатывания флаконов (Набор реагентов для количественного определения ферритина электрохемилюминесцентным методом в сыворотке или

Ferritin Control Material RFID

LOT A022100700  2022-07-29

QC Range (Low): 31.82-59.94 ng/mL

QC Range (High): 281.1-535.8 ng/mL

Lifotronic

Этикетка результатов значений материалов контрольных (Набор реагентов для количественного определения ферритина электрохемилюминесцентным методом в

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 9 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.

