


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ТестГен»
А. Н. Тороповский
«15» октября 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ

Набор реагентов для определения статуса мутаций
гена *KRAS* методом мультиплексной ПЦР-РВ с
детекцией кривых плавления
в пробе геномной ДНК человека из образцов
фиксированной ткани
«Тест-*KRAS*-ткань-мульти»

ТУ 21.20.23-035-97638376-2020

Версия 2 от 15.10.2021.



ООО «ТестГен»

Паспорт качества № 167

Набор реагентов для определения
статуса мутаций гена *KRAS* методом
мультиплексной ПЦР-РВ с детекцией
кривых плавления
в пробе геномной ДНК человека из
образцов фиксированной ткани
«Тест-*KRAS*-ткань-мульти»

ТУ 21.20.23-035-97638376-2020

Номер серии (лот)	202110-167
Количество наборов в серии	2
Дата изготовления	2021-10
Срок годности	2022-10

Набор реагентов для определения статуса мутаций гена *KRAS*
методом мультиплексной ПЦР-РВ с детекцией кривых плавления в
пробе геномной ДНК человека из образцов фиксированной ткани
«Тест-*KRAS*-ткань-мульти»

ТУ 21.20.23-035-97638376-2020

Состав набора

ЛОТ	202110-167	пробирок по 840 мкл
ПЦР-буфер		1 пробирка, 112 мкл
Праймер-мкс 12		1 пробирка, 112 мкл
Праймер-мкс 13		1 пробирка, 112 мкл
Праймер-мкс 35		1 пробирка, 112 мкл
Праймер-мкс 81		1 пробирка, 112 мкл
Праймер-мкс 117		1 пробирка, 112 мкл
Праймер-мкс 146		1 пробирка, 112 мкл
ГНО		1 пробирка, 324 мкл
ОВО		1 пробирка, 324 мкл

ру

Только для in vitro диагностики
Только для профессионального применения

Набор реагентов для определения статуса мутаций гена KRAS
методом мультиплексной ПЦР-РВ с детекцией кривых плавления в
пробах геномной ДНК человека из образцов фиксированной ткани
«Тест-KRAS-ткань-мульти»

ТУ 21.20.23-035-97638376-2020

IVD

Состав набора:

LOT 202110-167



2021-10



2022-10



24

-24 °C -16 °C




ПЦР-буфер	2 пробирки по 840 мкл
Праймер-микс 12	1 пробирка, 112 мкл
Праймер-микс 13	1 пробирка, 112 мкл
Праймер-микс 59	1 пробирка, 112 мкл
Праймер-микс 61	1 пробирка, 112 мкл
Праймер-микс 117	1 пробирка, 112 мкл
Праймер-микс 146	1 пробирка, 112 мкл
ПКО	1 пробирка, 324 мкл
ОКО	1 пробирка, 324 мкл

РУ ____/____

Только для in vitro диагностики

Только для профессионального применения



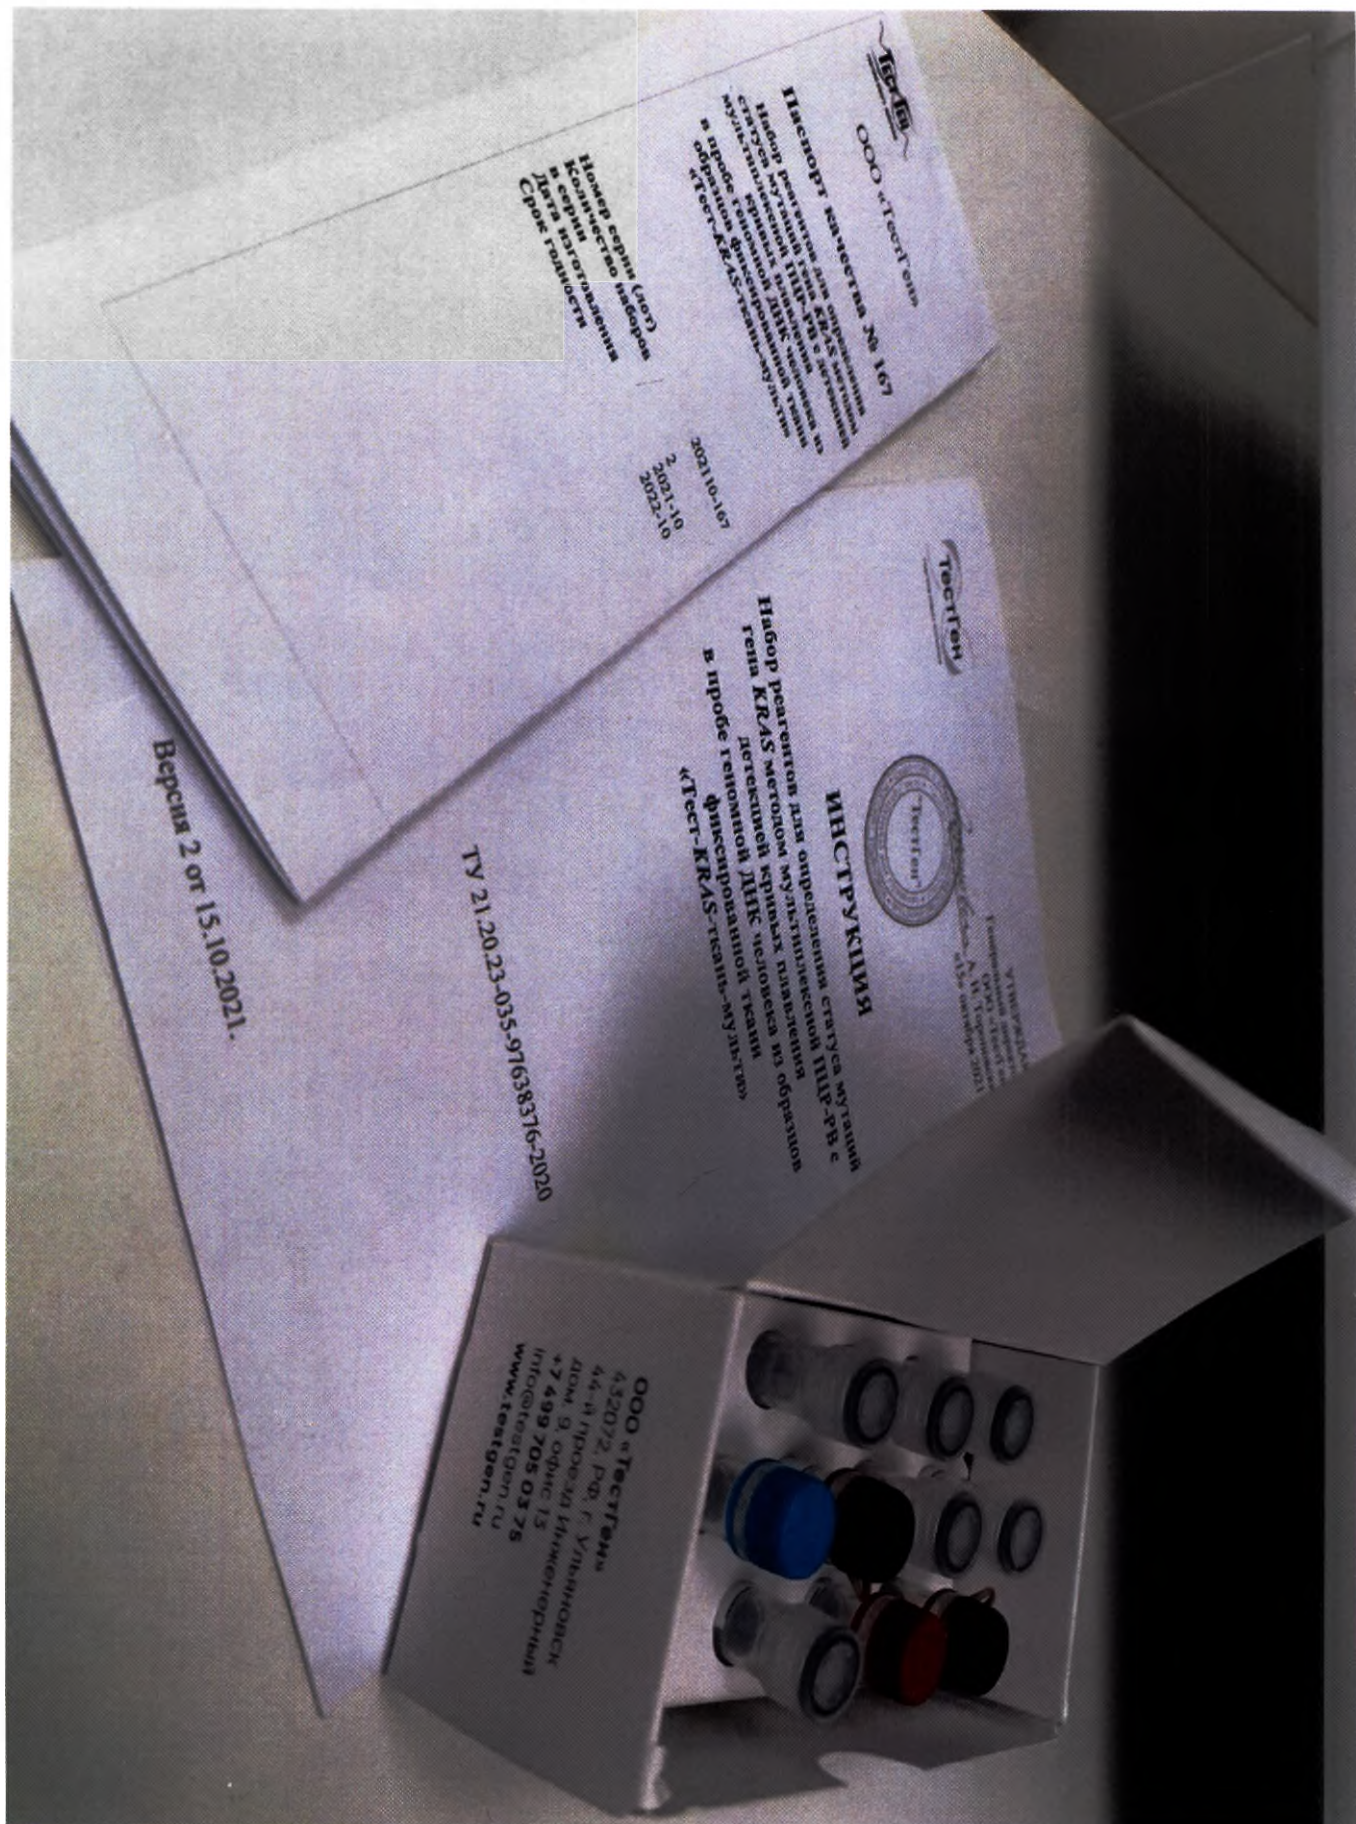

ТестГен
ООО «ТестГен»
Инструкция
Набор реагентов для определения
статуса мутации гена KRAS методом
мультимикционной ПЦР-РВ с
детекцией ДНК человека из
образцов фекальной ткани
«Тест-КРАС-ткань-мульт»

2021-10-167
2021-10
2022-10

ТестГен
ИНСТРУКЦИЯ
Набор реагентов для определения статуса мутации
гена KRAS методом мультимикционной ПЦР-РВ с
детекцией ДНК человека из образцов
фекальной ткани
Фиксированной мутации
«Тест-КРАС-ткань-мульт»




УТВЕРЖДЕНО
Исполнительный директор
А. В. Торгашев
15.10.2021


ТУ 21.20.23-035-91638316-2020


Всего 2 от 15.10.2021.

ООО «ТестГен»
432072, РД, г. Ульяновск
дом. 9, офис 13
+7 499 705 03 75
info@testgen.ru
www.testgen.ru

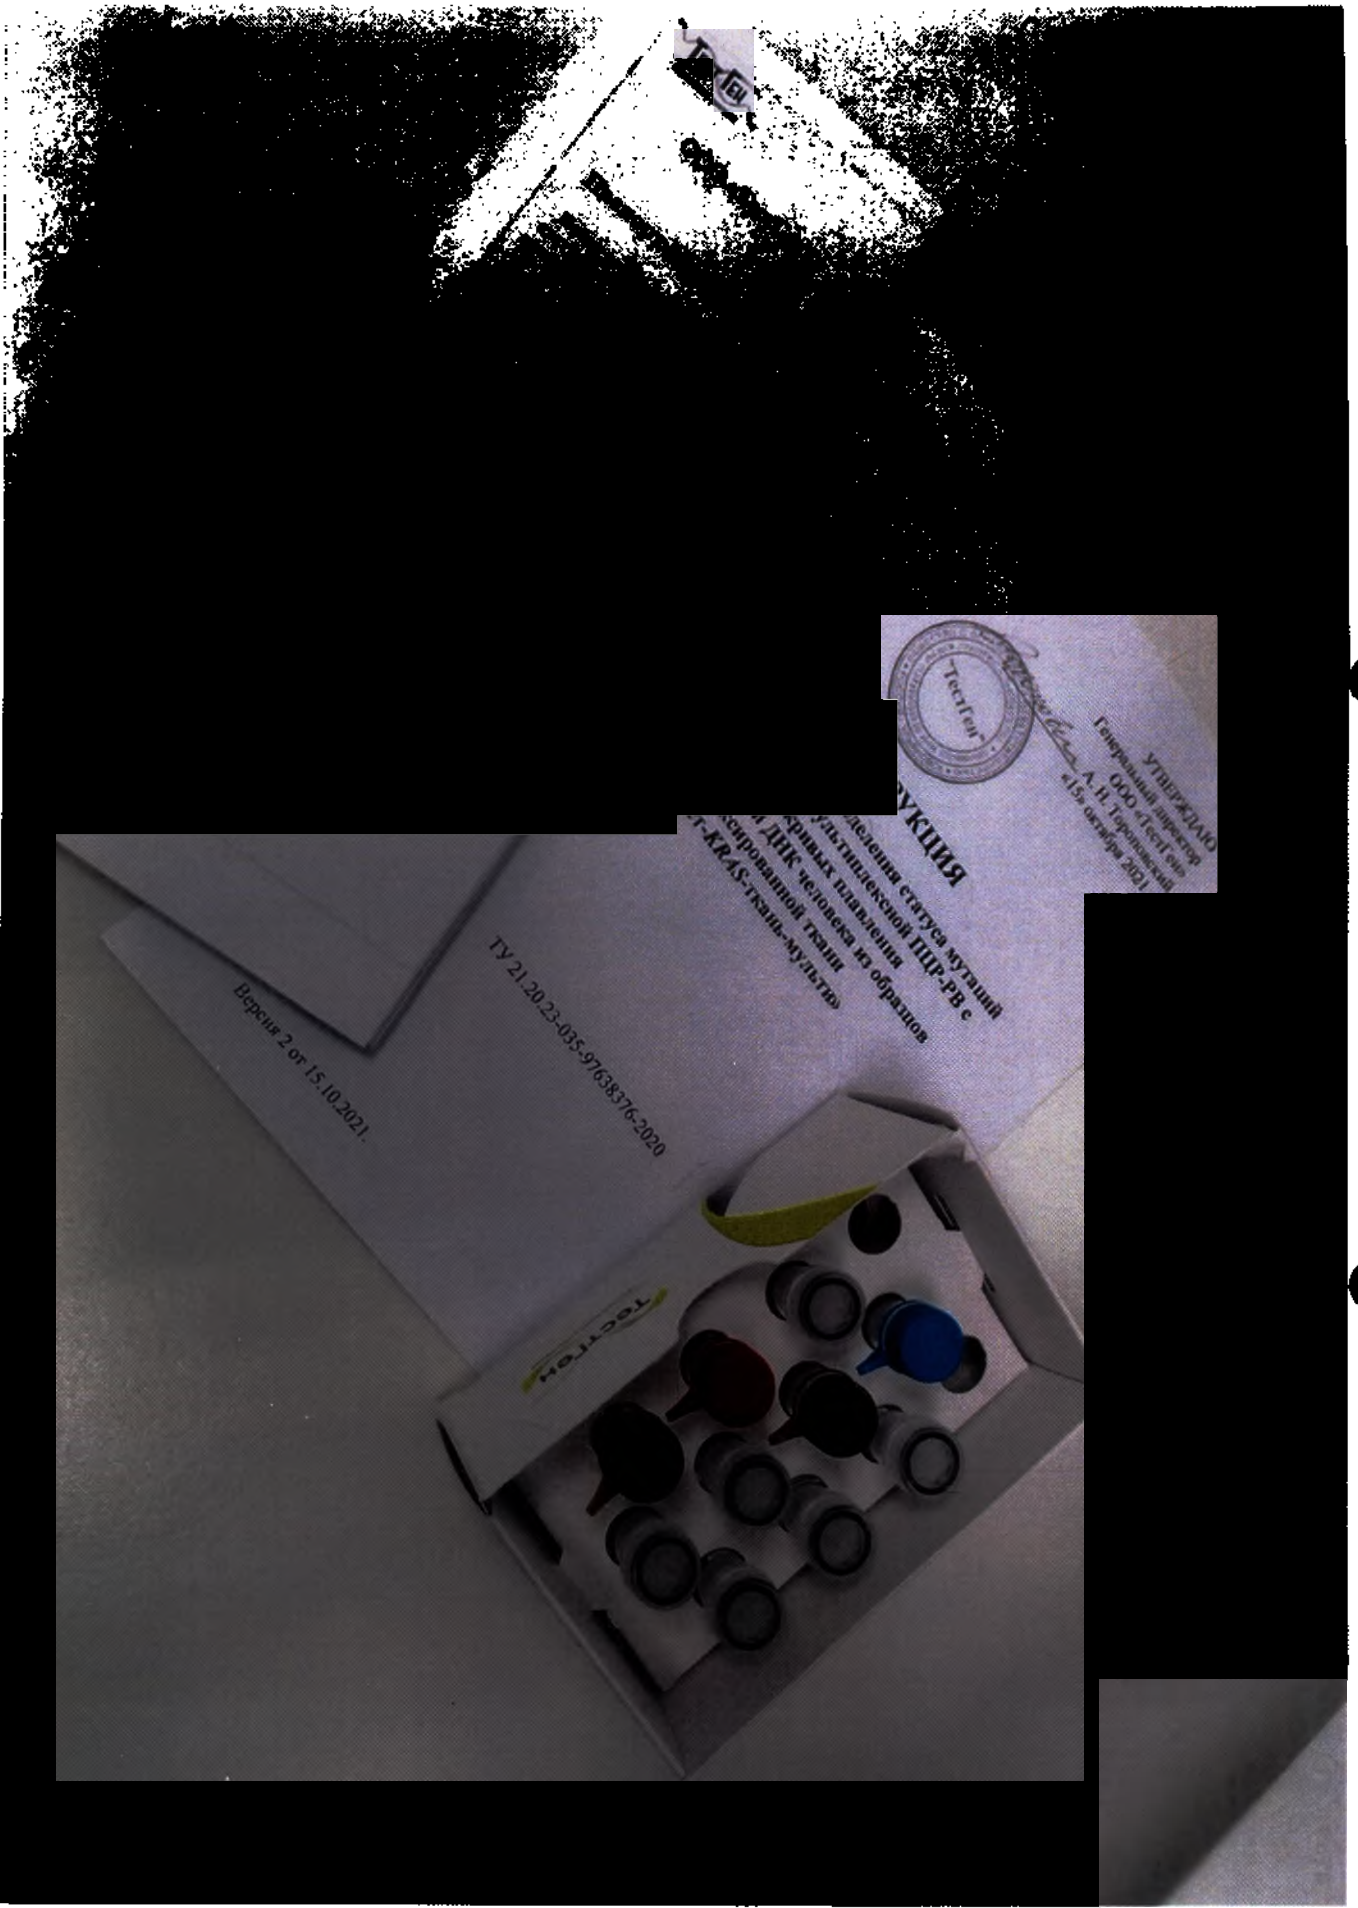



Нанесение маркировки на пробирки с помощью этикеток из белой полимерной пленки с печатной надписью черного цвета



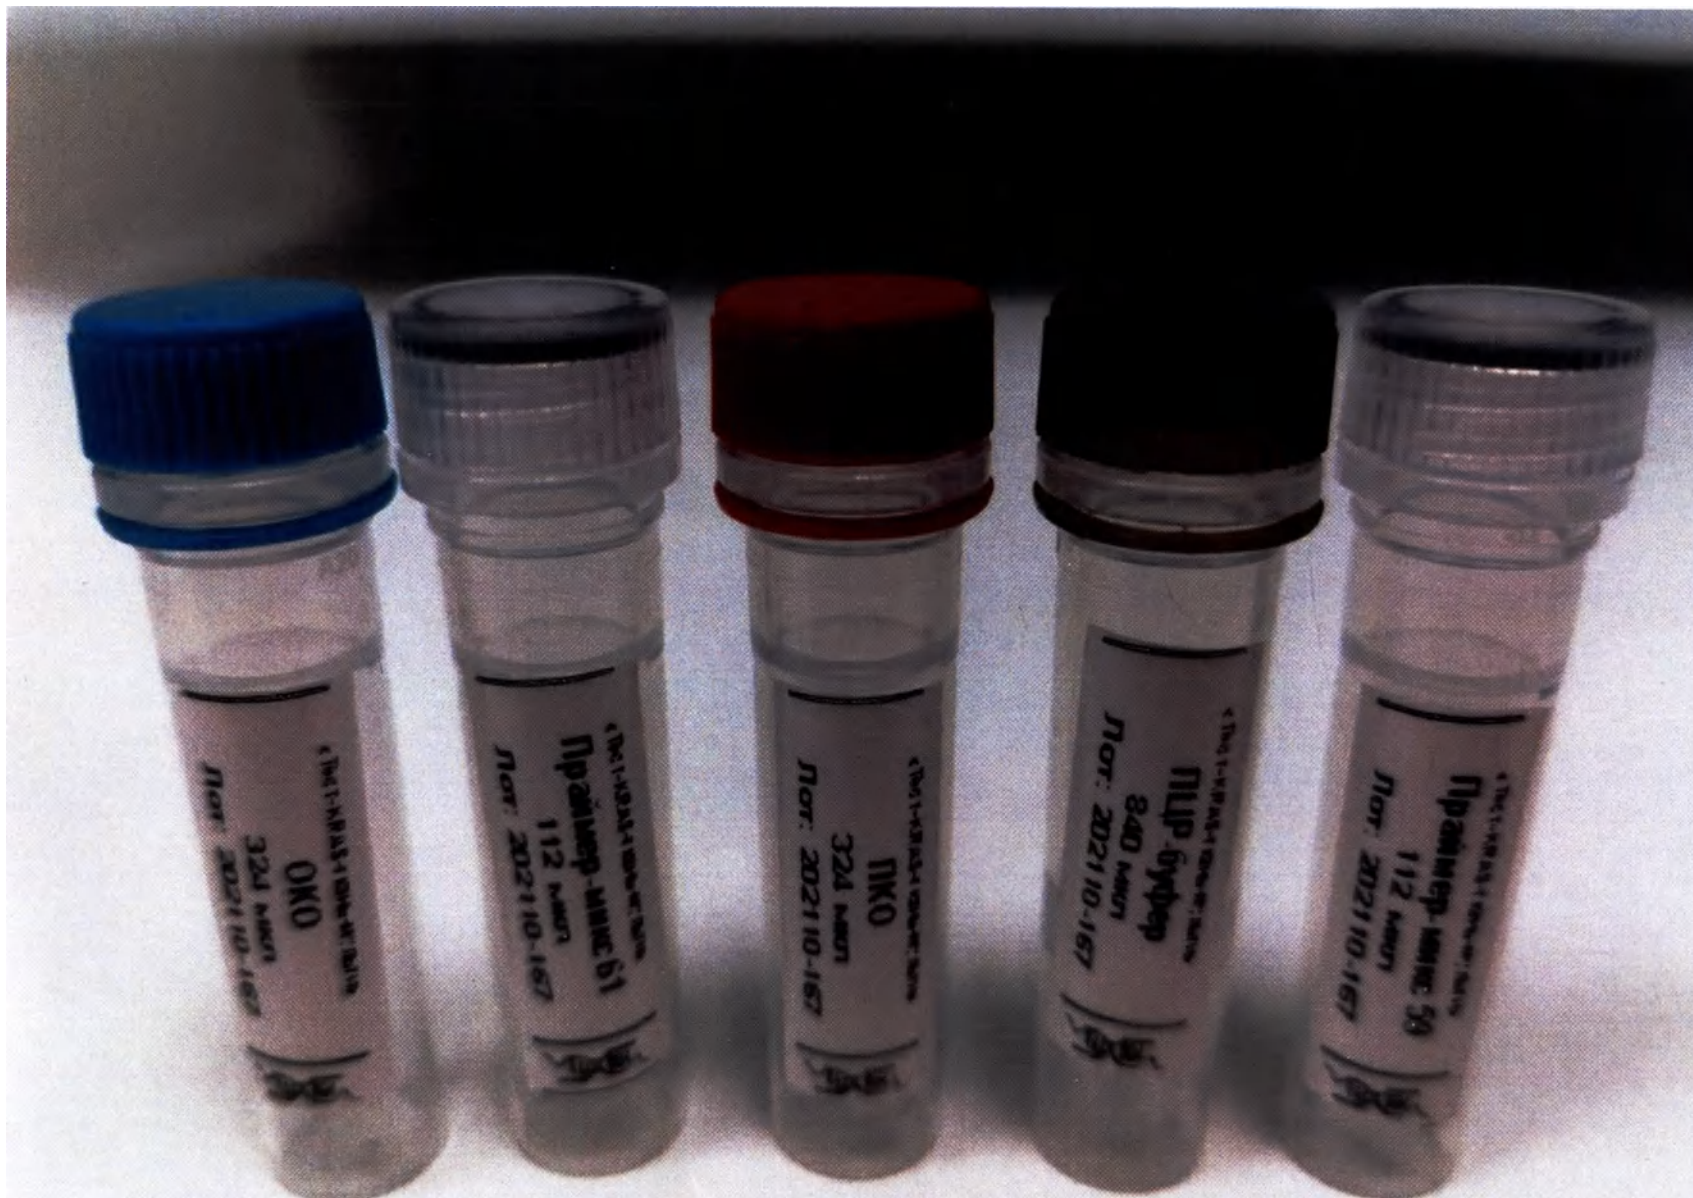


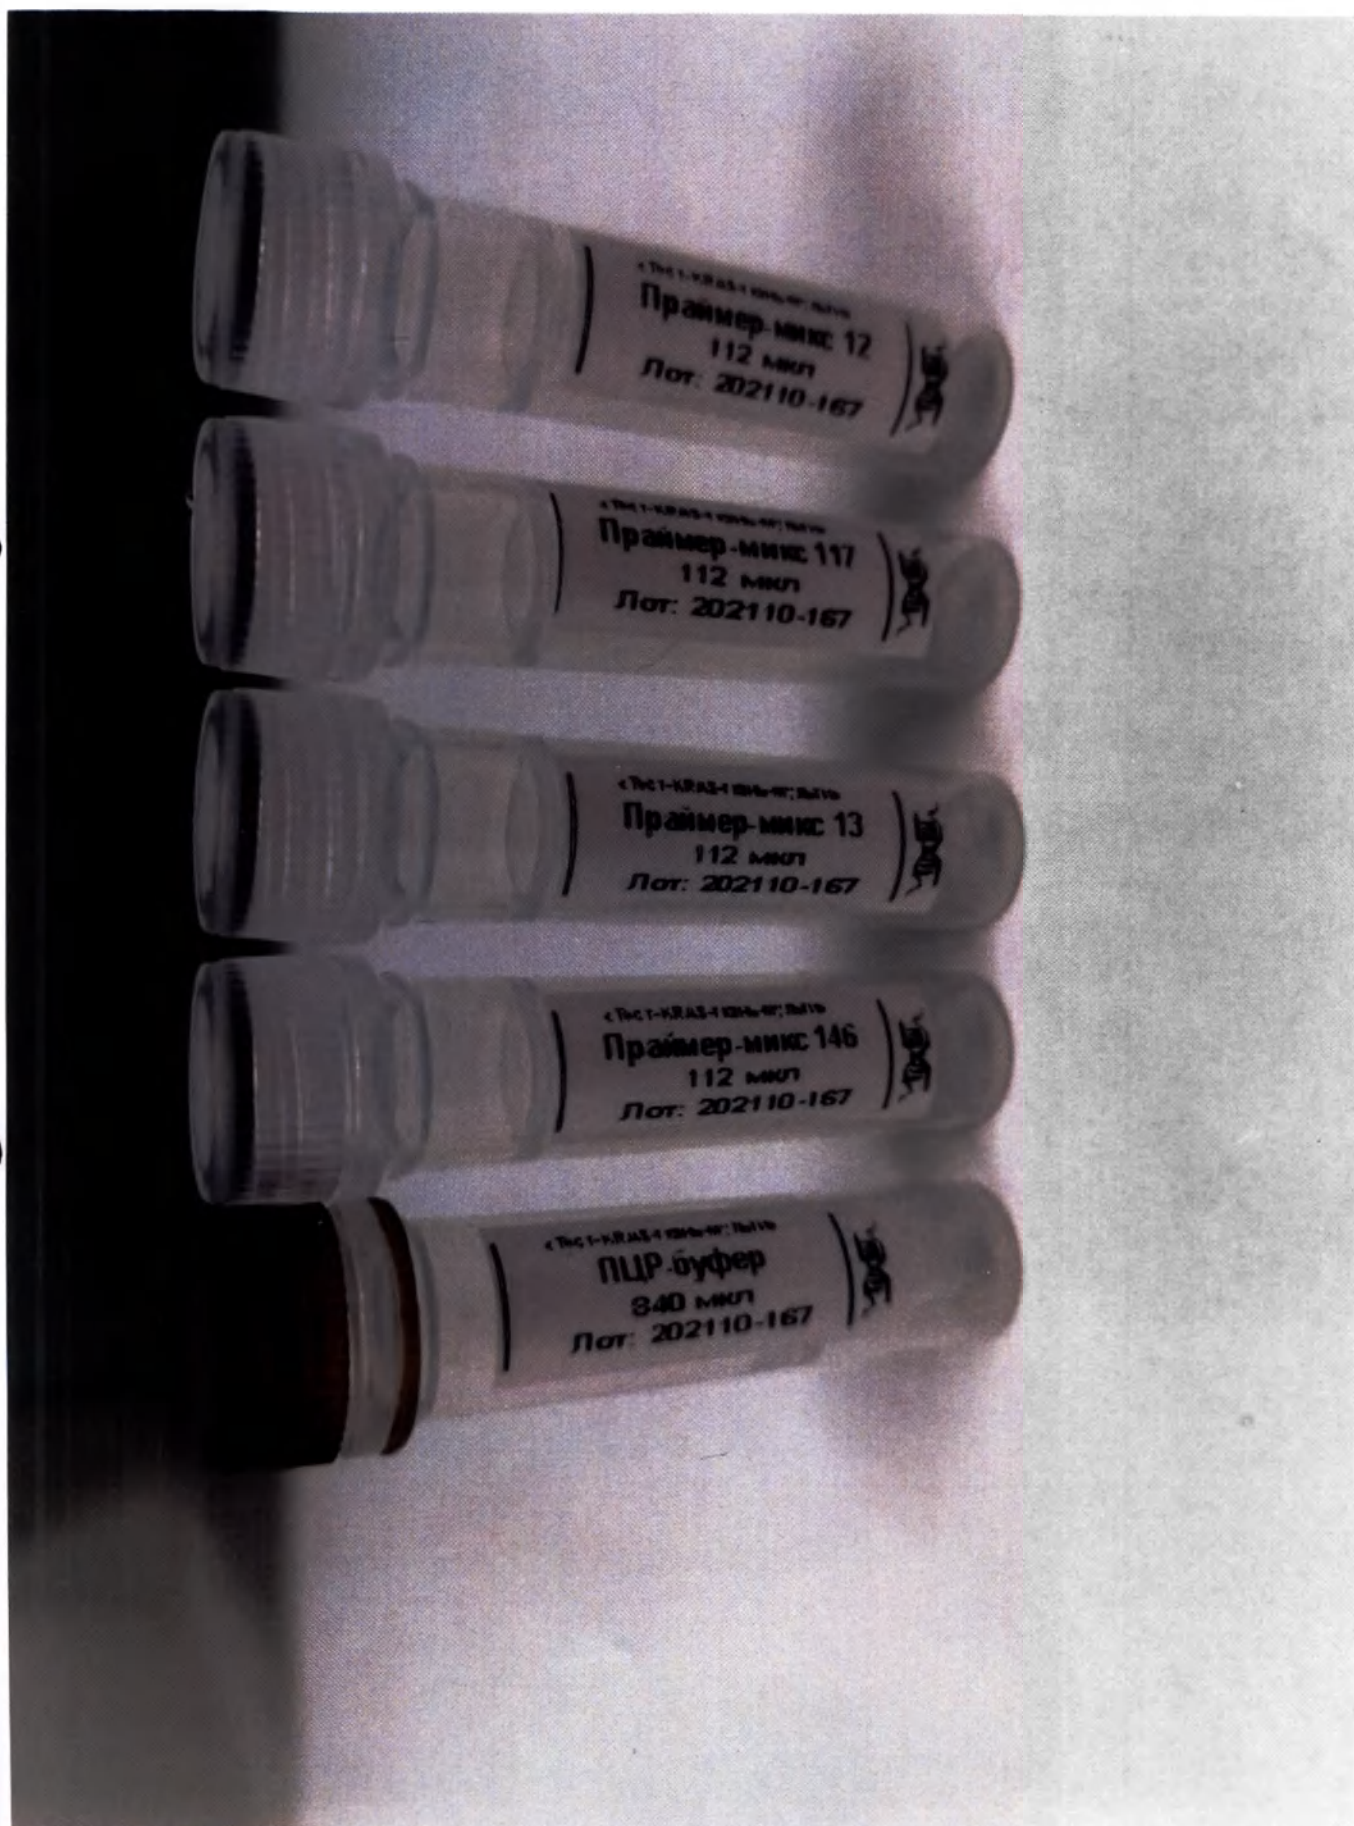


Нанесение маркировки на пробирки с помощью этикеток из прозрачной полимерной пленки с печатной надписью черного цвета

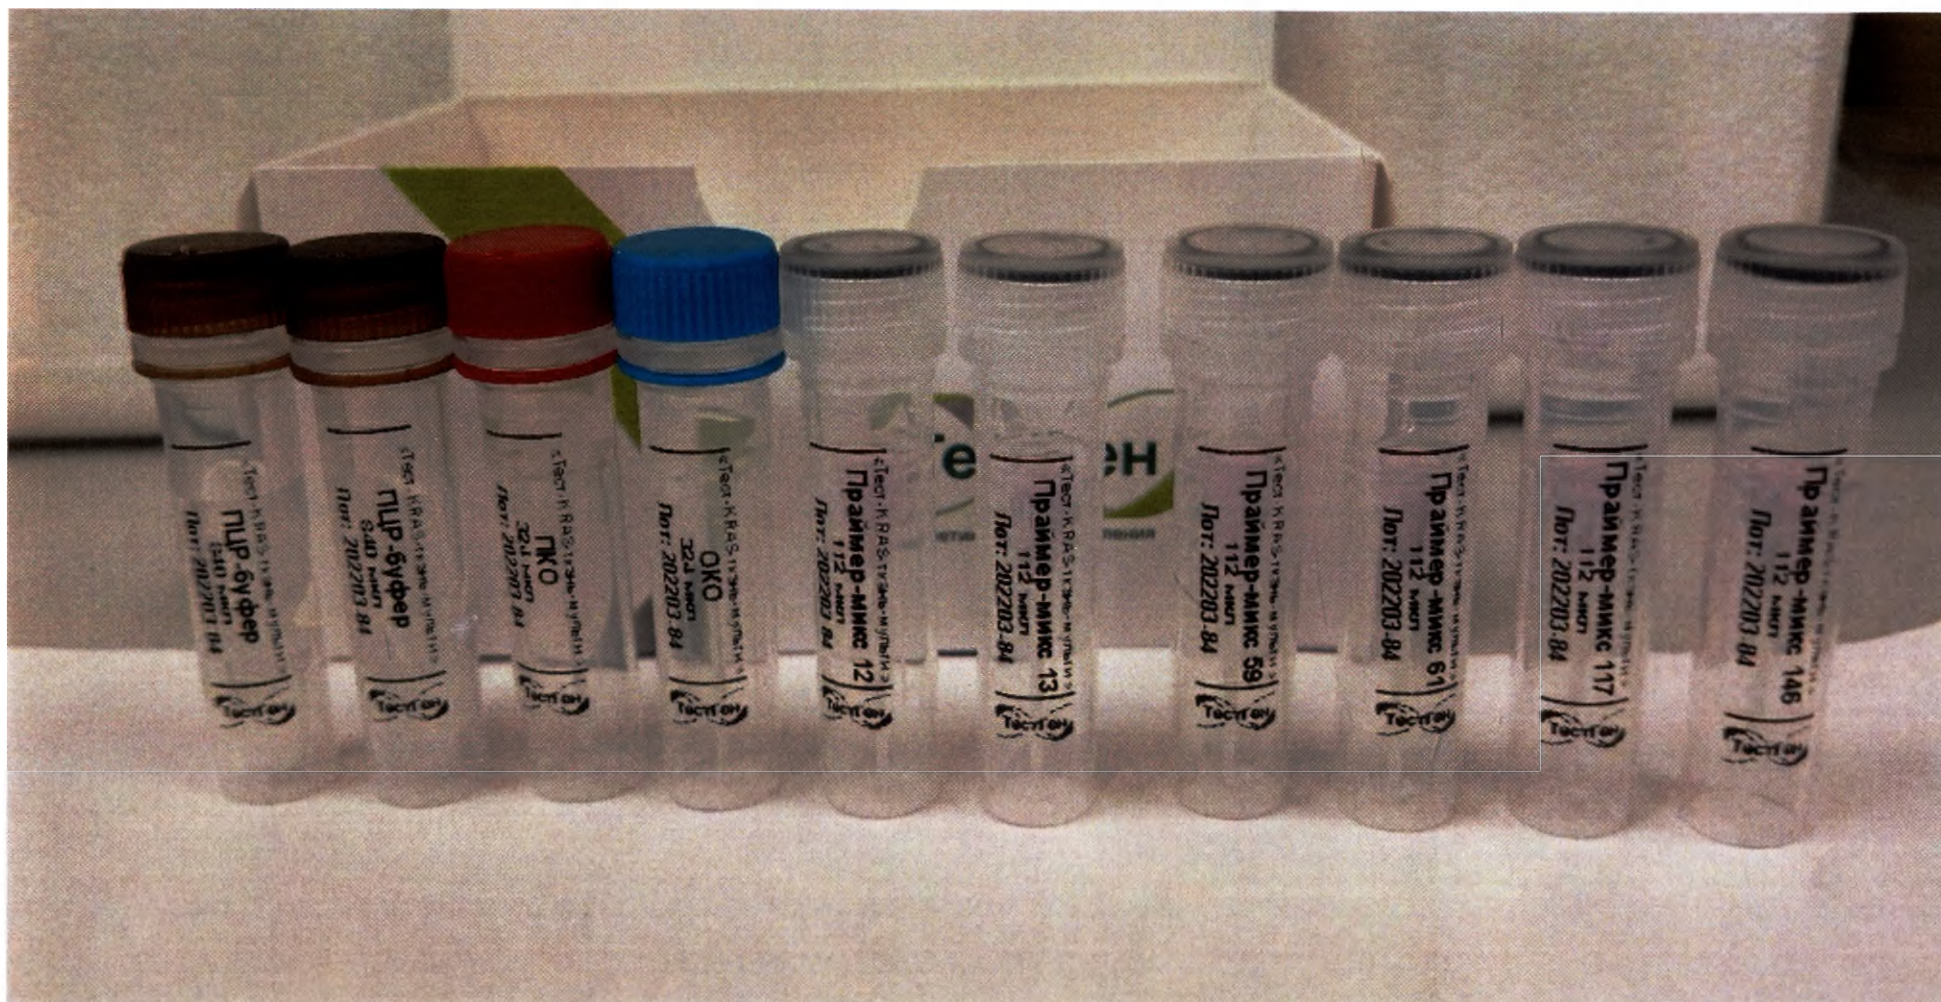

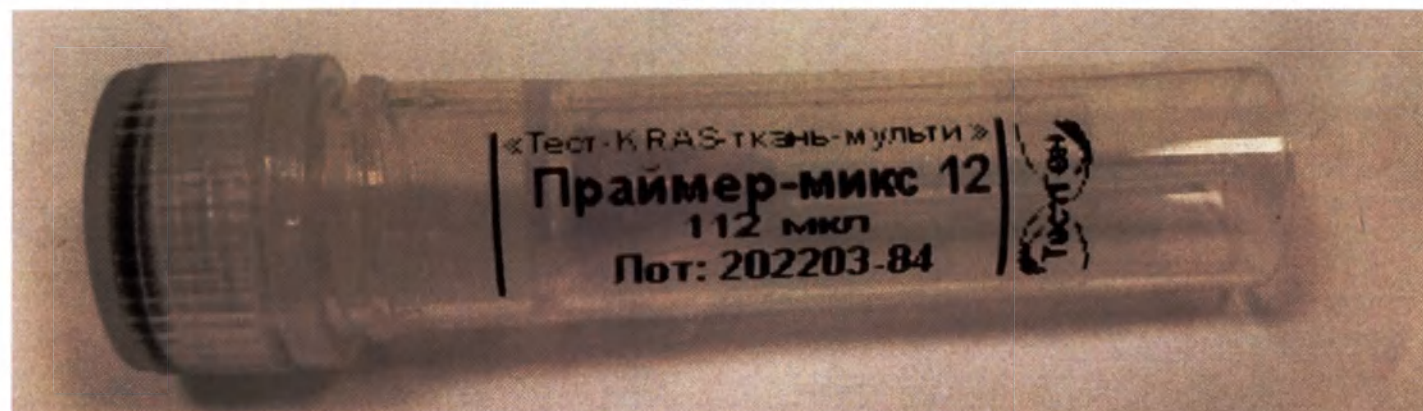

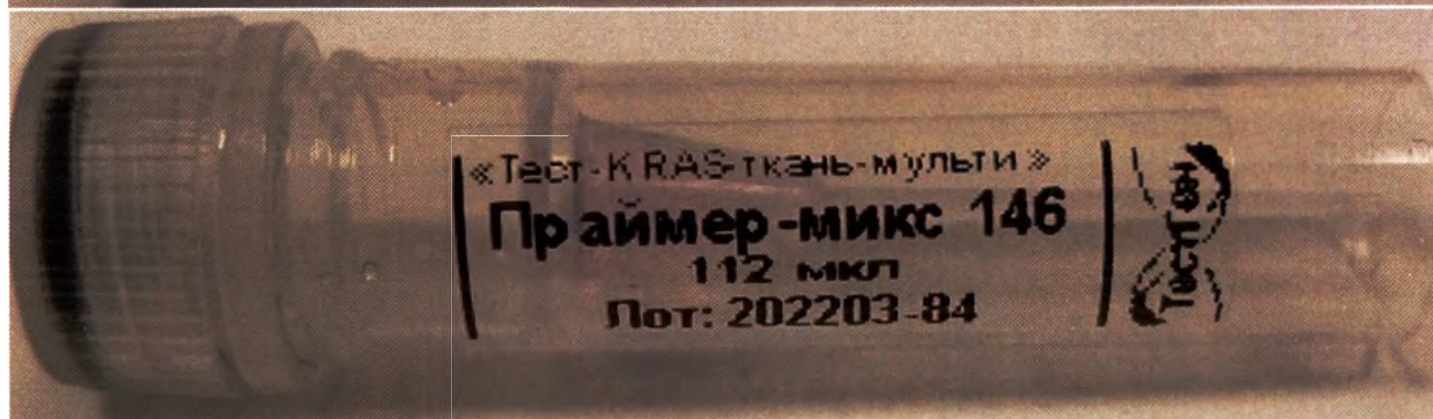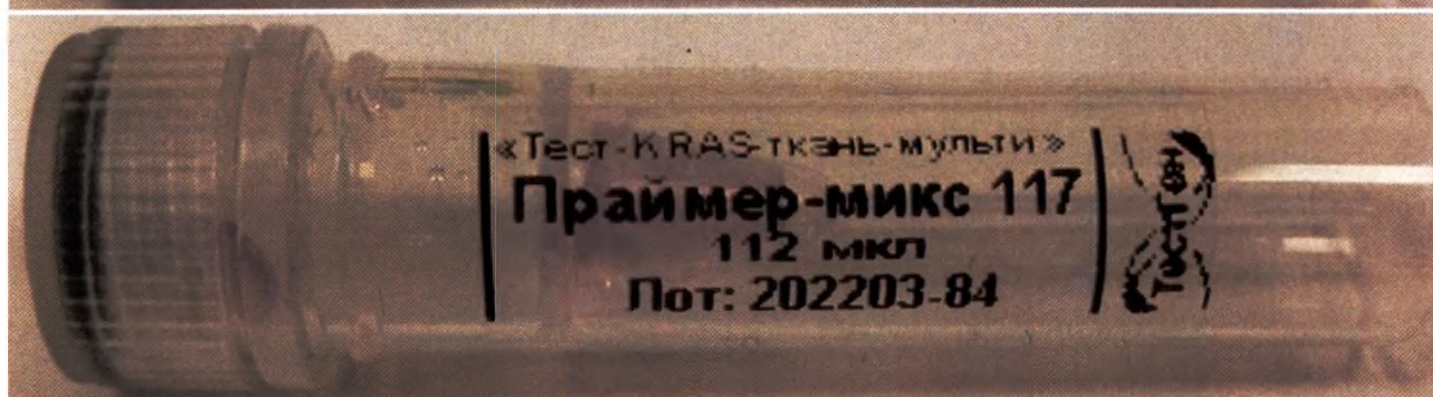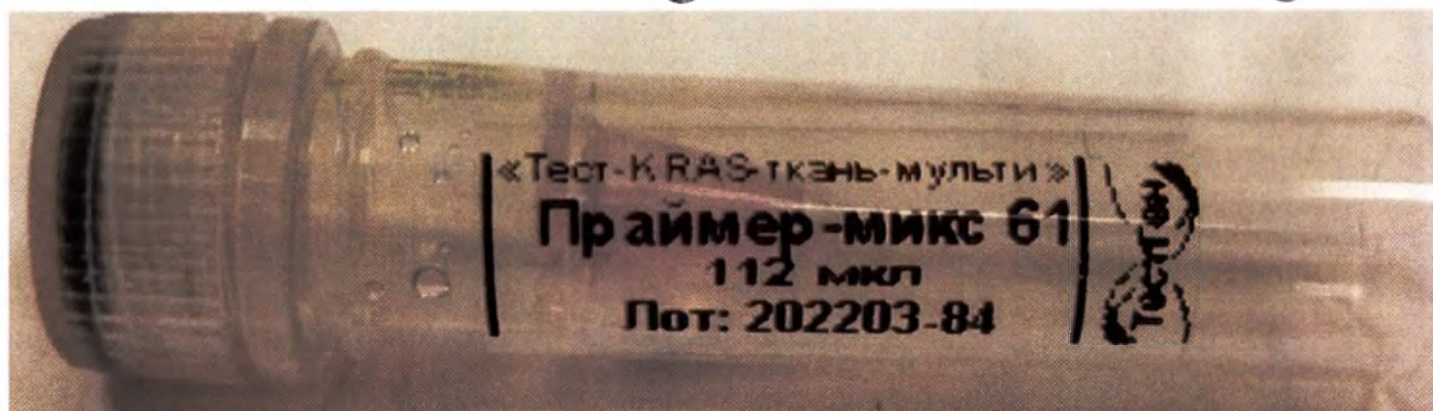

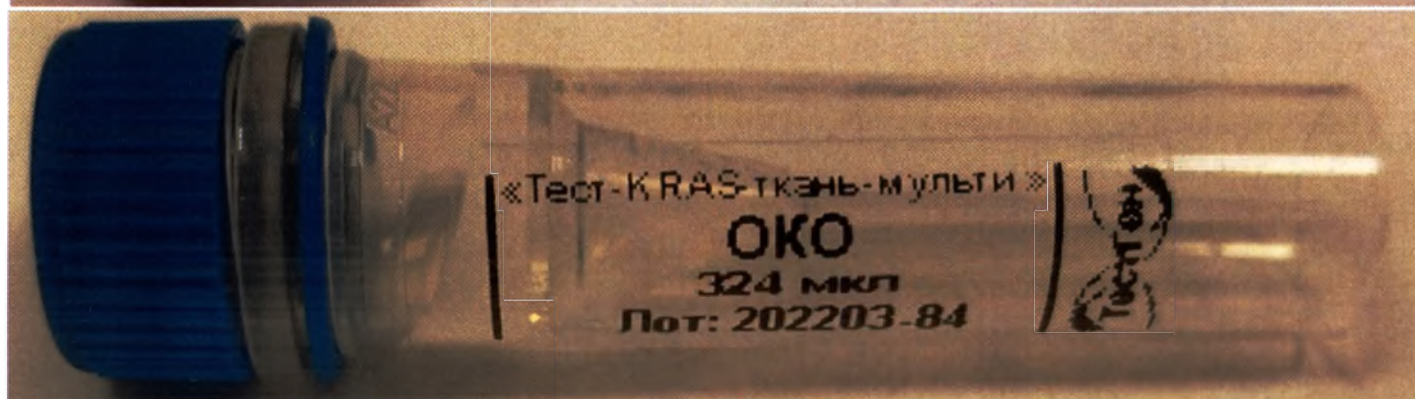

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

10 (десяти) листов

Должность: ген. директор

Тороповский А.П.

