



Фотографические изображения медицинского изделия


Медицинское изделие: Клапан Глаукоматозный Ахмед, модель FP7

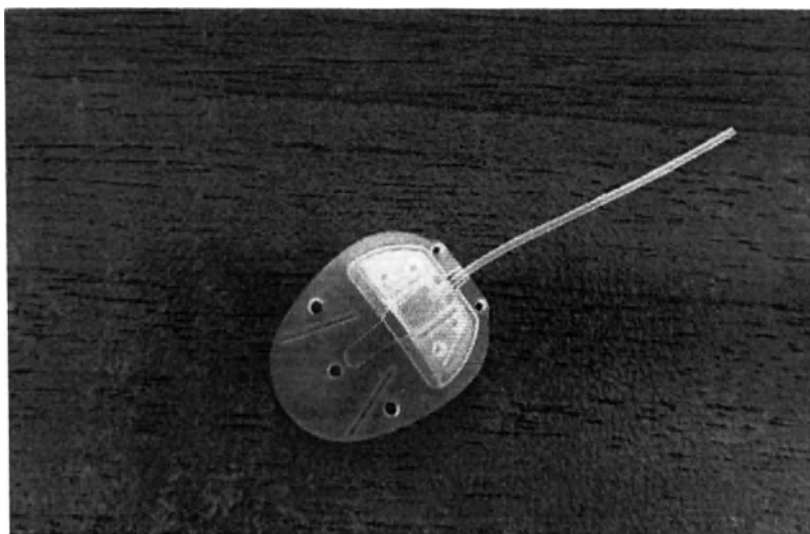


Медицинское изделие: Клапан Глаукоматозный Ахмед, модель FP8

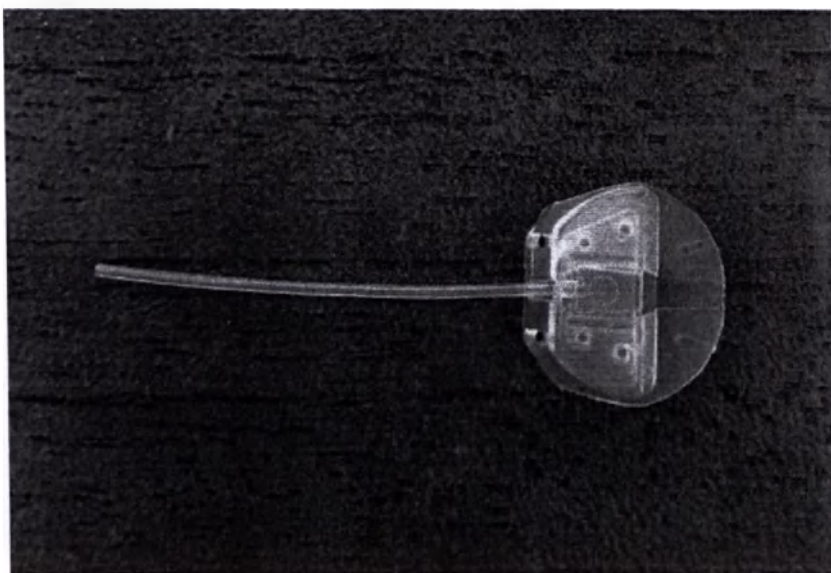

Блистерная упаковка на Клапан Глаукоматозный Ахмед, модель FP7

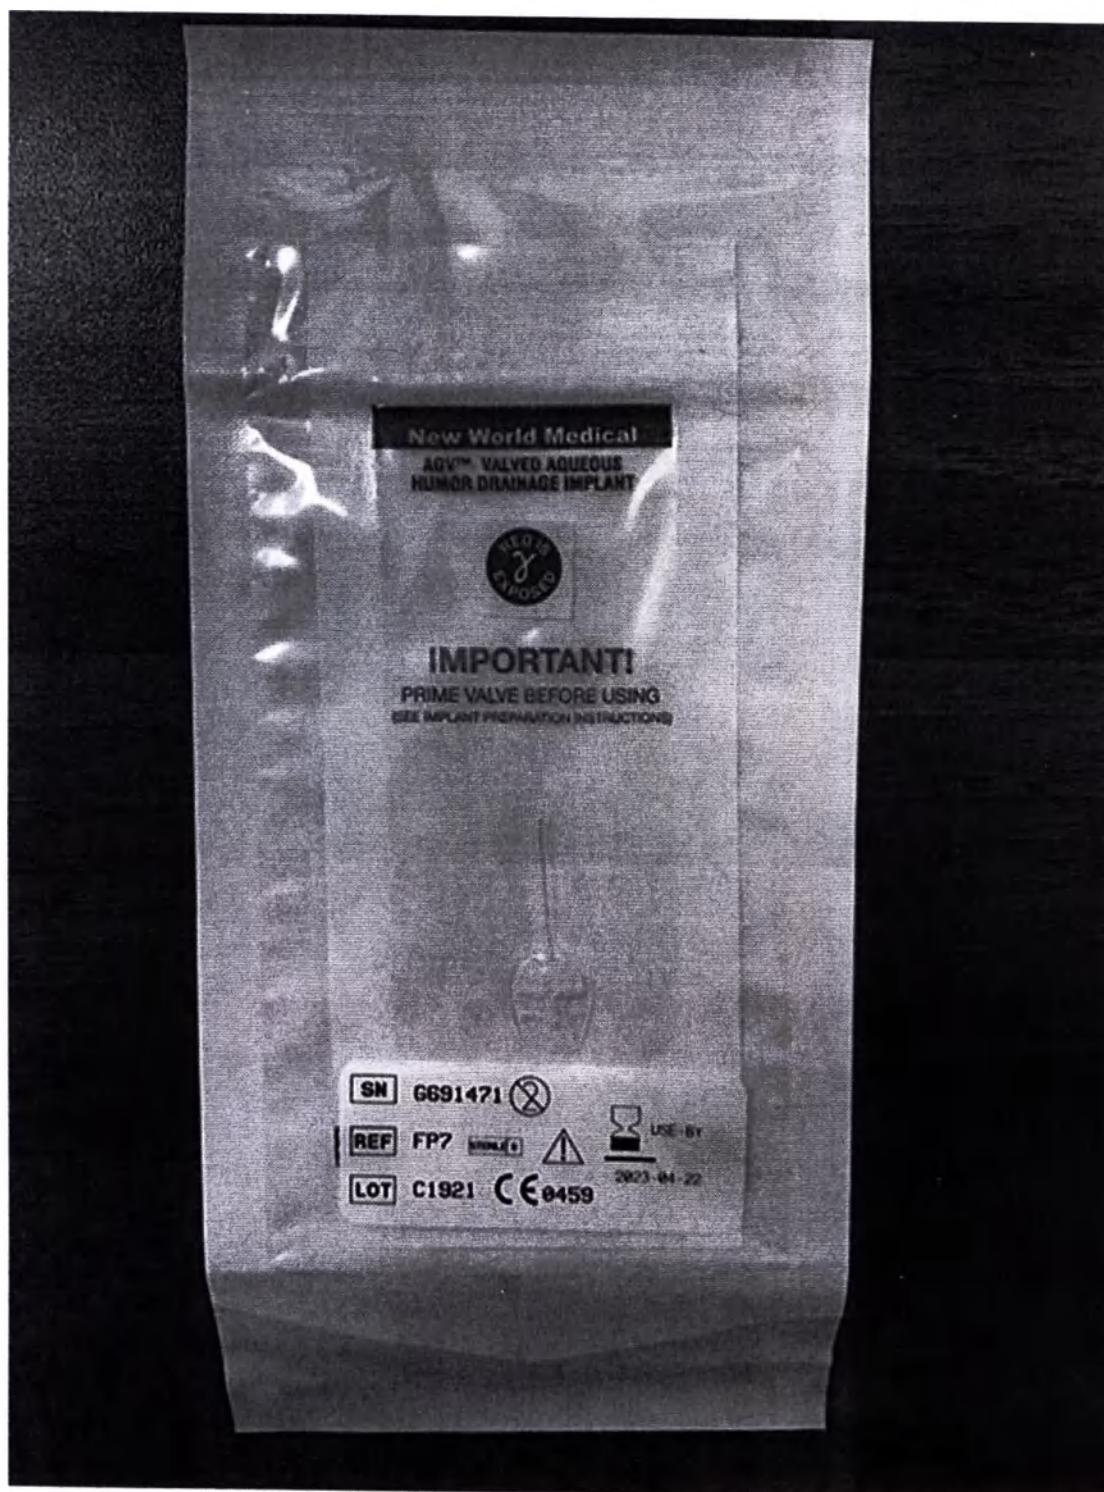

Потребительская упаковка (коробка) на Клапан Глаукоматозный Ахмед, модель FP7

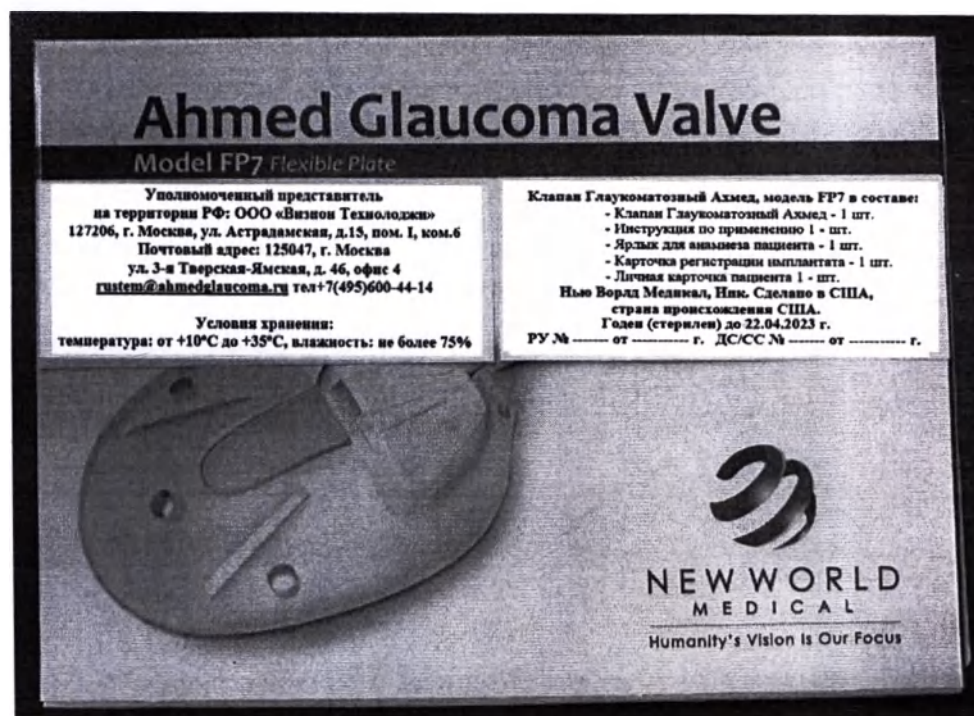


Contains (1) Ahmed Glaucoma Valve Flexible Plate Implant.
Guaranteed sterile unless inner pouch is opened or damaged.



DO NOT REUSE



CONSULT INSTRUCTIONS
FOR USE



STERILIZED USING IRRADIATION



DO NOT RESTERILIZE



DO NOT USE IF
PACKAGE IS DAMAGED



MR SAFE



Manufactured by:

Made in USA



**NEW WORLD
MEDICAL**

10763 Edison Court
Rancho Cucamonga
California 91730 U.S.A.

(909) 466-4304

Customer Service In USA
800.832.5327

www.newworldmedical.com



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



0459



8 92064 00211 9



Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale or on the order of a physician.



(01) 00002064402113
(11) 210422
(17) 230422
(21) 0401471
(10) C1921






C1921



2021-04

REF: 50-0000
REV: C 11/18

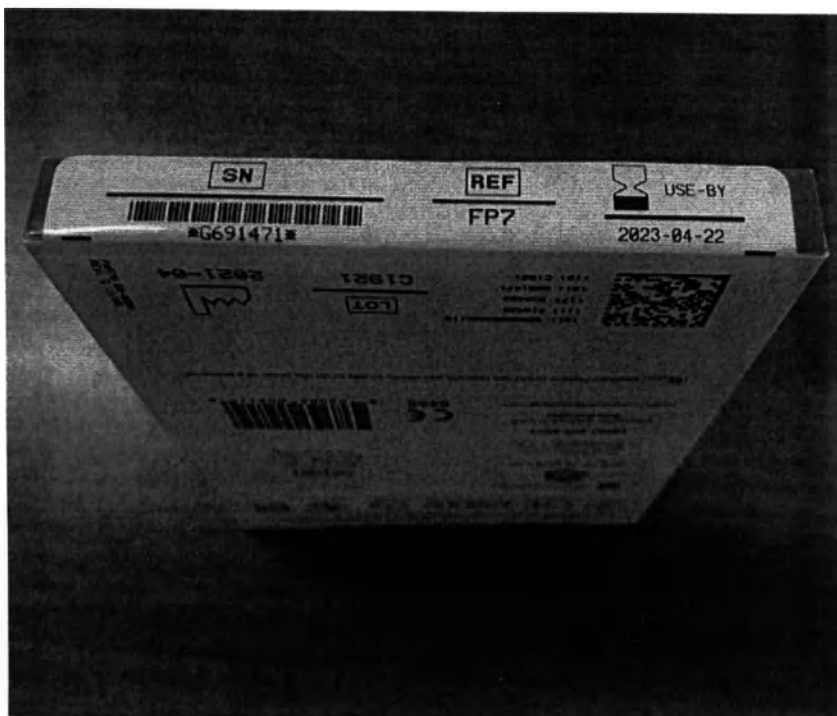


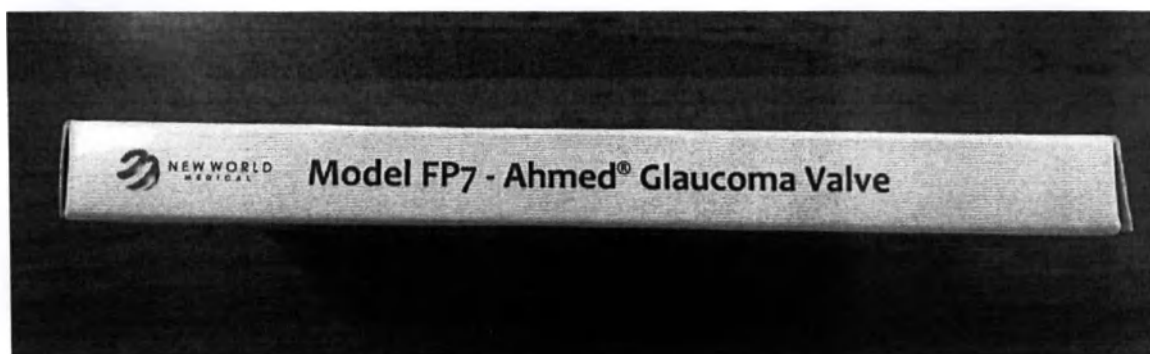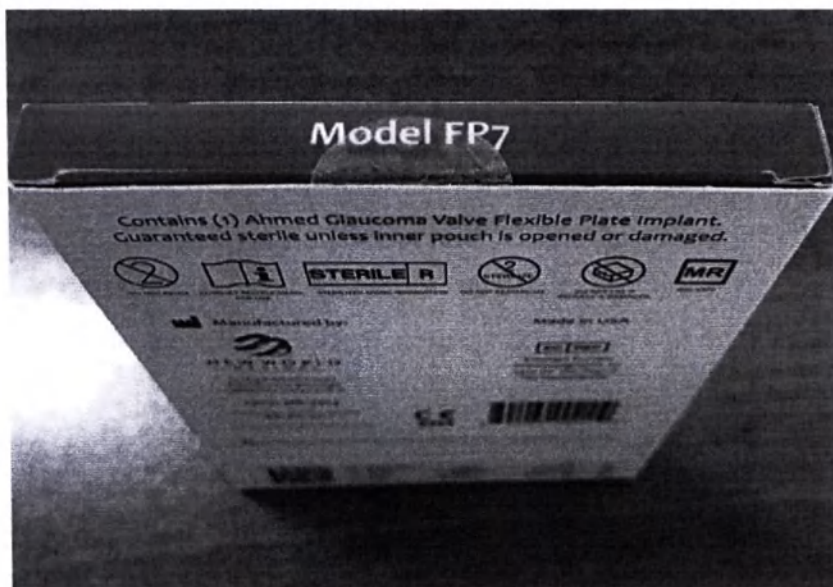

Блистерная упаковка на Клапан Глаукоматозный Ахмед, модель FP8



Потребительская упаковка (коробка) на Клапан Глаукоматозный Ахмед, модель FP8

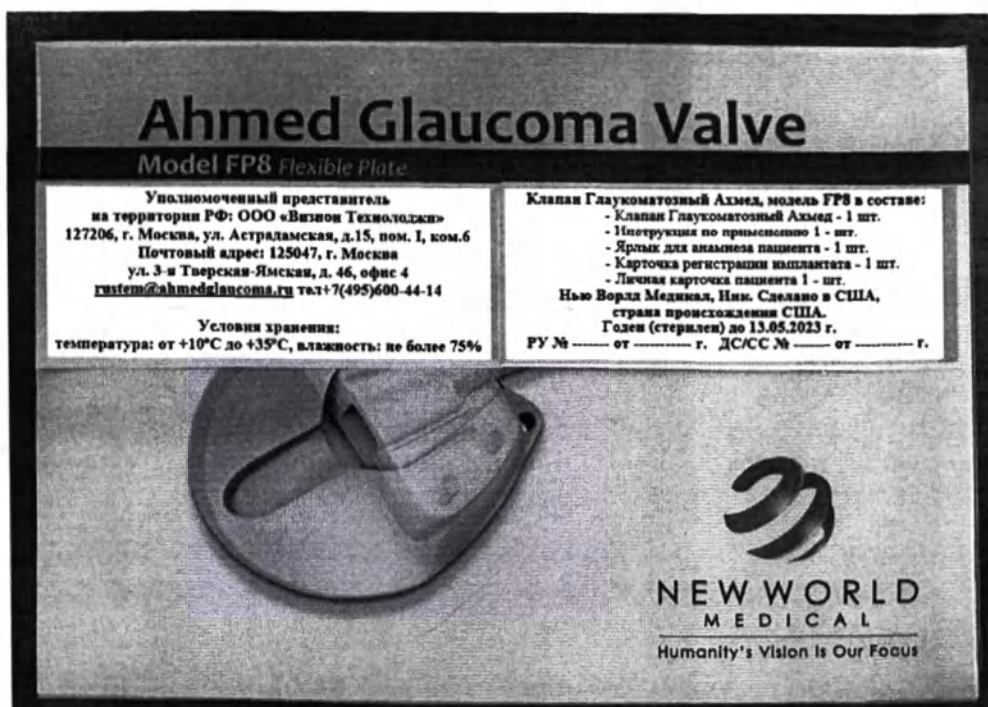


Contains (1) Ahmed Glaucoma Valve Flexible Plate Implant.
Guaranteed sterile unless inner pouch is opened or damaged.



DO NOT REUSE



CONSULT INSTRUCTIONS
FOR USE



STERILIZED USING IRRADIATION



DO NOT RESTERILIZE



DO NOT USE IF
PACKAGE IS DAMAGED



MR SAFE



Manufactured by:

Made in USA



NEW WORLD
MEDICAL

10763 Edison Court
Rancho Cucamonga
California 91730 U.S.A.

(909) 466-4304

Customer Service in USA
800.832.5327

www.newworldmedical.com

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

CE
0459



Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale or on the order of a physician.



(01) 00000000000000000000
(11) 210513
(17) 230513
(21) 0700303
(10) H1001



LOT

H1021



2021-05

LOT: 210513
DATE: 2021-05

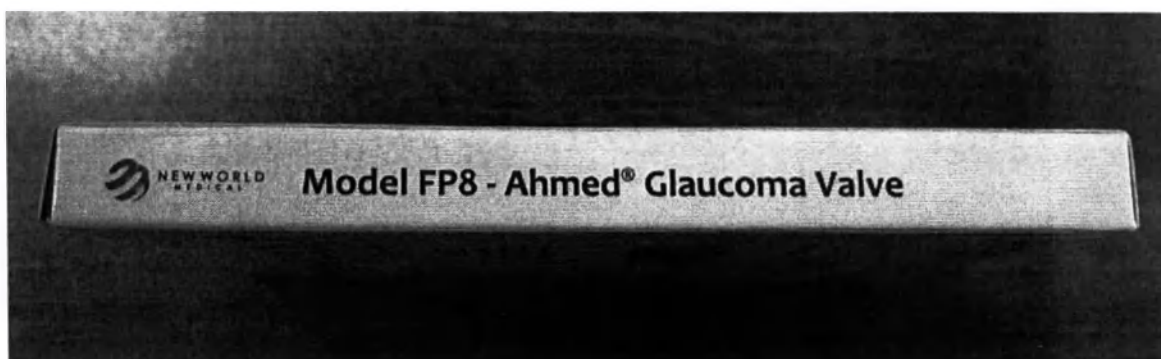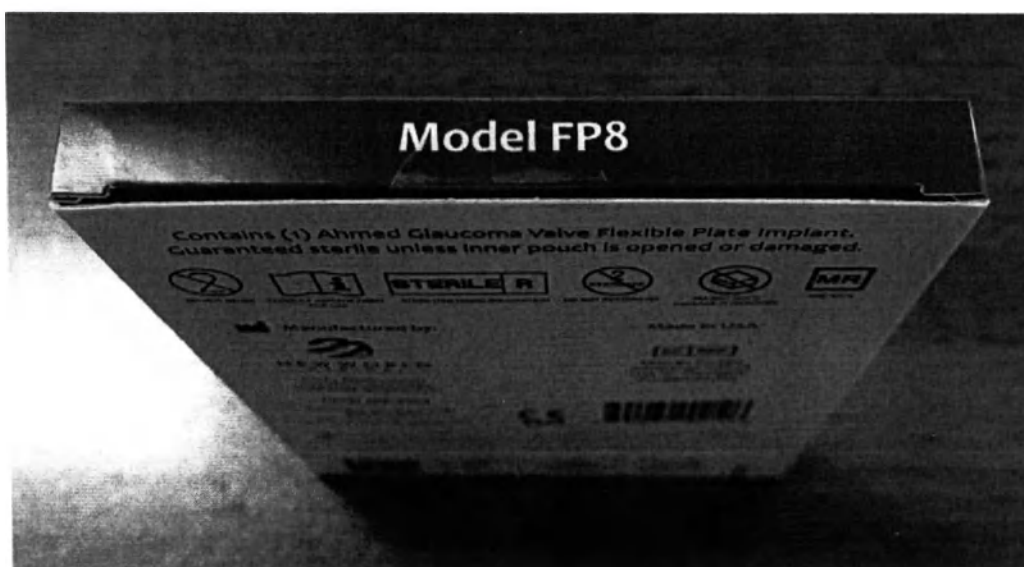

✓ Профессор
1-1 место
Медведев
Григорьев
Васильев



Макет маркировки медицинского изделия

Образец русскоязычной маркировки (наклейки)

Клапан Глаукоматозный Ахмед, модель FP7 в составе:

- Клапан Глаукоматозный Ахмед - 1 шт.
- Инструкция по применению 1 - шт.
- Ярлык для анамнеза пациента - 1 шт.
- Карточка регистрации имплантата - 1 шт.
- Личная карточка пациента 1 - шт.

**Нью Ворлд Медикал, Инк. Сделано в США,
страна происхождения США.**

Годеи (стерилиеи) до 22.04.2023 г.

РУ № ----- от ----- г.

ДС/СС № ----- от ----- г.

Условиа хранения:

температура: от +10°C до +35°C, влажность: не более 75%

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Визион Технолоджи»


127206, г. Москва, ул. Астрадамская, д. 15, помещение I, комната № 6

Почтовый адрес: 125047, г. Москва

ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 46, офис 4

rustem@ahmedglaucoma.ru тел+7(495)600-44-14

Макет потребительской упаковки

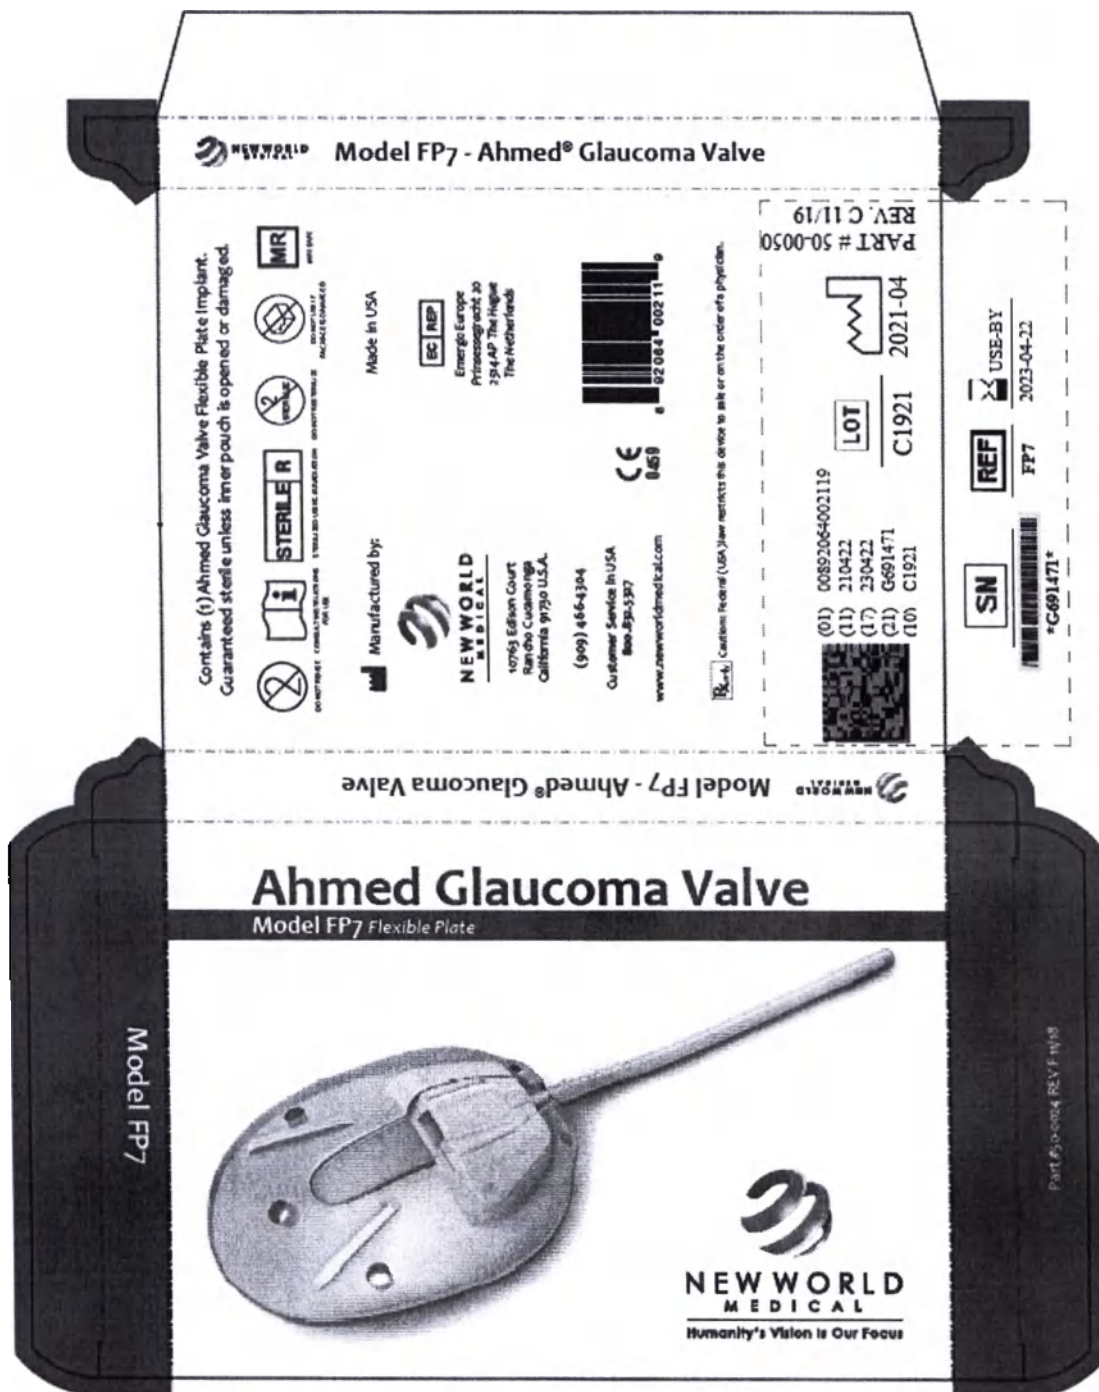

Макет личной карточки пациента (лицевая сторона)

AHMED™ GLAUCOMA VALVE
PATIENT IDENTIFICATION CARD

NAME: _____

DATE OF IMPLANTATION: _____

EYE: ☐ RIGHT ☐ LEFT

IN CASE OF EMERGENCY CONTACT DOCTOR
ON REVERSE SIDE

Перевод:

Клапан Глаукоматозный Ахмед
Идентификационная карта пациента
Имя: _____

Дата имплантации: _____

Глаз ☐ правый ☐ левый

В случае экстренной необходимости
обратитесь к врачу или воспользуйтесь
информацией
на обратной стороне

Макет личной карточки пациента (оборотная сторона)

DOCTOR: _____

TELEPHONE: _____

Part #50-0013 REV A 05/15

MR MRI SAFE

SN G691471

REF FP7

LOT C1921

USE-BY
2023-04-22

Перевод:

Доктор: _____

Телефон: _____

Символ «Серийный номер»

Символ «Номер по каталогу»

Символ «Код партии»

Символ «Использовать до»

Символ «Безопасно при проведении МРТ»

Макет карточки регистрации имплантата

NO POSTAGE
NECESSARY
IF MAILED
IN THE
UNITED STATES

BUSINESS REPLY MAIL
FIRST-CLASS MAIL PERMIT NO. 9198 RANCHO CUCAMONGA CA

New World Medical Inc
10763 EDISON COURT
RANCHO CUCAMONGA, CA 91730-9754

REMOVE TAPE, SEAL & MAIL - DO NOT STAPLE

REMOVE TAPE, SEAL & MAIL - DO NOT STAPLE

IMPLANT SURGEON:
Please complete and mail this form immediately upon use of implant.

DOCTOR: _____

HOSPITAL/CLINIC NAME: _____

CITY, STATE: _____

DR. TELEPHONE #: _____

DATE OF SURGERY: _____

DISPOSITION ☐ IMPLANTED
OF IMPLANT ☐ RETURNED
☐ DESTROYED

SN 6691471
REF FP7
LOT C1921

USE BY
2023-04-22

Part # 90-0014 Rev C 06/19

Перевод:

ПОЧТОВЫЕ РАСХОДЫ НЕ ТРЕБУЮТСЯ, ЕСЛИ ОТПРАВЛЕНО ПО ПОЧТЕ В
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ
ОТВЕТНОЕ БИЗНЕС ПИСЬМО
РАЗРЕШЕНИЕ №9198 ПИСЬМА ПЕРВОГО КЛАССА РАНЧО КУКАМОНГА, КА
Нью Ворлд Медикал, Инк.
10763 Эдисон Корт, Ранчо Кукамонга, КА, 91730-9754

**ОТОРВИТЕ ЛЕНТУ, ЗАПЕЧАТАЙТЕ И ОТПРАВЬТЕ - НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СТЕПЛЕР**

удалите, чтобы раскрыть клей

**ОТОРВИТЕ ЛЕНТУ, ЗАПЕЧАТАЙТЕ И ОТПРАВЬТЕ - НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СТЕПЛЕР**

ОПЕРАЦИЯ ИМПЛАНТАЦИИ

Пожалуйста, заполните и отправьте эту форму немедленно после имплантации

Доктор _____

Наименование госпиталя/клиники _____

Город, штат _____

Телефон доктора, № _____


Дата операции _____

ПОЗИЦИЯ ИМПЛАНТАТА ☐ ИМПЛАНТИРОВАН

☐ ВОЗВРАЩЕН

☐ ПОВРЕЖДЕН

Макет ярлыка для анамнеза пациента

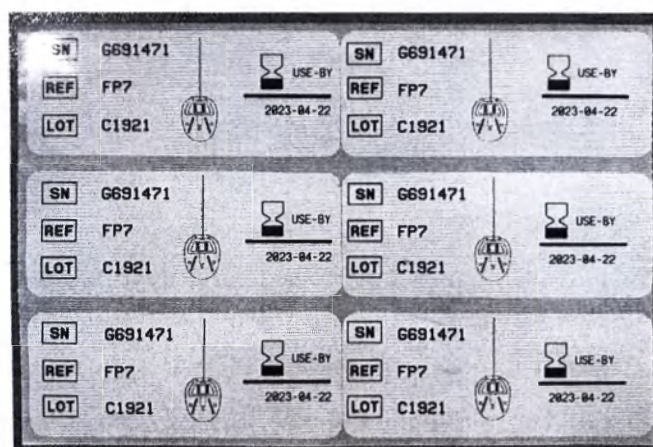

Перевод:

Символ «Серийный номер»

Символ «Номер по каталогу»

Символ «Код партии»

Символ «Использовать до»

