

СОГЛАСОВАНО

Директор

ООО «Прототип»

Кшнякин П.А.

«06» ноября 2021 г.




УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Новые Технологии»

Бурыкин А.В.

«06» ноября 2021 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система двигательной реабилитации мультисенсорная «Ревимоушен»

(ReviMotion)

Вариант исполнения ReviMotion Clinic

по ТУ ТВГД.32.50.50.190-002-2021

САМАРА

2021

Фотография 1. Внешний вид «Ревимоушен» варианта исполнения «ReviMotion Clinic» (при комплектации веб-камерой)



Фотография 2. Внешний вид «Ревимоушен». Вариант исполнения «ReviMotion Clinic» (при комплектации Kinect Sensor)



Фотография 3. Внешний вид «Ревимоушен». Вариант исполнения «ReviMotion Clinic» при комплектации веб-камерой. Вид сбоку




Фотография 4. Внешний вид «Ревимоушен». Вариант исполнения «ReviMotion Clinic» (при комплектации Kinect Sensor). Вид сзади




Фотография 5. Внешний вид «Ревимоушен». Кабель питания



Фотография 6. Внешний вид «Ревимоушен». Кабели.

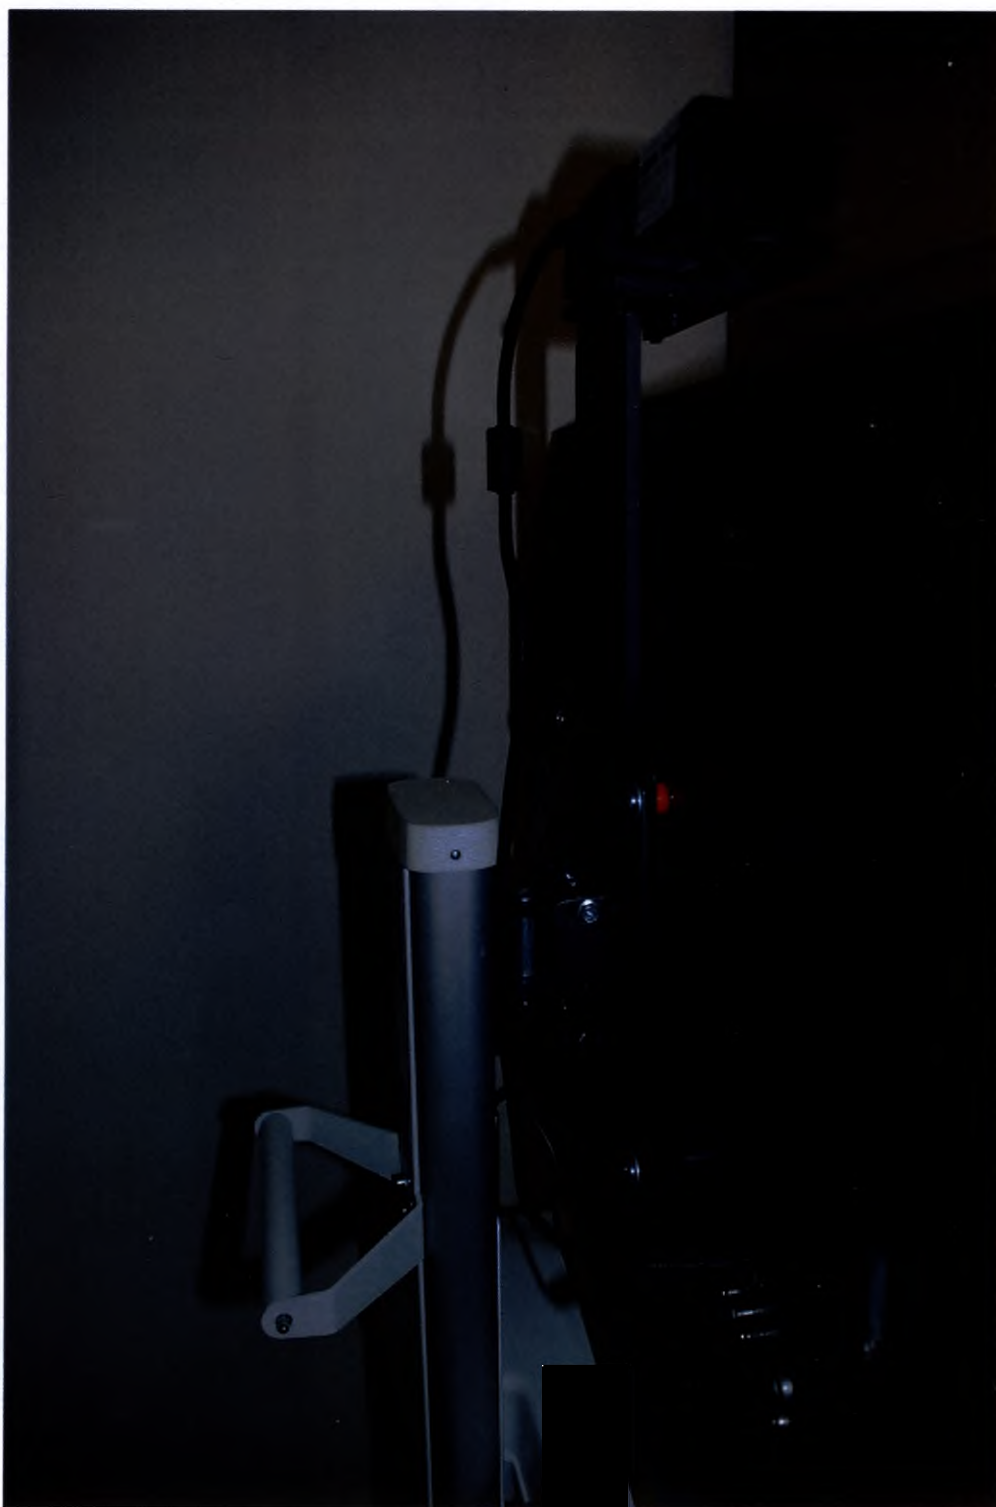

Фотография 7.

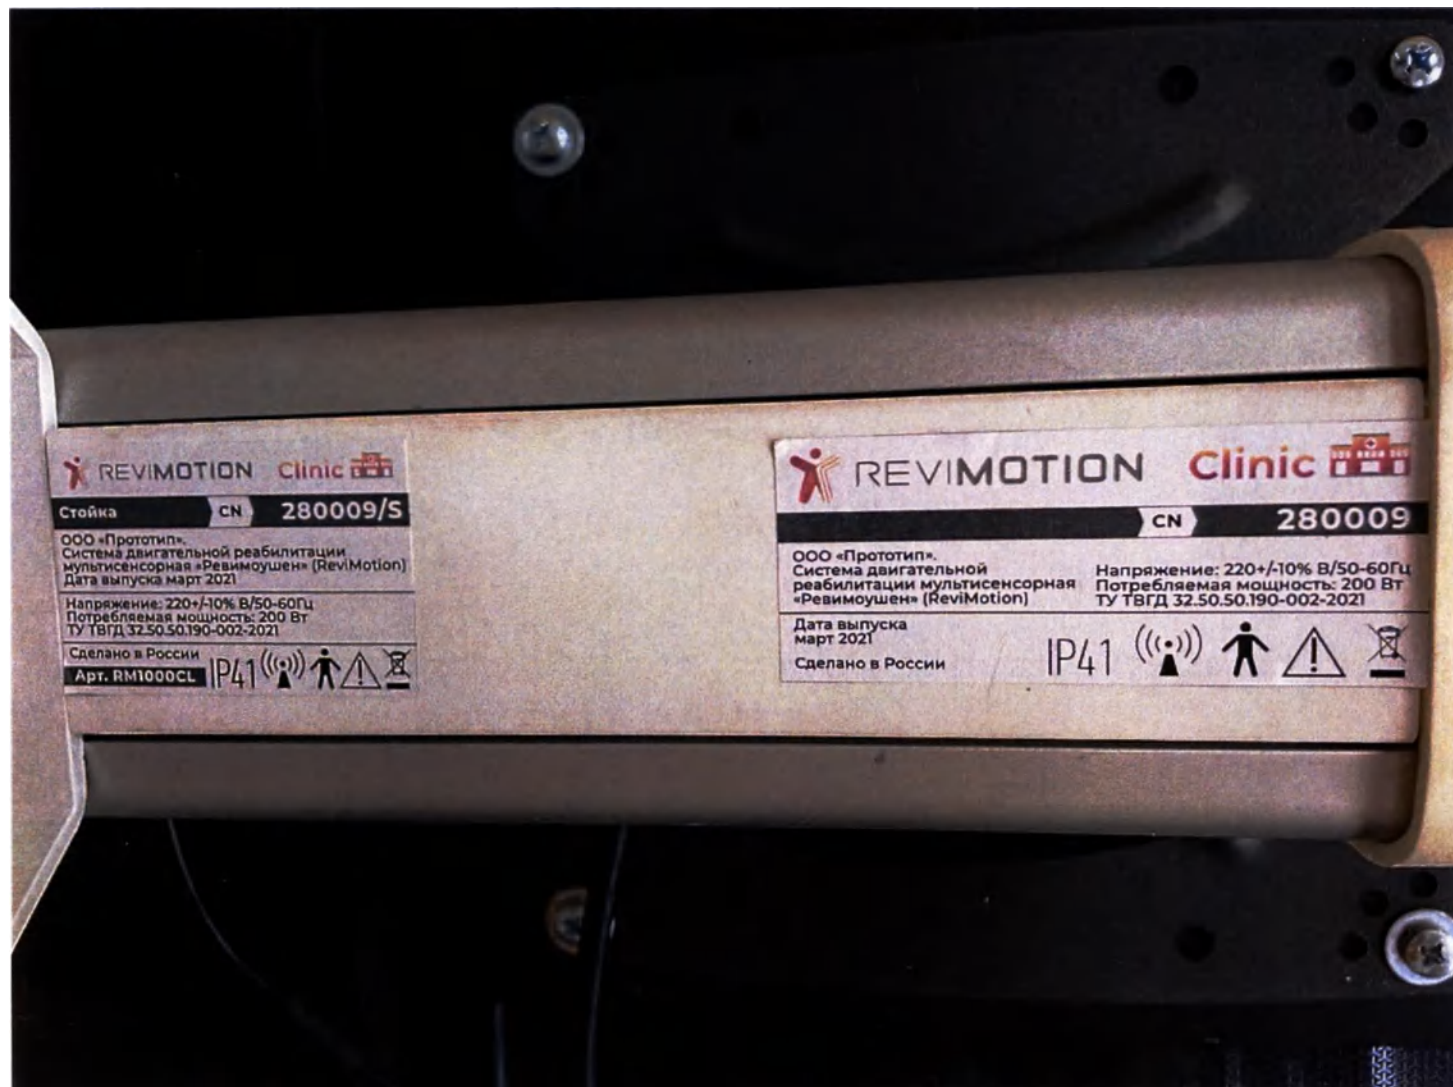

Стойка



Фотография 8.



Фотография 9.

Веб-камера



Фотография 10.




Фотография 11.



Фотография 12.




Фотография 13.

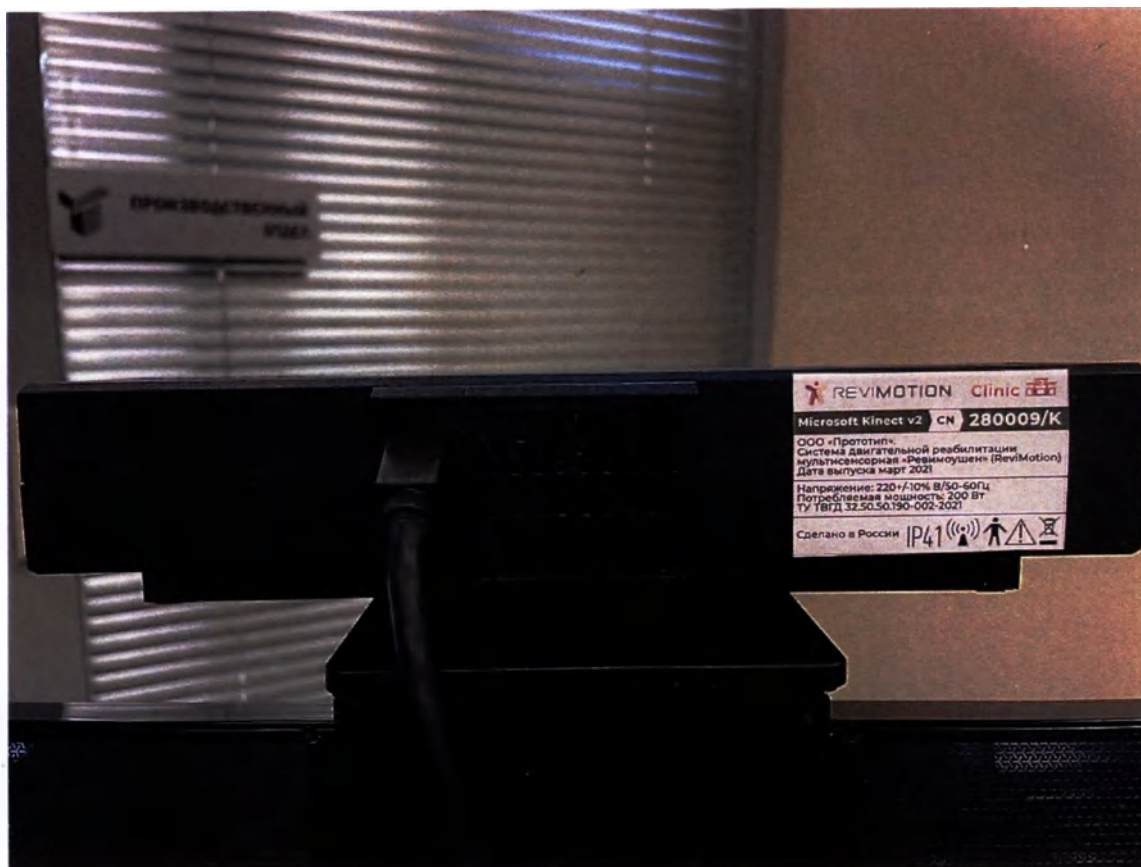

Фотография 14.



Фотография 15.

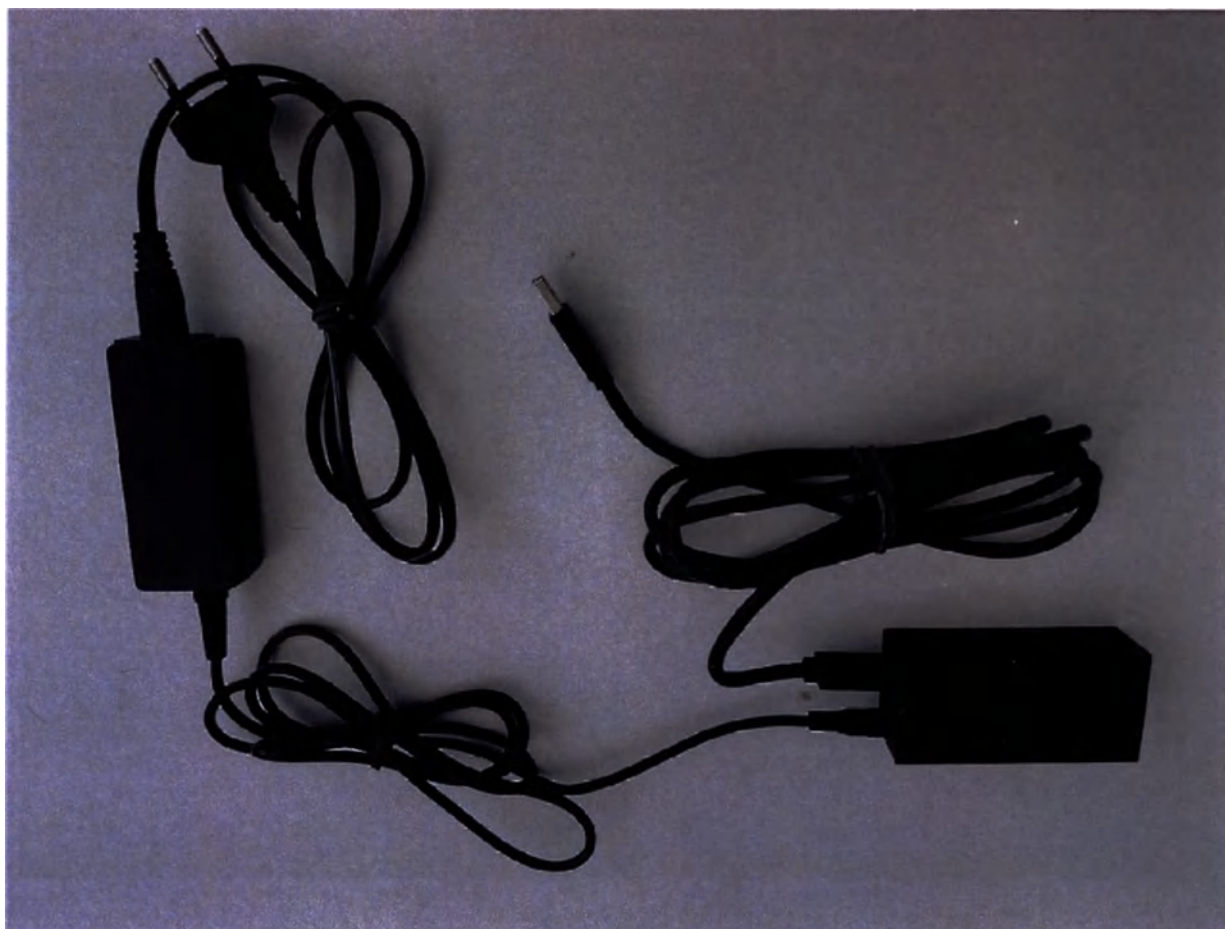


Фотография 16.


Телевизор



Фотография 17.

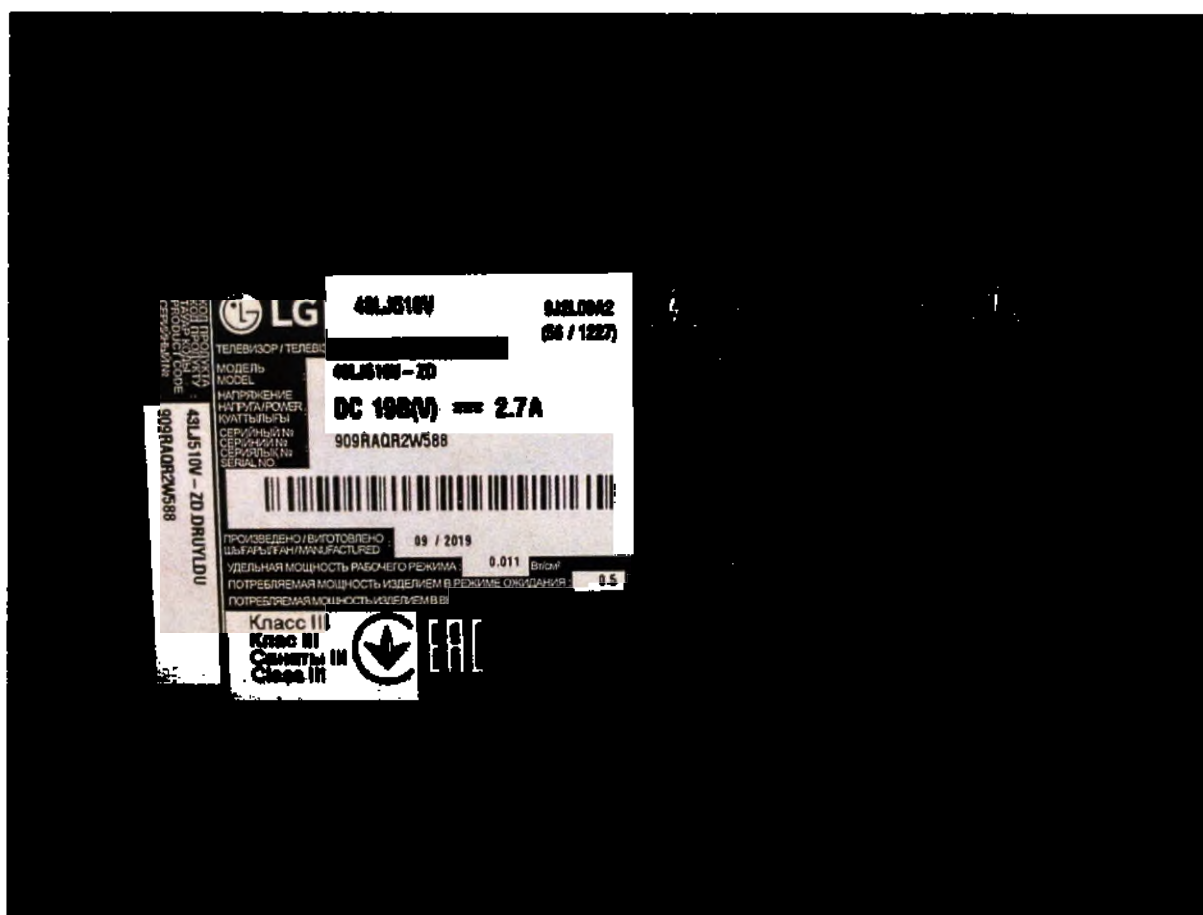

Фотография 18.



Клавиатура



Фотография 20.




Фотография 21.

Мышь



Фотография 22.

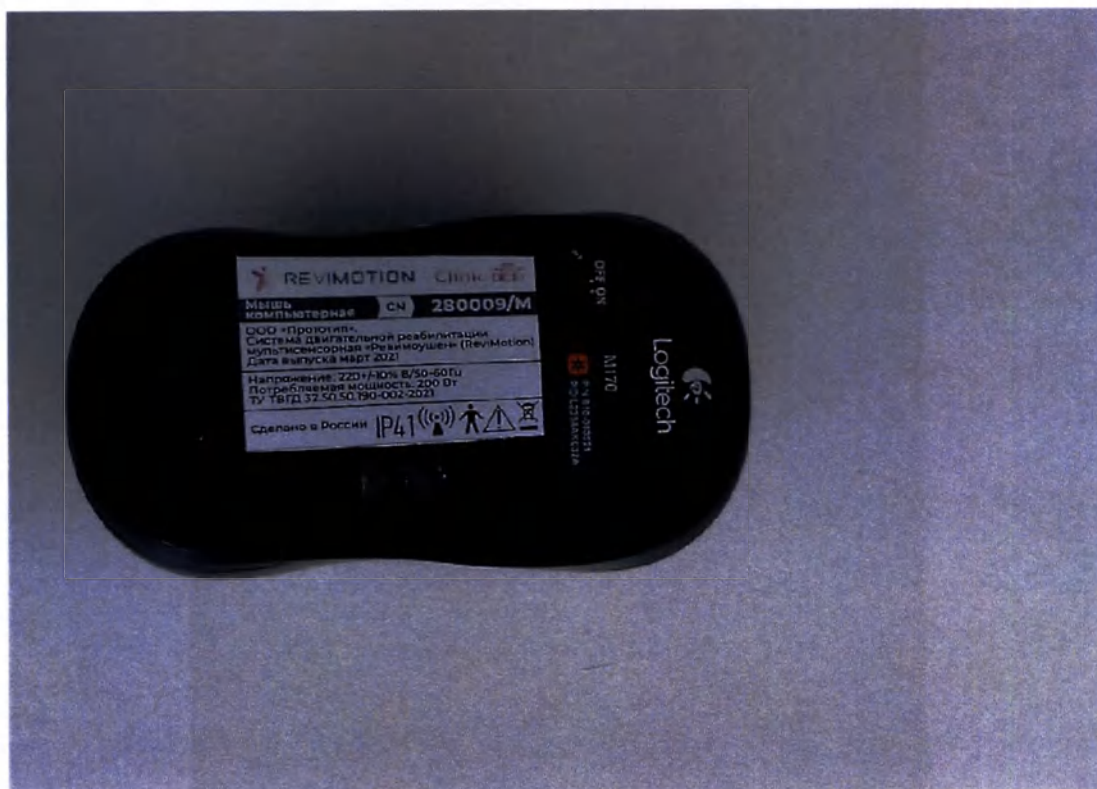

Фотография 23.

Рисунок 14. Упаковка при транспортировке



Рисунок 1 – Образец маркировки стойки для комплектации Clinic

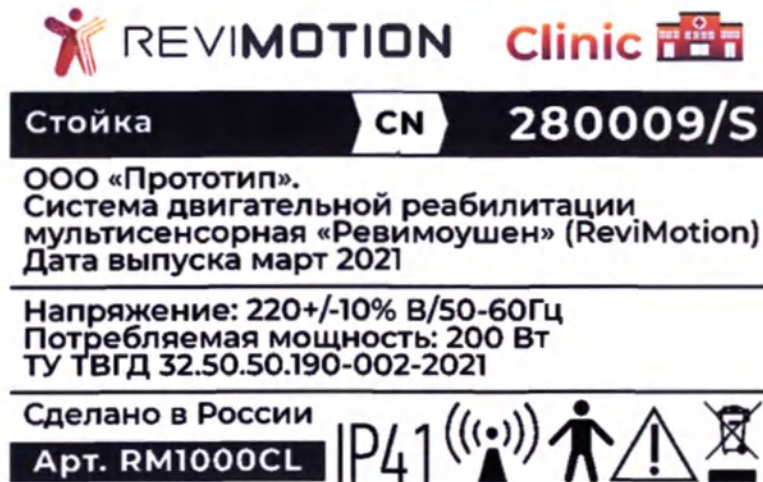


Рисунок 2 – Образец маркировки телевизора для комплектации Clinic

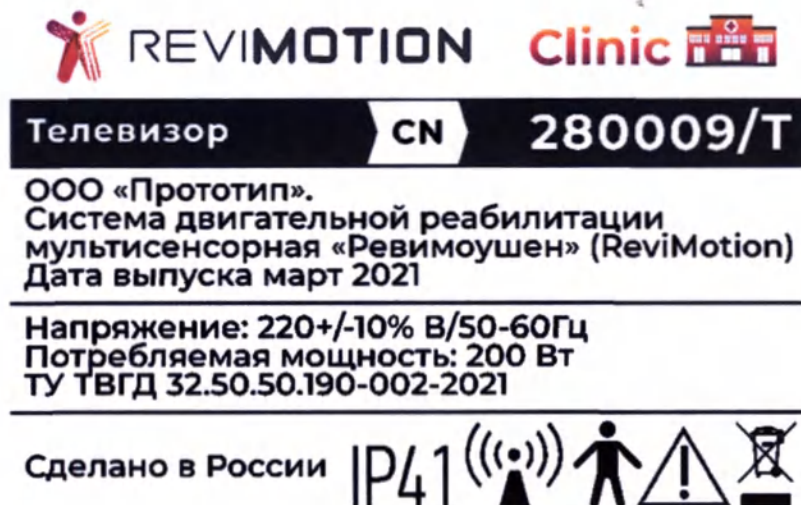


Рисунок 3 -Образец маркировки мыши компьютерной для комплектации Clinic

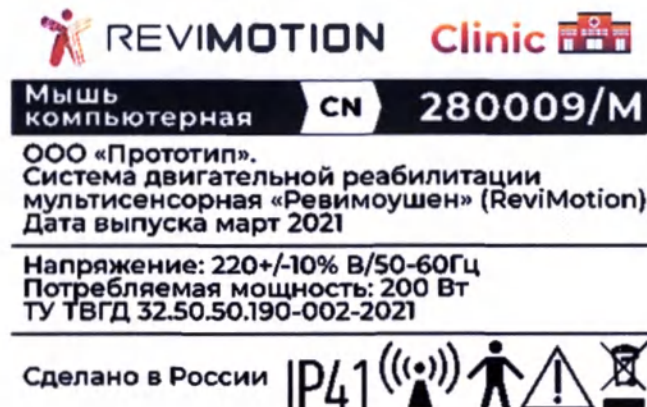


Рисунок 4 – Образец маркировки клавиатуры компьютерной для комплектации Clinic

Клавиатура компьютерная **CN** **280009/C**

ООО «Прототип».
Система двигательной реабилитации
мультисенсорная «Ревимоушен» (ReviMotion)
Дата выпуска март 2021

Напряжение: 220+/-10% В/50-60Гц
Потребляемая мощность: 200 Вт
ТУ ТВГД 32.50.50.190-002-2021

Сделано в России IP41    

Рисунок 5 – Образец маркировки Microsoft Kinect v2 для комплектации Clinic

Microsoft Kinect v2 **CN** **280009/K**

ООО «Прототип».
Система двигательной реабилитации
мультисенсорная «Ревимоушен» (ReviMotion)
Дата выпуска март 2021

Напряжение: 220+/-10% В/50-60Гц
Потребляемая мощность: 200 Вт
ТУ ТВГД 32.50.50.190-002-2021

Сделано в России IP41    

Рисунок 6 – Образец маркировки веб-камеры для комплектации Clinic

Веб-камера **CN** **280009/W**

ООО «Прототип».
Система двигательной реабилитации
мультисенсорная «Ревимоушен» (ReviMotion)
Дата выпуска март 2021

Напряжение: 220+/-10% В/50-60Гц
Потребляемая мощность: 200 Вт
ТУ ТВГД 32.50.50.190-002-2021

Сделано в России IP41    



ООО «Прототип».

Система двигательной
реабилитации мультисенсорная
«Ревимоушен» (ReviMotion)

Напряжение: 220+/-10% В/50-60Гц

Потребляемая мощность: 200 Вт
ТУ ТВГД 32.50.50.190-002-2021

Дата выпуска
март 2021

Сделано в России

IP41



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью

Всего 22 листа (ов)



Генеральный директор
ООО «Новые Технологии»
А.В. Бурыкин

СОГЛАСОВАНО

Директор

ООО «Прототип»

Кишнякин П.А.

«06» ноября 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Новые Технологии»

Бурыкин А.В.

«06» ноября 2021 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Система двигательной реабилитации мультисенсорная «Ревимоушен»
(ReviMotion)**

**Вариант исполнения ReviMotion Clinic-1
по ТУ ТВГД.32.50.50.190-002-2021**

САМАРА
2021

Фотография 1. Внешний вид «Ревимоушен» варианта исполнения «ReviMotion Clinic1» (при комплектации веб-камерой)



Фотография 2. Внешний вид «Ревимоушен». Вариант исполнения «ReviMotion Clinic 1» (при комплектации Kinect Sensor)



Камера



Фотография 3




Фотография 4


Кинект Microsoft Kinect V2



Фотография 5

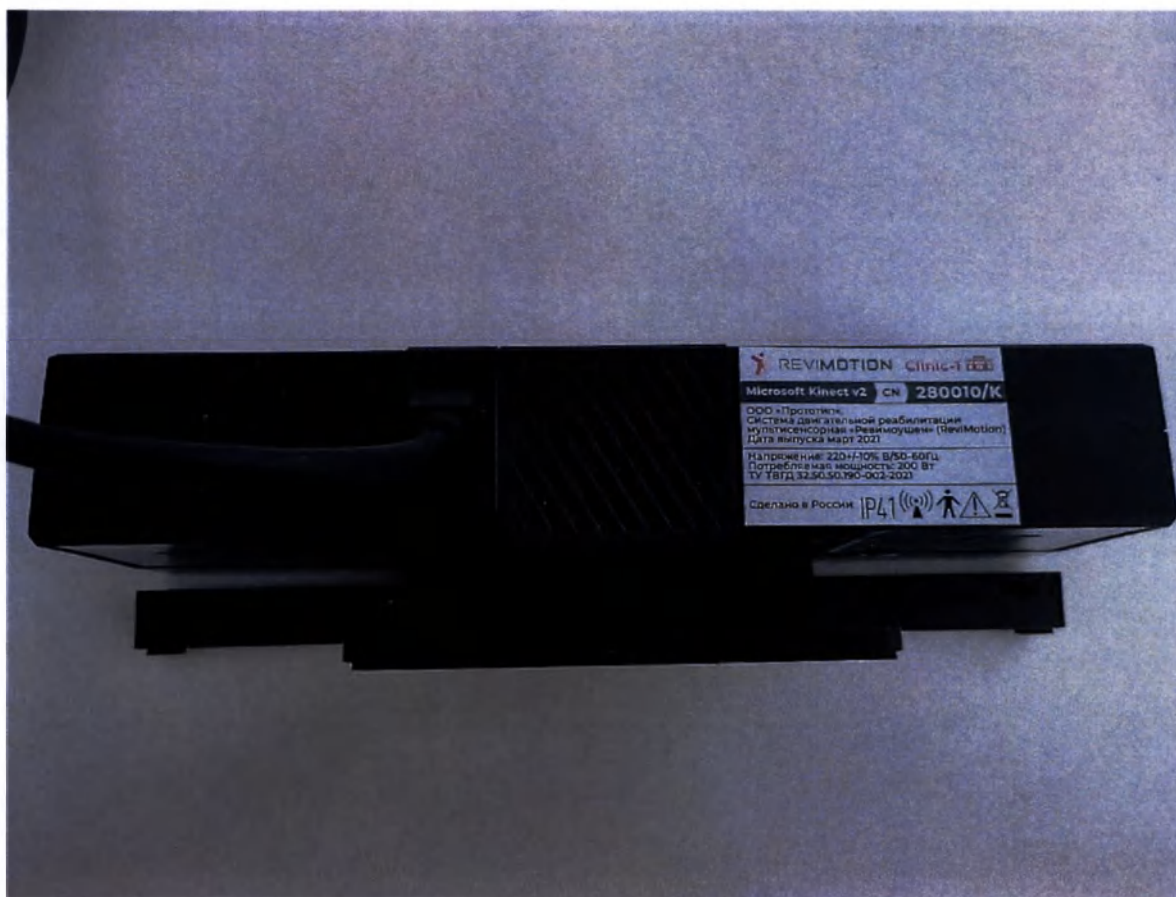

Фотография 6.

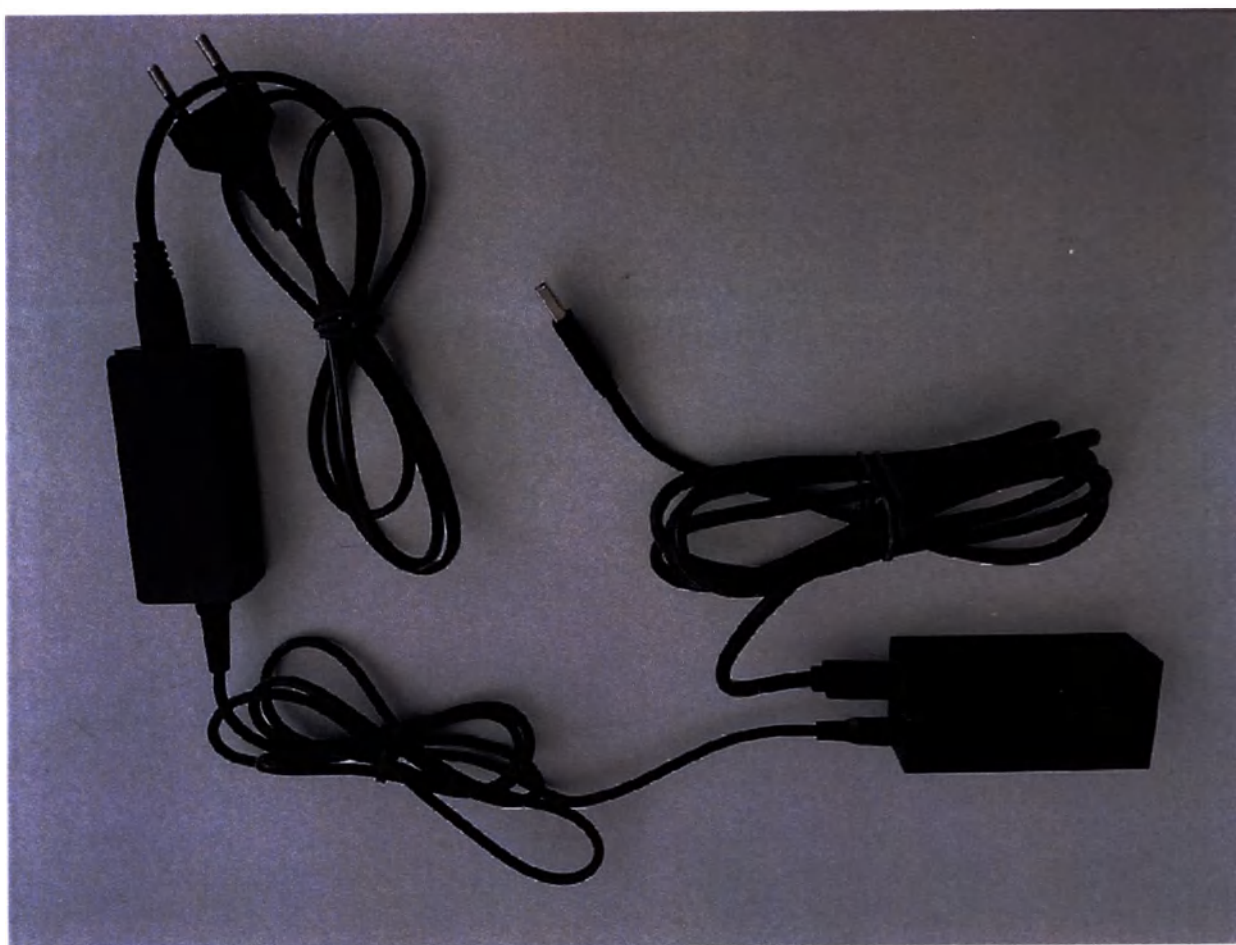

Фотография 7.




Фотография 8.

Мышь




Фотография 9

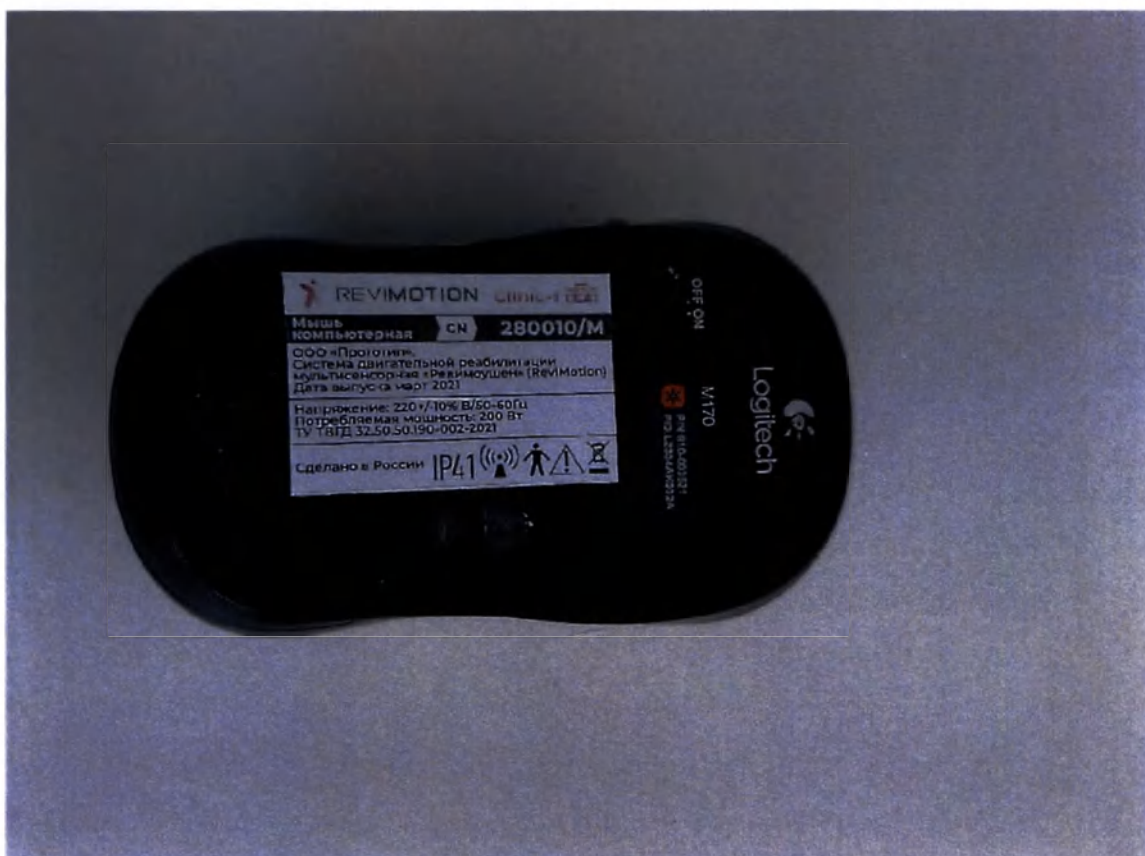

Фотография 10.

Ноутбук

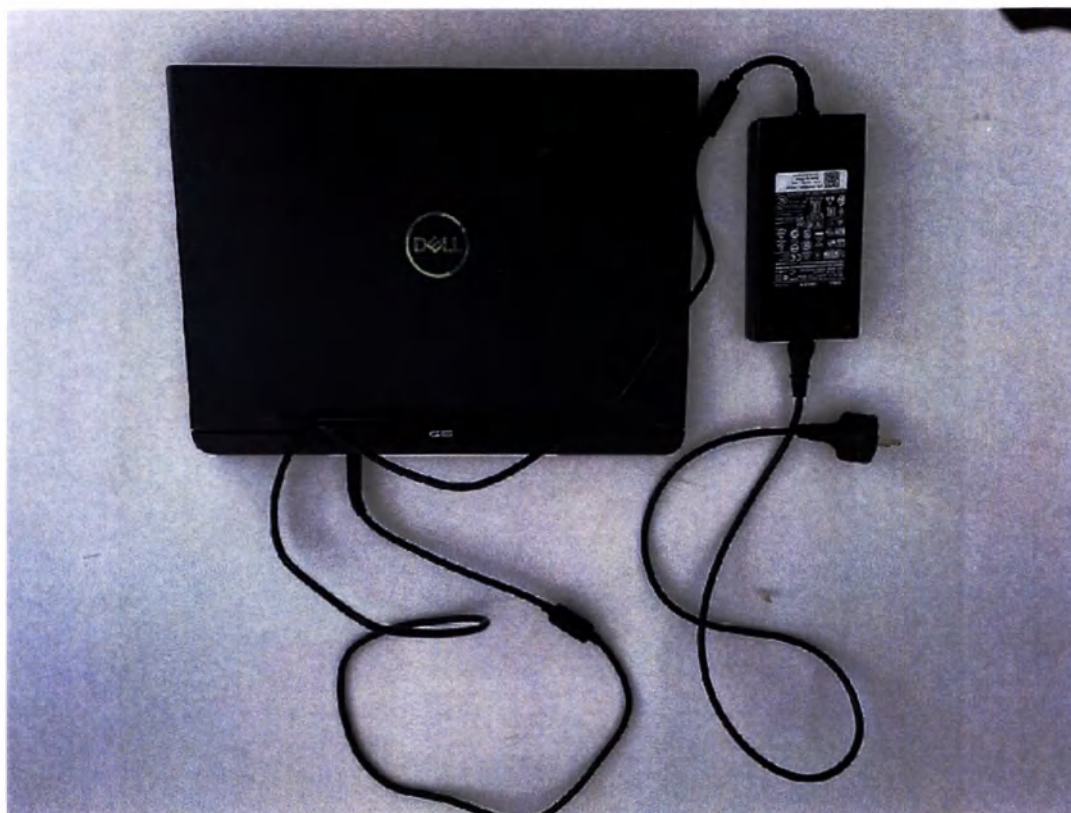

Фотография 11.



Фотография 12.



Фотография 13. Адаптер

Рисунок 1– Образец маркировки ноутбука для комплектации Clinic-1



Рисунок 2 – Образец маркировки мыши компьютерной для комплектации Clinic-1

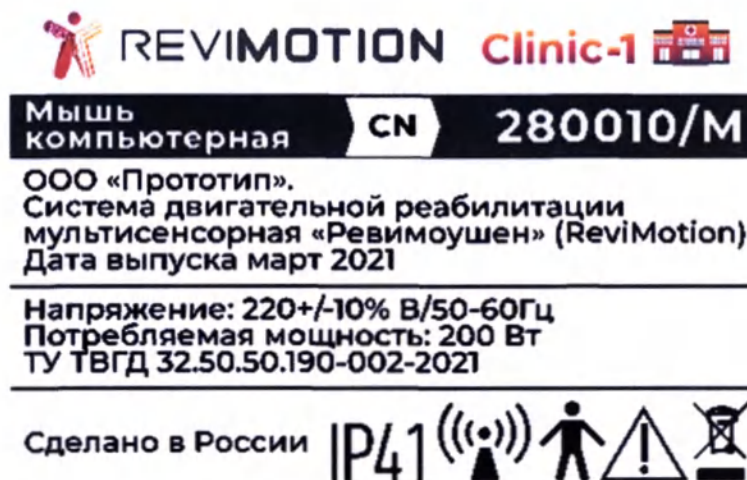


Рисунок 3 – Образец маркировки Microsoft Kinect v2 для комплектации Clinic-1



Рисунок 4 – Образец маркировки веб-камеры для комплектации Clinic-1



Рисунок 5 – Образец маркировки Ревимоушен для комплектации Clinic-1



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью

Всего 10 листа (ов)



Генеральный директор
ООО «Новые Технологии»
А.В. Бурякин

СОГЛАСОВАНО

Директор

ООО «Прототип»

Кшнякин П.А.

«06» ноября 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Новые Технологии»

Бурыкин А.В.

«06» ноября 2021 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система двигательной реабилитации мультисенсорная «Ревимоушен»

(ReviMotion)

Вариант исполнения ReviMotion Personal

по ТУ ТВГД.32.50.50.190-002-2021

САМАРА
2021

Фотография 1. Внешний вид «Ревимоушен» варианта исполнения «ReviMotion Personal» (при комплектации веб-камерой)




Фотография 2. Внешний вид «Ревимоушен». Вариант исполнения «ReviMotion Personal» (при комплектации Kinect Sensor)



Камера



Фотография 3

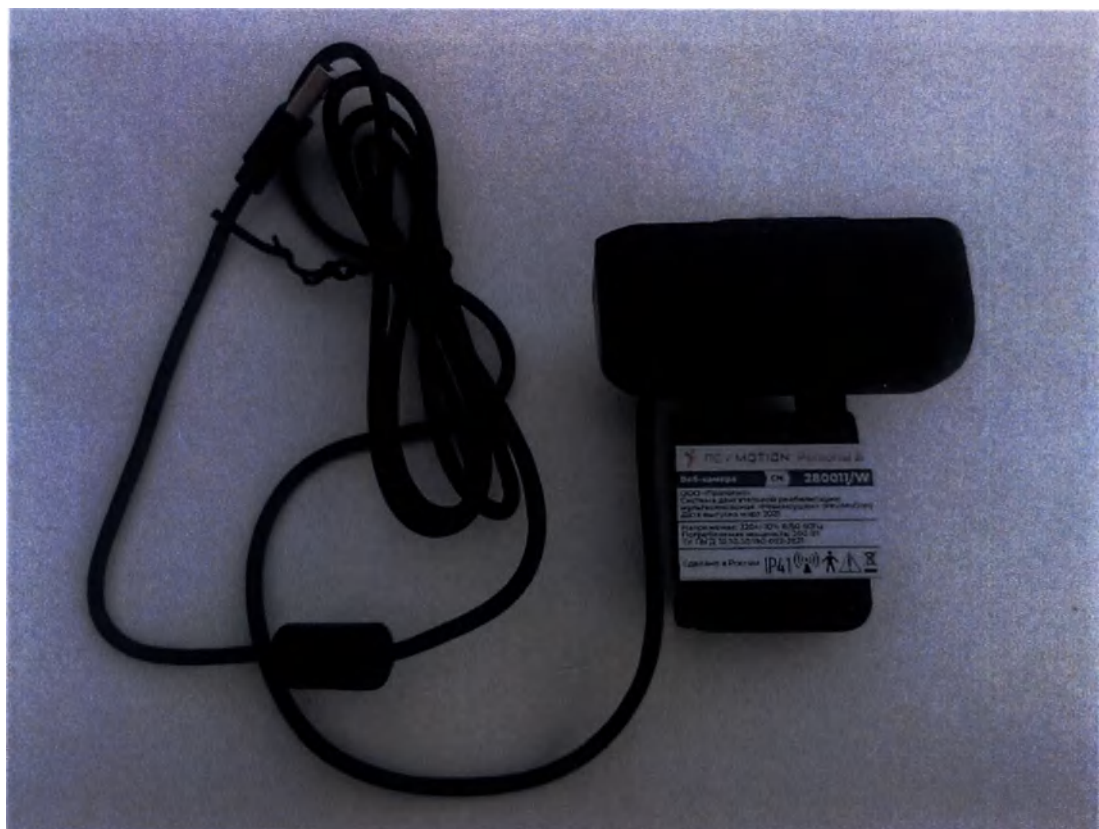


Фотография 4


Кинект Microsoft Kinect V2



Фотография 5.

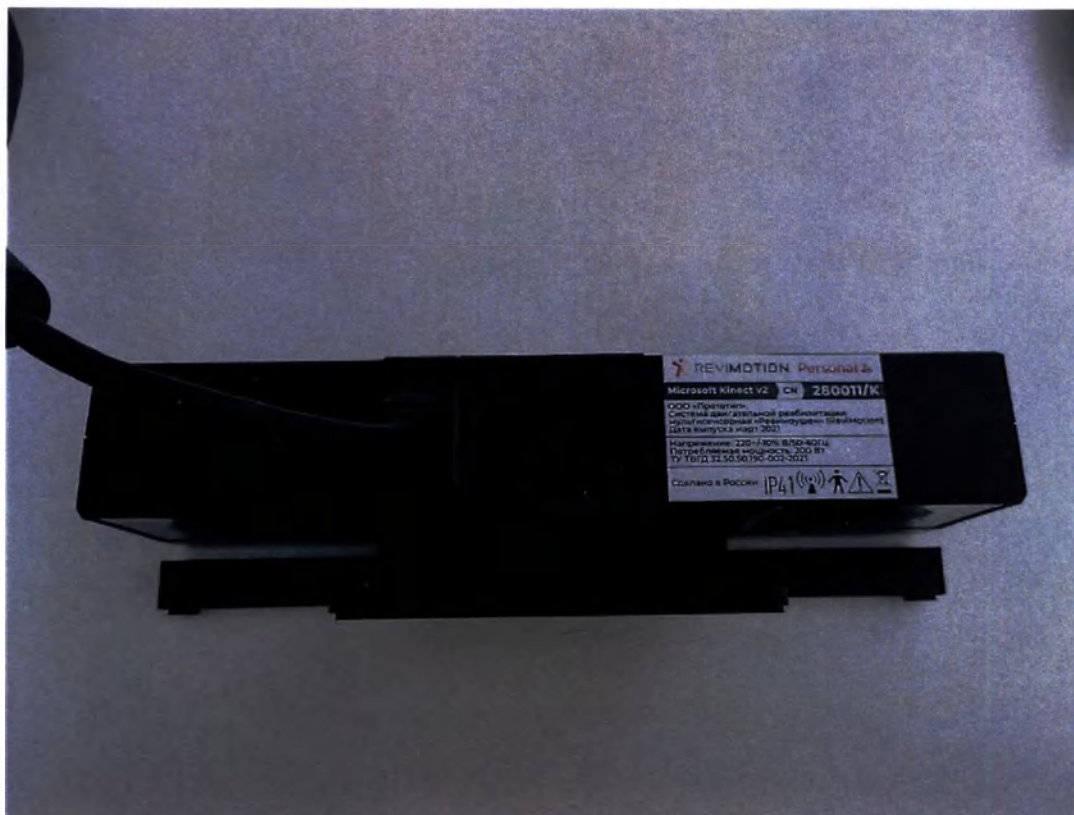

Фотография 6.

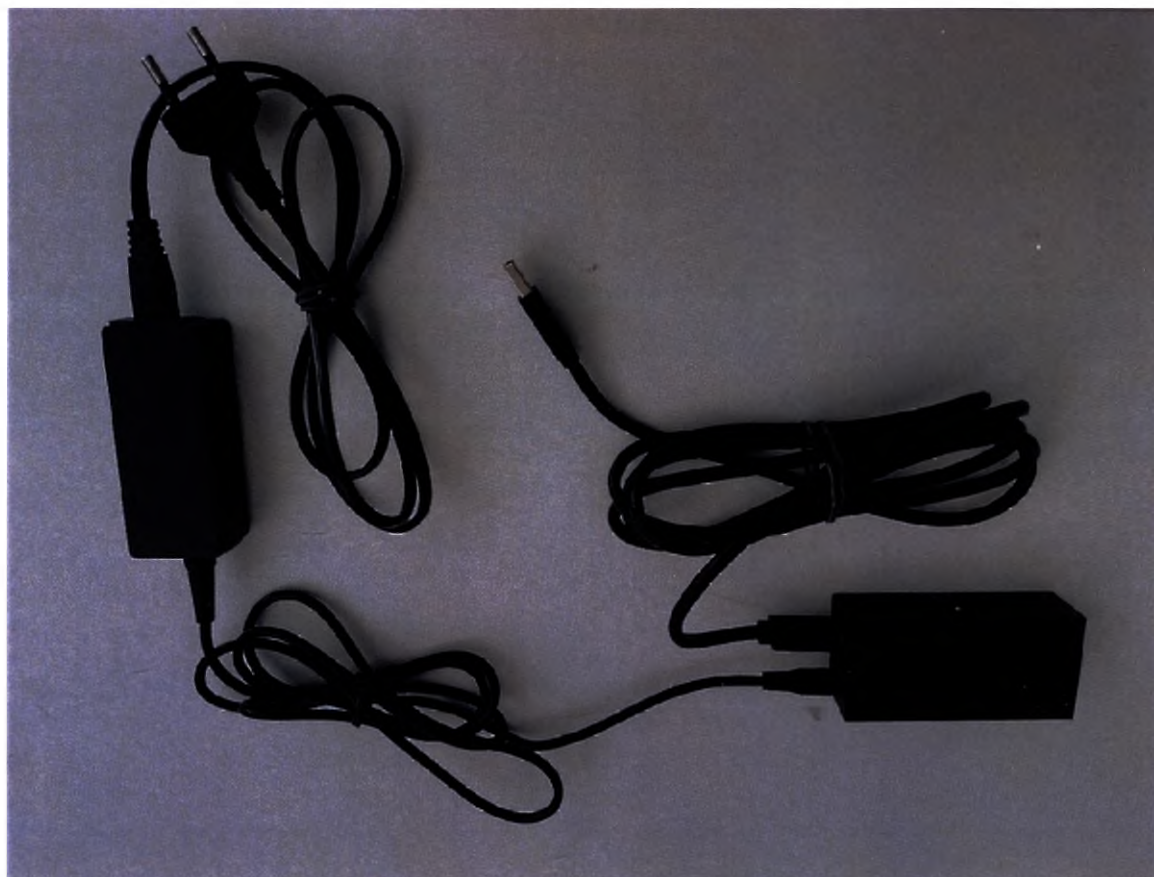

Фотография 7




Фотография 8

Мышь




Фотография 9

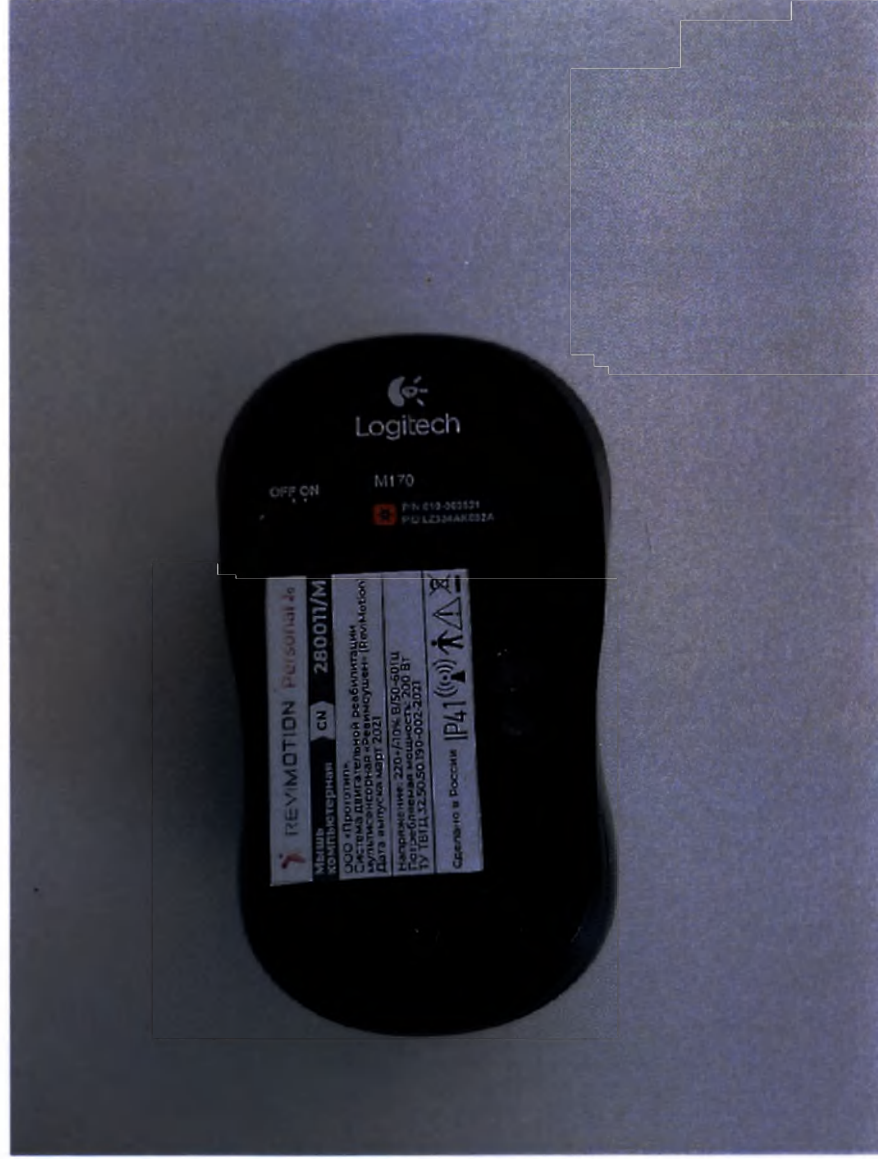


Фотография 10

Ноутбук

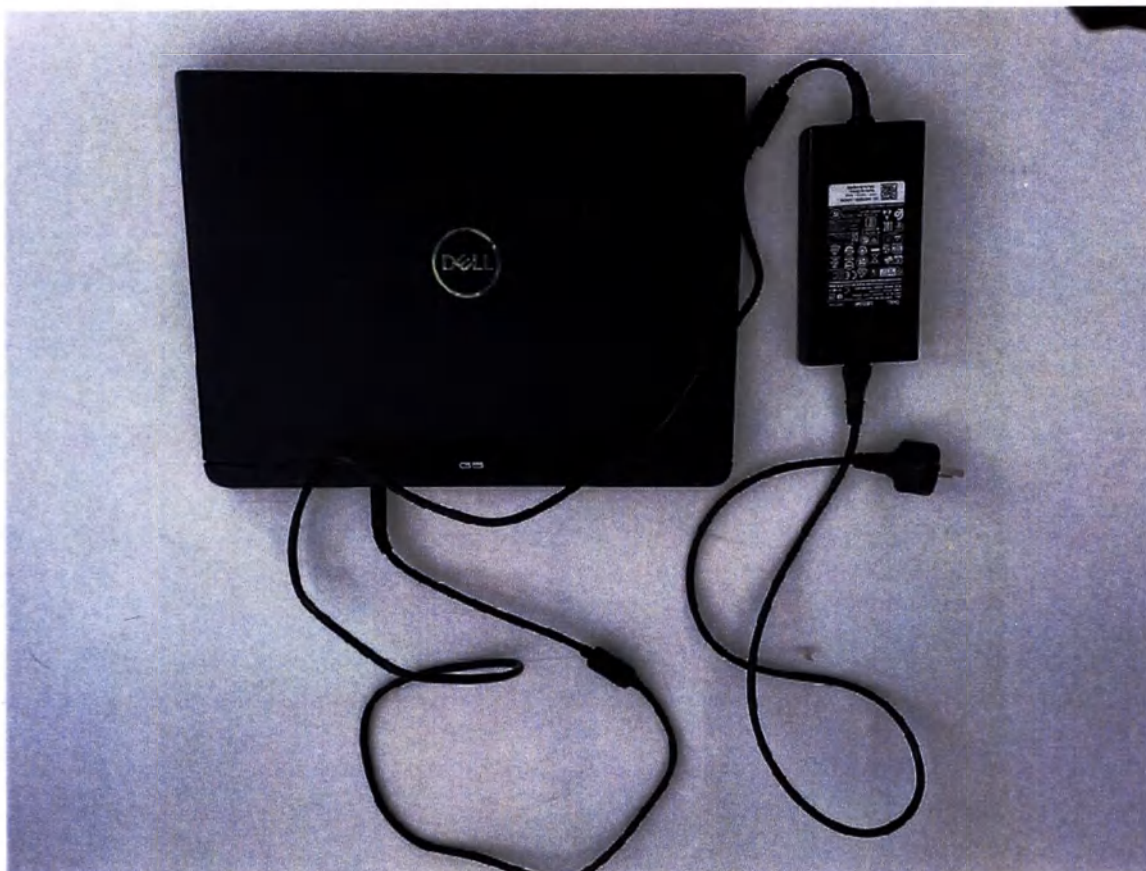

Фотография 11

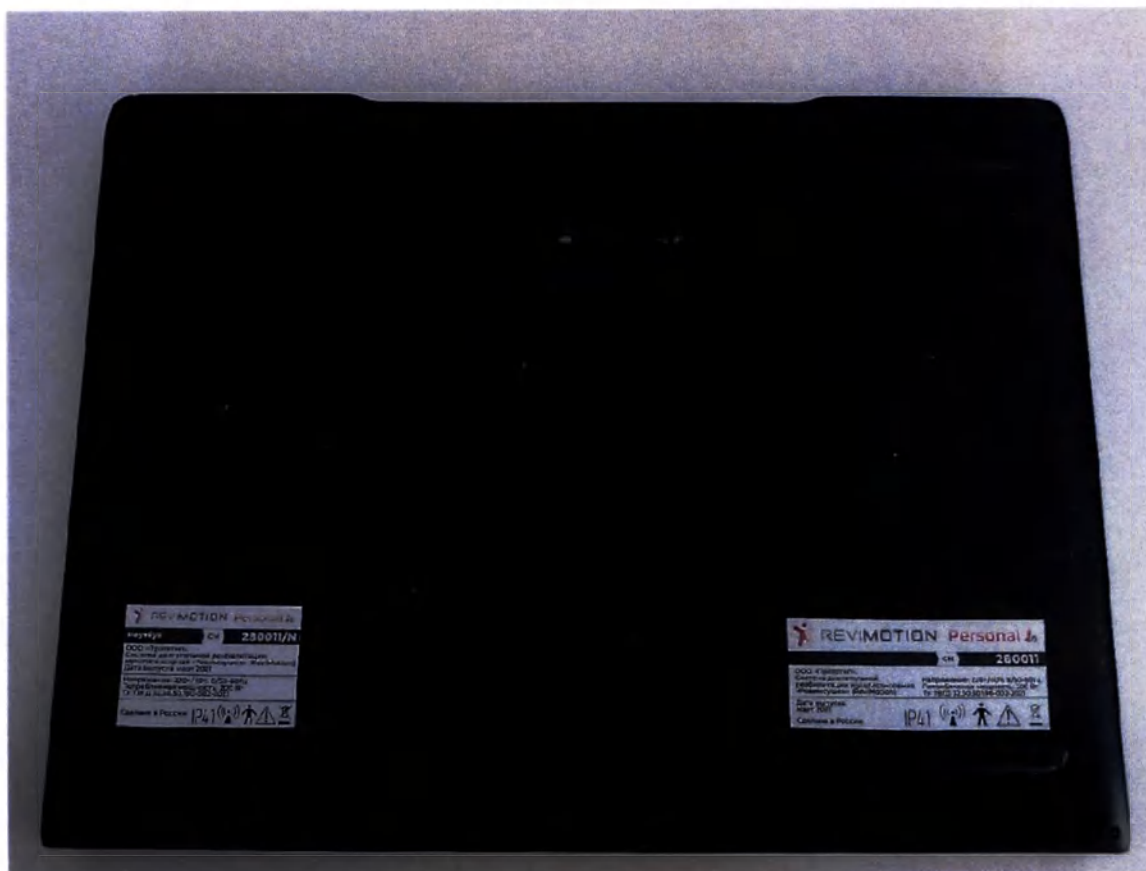

Фотография 12

Маркировка.

Рисунок 1 – Образец маркировки Ревимоушен для комплектации Personal



ООО «Прототип».
Система двигательной
реабилитации мультисенсорная
«Ревимоушен» (ReviMotion)

Напряжение: 220+/-10% В/50-60Гц
Потребляемая мощность: 200 Вт
ТУ ТВГД 32.50.50.190-002-2021

Дата выпуска
март 2021

Сделано в России



Рисунок 2 – Образец маркировки ноутбука для комплектации Personal



Ноутбук

CN

280011/N

ООО «Прототип».
Система двигательной реабилитации
мультисенсорная «Ревимоушен» (ReviMotion)
Дата выпуска март 2021

Напряжение: 220+/-10% В/50-60Гц
Потребляемая мощность: 200 Вт
ТУ ТВГД 32.50.50.190-002-2021

Сделано в России




Рисунок 3 – Образец маркировки мыши компьютерной для комплектации Personal



Microsoft Kinect v2

CN

280011/K

ООО «Прототип».
Система двигательной реабилитации
мультисенсорная «Ревимоушен» (ReviMotion)
Дата выпуска март 2021

Напряжение: 220+/-10% В/50-60Гц
Потребляемая мощность: 200 Вт
ТУ ТВГД 32.50.50.190-002-2021

Сделано в России




Рисунок 4 – Образец маркировки веб-камеры для комплектации Personal



Рисунок 5 – Образец маркировки мыши компьютерной для комплектации Personal



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью

Всего 10 листа (ов)

