

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Результат-Аудит»

Г. В. Родина

«20» января 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Дилататор баллонный урологический

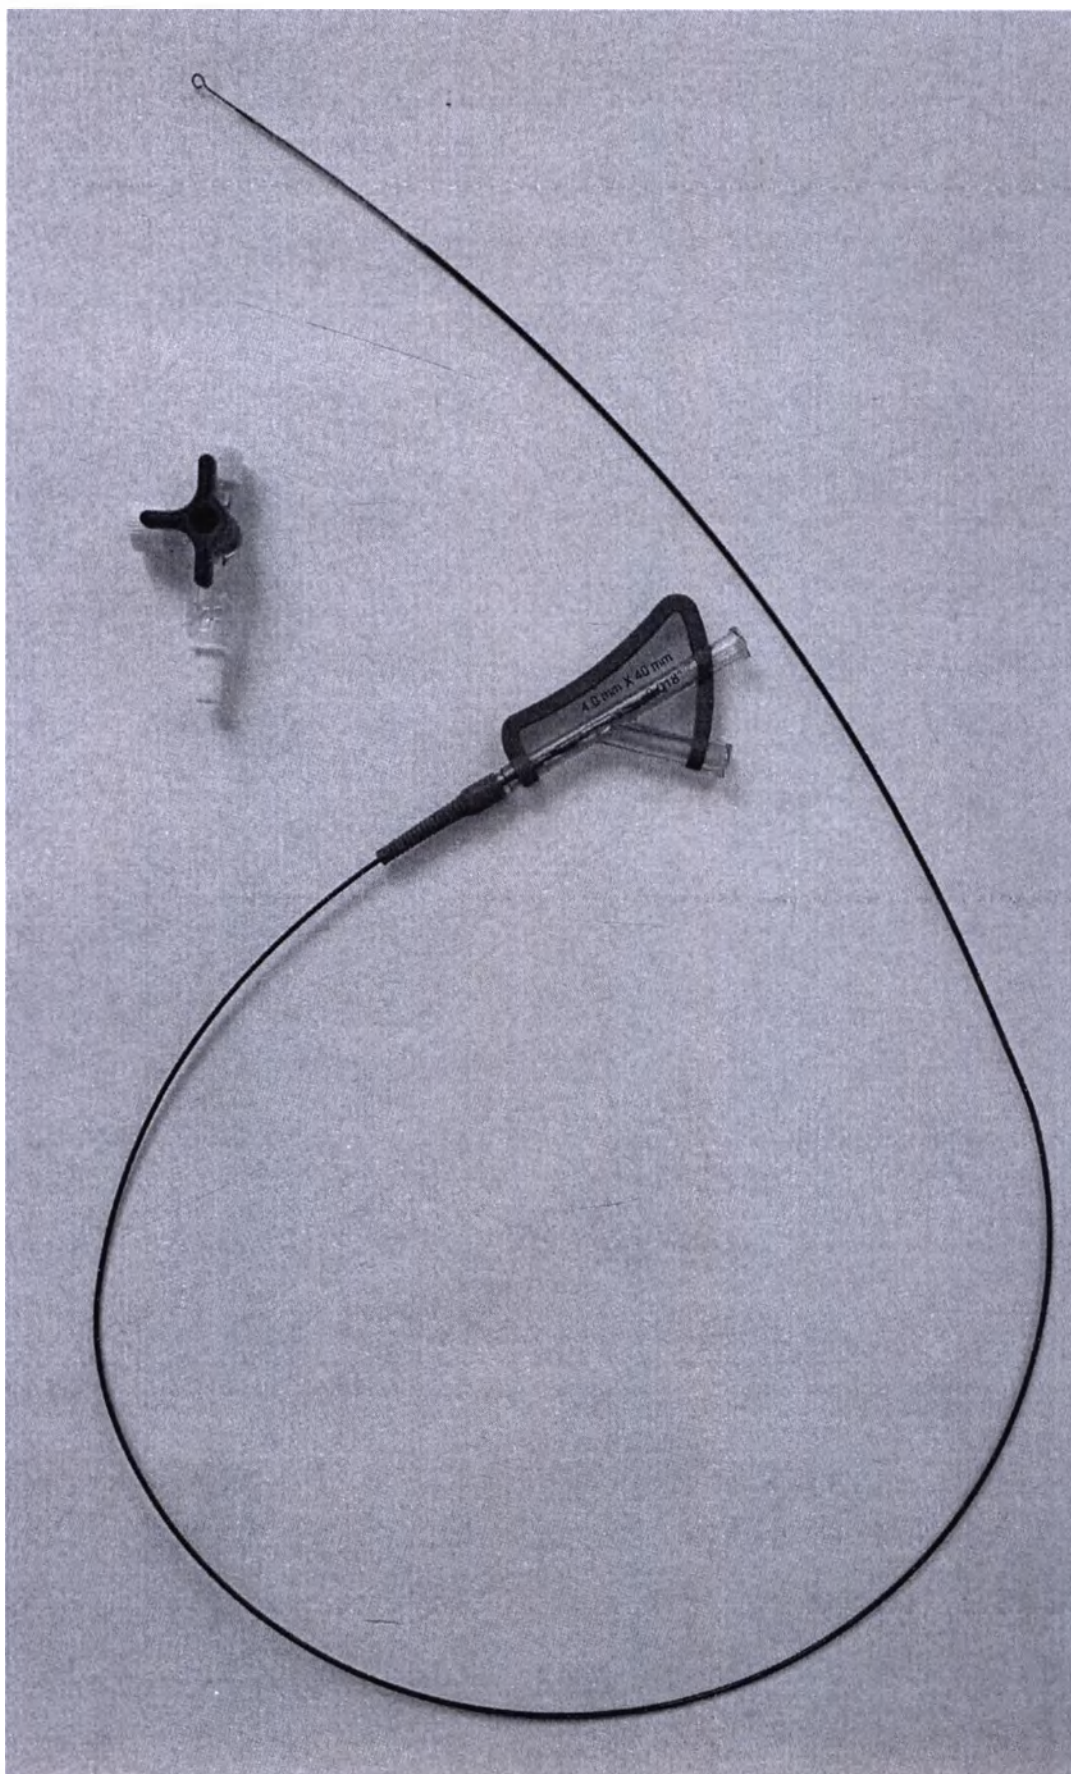


Рис. 1 Изображение Дилататора баллонного мочеточникового диаметром 3,5 Fr (1,16 мм) длиной 75 см с диаметром баллона 4 мм, длиной баллона 40 мм.

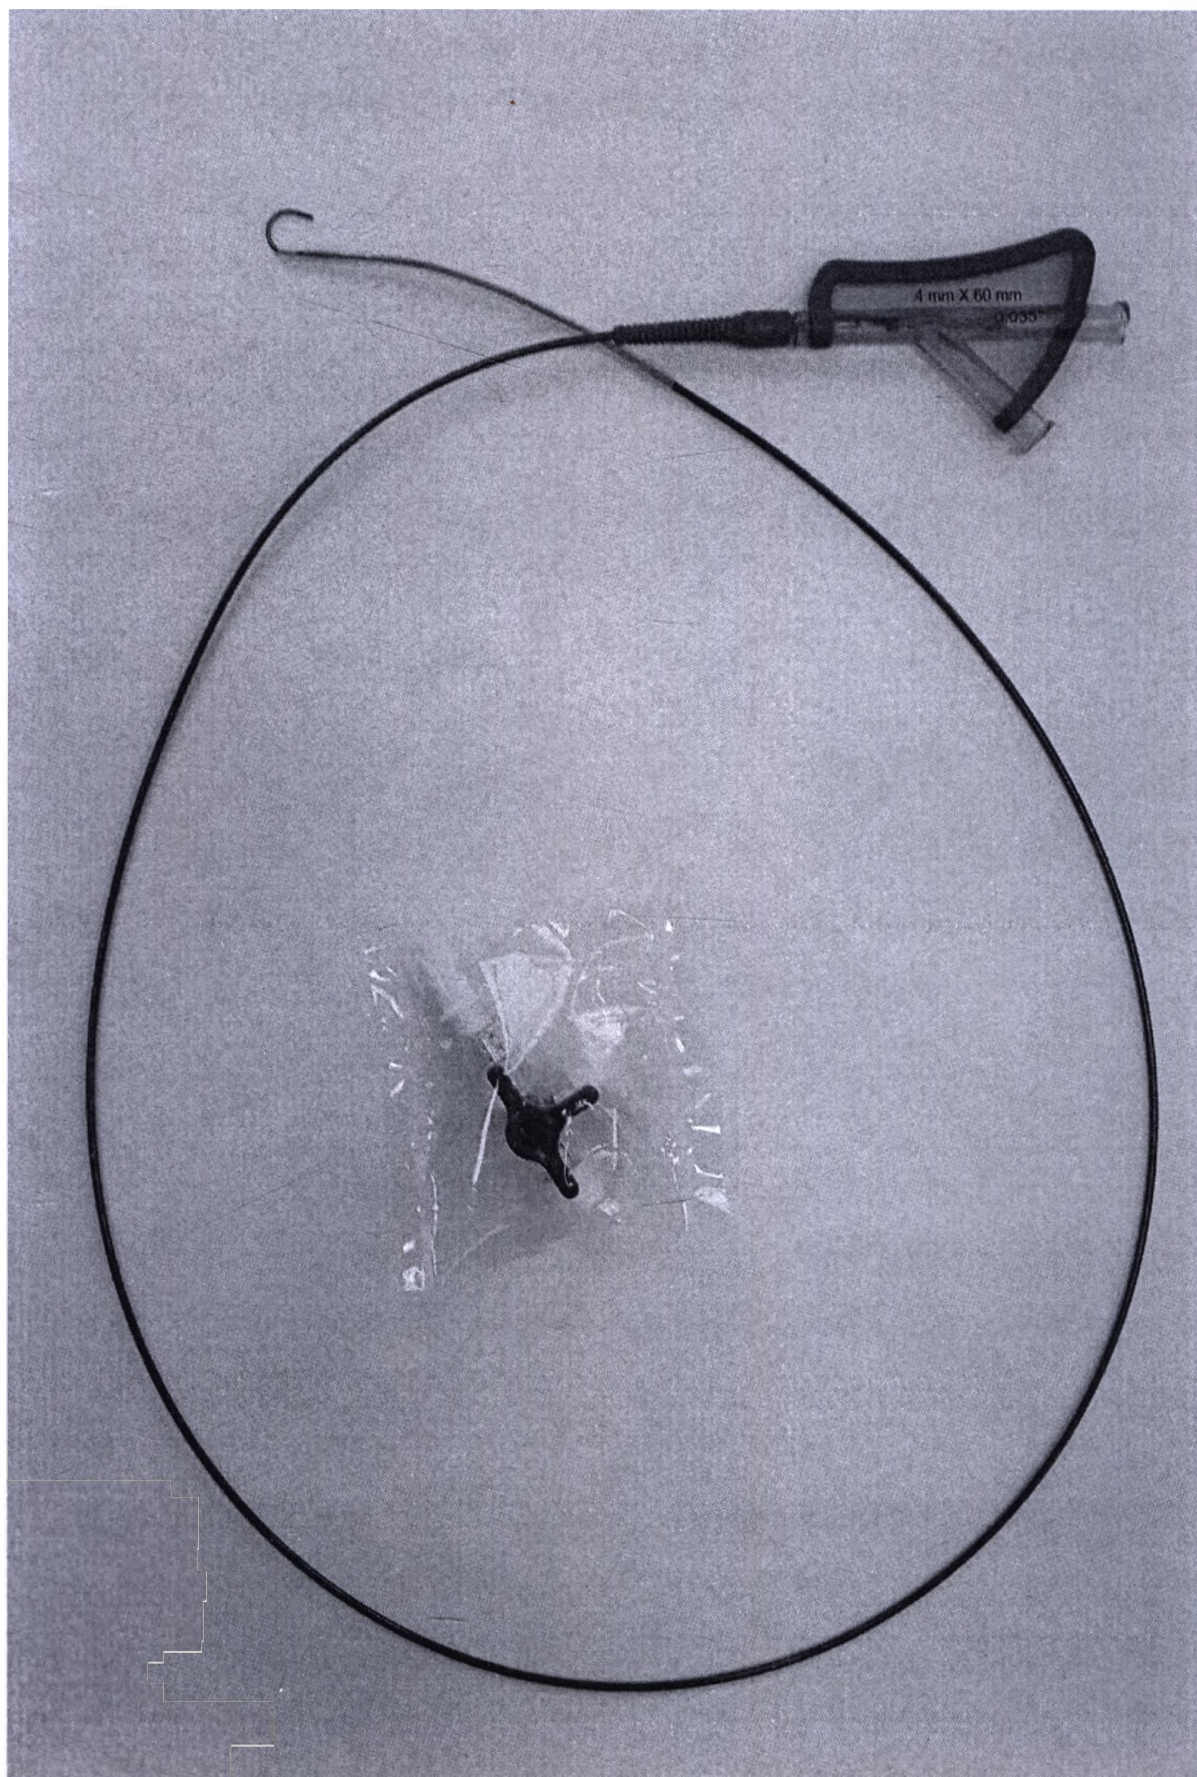


Рис. 2 Изображение Дилататора баллонного мочеточникового диаметром 4,8 Fr (1,60 мм) длиной 75 см с диаметром баллона 4 мм, длиной баллона 60 мм.

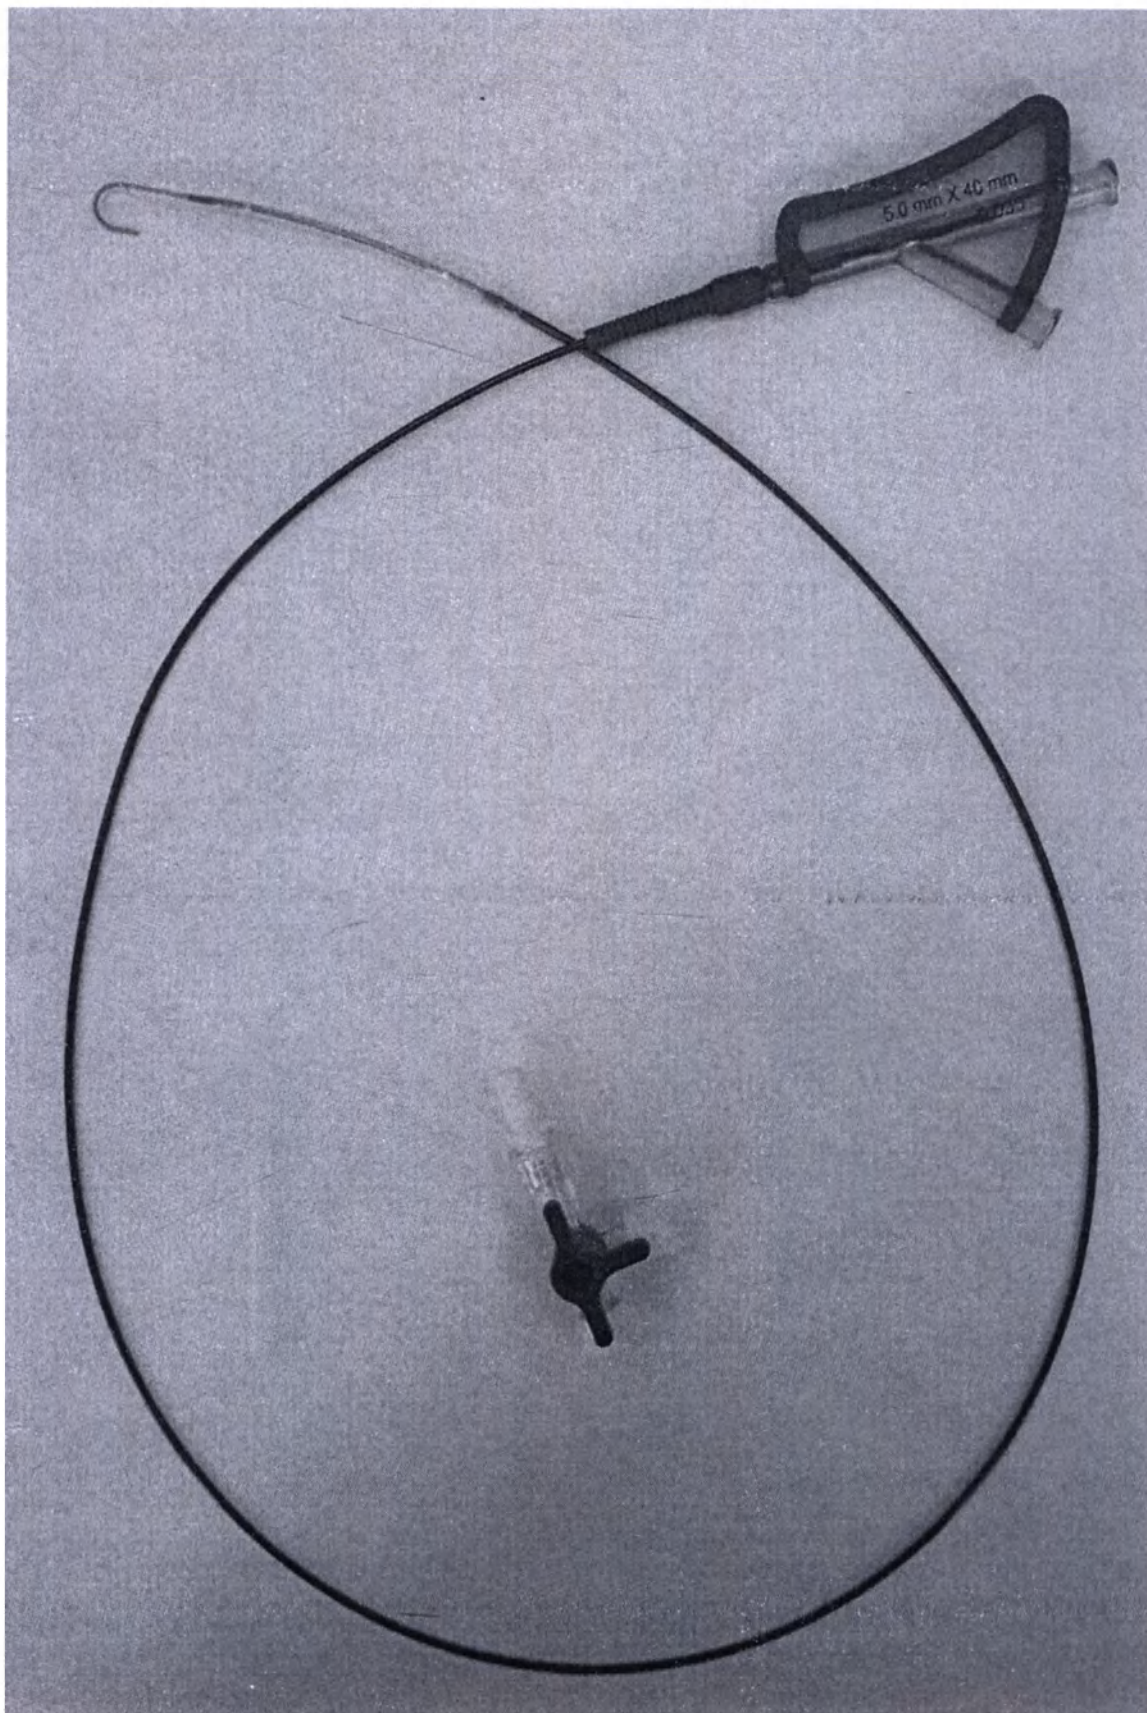


Рис. 3 Изображение Дилататора баллонного мочеточникового диаметром 4,8 Fr (1,60 мм) длиной 75 см с диаметром баллона 5 мм, длиной баллона 40 мм.

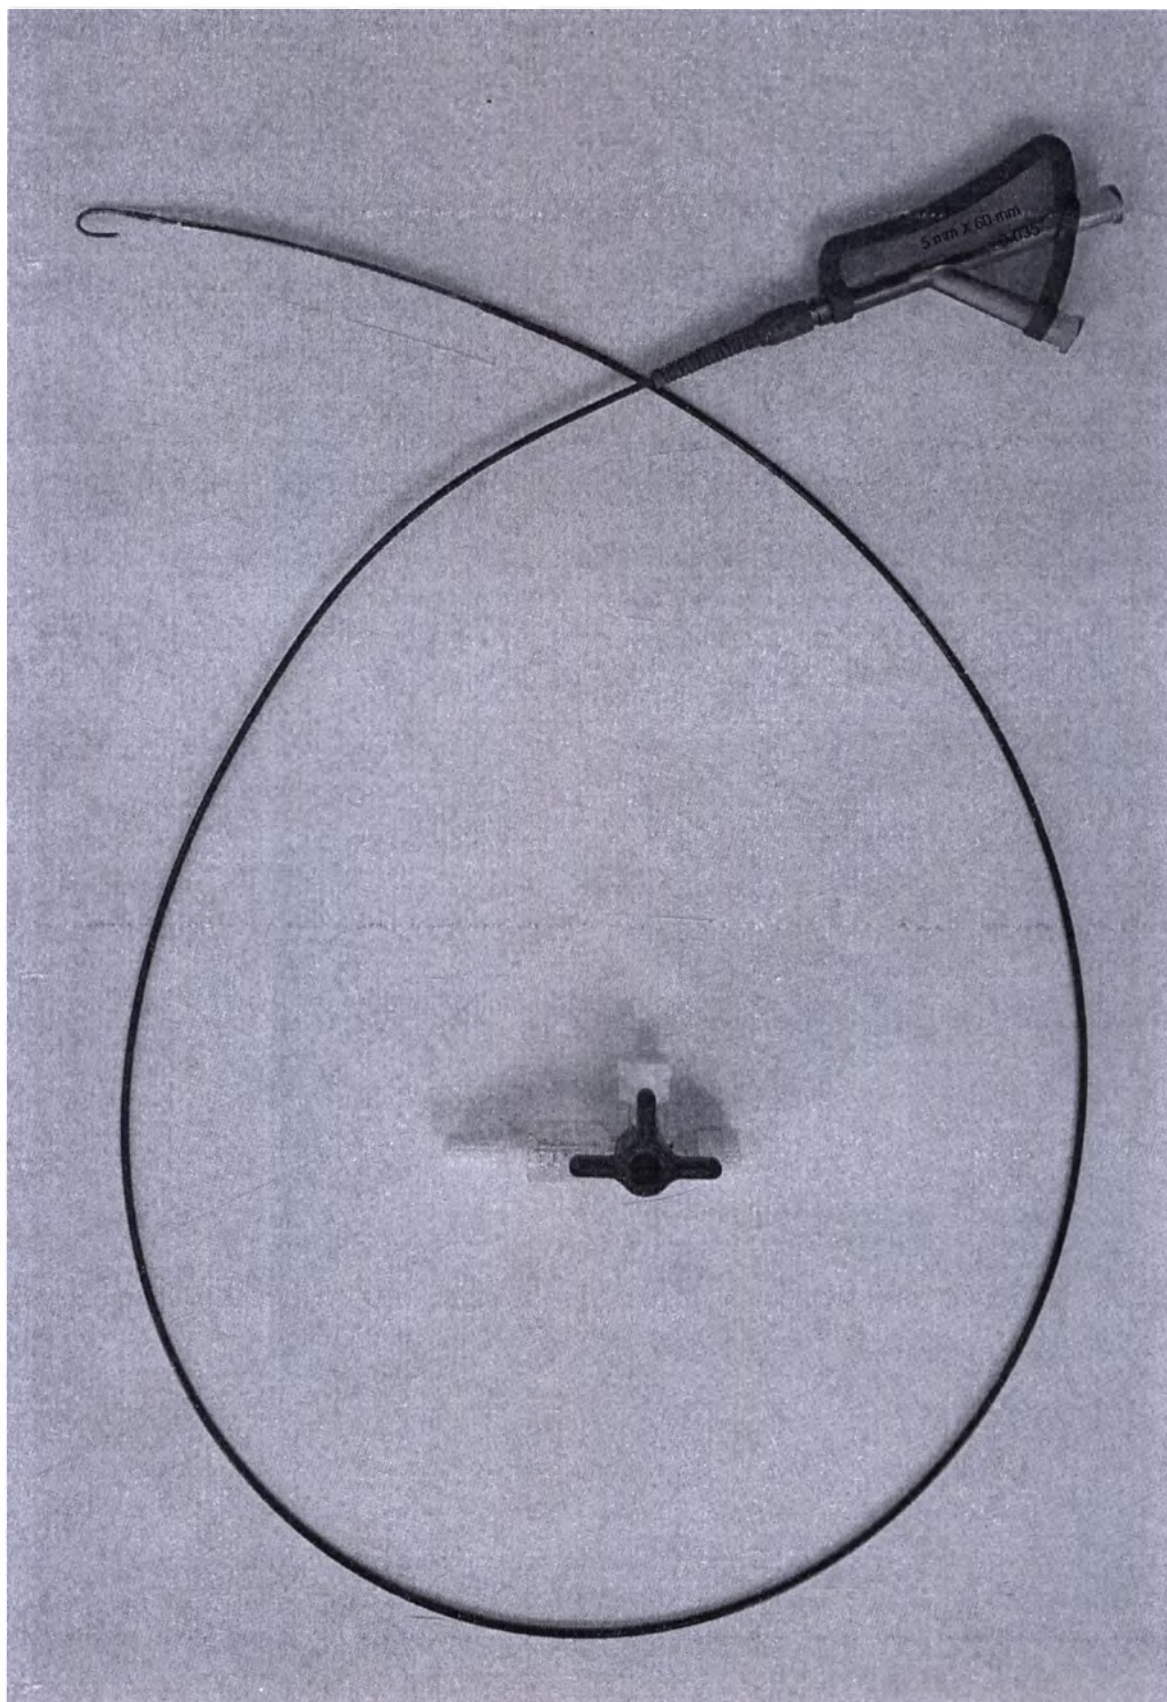


Рис. 4 Изображение Дилататора баллонного мочеточникового диаметром 4,8 Fr (1,60 мм) длиной 75 см с диаметром баллона 5 мм, длиной баллона 60 мм.

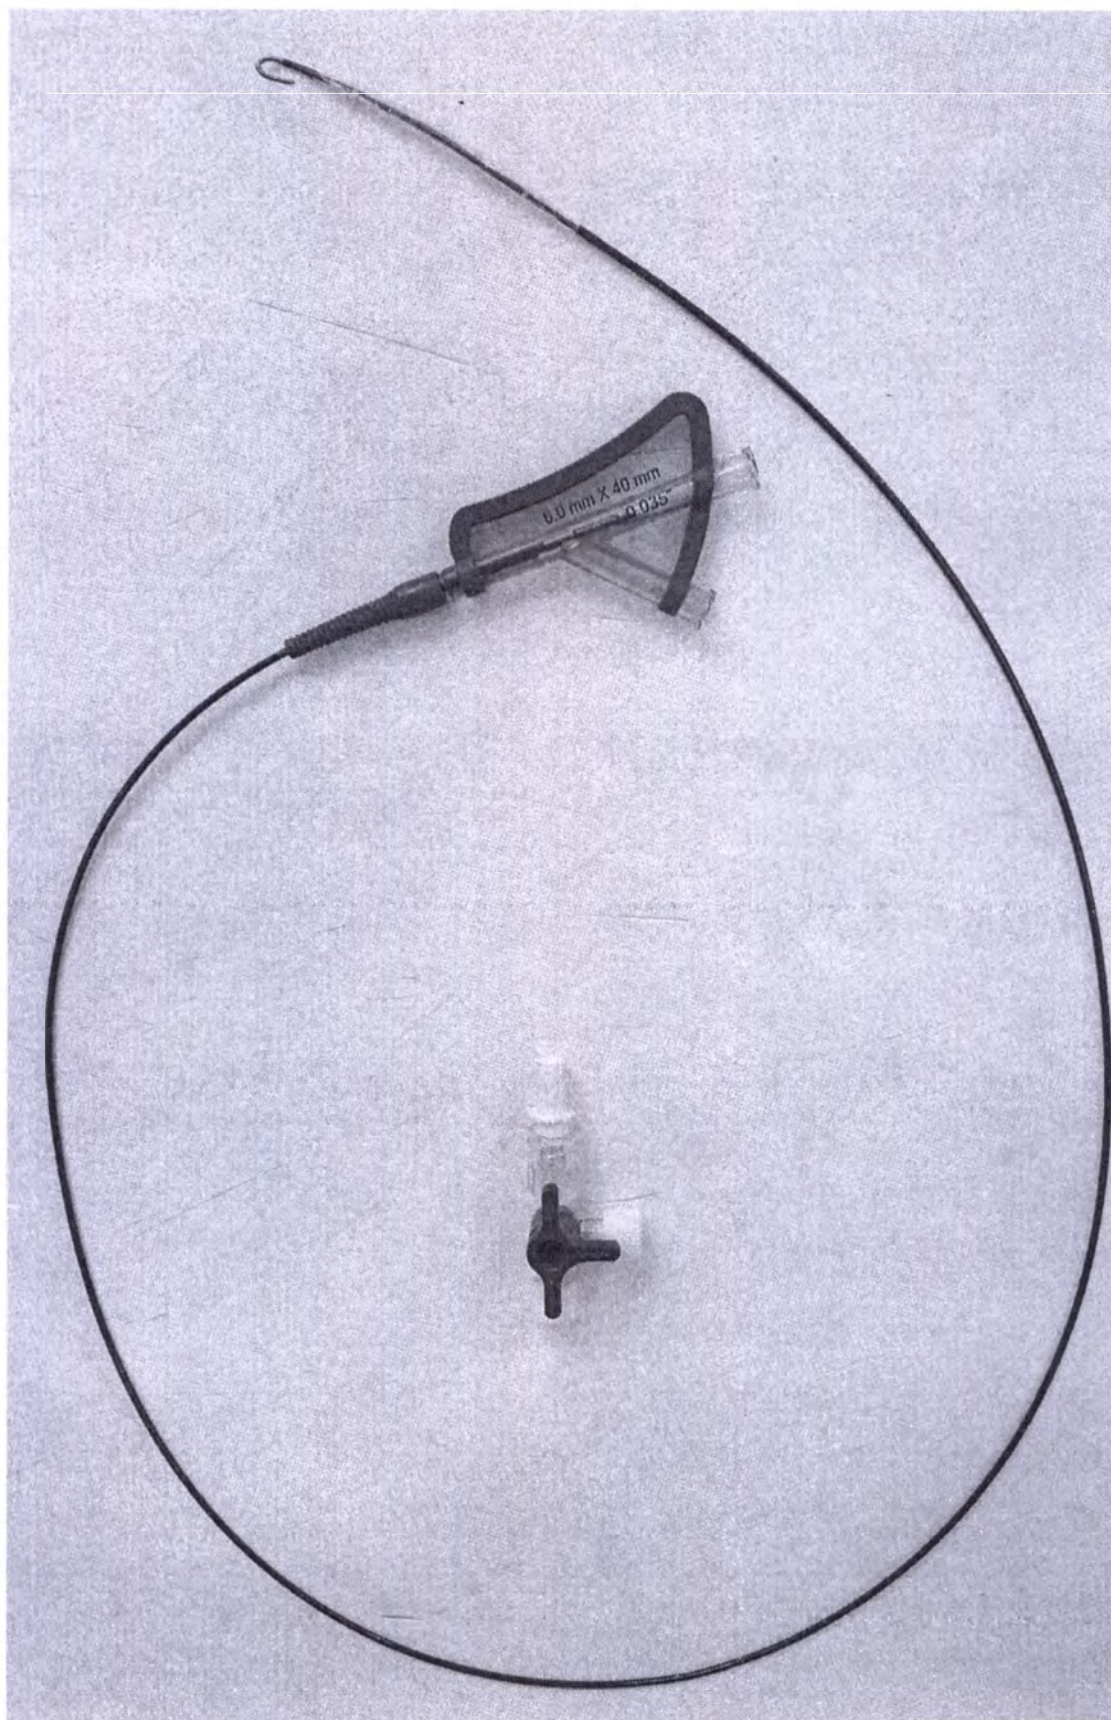


Рис. 5 Изображение Дилататора баллонного мочеточникового диаметром 4,8 Fr (1,60 мм) длиной 75 см с диаметром баллона 6 мм, длиной баллона 40 мм.

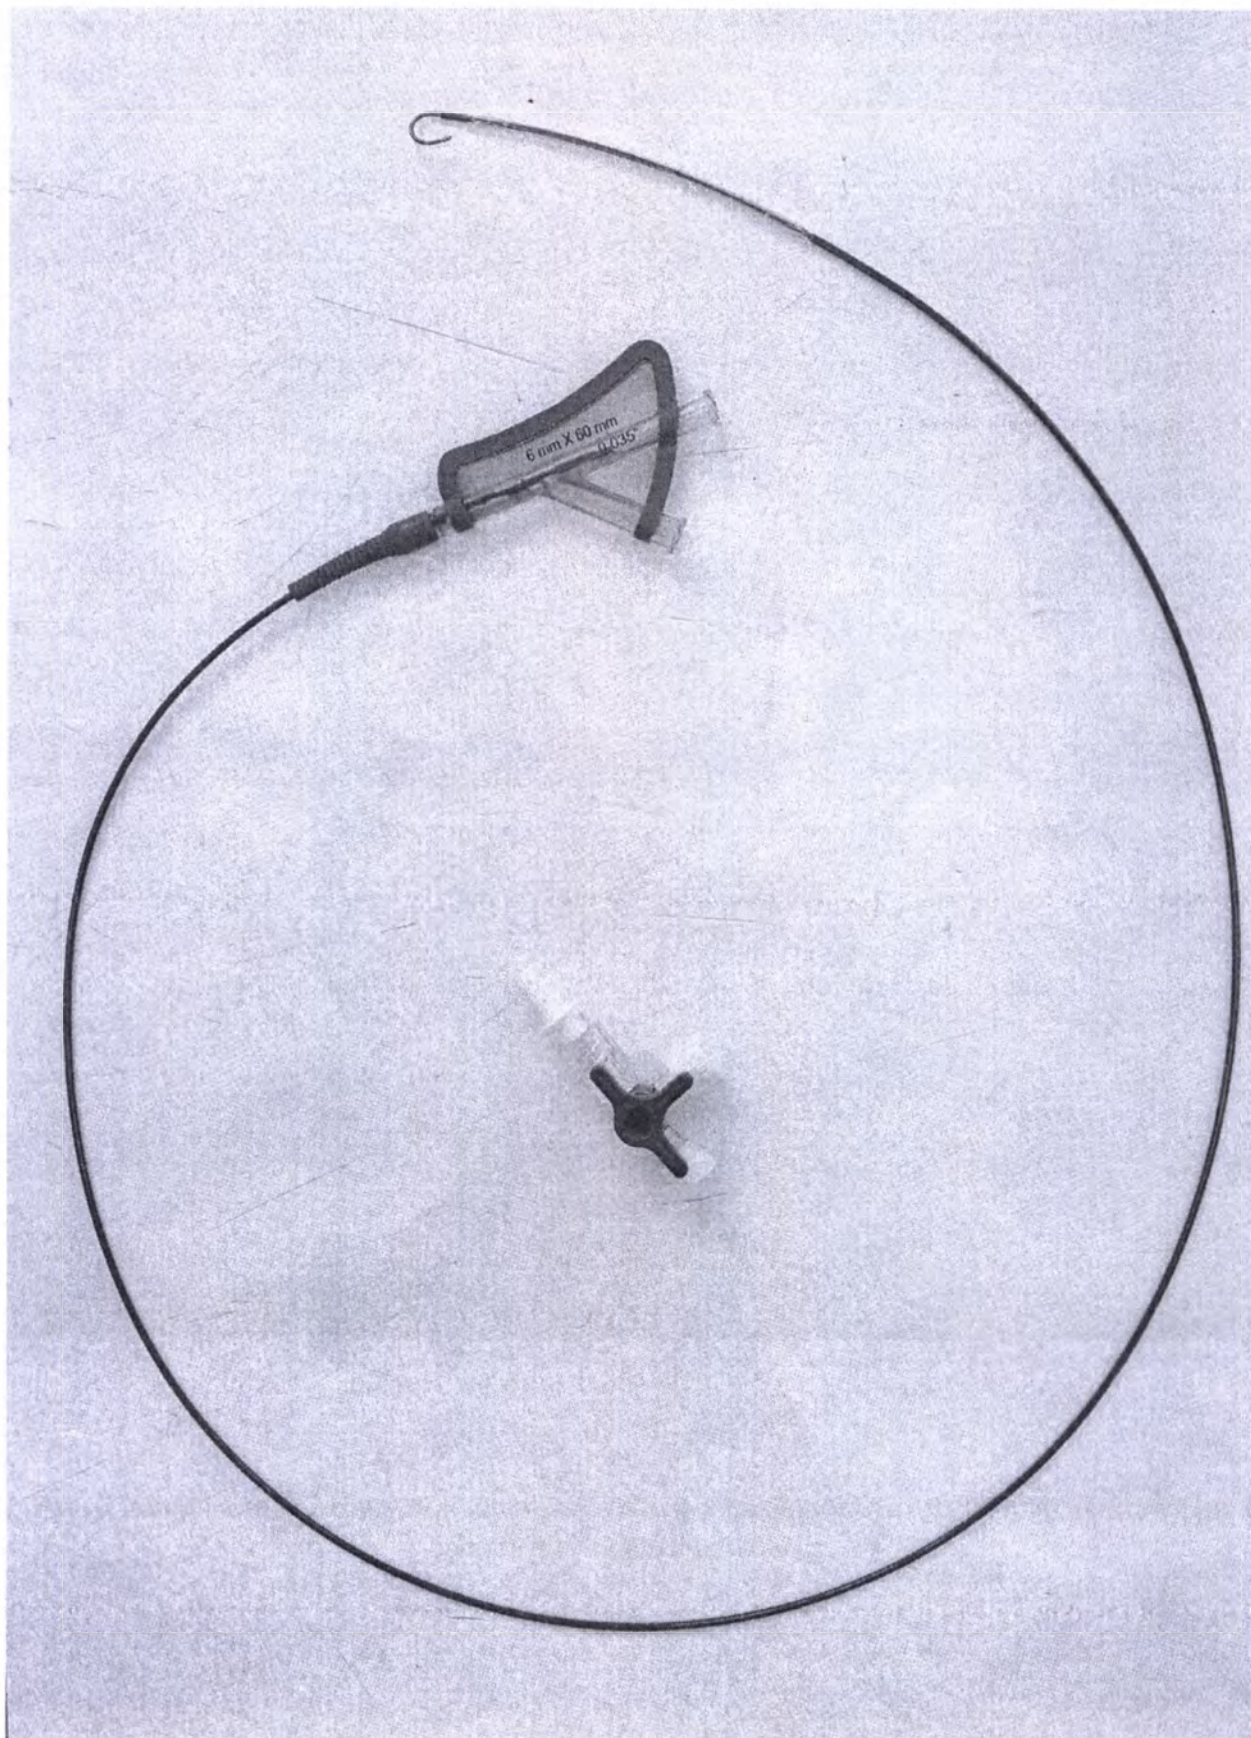


Рис. 6 Изображение Дилататора баллонного мочеточникового диаметром 4,8 Fr (1,60 мм) длиной 75 см с диаметром баллона 6 мм, длиной баллона 60 мм.



Рис. 7 Изображение первичной индивидуальной упаковки с этикеткой для дилататоров баллонных мочеточниковых.




Рис. 8 Изображение пользовательской коробки для первичной упаковки дилататоров баллонных мочеточниковых.

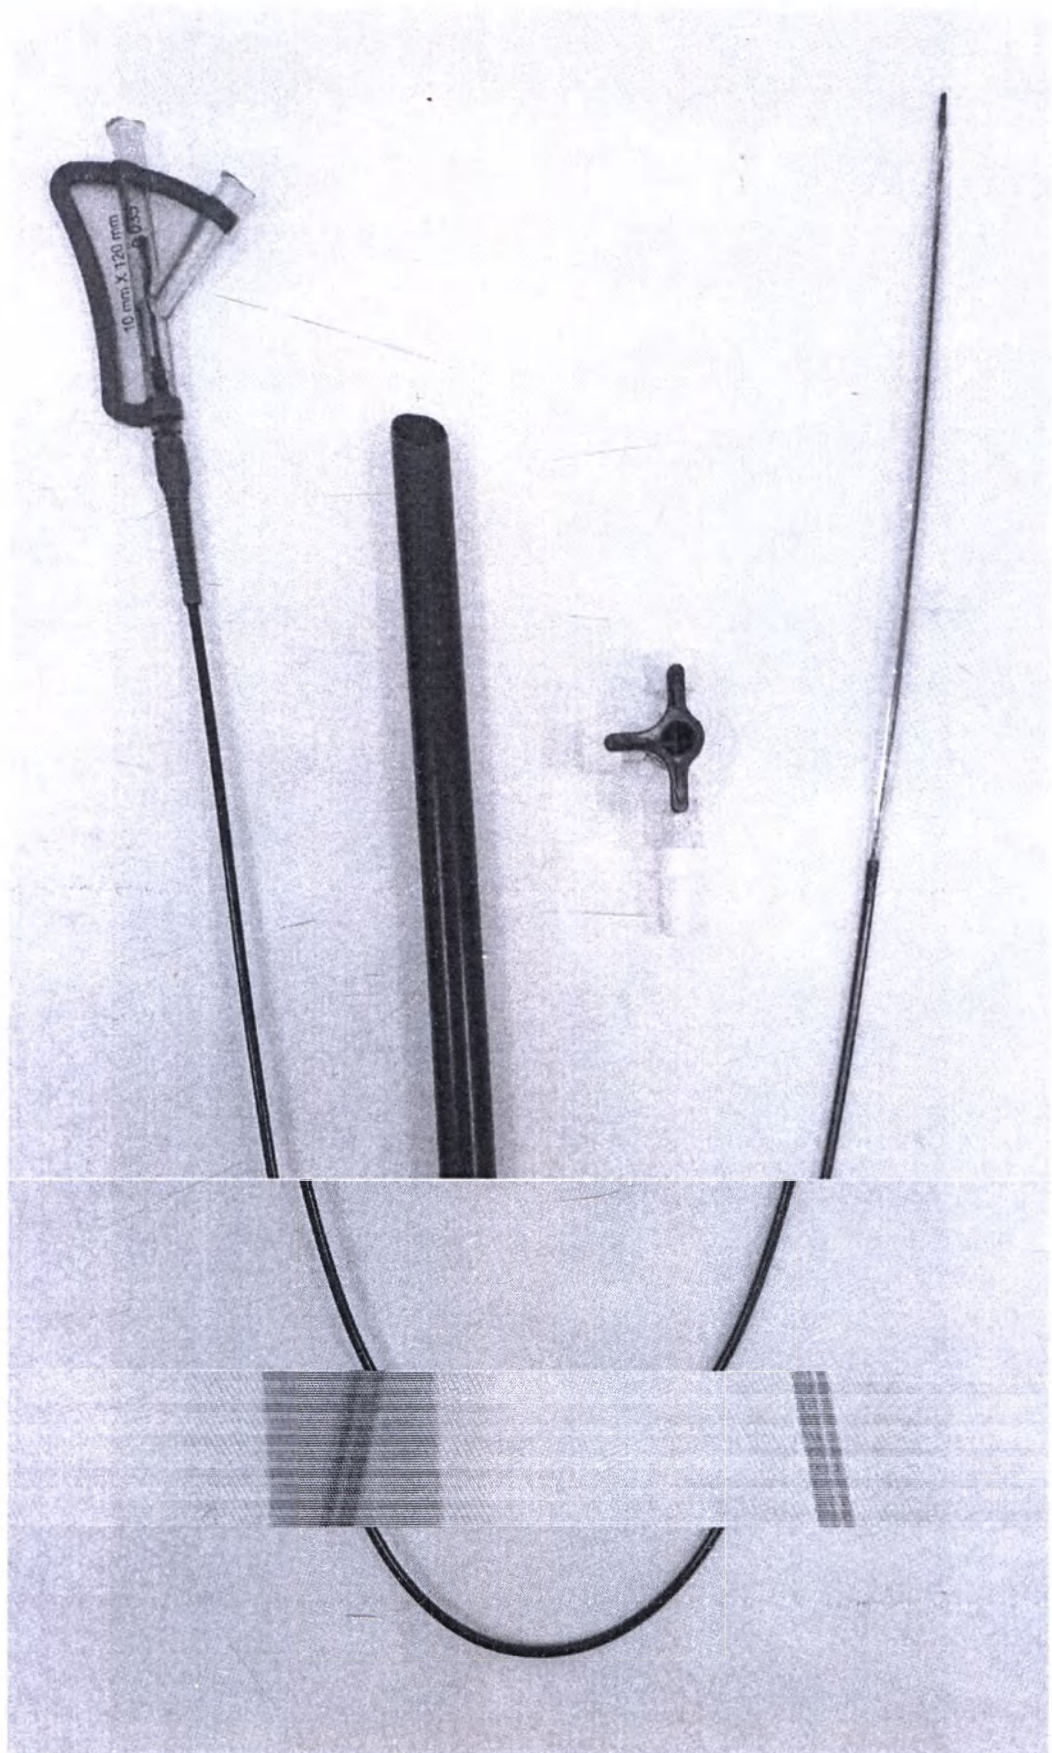


Рис. 9 Изображение Дилататора баллонного нефростомического диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 55 см, с диаметром баллона 10 мм, длиной баллона 12 см.

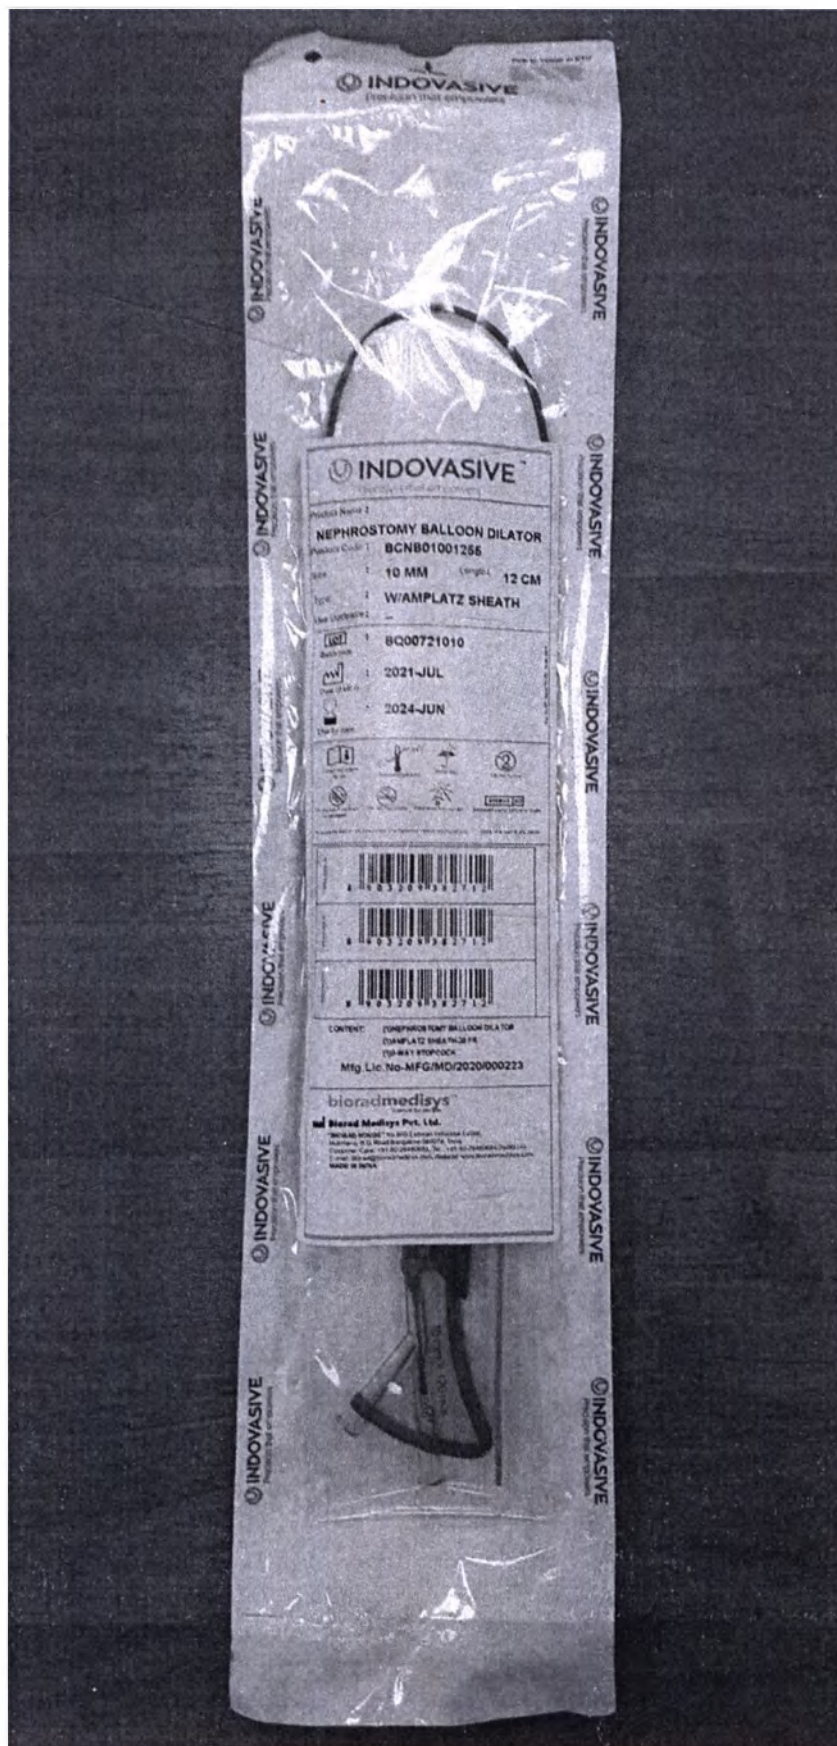


Рис. 10 Изображение первичной индивидуальной упаковки с этикеткой для Дилатора баллонного нефростомического диметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 55 см, с диаметром баллона 10 мм, длиной баллона 12 см.

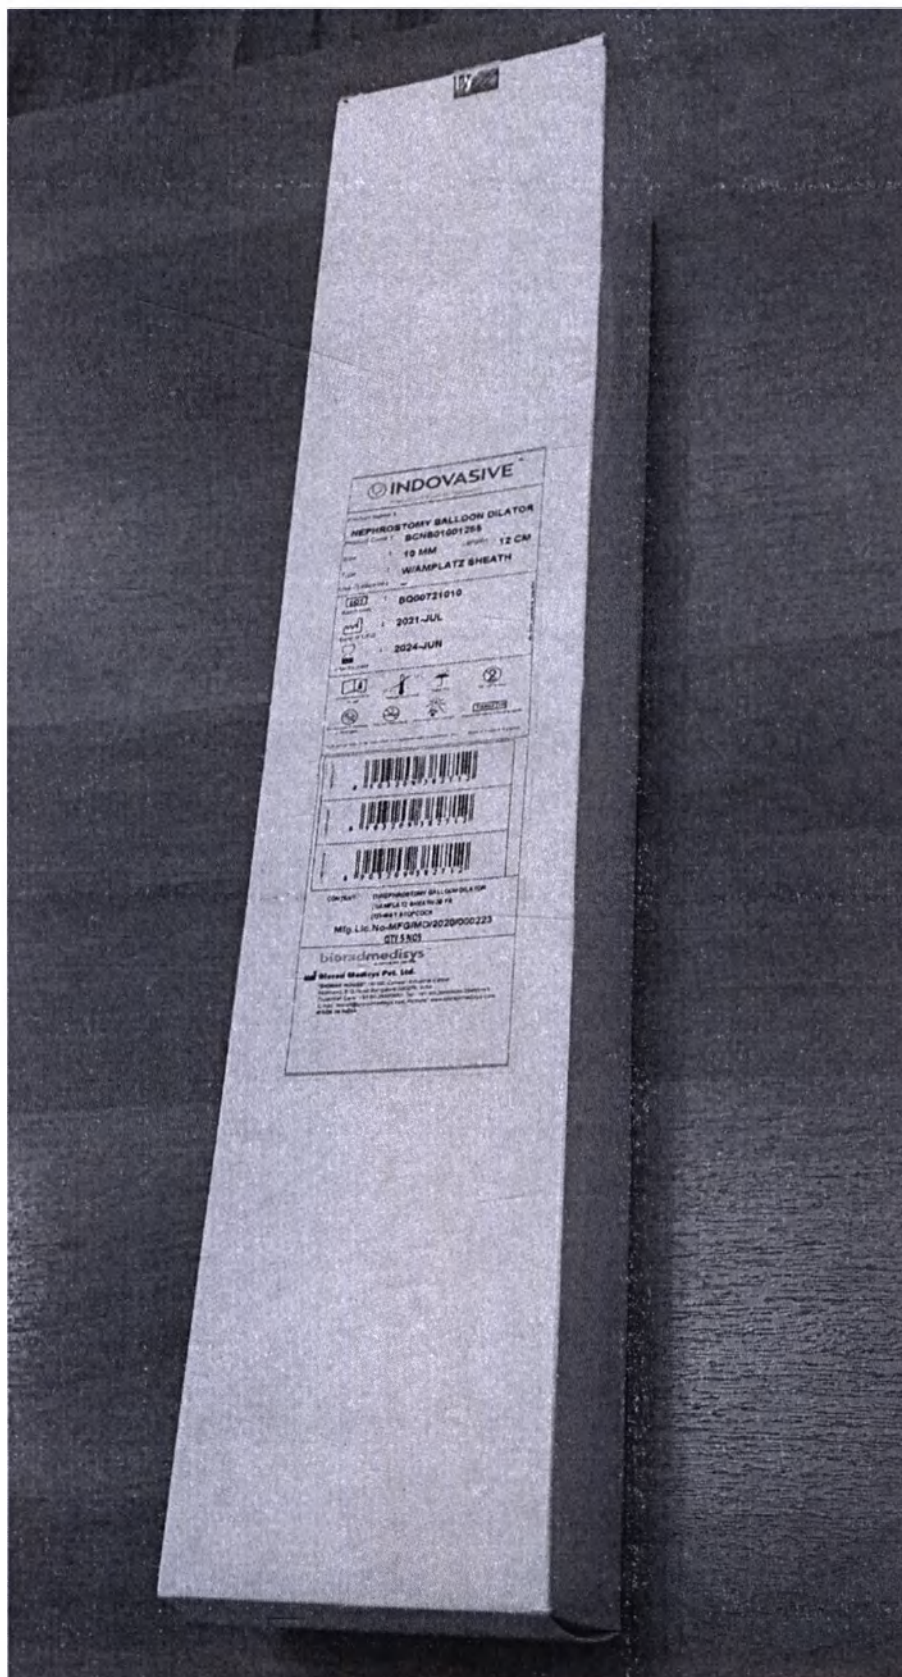


Рис. 11 Изображение пользовательской коробки для первичной упаковки Дилатора баллонного нефростомического диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 55 см, с диаметром баллона 10 мм, длиной баллона 12 см.

Пример маркировки русскоязычного стикера
(порядок слов и расположение символов могут быть изменены)

Дилататор баллонный урологический нефростомический диаметром 7 Fr (2,33 мм), длиной 55 см, с диаметром баллона 10 мм, длиной баллона 12 см	
Регистрационное Удостоверение № _____	
Производитель: Биорад Медисис Пвт. Лтд. Адрес: 221, Damji Shamji Industrial Complex, 9 L.B.S. Marg, Kurla (West), Mumbai - 400 070 Maharashtra, India	
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «Результат-Аудит», 127572, г. Москва, ул. Абрамцевская, д.14А Тел: 8 (495) 455-11-16	
Дата изготовления Серия: см. упаковку	См. Инструкцию См. символы на упаковке

Прошнуровано и пронумеровано

13 лист об

Генеральный Директор

ООО "Результат-Аудит"

Г.В. Родина

Родина

