


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МНПК Биомир XXI»




Осташев А. В.
«21» декабря 2021 г.
М.П.

Система перемещения пациента: Модель Алво Транспа 4-12


Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

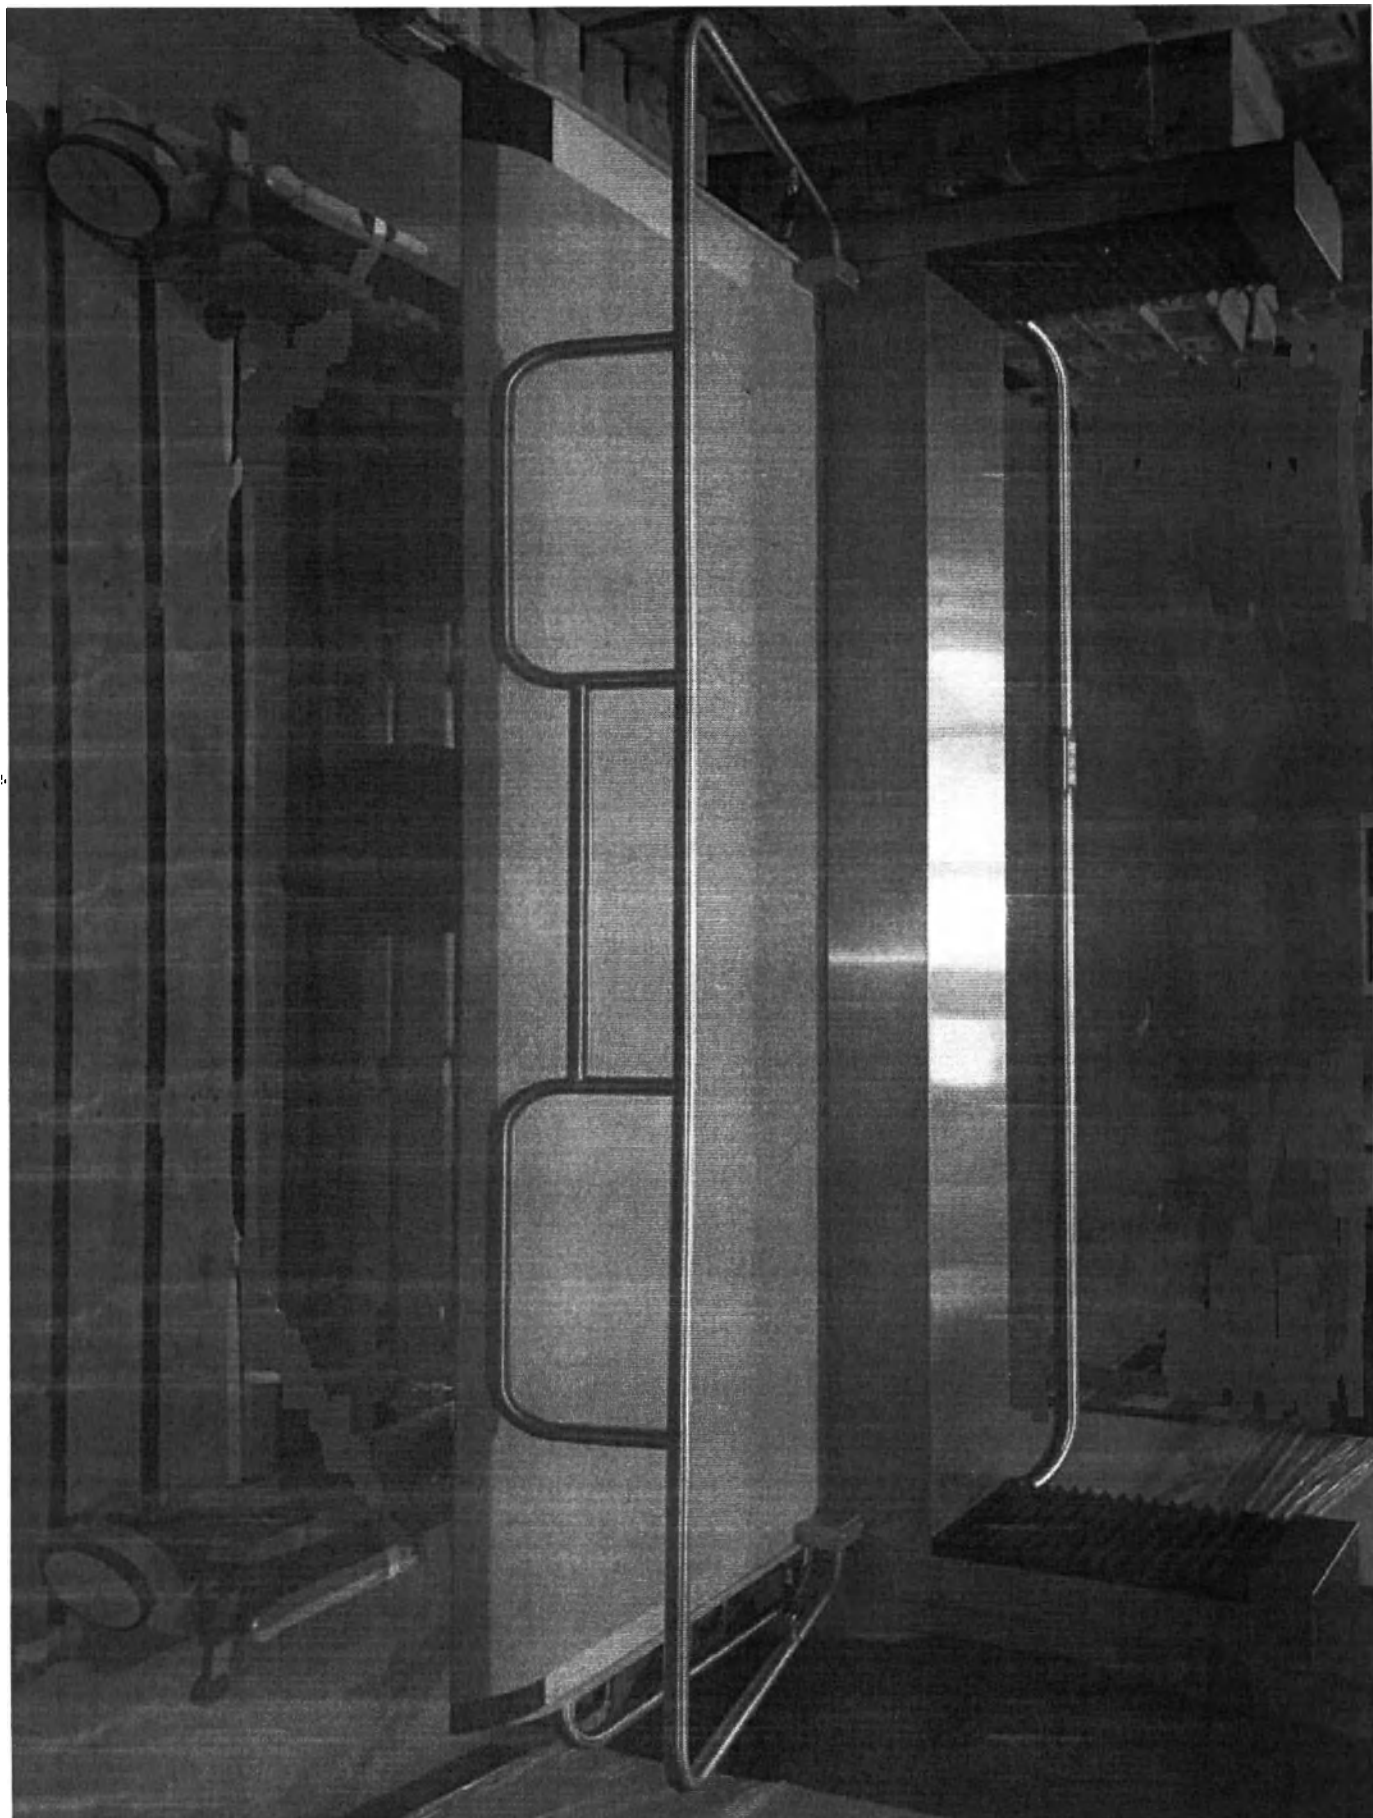

Фотографическое изображение 1 – Система перемещения пациента: Модель Алво Транспа 4-12, вид спереди.

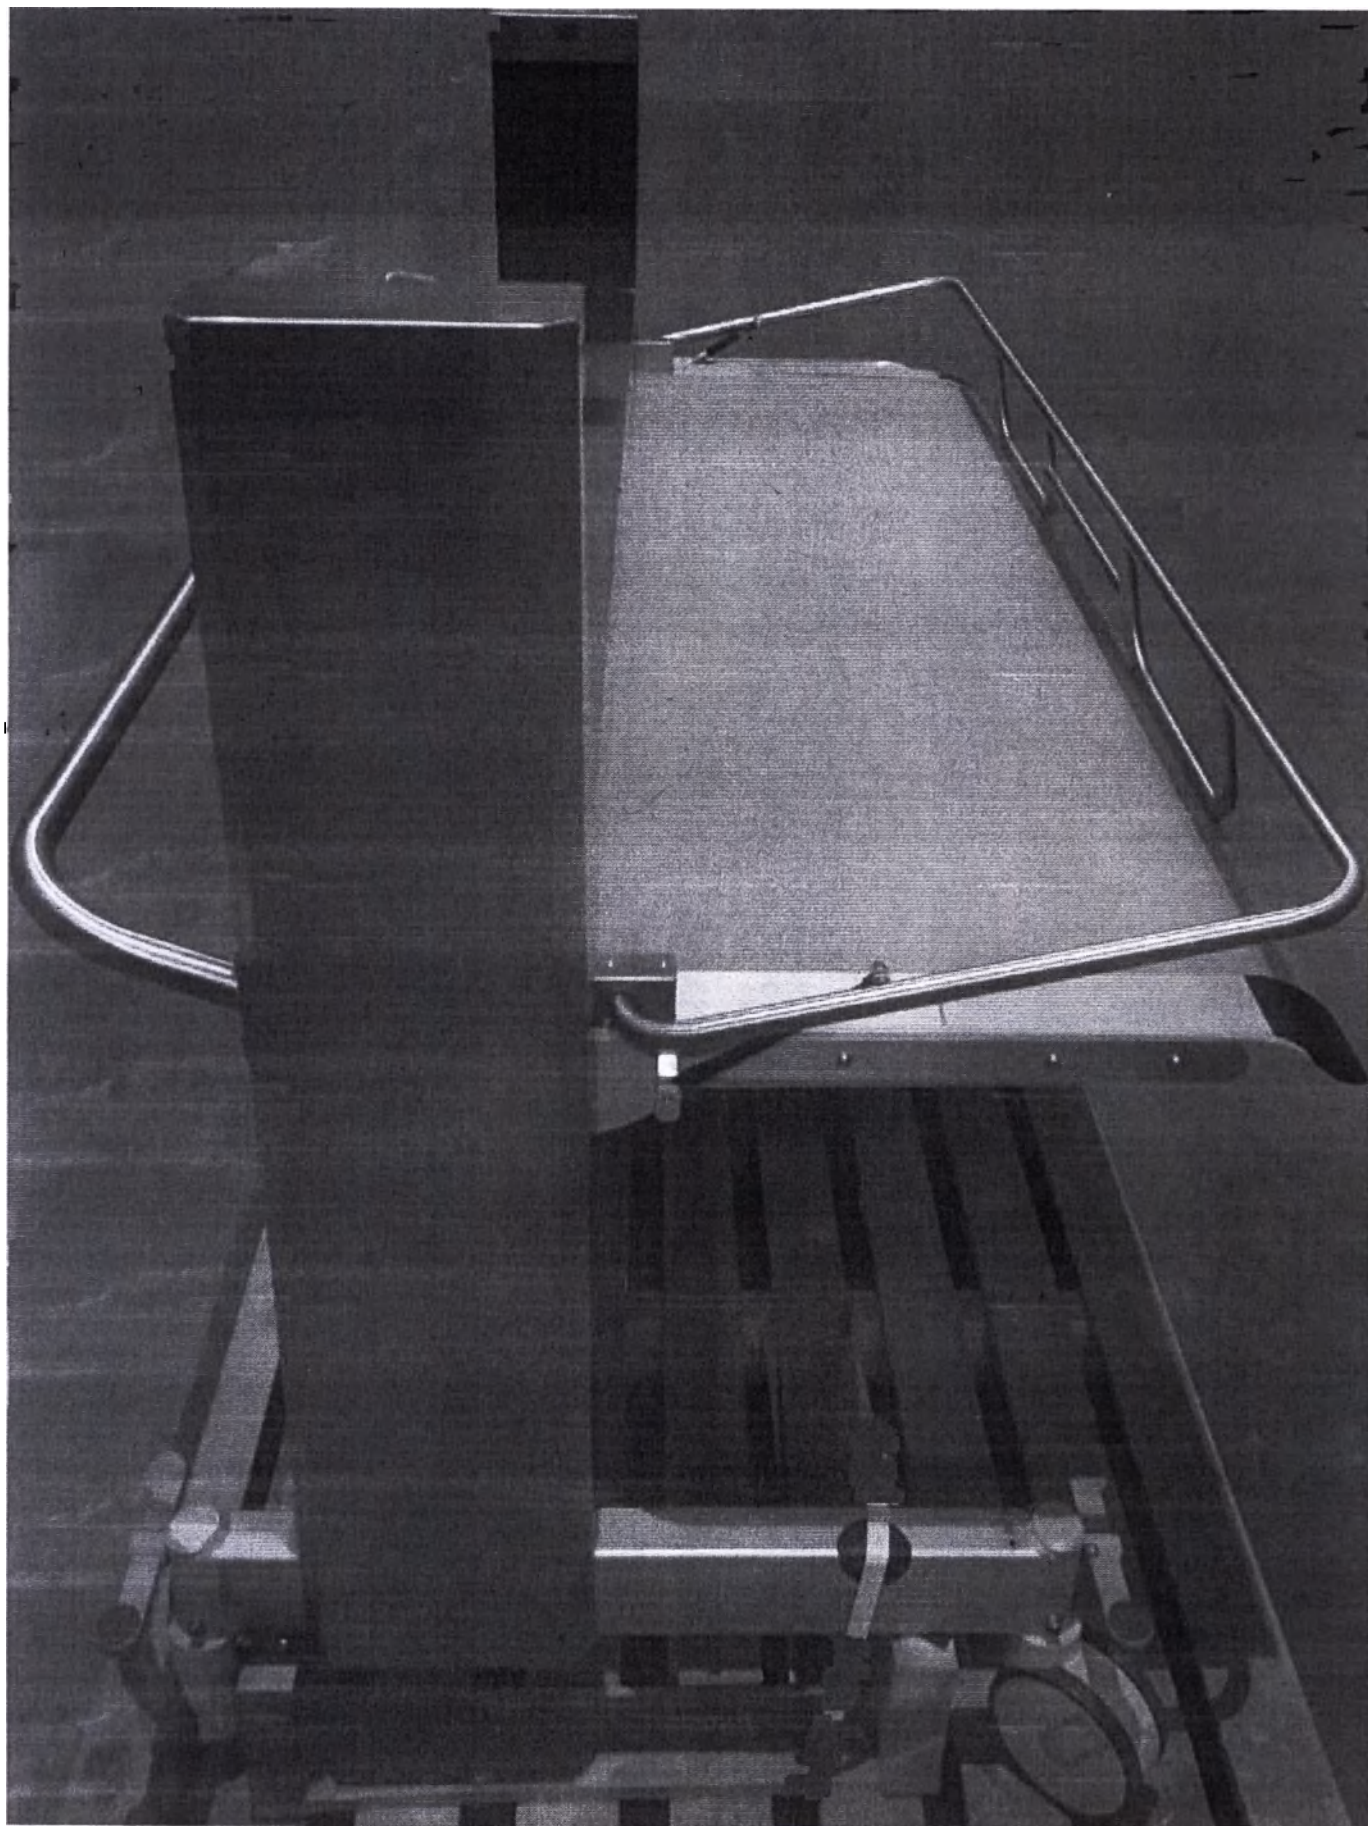

Фотографическое изображение 2 – Система перемещения пациента: Модель Алво Транспа 4-12, вид сбоку.

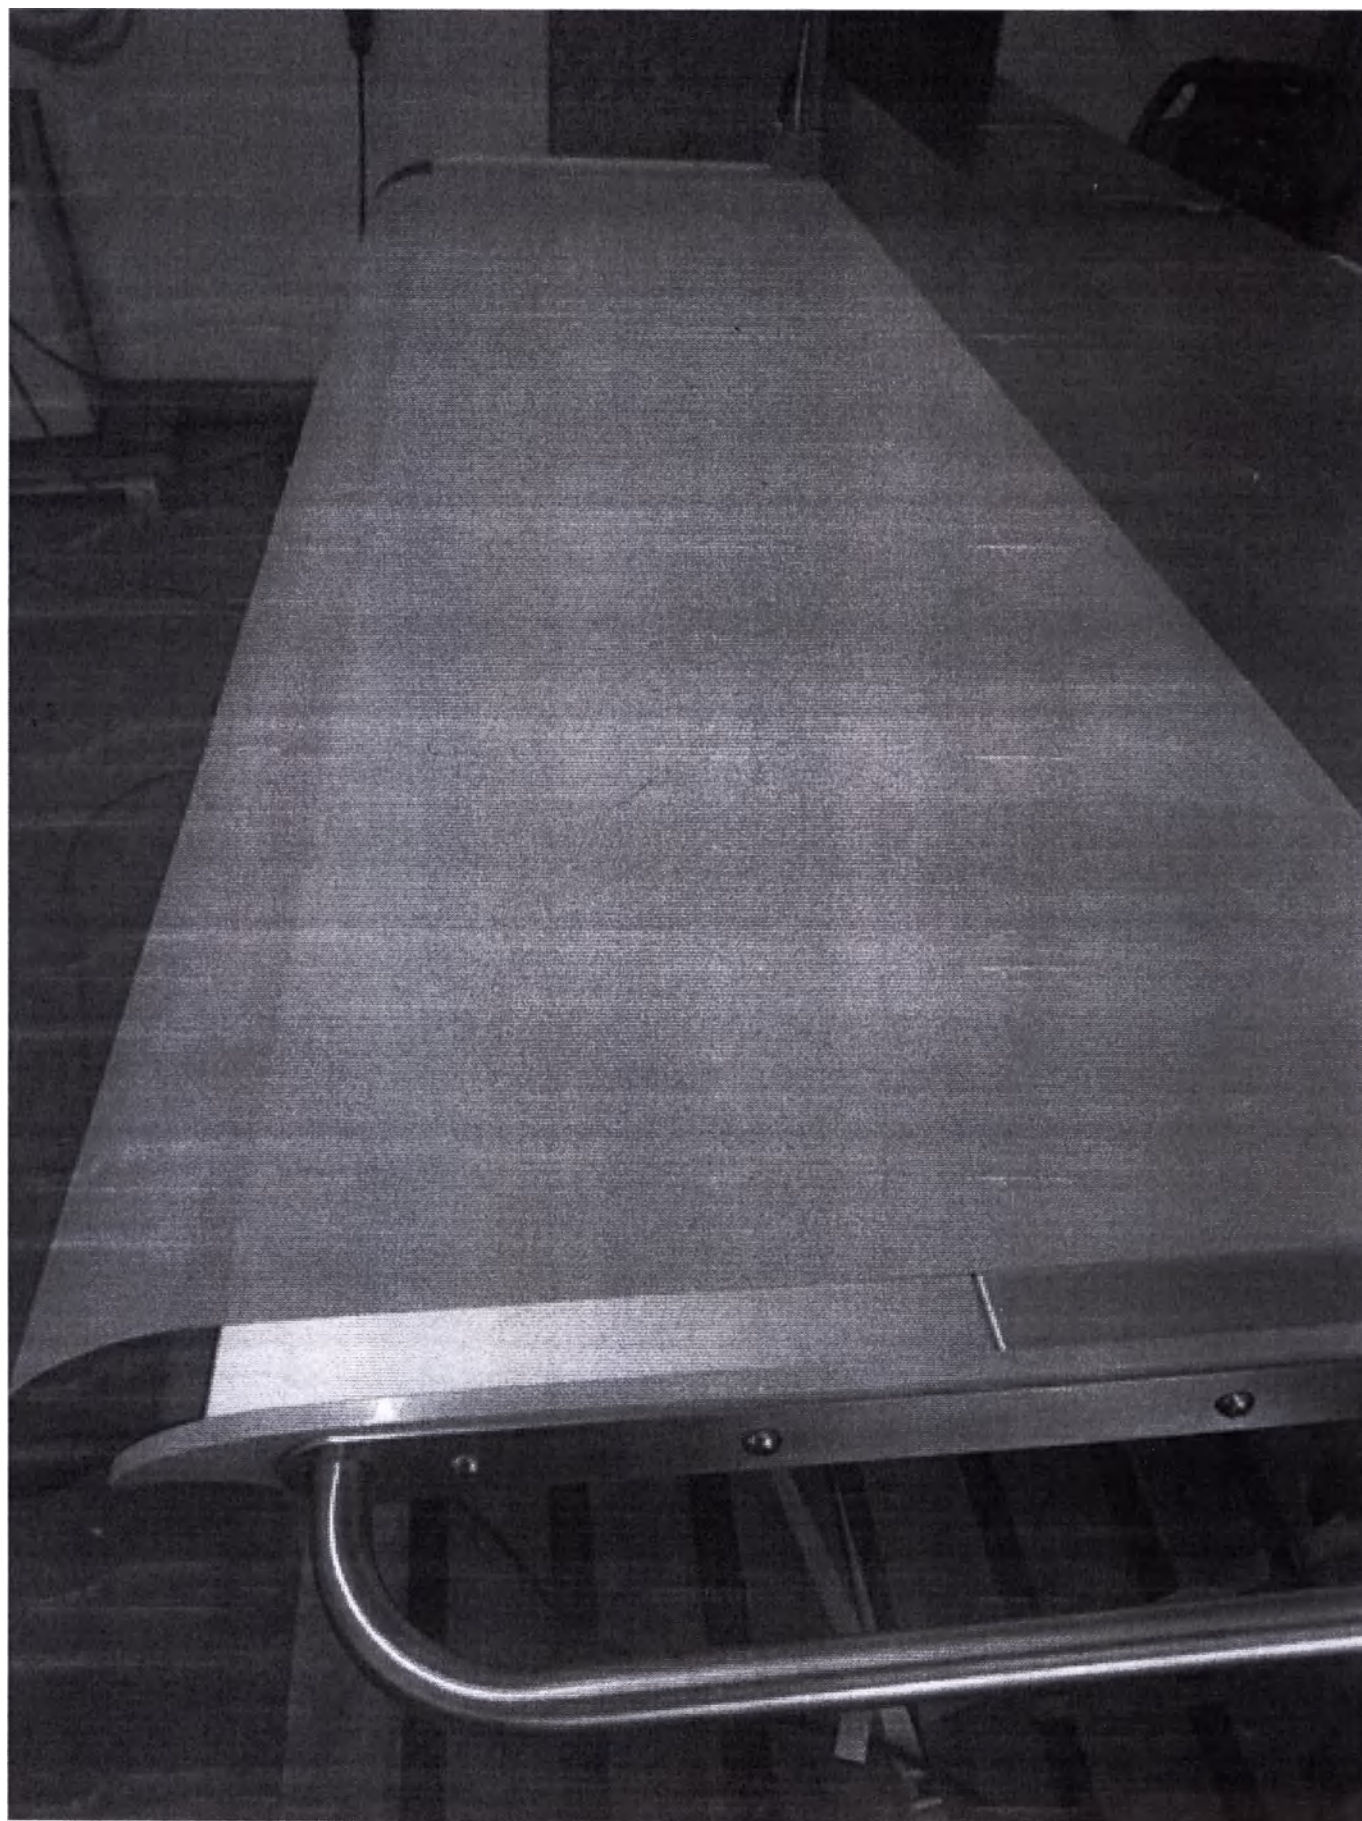

Фотографическое изображение 3- Ленточный стол медицинского изделия: «Система перемещения пациента: Модель Алво Транспа 4-12»



Фотографическое изображение 4- Маркировка производителя медицинского изделия: «Система перемещения пациента: Модель Алво Транспа 4-12»

ЕВРОPOWER

EV 22-12 (12V, 88W/Cell 15Min)

VR/LA - valve regulated lead-acid battery

Constant Voltage Charge (20°C)

Standby use: 13.5-13.8 V

Cycle use: 14.4-15.0 V

Max. initial current: 6.00 A

CAUTION

- Avoid short circuit.
- Do not throw into flame.
- Avoid charging in a sealed container.
- Avoid mechanical shocks, if exposed to electrolyte, wash immediately with water.

JAPAN TECH

www.europower.eu



Фотографическое изображение 5 – Встроенная аккумуляторная батарея EUROPOWER EV22-12 медицинского изделия: «Система перемещения пациента: Модель Алво Транспа 4-12»



*Фотографическое изображение 6 – Кабель уравнивания потенциалов 5 м медицинского изделия:
«Система перемещения пациента: Модель Алво Транспа 4-12»*

Всего прошито и скреплено печатью
7 (семь) и и листов



Генеральный директор
ООО «МНПК БИОМИР XXI»
Осташев А.В.

