

В Федеральную службу по надзору
в сфере здравоохранения
109074, Москва, Славянская пл., д. 4,
стр. 1

**МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ и ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
медицинского изделия**

**«Лейкопластырь медицинский фиксирующий в вариантах
исполнения»**

Генеральный директор ООО «СПЕКТРУМ»
Федюнина Мария Александровна

Утверждено: «16» января 2023 г.
Изменение № 2: «18» октября 2023 г.



Макеты маркировки потребительских упаковок


3,8x3,8 см



MASTER UNI
МАСТЕР ЮНИ

MASTER UNI лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе. Размер: 3,8x3,8 см – 1 шт. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Отпускается без рецепта. Не является восстановленным. Стерилизация оксидом этилена. **РУ №** _____

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии. **Уполномоченный представитель на территории РФ:** ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.

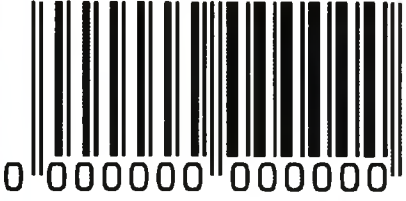

Дата изготовления/Mfg date: 12.11.2019

Годен до/Use before: 11.11.2024

Партия №/LOT: RYTFW02















открывать здесь


6,5x2,5 см



MASTER UNI
МАСТЕР ЮНИ

MASTER UNI лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе. Размер: 6,5x2,5 см – 1 шт. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Отпускается без рецепта. Не является восстановленным. Стерилизация оксидом этилена. **РУ №** _____

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии. **Уполномоченный представитель на территории РФ:** ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.

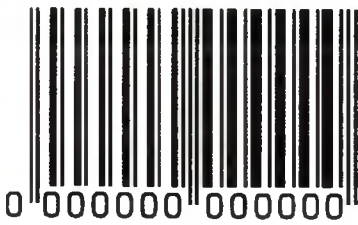

Дата изготовления/Mfg date: 12.11.2019

Годен до/Use before: 11.11.2024

Партия №/LOT: RYTFW02












открывать здесь



Производитель: PharmLine s.r.o.,
Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha
4, Czech Republic. Tel. +420608196035 /
Фармлайн ООО, Доброничка 1257,
Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская
Республика. Тел.: +420608196035.
Сделано в Чехии. **Уполномоченный
представитель на территории РФ:**
ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ
Басманный, ул. Нижняя Красносельская,
д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс:
+7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.



**MASTER UNI лейкопластырь
медицинский фиксирующий на
полимерной основе.**

Размер: диаметр 2,2 см – 1 шт.

Противопоказания: индивидуальная
непереносимость.

Правила хранения: Хранить вдали
источников тепла, при температуре от
+4 до +25°C и относительной
влажности воздуха не более 65%,
в недоступном для детей месте.
Стерилизация оксидом этилена.
Не является восстановленным.

Отпускается без рецепта.

РУ № _____

Дата изготовления:/Mfg date: 27.07.2021

Годен до:/Use before: 26.07.2026

Партия №:/LOT: RYTFW02

открывать здесь

ОГРН 1105994093429
ИНН РРР 5374 14298
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
р/с - 30762169305001000000

TENERiS®

ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫННОГО ТИПА
НЕДВИЖИМАЯ ФИКСИРУЮЩАЯ

Стерильная
на нетканой основе

[illegible]

10x25 cm

Система: микробная среда, источник энергии (подушечки, горелка, лампы), источник итерации (тепловое поле), источник биомассы. Правильно хранить: хранить в холодильнике, при температуре +4 до +8 °С, в аэробной среде, в течение не более 65 % в течение 10 дней в герметичной таре.

[illegible]

STERILE	EO
---------	----

 My data files are secure

 freeinfo@freemove.org

DOI: 10.1002/for




8 594202 460844

В приближении:
TENERiS

ПОВЯЗКА
пластырного типа
МЕДИЦИНСКАЯ ФИКСИРУЮЩАЯ

**Стерильная
на нетканой основе**

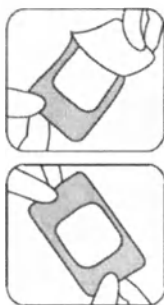

TENERIS лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе. Размер: 10x25 см – 1 шт.

Назначение: для защиты постоперационных и острых ран в процессе их заживления от вторичной инфекции и механических раздражений; для закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран.

Противопоказания: не использовать, если упаковка или изделие были повреждены или загрязнены. Не использовать, если изделие повреждено влагой или дымом. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Изделие предназначено для наружного применения. Не использовать по истечении срока годности (5 лет). Не использовать при индивидуальной непереносимости на компоненты, входящие в состав изделия. Заменить по необходимости или спустя 48 часов.

10x25 cm

Состав: нетканая основа, впитывающая подушечка, пористая пленка, клеящий материал (гипоаллергенный), защитная бумага.
Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Способ применения: вымыть руки перед использованием изделия, открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря. После извлечения лейкопластыря из единичной упаковки, устранить перичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей), приложить лейкопластырь к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.

Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным.
Отпускается без рецепта. Утилизация в соответствии
с СанПин 2.1.3684-21

STERILE	EO
---------	----

 Mfg date / Дата изготовления

 Use before /Tageen go

[LOT] LOT/Partner №

Р/у № _____ от _____

Производитель: Pharmline s.r.o., Dobruška 1257, Kunratice,
148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО,
Добрушка 1257, Кунратиче, 148 00 Прага 4, Чешская Республика.
Тел. +420608196035

Уполномоченный представлять на территории РФ
ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Басманный, ул. Невская Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6
Тел./факс: +7 495 665 80 58, info@spectrumnutrition.ru



8 594202 460844

TENERIS®

Производитель: PharmLine s.r.o.,
Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha
4, Czech Republic. Tel. +420608196035 /
Фармлайн ООО, Доброницка 1257,
Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская
Республика. Тел.: +420608196035.
Сделано в Чехии. **Уполномоченный
представитель на территории РФ:**
ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ
Басманный, ул. Нижняя Красносельская,
д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс:
+7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.



TENERIS лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе.

Размер: диаметр 2,2 см — 1 шт.

Противопоказания: индивидуальная
непереносимость.

Правила хранения: Хранить вдали
источников тепла, при температуре от
+4 до +25°C и относительной
влажности воздуха не более 65%,
в недоступном для детей месте.
Стерилизация оксидом этилена.
Не является восстановленным.
Отпускается без рецепта.

РУ № _____

Дата изготовления:/Mfg date: 27.07.2021


Годен до:/Use before: 26.07.2026

Партия №:/LOT: 00IU81

открывать здесь

TENERIS®

Дата изготовления:/Mfg date: 27.07.2021
Годен до:/Use before: 26.07.2026
Партия №:/LOT: 00IU81

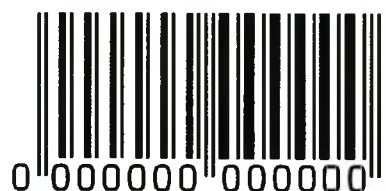

TENERIS лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе.

Размер: 7,2x1,9 см — 1 шт. **Противопоказания:** индивидуальная
непереносимость. **Правила хранения:** Хранить вдали источников тепла, при
температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в
недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является
восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ № _____

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech
Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброницка 1257, Кунратице, 148 00
Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066,
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская,
д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.



открывать здесь



**ДОКТОР
ПЛАСТ®**

Доктор Пласт лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе. Размер: 6,5х2,5 см – 10 шт. Правила хранения: Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ № _____

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.



0 000000 000000



Дата изготовления: / Mfg date:

Годен до: / Use before:

Партия №: / LOT:

12.11.2019
11.11.2024
POPLK12

6x2 см



Дата изготовления:/Mfg date: 27.07.2021
Годен до:/Use before: 26.07.2026
Партия №:/LOT: MU001



MASTER UNI лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе. Размер: 6x2 см – 1 шт. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Отпускается без рецепта. Не является восстановленным. Стерилизация оксидом этилена. **РУ №**

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии.
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.




открывать здесь

7,2x1,9 см



Дата изготовления:/Mfg date: 27.07.2021
Годен до:/Use before: 26.07.2026
Партия №:/LOT: MU001

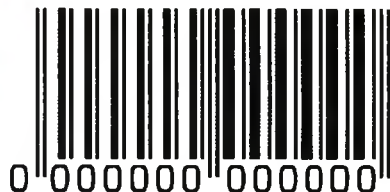

MASTER UNI лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе. Размер: 7,2x1,9 см – 1 шт. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. **РУ №**

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии.
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.



открывать здесь

MASTER UNI

МАСТЕР ЮНИ

3,8x3,8 см

MASTER UNI лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе. Размер: 3,8x3,8 см – 1 шт. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. **РУ №**

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии. **Уполномоченный представитель на территории РФ:** ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.



Дата изготовления:/Mfg date: 27.07.2021
Годен до:/Use before: 26.07.2026
Партия №:/LOT: MU001




открывать здесь

MASTER UNI

МАСТЕР ЮНИ

4x1 см

Дата изготовления:/Mfg date: 27.07.2021
Годен до:/Use before: 26.07.2026
Партия №:/LOT: MU001

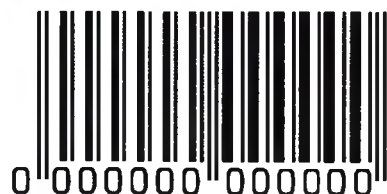


MASTER UNI лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе. Размер: 4x1 см – 1 шт. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. **РУ №**
Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии. **Уполномоченный представитель на территории РФ:** ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.



открывать здесь

65 mm x 25 mm

TENERiS®

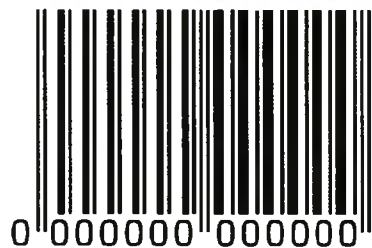

TENERIS лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе.
Размер: 6,5х2,5 см. Правила хранения: Хранить вдали источников тепла, при
температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более
65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена.
Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ № _____

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4,
Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброницка 1257, Кунратице,
148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии.
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066,
г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя
Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58.
info@spectrumnutrition.ru.

Дата изготовления: / Mfg date: 12.11.2019
Годен до: / Use before: 11.11.2024
Партия №: / LOT: 00IUUY80

открывать здесь



TENERiS®

ЛЕЙКОПЛАСТЫРИ
МЕДИЦИНСКИЕ
ФИКСИРУЮЩИЕ
НА ПОЛИМЕРНОЙ
ОСНОВЕ



15
ШТ

ЛЕЙКОПЛАСТЫРИ
ТЕНЕРИС

ЛЕЙКОПЛАСТЫРИ
ТЕНЕРИС

TENERiS®

TENERIS лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе. Размер: 7,6x1,9 см – 15 шт. Правила хранения: Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ №

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel: +420608196035 / Фармлайн 000, Доброница 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии. Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru



Дата изготовления: / Mfg date:

Годен до: / Use before:

Партия №: / LOT:

27.07.2021
26.07.2026
001UY80

ДОКТОР ПЛАСТ®

38 mm x 38 mm

Доктор Пласт лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе. Размер: 3,8x3,8 см – 1 шт. Правила хранения: Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ №

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброничка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии. Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.

Дата изготовления: / Mfg date:

12.11.2019

Годен до: / Use before:

11.11.2024

Партия №: / LOT:

POPLK12



открывать здесь

WELLFIX

38 mm x 38 mm

WELLFIX лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе. Размер: 3,8x3,8 см – 1 шт. Правила хранения: Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ №

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброничка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии. Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.

Дата изготовления: / Mfg date:

12.11.2019

Годен до: / Use before:


11.11.2024

Партия №: / LOT:

WEOTT42



открывать здесь





TENERiS®

CE
0123

ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА
МЕДИЦИНСКАЯ ФИКСИРУЮЩАЯ

**Стерильная
на нетканой основе**



STERILE EO

Дата изготовления / Mfg date:

Годен до: / Use before:

Lot: Партия №: / LOT:



TENERiS лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе. Размер: 6x7 см — 1 шт.

Назначение: для защиты послеоперационных и острых ран в процессе их заживления от вторичной инфекции и механических раздражений; для закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран.

Противопоказания: не использовать, если упаковка или изделие были повреждены или загрязнены. Не использовать, если изделие повреждено влагой или дымом. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Изделие предназначено для наружного применения. Не использовать по истечении срока годности (5 лет). Не использовать при индивидуальной непереносимости на компоненты, входящие в состав изделия. Заменить по необходимости или спустя 48 часов.

6x7 см

Состав: нетканая основа, впитывающая подушечка, пористая пленка, клеящий материал (гипоаллергенный), защитная бумага.

Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25 °C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Способ применения: вымыть руки перед использованием изделия, открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря. После извлечения лейкопластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей), приложить лейкопластырь к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.

Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

РУ № _____ от _____


Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel.: +420608196035 / «Фармлайн ООО», Доброничка 1257, Кунратиче, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035.

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.



Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035.
Сделано в Чехии. **Уполномоченный представитель на территории РФ:** ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.



MASTER UNI лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе.

Размер: диаметр 2,2 см – 1 шт.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Правила хранения: Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ № _____

Дата изготовления/Mfg date: 27.07.2021

Годен до:/Use before: 26.07.2026



Партия №:/LOT: MU001



открывать здесь



Дата изготовления/Mfg date: 27.07.2021
Годен до:/Use before: 26.07.2026
Партия №:/LOT: MU001

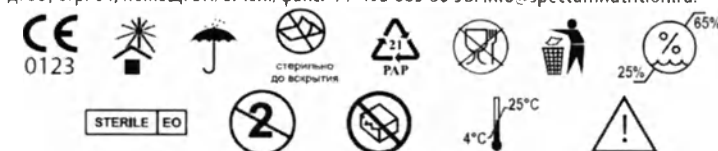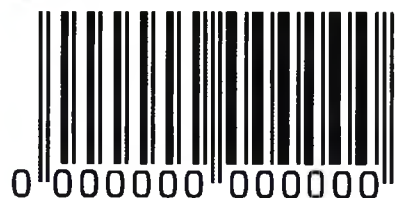

MASTER UNI лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе.

Размер: 4×1 см – 1 шт. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ № _____

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии. **Уполномоченный представитель на территории РФ:** ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.



открывать здесь

4×1 см

Ø2,2 см

143x17x153 mm

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

FIRST AID


FIRST AID

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕМ ДОМЕ

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ
НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

10 шт.

10 × 10 см

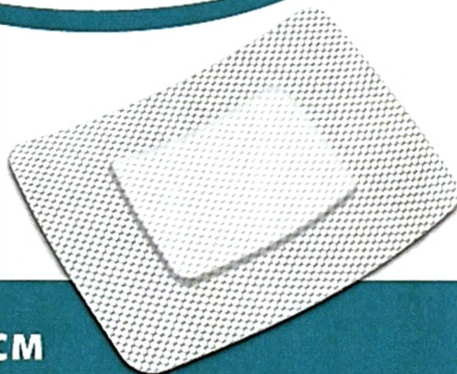

Мед. дата / Дата изготовления: 27.07.2021
Use before / Срок до: 26.07.2026
LOT / Лот: 1001

FIRST AID

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

FIRST AID

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ФИКСИРУЮЩИЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ



Firstaid лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе. Размер: 10х10 см – 10 шт.

Лейкопластырь медицинский фиксирующий предназначен для послеоперационной обработки ран и ухода за незначительными повреждениями кожи. Подходит для фиксации медицинских устройств (катетеров, датчиков, дренажных трубок и т.д.) и закрепления перевязочных средств.

Правила хранения: Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

Производитель: PharmaLine s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic.
Tel: +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброничка 1257, Мунратиче, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел: +4 20608196035. Сделано в Чехии.
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Никитиня Красносельская, д.35, стр.64, помещ. 3Н/6. Тел/факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.

РУ № _____
OF _____






Уполномоченный представитель на территории РФ ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58, info@spectrumnutrition.ru.



LOT LOT: /Партия №:







TENERiS®

ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА
МЕДИЦИНСКАЯ ФИКСИРУЮЩАЯ

**Стерильная
на нетканой основе**



STERILE EO

Mfg date: /Дата изготовления:

Use before: /Годен до:

LOT: /Партия №:



TENERiS лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе. Размер: 8x10 см – 1 шт.
Назначение: для защиты постоперационных и острых ран в процессе их заживления от вторичной инфекции и механических раздражений; для закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран.
Противопоказания: не использовать, если упаковка или изделие были повреждены или загрязнены. Не использовать, если изделие повреждено влагой или дымом. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Изделие предназначено для наружного применения. Не использовать по истечении срока годности (5 лет). Не использовать при индивидуальной непереносимости на компоненты, входящие в состав изделия. Заменить по необходимости или спустя 48 часов.

8x10 см

Состав: нетканая основа, впитывающая подушечка, пористая пленка, клеящий материал (гипоаллергенный), защитная бумага.

Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.


Способ применения: вымыть руки перед использованием изделия, открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря. После извлечения лейкопластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей), приложить лейкопластырь к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.

Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

РУ № _____ от _____

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel: +420608196035 / «Фармлайн ООО», Доброничка 1257, Кунратиче, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035.


Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.



TENERiS®

ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА
МЕДИЦИНСКАЯ ФИКСИРУЮЩАЯ

**Стерильная
на нетканой основе**

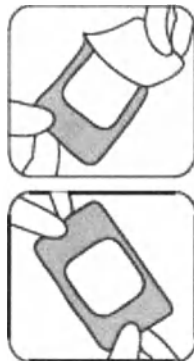

TENERiS лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе. Размер: 8x15 см – 1 шт.

Назначение: для защиты послеоперационных и острых ран в процессе их заживления от вторичной инфекции и механических раздражений; для закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран.

Противопоказания: не использовать, если упаковка или изделие были повреждены или загрязнены. Не использовать, если изделие повреждено влагой или дымом. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования.

Изделие предназначено для наружного применения.

Не использовать по истечении срока годности (5 лет).

Не использовать при индивидуальной непереносимости на компоненты, входящие в состав изделия. Заменить по необходимости или спустя 48 часов.

8x15 см

STERILE EO



Mfg date/Дата изготовления:

Use before/Использовать до:

LOT/Партия №:



Состав: нетканая основа, впитывающая подушечка, пористая пленка, клеящий материал (гипоаллергенный), защитная бумага.

Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Способ применения: вымыть руки перед использованием изделия, открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря. После извлечения лейкопластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей), приложить лейкопластырь к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.

Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным.

Отпускается без рецепта. Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

РУ № _____ от _____

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel: +420608196035 / «Фармлайн ООО», Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035.

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru

cm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TENERiS®

ПОВЯЗКА

ПЛАСТЫРНОГО ТИПА
МЕДИЦИНСКАЯ ФИКСИРУЮЩАЯ

Стерильная
на нетканой основе



TENERiS лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе. Размер: 10х15 см – 1 шт.
Назначение: для защиты послеоперационных и острых ран в процессе их заживления от вторичной инфекции и механических раздражений; для закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран.
Противопоказания: не использовать, если упаковка или изделие были повреждены или загрязнены. Не использовать, если изделие повреждено влагой или дымом. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Изделие предназначено для наружного применения. Не использовать по истечении срока годности (5 лет). Не использовать при индивидуальной непереносимости на компоненты, входящие в состав изделия. Заменить по необходимости или спустя 48 часов.

10х15 см

STERILE EO



Mfg date/Дата изготовления:

Use before/Срок годности:

Lot/Партия №:



Состав: нетканая основа, впитывающая подушечка, пористая пленка, клеящий материал (гипоаллергенный), защитная бумага.
Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.
Способ применения: вымыть руки перед использованием изделия, открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря. После извлечения лейкопластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей), приложить лейкопластырь к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.
Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным.
Отпускается без рецепта. Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21.

РУ № _____ от _____

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel: +420608196035 / «Фармлайн ООО», Доброничка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035.
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.

В приближении:

ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА
МЕДИЦИНСКАЯ ФИКСИРУЮЩАЯ

Стерильная
на нетканой основе



TENERIS®

ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА
МЕДИЦИНСКАЯ ФИКСИРУЮЩАЯ

Стерильная
на нетканой основе

TENERIS лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе. Размер: 10x20 см – 1 шт.



Назначение: для защиты постоперационных и острых ран в процессе их заживления от вторичной инфекции и механических раздражений; для закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран.

Противопоказания: не использовать, если упаковка или изделие были повреждены или загрязнены. Не использовать, если изделие повреждено влагой или дымом. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования.

Использование: предназначено для наружного применения. Не использовать по истечении срока годности (5 лет).

Не использовать при индивидуальной непереносимости на компоненты, входящие в состав изделия.

Заменить по необходимости или спустя 48 часов.

10x20 cm


Состав: нетканая основа, впитывающая подушка, пористая пленка, клеевый материал (гипоаллергенный), защитная бумага.

Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Способ применения: вымыть руки перед использованием изделия, открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря. После извлечения лейкопластыря из единичной упаковки, устроить перпендикулярно (бумагу, защищающую клеевую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей), приложить лейкопластырь к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.

Стерилизация: оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.


STERILE EO



Min date / Дата изготовления:

Use before / Примен до:

Lot / Лот / Партия №:




8 594202 460813

RU № _____ от _____

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronická 1257, Klatovice,
148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel.: +420608196035 / «Фармлайн ООО»,
Доброничка 1257, Клатовице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика.
Тел.: +420608196035.

Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, ул. Липовый лес, д. 3, стр. 64, помещ. 31/6,
Басманная ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 31/6.
Тел./факс: +7 495 665 665 80-58. info@spectrumnutrition.ru

STERILE EO



Min date / Дата изготовления:

Use before / Примен до:

Lot / Лот / Партия №:



8 594202 460813

RU № _____ от _____

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronická 1257, Klatovice,
148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel.: +420608196035 / «Фармлайн ООО»,
Доброничка 1257, Клатовице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика.
Тел.: +420608196035.

Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, ул. Липовый лес, д. 3, стр. 64, помещ. 31/6,
Басманная ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 31/6.
Тел./факс: +7 495 665 665 80-58. info@spectrumnutrition.ru



ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА
МЕДИЦИНСКАЯ ФИКСИРУЮЩАЯ

Стерильная
на нетканой основе

10x35 см

Состав нетканая основа, неэластичная подложка, пористая пленка, клеевый материал (полиакриловый), гидрофобная бумага. Применяется для фиксации повязки на теле, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 85%, в недоступном для детей месте.

Способ применения: в месте нанесения повязки, стерильную подложку оторвать от основы нетканого гидрогеля. После нанесения гидрогеля на поверхность кожи, устранив пузырьки воздуха, прижать гидрогель к коже. Сторону нетканой основы повязки, которая непосредственно соприкасается с кожей, приложить гидрогеля к ране и легко прижать края гидрогеля к коже вокруг раны. Осторожно оторвать пленку. Не наносить влажносточивые. Осторожно высушить. Утилизировать в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21.

STERILE EO

ISO 13485

ISO 9001

ISO 14001

РПН _____ от _____

Промышленные: ПромЛиния, ООО, Калужская обл., 148 80 Рязань 4, Свободный. Тел. +426887 8405 / 840600000, Дзержинский 1257, Калужская 148 80 Рязань 4, Чкаловский 148 80 Рязань 4, Чкаловский 148 80 Рязань 4.

Тел. +426887 8405.


Упаковка: 10 шт. в коробе.


ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д.35, стр. 64, помещ. 38/1/6, Тел. +7 (495) 665-80-58, info@spectrumnutrition.ru

8 594202 464644


25

Макеты маркировки промежуточной упаковки (middle box), образец

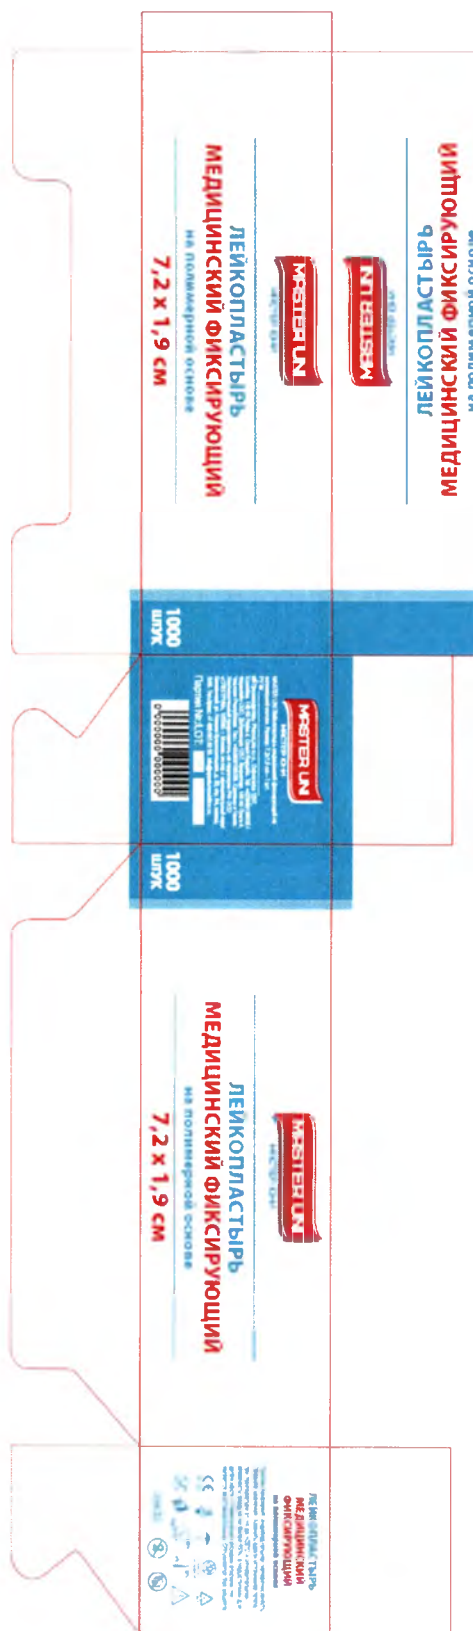

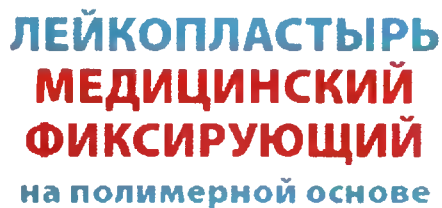

Противопоказания: индивидуальная непереносимость
Правила хранения: Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°С и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

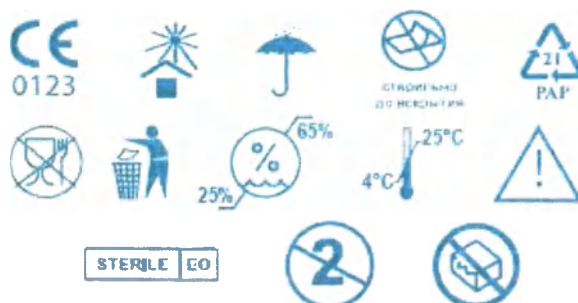





MASTER UNI Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе.
 Размер: 6,5 x 2,5 см – 10 шт.

Правила хранения: Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4° до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.



Макеты маркировки транспортной упаковки, образец

**TENERIS лейкопластырь
медицинский фиксирующий
на нетканой основе.
Размер: 6x7 см – 1 шт.**

Non-woven medical adhesive plaster 6 x 7 cm, 1 pc
0211-049

TENERIS®

40 кор./boxes x 50 шт./pcs = 2000 шт./pcs

РУ № _____ от _____

■ **Производитель:** PharmLine s.r.o.,
Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha
4, Czech Republic. Tel. +420608196035 /
«Фармлайн ООО», Доброницка 1257,
Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская
Республика. Тел.: +420608196035.
**Уполномоченный представитель на
территории РФ:** ООО «СПЕКТРУМ»,
105066, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Басманный, ул.
Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64,
помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58.
info@spectrumnutrition.ru.

Дата изготовления:/Mfg date: 

Годен до:/Use before: 

Партия №:/LOT:

LOT



MASTER UNI
**Лейкопластырь медицинский
фиксирующий на полимерной основе.**
Размер: 6,5 x 2,5 см – 10 шт.
PE wound plaster
MASTER UNI
xxxx-xxx

MASTER UNI

МАСТЕР ЮНИ

10 кор./boxes x 1000 шт./pcs = 10 000 шт./pcs

РУ № _____ от _____

■ **Производитель:** PharmLine s.r.o.,
Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha
4, Czech Republic. Tel. +420608196035 /
«Фармлайн ООО», Доброницка 1257,
Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская
Республика. Тел.: +420608196035.
**Уполномоченный представитель на
территории РФ:** ООО «СПЕКТРУМ»,
105066, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Басманный, ул.
Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64,
помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58.
info@spectrumnutrition.ru.

Дата изготовления:/Mfg date: 


Годен до:/Use before: 

Партия №:/LOT:

LOT



Фотографические изображения медицинского изделия

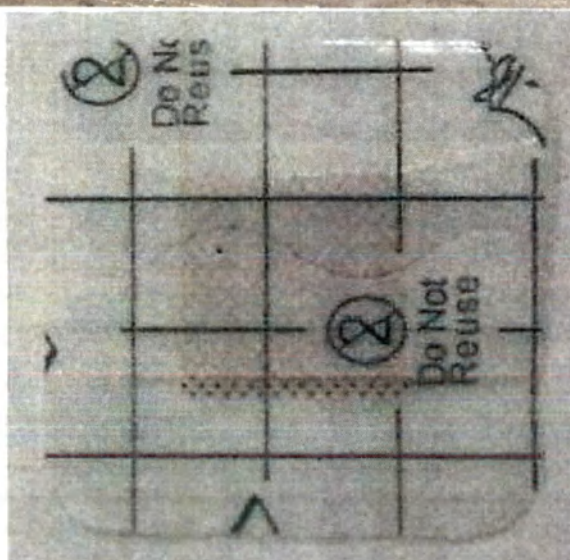

6,5x2,5 см

MASTER UNI
МАСТЕР ЮНИ

Дата изготовления/Mfg date: 12.11.2019
Искрен до/Use before: 11.11.2024
Партия №/LOT: RYTFW02



0 000000 000000

MASTER UNI лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе. Размер: 6,5x2,5 см – 1 шт. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Отпускается без рецепта. Не является восстановленным. Стерилизация оксидом этилена. РУ № _____

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel.: +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброничка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии. Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. Info@spectrumnutrition.ru.

CE 0123

STERILE EO



2



25°C

65%

!

открывать здесь

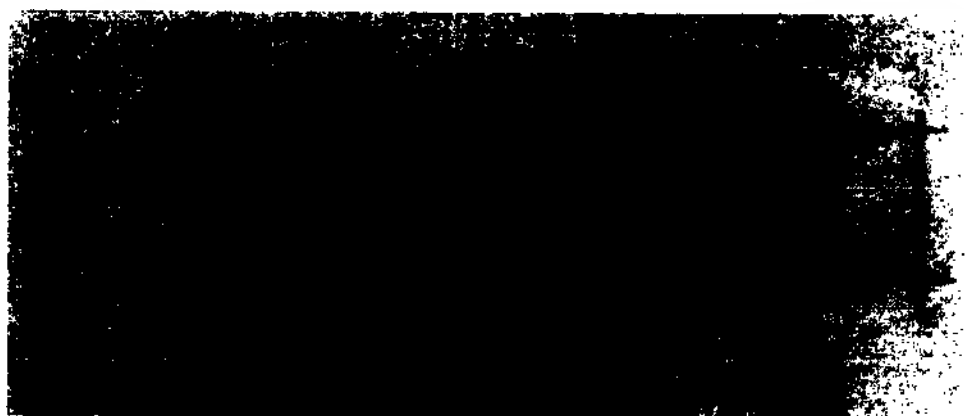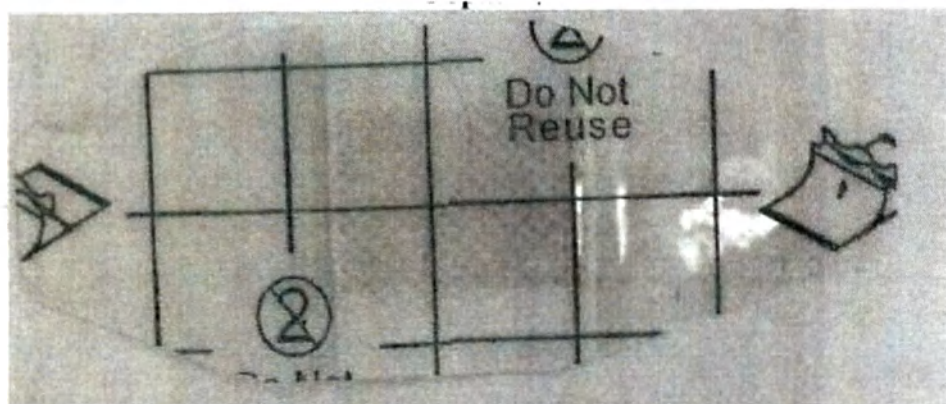

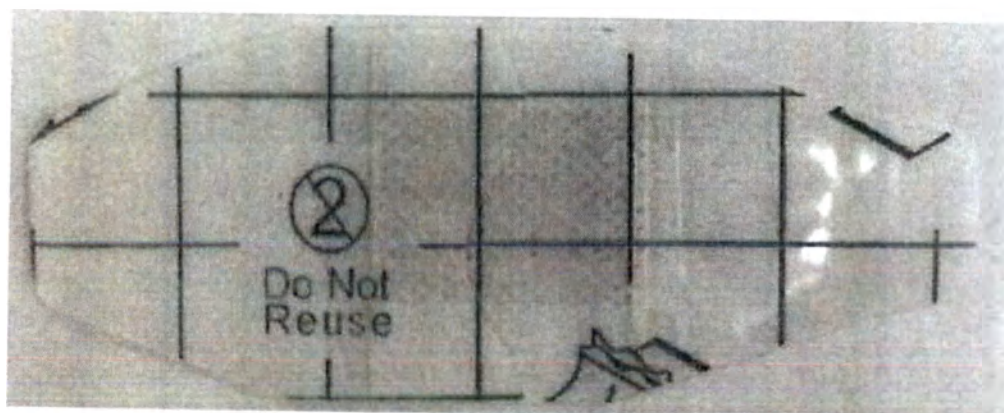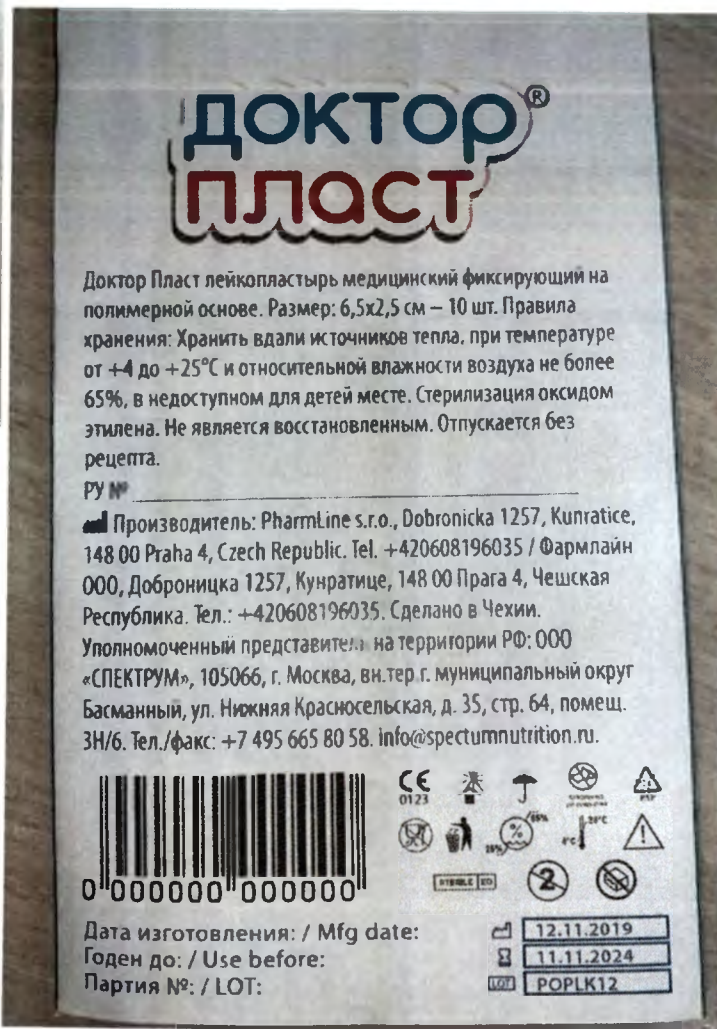

65 mm x 25 mm



Еconta лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе.
Размер: 6,5х2,5 см – 1 шт. Правила хранения: Хранить вдали от источников
тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности
воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация
оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.
РУ №

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice,
148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО,
Доброничка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика.
Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии.
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ»,
105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул.
Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс:
+7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.

Дата изготовления: / Mfg date: 12.11.2019
Годен до: / Use before: 11.11.2024
Партия №: / LOT: QROLB30

открывать здесь

65 mm x 25 mm

WELLFIX




WELLFIX лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе.
Размер: 6,5х2,5 см – 1 шт. Правила хранения: Хранить вдали от источников
тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха
не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом
этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.
РУ №

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice,
148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО,
Доброничка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика.
Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии.
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ»,
105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный,
ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс:
+7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.

Дата изготовления: / Mfg date: 12.11.2019
Годен до: / Use before: 11.11.2024
Партия №: / LOT: WE01T42

открывать здесь

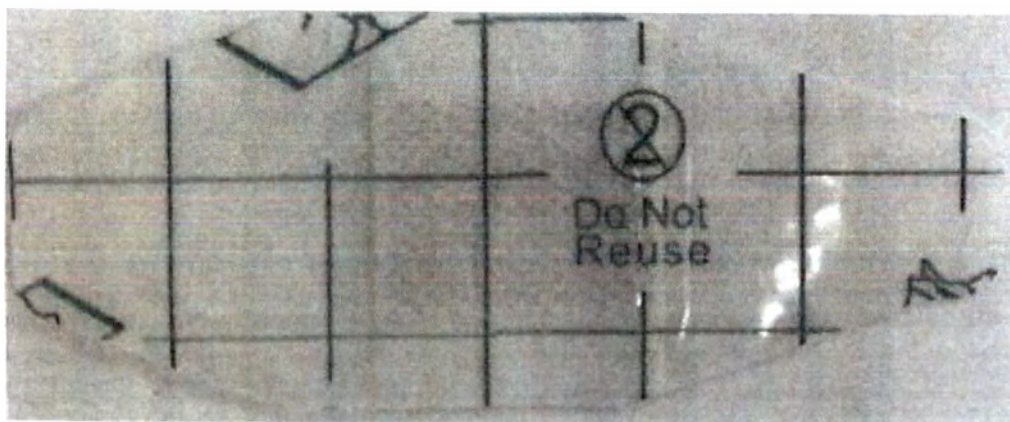

MASTER UNI

МАСТЕР ЮНИ

Производитель: PharmLine s.r.o.,
Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha
4, Czech Republic. Tel. +420608196035 /
Фармлайн ООО, Доброница 1257,
Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская
Республика. Тел.: +420608196035.
Сделано в Чехии. **Уполномоченный
представитель на территории РФ:**
ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ
Басманный, ул. Нижняя Красносельская,
д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс:
+7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.



STERILE EO

CE
0123



стерильно
до вскрытия



Дата изготовления: /Mfg date: 27.07.2021
Годен до: /Use before: 26.07.2026
Партия №: /LOT: RYTFW02

**MASTER UNI лейкопластырь
медицинский фиксирующий на
полимерной основе.**

Размер: диаметр 2,2 см – 1 шт.


Противопоказания: индивидуальная
непереносимость.

Правила хранения: Хранить вдали
источников тепла, при температуре от
+4 до +25°C и относительной
влажности воздуха не более 65%,
в недоступном для детей месте.
Стерилизация оксидом этилена.
Не является восстановленным.
Отпускается без рецепта.

РУ № _____



открывать здесь

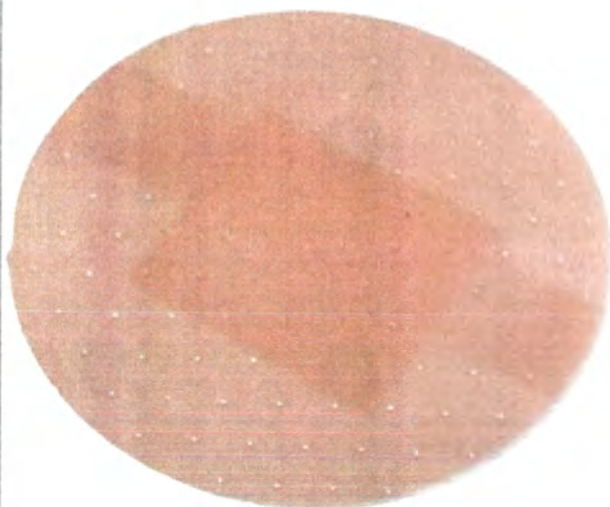



TENERiS®

TENERIS лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе. Размер: 7,6х1,9 см – 15 шт. Правила хранения: Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.


РУ № _____

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.

Дата изготовления: / Mfg date: 27.07.2021
Годен до: / Use before: 26.07.2026
Партия №: / LOT: QOHUY80

CE 0123, ISO 13485, and other regulatory symbols.

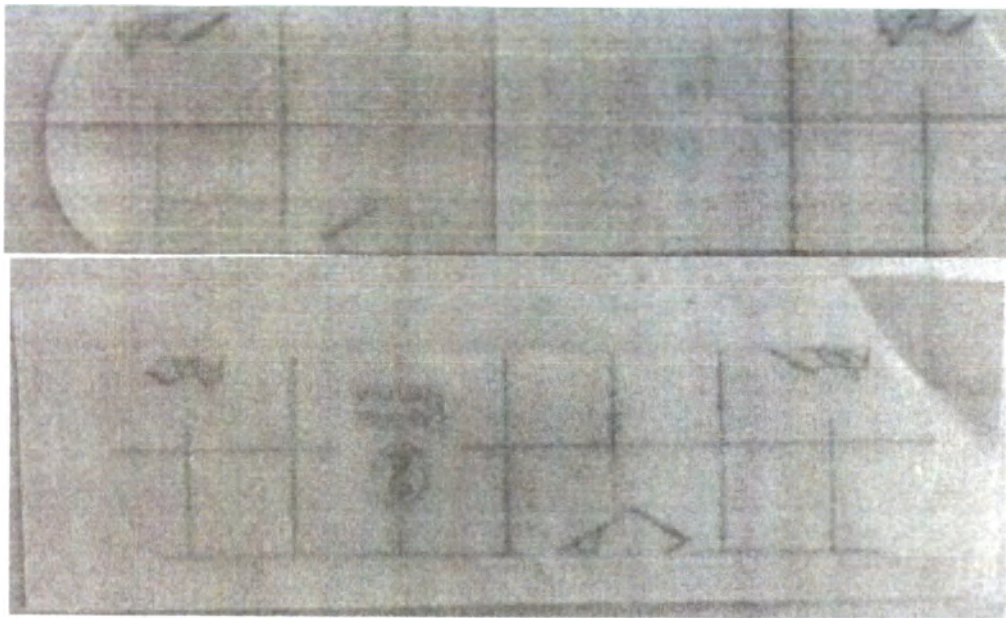

60 mm x 80 mm

TENERIS[®]

T-PORE

TENERIS лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе.
Размер: 6x8 см – 1 шт. Правила хранения: Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.
РУ № _____

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic.
Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброница 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии.
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.

Дата изготовления: / Mfg date:
Годен до: / Use before:
Партия №: / LOT:


06.05.2021
05.05.2026
OOIUY81

CE 0123
STERILE EO
2

0 000000 000000

открывать здесь





Стерильная
на нетканой основе



10x25 cm

Способ применения: вымыть руки перед использованием изделия, открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря. После извлечения лейкопластыря из единичной упаковки, устроить перпендикулярно обертку (бумагу, защищающую клеющую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей), приложить лейкопластырь к ране и легко прижать край лейкопластыря к коже вокруг раны.

Стерилизовать оксидом этилена. Не является восстановленным.

Отсутствует без рецепта. Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3.684-21.

[LOT] LOT:Партыя №:



TENERIS®

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии. **Уполномоченный представитель на территории РФ:** ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.

TENERIS лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе.
Размер: диаметр 2,2 см – 1 шт.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.
Правила хранения: Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.
РУ № _____

Дата изготовления/Mfg date: 27.07.2021
Годен до/Use before: 26.07.2026
Партия №/LOT: 001UY81

0 000000 000000

STERILE EO 0123

CE 0123

ПАП

25% 65%

4°C 25°C

открывать здесь

TENERIS®

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии. **Уполномоченный представитель на территории РФ:** ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.

TENERIS лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе.
Размер: 7,2x1,9 см – 1 шт. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.
РУ № _____

Дата изготовления/Mfg date: 27.07.2021
Годен до/Use before: 26.07.2026
Партия №/LOT: 001UY81

0 000000 000000

STERILE EO 0123


CE 0123

ПАП

25% 65%



4°C 25°C

открывать здесь

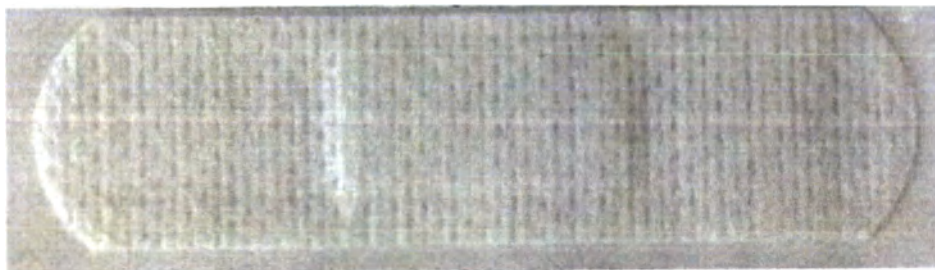

FIRST AID

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

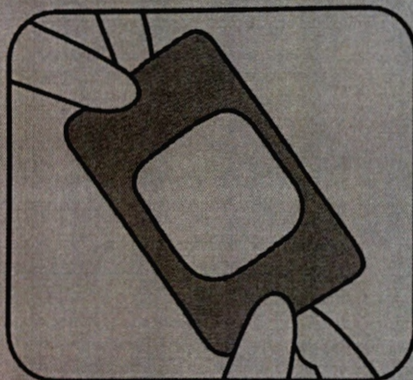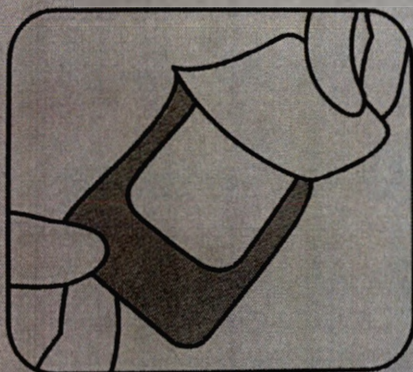

Firstaid лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе. Размер: 10x10 см – 10 шт.


Лейкопластырь медицинский фиксирующий предназначен для послеоперационной обработки ран и ухода за незначительными повреждениями кожи. Подходит для фиксации медицинских устройств (катетеров, датчиков, дренажных трубок и т.д.) и закрепления перевязочных средств.

Правила хранения: Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic.
Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии.
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.


РУ № _____
от _____ г.



Mfg date:/Дата изготовления: 27.07.2021
 Use before:/Годен до: 26.07.2026
 LOT/Партия №: F1001

FIRST AID

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В ВАШЕМ ДОМЕ

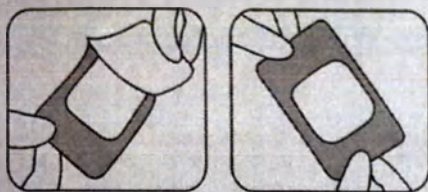

Производитель: PharmLine s.r.o.,
Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4,
Czech Republic. Tel. +420608196035 /
Фармлайн ООО, Доброничка 1257,
Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская
Республика. Тел.: +420608196035.
Сделано в Чехии. **Уполномоченный
представитель на территории РФ:**
ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ
Басманный, ул. Нижняя Красносельская,
д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс:
+7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.



**Firstaid лейкопластырь медицинский
фиксирующий на тканевой основе.**

Размер: 10×10 см – 1 шт.

Показания: лейкопластырь медицинский
фиксирующий предназначен для послеопераци-
онной обработки ран и ухода за незначительными
повреждениями кожи. Подходит для фиксации
медицинских устройств (катетеров, датчиков,
дренажных трубок и т.д.) и закрепления
перевязочных средств.

Применение: вымойте руки, очистите и
высушите рану и кожу вокруг, не прикасаясь к
сорбционной подушечке пальцами, приложите
лейкопластырь на поврежденную поверхность
кожи, плотно прижмите края, не допуская
складок. Меняйте ежедневно. Не использовать
повторно.

Противопоказания: индивидуальная
непереносимость.

Правила хранения: Хранить вдали источников
тепла, при температуре от +4 до +25°C и
относительной влажности воздуха не более 65%,
в недоступном для детей месте. Отпускается без
рецепта. Не является восстановленным.
Стерилизация оксидом этилена.

РУ № _____

Дата изготовления:/Mfg date: 27.07.2021

Годен до:/Use before: 26.07.2026

Партия №:/LOT: F1001

открывать здесь

10×10 см



MASTER UNI

МАСТЕР ЮНИ

📅 Дата изготовления/Mfg date: 27.07.2021

📅 Годен до/Use before: 26.07.2026

📦 Партия №/LOT: MU001



MASTER UNI лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе. Размер: 6x2 см – 1 шт. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Отпускается без рецепта. Не является восстановленным. Стерилизация оксидом этилена. **РУ №** _____

🏭 **Производитель:** PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel.: +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии.

👤 **Уполномоченный представитель на территории РФ:** ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.



0123

стерильно до вскрытия

РАР

25%

65%

4°C - 25°C

4°C

!

STERILE EO



открывать здесь



7,2x1,9 cm



MASTER UNI
МАСТЕР ЮНИ

Дата изготовления:/Mfg date: 27.07.2021
 Годен до:/Use before: 26.07.2026
 Партия №:/LOT: MU001



0 000000 000000

MASTER UNI лейкопластырь медицинский фиксирующий на тканевой основе. Размер: 7,2x1,9 см – 1 шт. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. **Правила хранения:** Хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ №

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel: +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброничка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.

открывать здесь






















PY №

Партия №: / LOT:




00000000000000



открывать здесь

открывать здесь

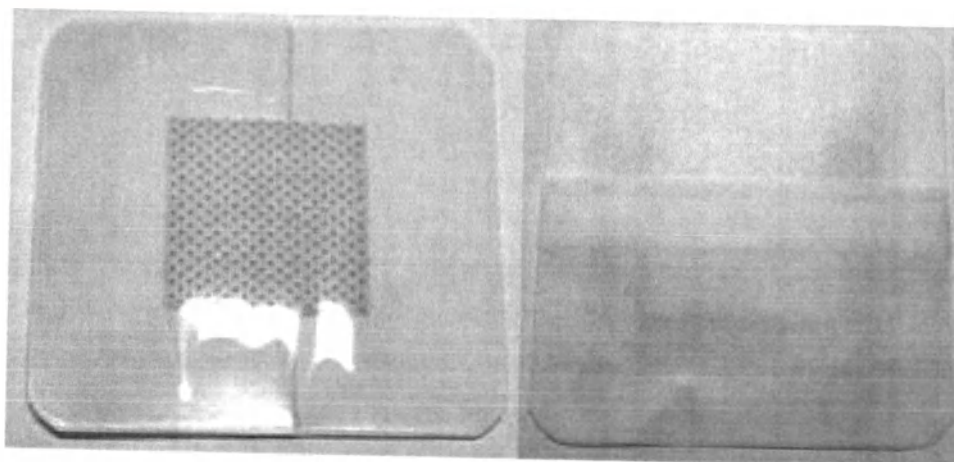

WELLFIX

WELLFIX лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной основе. Размер: 3,8х3,8 см – 1 шт. Правила хранения: Хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта.

РУ № _____

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronicka 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / Фармлайн ООО, Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Сделано в Чехии. Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.

Дата изготовления: / Mfg date:

12.11.2019

Годен до: / Use before:


11.11.2024

Партия №: / LOT:

WEOTT42



открывать здесь

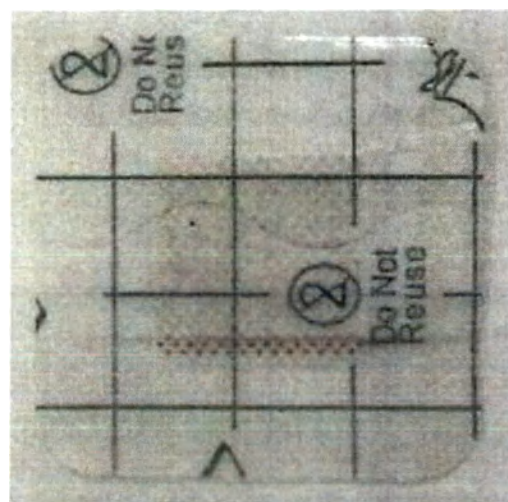







TENERIS®

CE
0123

ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА
МЕДИЦИНСКАЯ ФИКСИРУЮЩАЯ

**Стерильная
на нетканой основе**

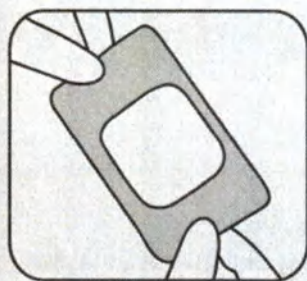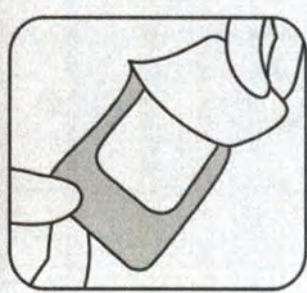

STERILE EO

Дата изготовления:/Mfg date:

Годен до:/Use before:


Партия №:/LOT:




TENERIS лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе. Размер: 6x7 см — 1 шт.
Назначение: для защиты послеоперационных и острых ран в процессе их заживления от вторичной инфекции и механических раздражений; для закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран.
Противопоказания: не использовать, если упаковка или изделие были повреждены или загрязнены. Не использовать, если изделие повреждено влагой или дымом. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Изделие предназначено для наружного применения. Не использовать по истечении срока годности (5 лет). Не использовать при индивидуальной непереносимости на компоненты, входящие в состав изделия. Заменить по необходимости или спустя 48 часов.

6x7 см

Состав: нетканая основа, впитывающая подушечка, пористая пленка, клеящий материал (гипоаллергенный), защитная бумага.
Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.
Способ применения: вымыть руки перед использованием изделия, открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря. После извлечения лейкопластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей), приложить лейкопластырь к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.
Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.
РУ № _____ от _____
Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / «Фармлайн ООО», Доброничка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035.
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.


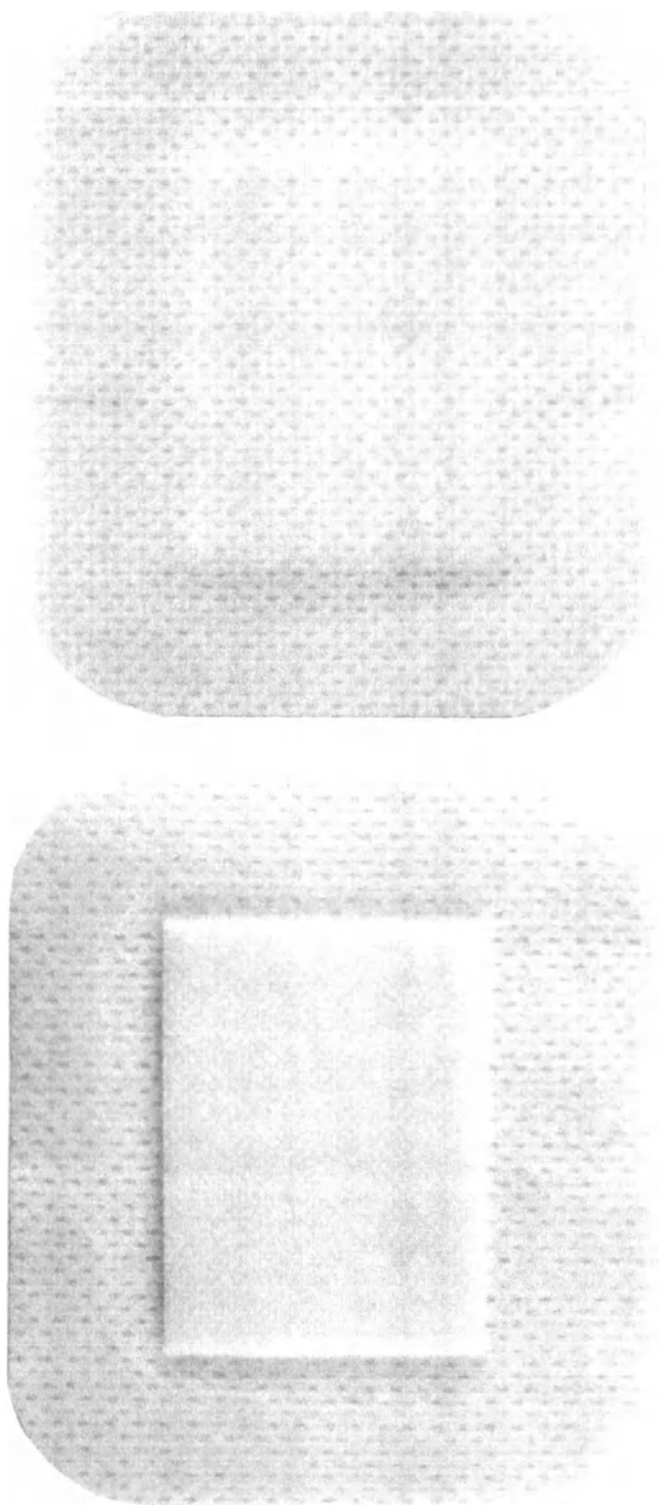




TENERIS®

ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА
МЕДИЦИНСКАЯ ФИКСИРУЮЩАЯ

*Стерильная
на нетканой основе*



STERILE EO

Mfg date:/Дата изготовления:

Use before:/Годен до:

LOT/Партия №:



8 594202 460691

TENERIS лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе. Размер: 8x10 см – 1 шт.
Назначение: для защиты постоперационных и острых ран в процессе их заживления от вторичной инфекции и механических раздражений; для закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран.

Противопоказания: не использовать, если упаковка или изделие были повреждены или загрязнены. Не использовать, если изделие повреждено влагой или дымом. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Изделие предназначено для наружного применения. Не использовать по истечении срока годности (5 лет). Не использовать при индивидуальной непереносимости на компоненты, входящие в состав изделия. Заменить по необходимости или спустя 48 часов.

8x10 см

Состав: нетканая основа, впитывающая подушечка, пористая пленка, клеящий материал (гипоаллергенный), защитная бумага.

Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.



Способ применения: вымыть руки перед использованием изделия, открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря. После извлечения лейкопластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей), приложить лейкопластырь к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.

Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

РУ № _____ от _____

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Тел.: +420608196035 / «Фармлайн ООО», Доброничка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035.

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.

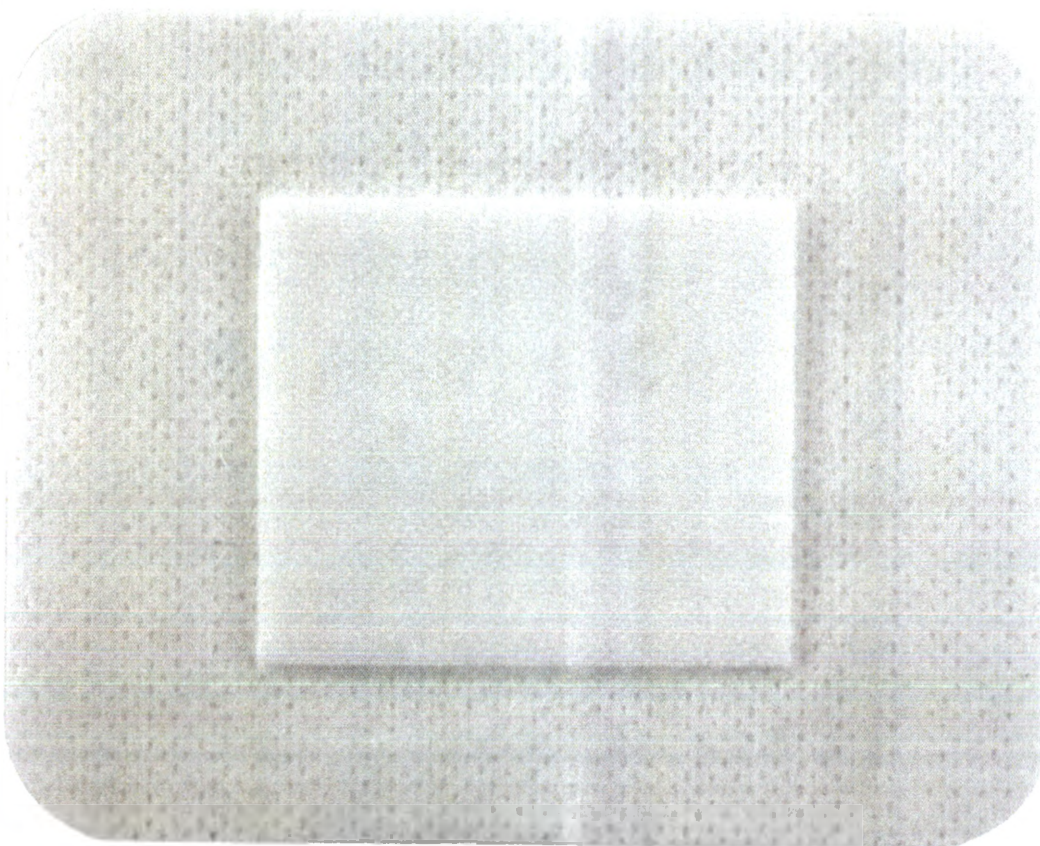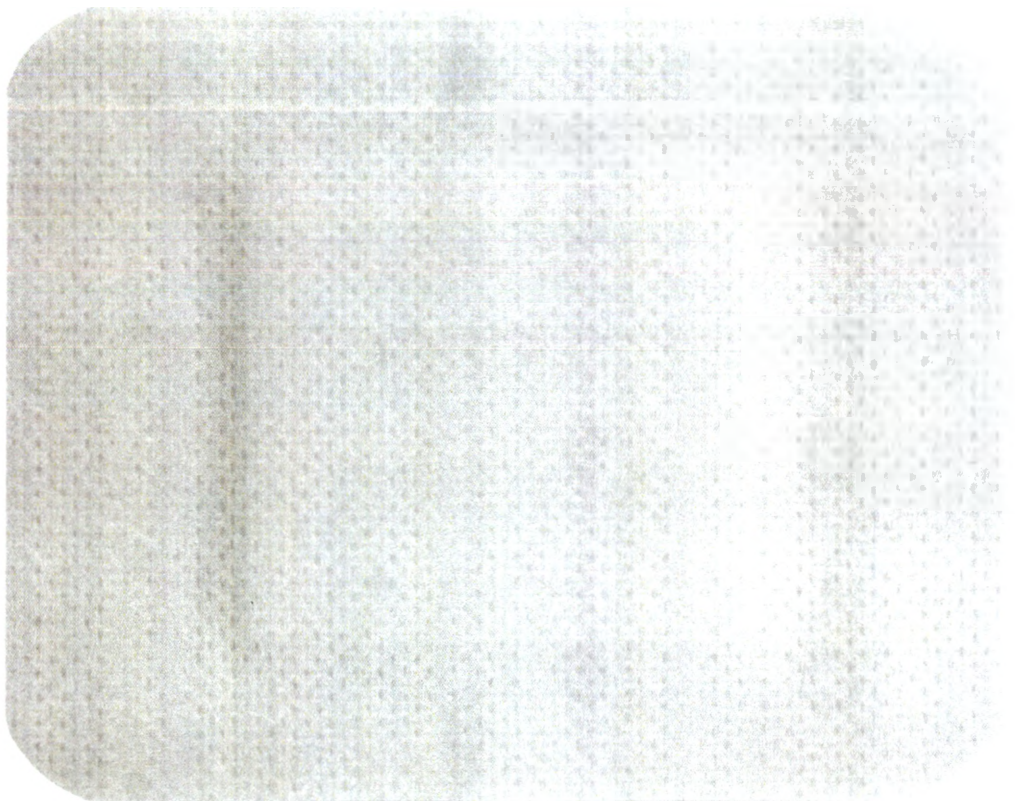




TENERiS®

ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА
МЕДИЦИНСКАЯ ФИКСИРУЮЩАЯ

**Стерильная
на нетканой основе**

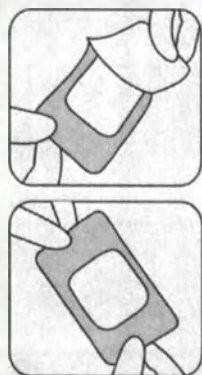


TENERiS лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе. Размер: 8x15 см – 1 шт.

Назначение: для защиты послеоперационных и острых ран в процессе их заживления от вторичной инфекции и механических раздражений; для закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран.

Противопоказания: не использовать, если упаковка или изделие были повреждены или загрязнены. Не использовать, если изделие повреждено влагой или дымом. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Изделие предназначено для наружного применения. Не использовать по истечении срока годности (5 лет). Не использовать при индивидуальной непереносимости на компоненты, входящие в состав изделия. Заменить по необходимости или спустя 48 часов.

8x15 см

STERILE EO



Mfg date:/Дата изготовления:

Use before:/Годен до:

LOT/Партия №:



Состав: нетканая основа, впитывающая подушечка, пористая пленка, клеящий материал (гипоаллергенный), защитная бумага.

Правила хранения: хранить вдали источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.


Способ применения: вымыть руки перед использованием изделия, открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря. После извлечения лейкопластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей), приложить лейкопластырь к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.

Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

РУ № _____ от _____

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel: +420608196035 / «Фармлайн ООО», Доброница 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел: +420608196035.

Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6.
Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.


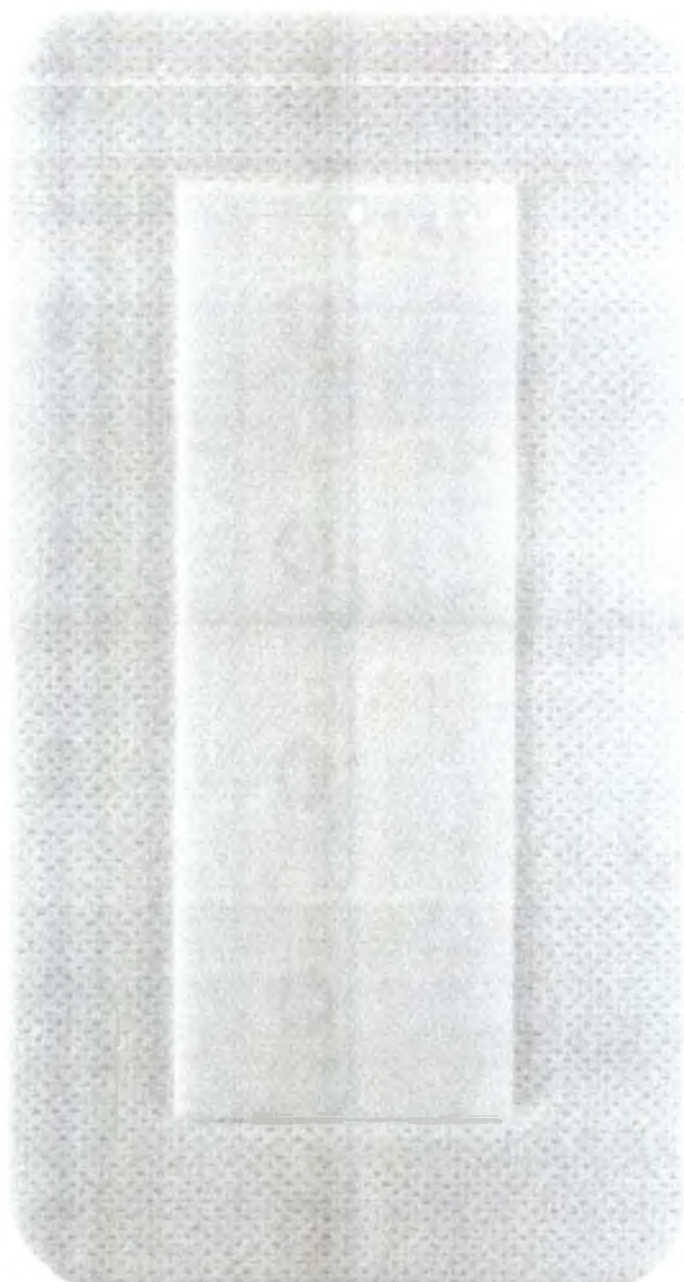




TENERiS®

ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА
МЕДИЦИНСКАЯ ФИКСИРУЮЩАЯ

Стерильная
на нетканой основе



TENERiS лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе. Размер: 10×15 см — 1 шт.

Назначение: для защиты послеоперационных и острых ран в процессе их заживления от вторичной инфекции и механических раздражений; для закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран.

Противопоказания: не использовать, если упаковка или изделие были повреждены или загрязнены. Не использовать, если изделие повреждено влагой или дымом. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Изделие предназначено для наружного применения. Не использовать по истечении срока годности (5 лет). Не использовать при индивидуальной непереносимости на компоненты, входящие в состав изделия. Заменить по необходимости или спустя 48 часов.

10×15 см

Состав: нетканая основа, впитывающая подушечка, пористая пленка, клеевый материал (гипоаллергенный), защитная бумага.

Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.


Способ применения: вымыть руки перед использованием изделия, открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря. После извлечения лейкопластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеевую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей), приложить лейкопластырь к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.

Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

РУ № _____ от _____

■ **Производитель:** PharmLine s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Тел.: +420608196035 / «Фармлайн ООО», Доброница 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035.

Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.



STERILE EO




Mfg date:/Дата изготовления:

Use before:/Годен до:

LOT/Партия №:



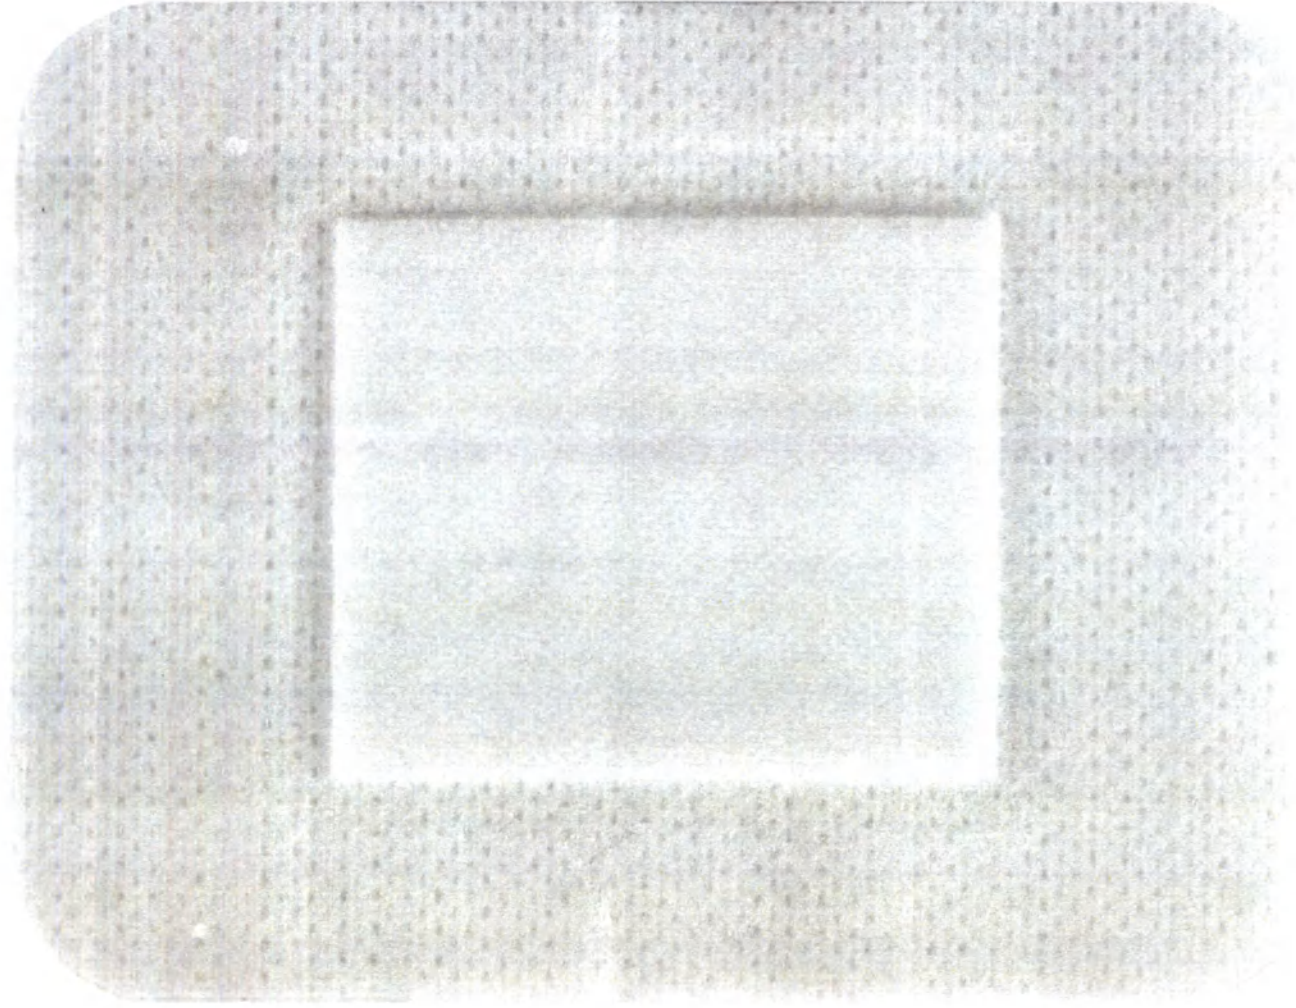



TENERiS®

ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА
МЕДИЦИНСКАЯ ФИКСИРУЮЩАЯ

*Стерильная
на нетканой основе*



TENERiS лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе. Размер: 10x20 см – 1 шт.

Назначение: для защиты послеоперационных и острых ран в процессе их заживления от вторичной инфекции и механических раздражений; для закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран.

Противопоказания: не использовать, если упаковка или изделие были повреждены или загрязнены. Не использовать, если изделие повреждено влагой или дымом. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Изделие предназначено для наружного применения. Не использовать по истечении срока годности (5 лет). Не использовать при индивидуальной непереносимости на компоненты, входящие в состав изделия.

Заменить по необходимости или спустя 48 часов.


10x20 см

Состав: нетканая основа, впитывающая подушечка, пористая пленка, клеящий материал (гипоаллергенный), защитная бумага.

Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.

Способ применения: вымыть руки перед использованием изделия, открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря. После извлечения лейкопластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеящую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей), приложить лейкопластырь к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны. Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3.684-21.

STERILE EO



Mfg date: /Дата изготовления

Use before: /Годен до:

LOT: /Партия №



РУ № _____ от _____

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice,
148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel: +420608196035 / «Фармлайн ООО»,
Доброничка 1257, Кунратиче, 148 00 Прага 4, Чешская Республика.
Тел: +420608196035.

Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6.
Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru

TENERiS®

ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА
МЕДИЦИНСКАЯ ФИКСИРУЮЩАЯ

Стерильная
на нетканой основе




TENERiS лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе. Размер 10x30 см — 1 шт.
Назначение: для защиты послеоперационных и острых ран в процессе их заживления от вторичной инфекции и механических раздражений; для закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран.
Противопоказания: не использовать, если упаковка или изделие были повреждены или загрязнены. Не использовать, если изделие повреждено влагой или дыном. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Изделие предназначено для наружного применения. Не использовать по истечении срока годности (5 лет). Не использовать при индивидуальной непереносимости на компоненты, входящие в состав изделия. Заменить по необходимости или спустя 48 часов.

10x30 см

Состав: нетканая основа, впитывающая подушечка, пористая пленка, клеевый материал (гипоаллергенный), защитная бумага.
Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.
Способ применения: вымыть руки перед использованием изделия, открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря. После извлечения лейкопластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеевую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей), приложить лейкопластырь к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.
Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3.684-21.

STERILE EO



My date / Дата изготовления

Use before / Перед тем как

LOT / Лот №

РУ № _____ от _____
Производитель: PharmLine s.r.o., Dobroně 1257, Kunovice
148 00 Praha 4 Czech Republic. Tel: +420208196015 / «Фармайн» ООО,
Добронолька 1257, Кунувце, 148 00 Прага 4, Чешская Республика.
Тел: +420208196015
Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6.
Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru



8 594202 460875

TENERiS®

ПОВЯЗКА
ПЛАСТЫРНОГО ТИПА
МЕДИЦИНСКАЯ ФИКСИРУЮЩАЯ

Стерильная
на нетканой основе



TENERiS лейкопластырь медицинский фиксирующий на нетканой основе. Размер 10x35 см — 1 шт.
Назначение: для защиты послеоперационных и острых ран в процессе их заживления от вторичной инфекции и механических раздражений; для закрепления перевязочных средств, медицинских приспособлений и сведения краев кожных ран.
Противопоказания: не использовать, если упаковка или изделие были повреждены или загрязнены. Не использовать, если изделие повреждено влагой или дымом. Использовать сразу же после вскрытия упаковки и утилизировать изделие после использования. Изделие предназначено для наружного применения. Не использовать по истечении срока годности (5 лет). Не использовать при индивидуальной непереносимости на компоненты, входящие в состав изделия. Заменить по необходимости или спустя 48 часов.

10x35 см

Состав: нетканая основа, впитывающая подушечка, пористая пленка, клеевый материал (гипоаллергенный), защитная бумага.
Правила хранения: хранить вдали от источников тепла, при температуре от +4 до +25°C и относительной влажности воздуха не более 65%, в недоступном для детей месте.
Способ применения: вымыть руки перед использованием изделия, открыть индивидуальную упаковку единичного лейкопластыря. После извлечения лейкопластыря из единичной упаковки, устранить первичную обертку (бумагу, защищающую клеевую сторону лейкопластыря, которая непосредственно соприкасается с кожей), приложить лейкопластырь к ране и легко прижать края лейкопластыря к коже вокруг раны.
Стерилизация оксидом этилена. Не является восстановленным. Отпускается без рецепта. Утилизация в соответствии с СанПин 2.1.3.684-21.

STERILE EO



My date / Дата изготовления



Use before / Перед тем как

LOT / Лот №

РУ № ПЗН 2023/0014 от 06.04.2021 г.
Производитель: PharmLine s.r.o., Dobroně 1257, Kunovice
148 00 Praha 4 Czech Republic. Tel: +420208196015 / «Фармайн» ООО,
Добронолька 1257, Кунувце, 148 00 Прага 4, Чешская Республика.
Тел: +420208196015
Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6.
Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru



8 594202 466444

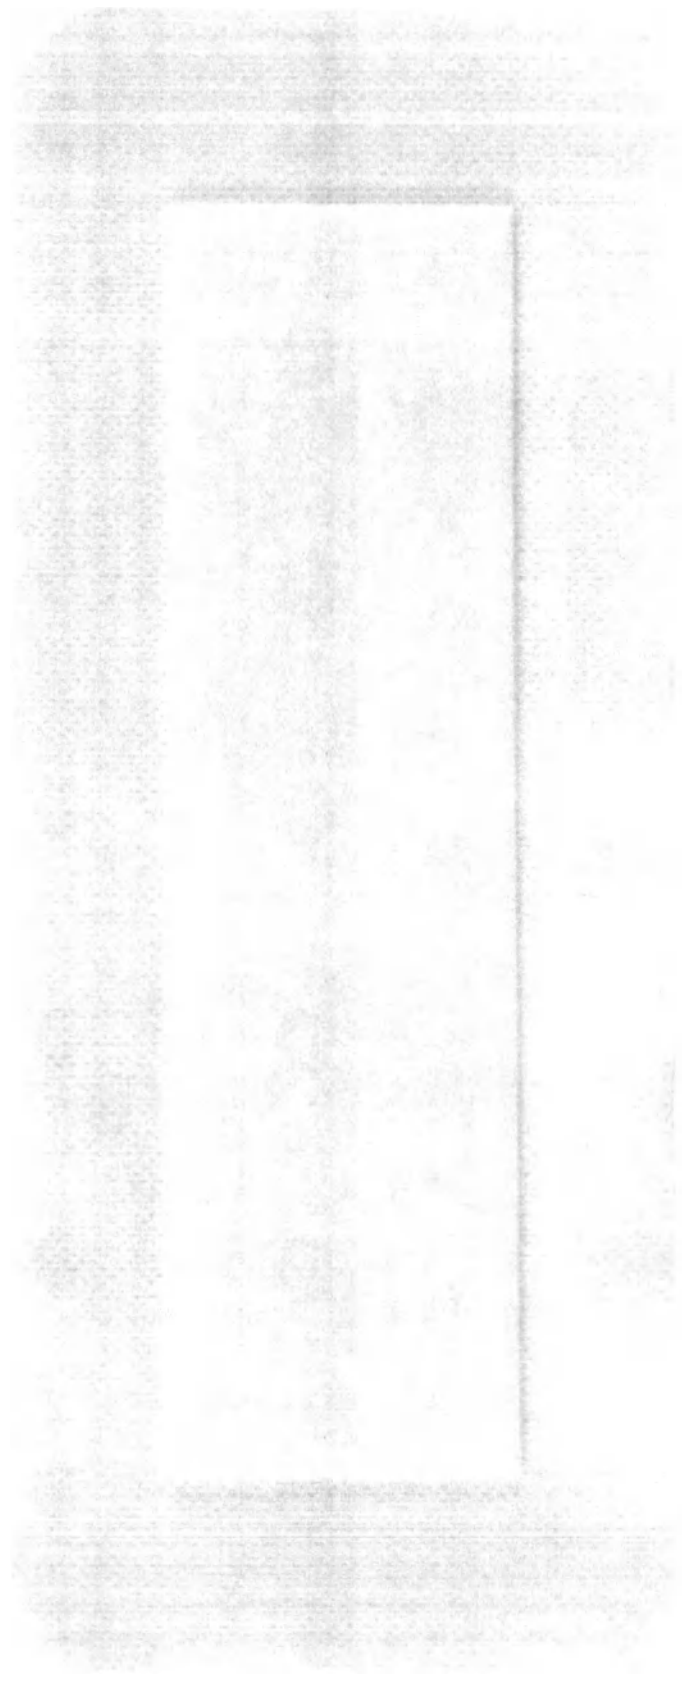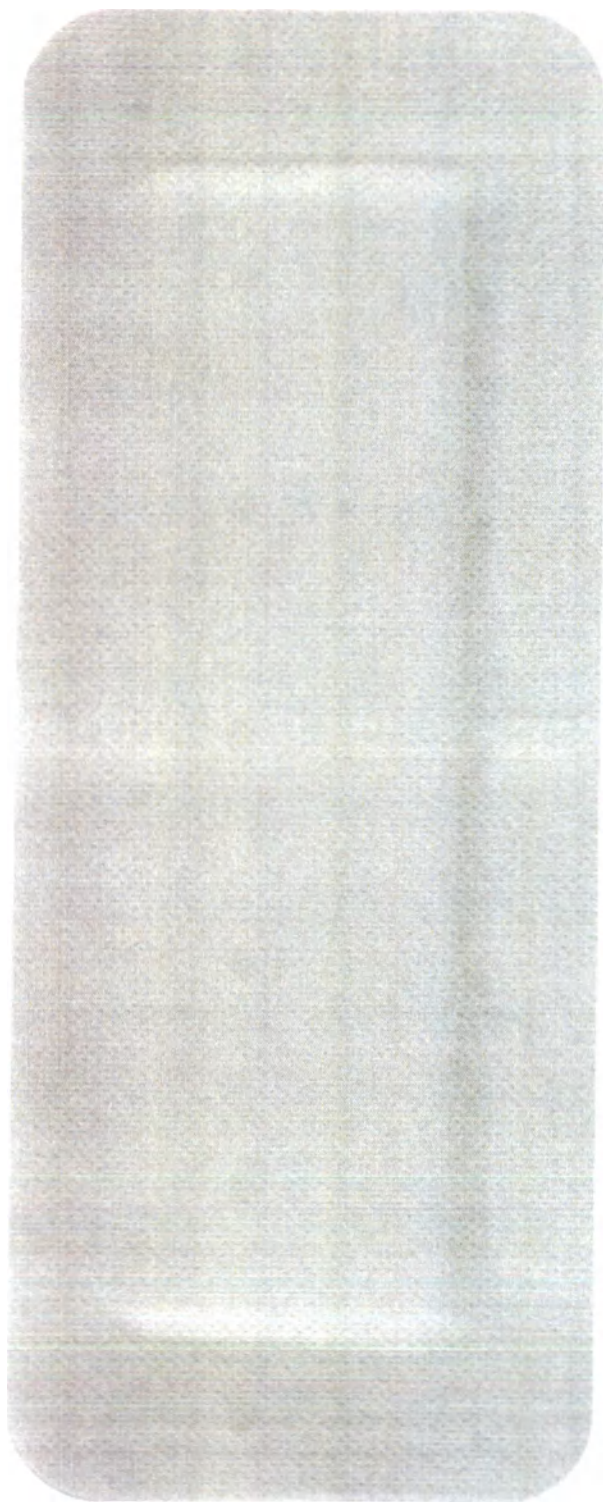

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Изменение	Номера листов (страниц)			Всего листов (страниц)	Ответственное лицо	Дата
		измененных	новых	изъятых			
1.	Замена макета маркировки варианта исполнения индивидуальной упаковки	5	6	-	64	Федюни на М.А.	20.09.2023
2.	Замена макета маркировки варианта исполнения индивидуальной упаковки	12	14	-	64	Федюни на М.А.	20.09.2023
3.	Замена макета маркировки варианта исполнения индивидуальной упаковки	14	17	-	64	Федюни на М.А.	20.09.2023
4.	Добавление макета маркировки варианта исполнения индивидуальной упаковки	-	18	-	64	Федюни на М.А.	20.09.2023
5.	Добавление макета маркировки варианта исполнения индивидуальной упаковки	-	19	-	64	Федюни на М.А.	20.09.2023
6.	Добавление макета маркировки варианта исполнения индивидуальной упаковки	-	20	-	64	Федюни на М.А.	20.09.2023
7.	Добавление макета маркировки варианта исполнения индивидуальной упаковки	-	21	-	64	Федюни на М.А.	20.09.2023
8.	Добавление макета маркировки варианта исполнения индивидуальной упаковки	-	22-23	-	64	Федюни на М.А.	20.09.2023
9.	Добавление макета маркировки варианта исполнения индивидуальной упаковки	-	24-25	-	64	Федюни на М.А.	20.09.2023

10.	Замена и добавление образцов макетов маркировки транспортной упаковки	30	-	-	64	Федюни на М.А.	20.09.2023
11.	Замена фотографического изображения индивидуальной упаковки вариантов исполнений	39	-	-	64	Федюни на М.А.	20.09.2023
12.	Замена фотографического изображения индивидуальной упаковки вариантов исполнений	-	50	-	64	Федюни на М.А.	20.09.2023
13.	Добавлены фотографические изображения индивидуальной упаковки вариантов исполнения с фотографическим изображением общего вида медицинского изделия	-	52-62	-	64	Федюни на М.А.	20.09.2023
14.	Обновлены макеты маркировки и фотографические изображения с учетом смены юридического адреса компании-уполномоченного представителя изготовителя	1-62	-	-	64	Федюни на М.А.	18.10.2023

Генеральный директор ООО «СПЕКТРУМ»
Федюнина Мария Александровна



Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью на 64 листах

Генеральный директор ООО «СПЕКТРУМ»

Федюнина М.А.

