

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Медтроник»



Плясунова Е.В.

30 «мая» 2021 г.

Фотографические изображения


медицинского изделия

«Электрод трансвенозный биполярный Crystalline Actfix MRI SureScan ICQ09B»

производства:


«Витатрон Холдинг Б.В.», Нидерланды / Vitatron Holding B.V., The Netherlands

внешний вид изделия Электрод трансвенозный биполярный Crystalline Actfix MRI SureScan ICQ09B, модель ICQ09B-52, в составе: 1.1 Электрод с фиксирующей муфтой, стилетом и проводником стилета - 1 шт. 1.2 Рукоятка для вены - 1 шт. 1.3 Инструмент для фиксации - 2 шт. 1.4 Дополнительные стилеты - не более 10 шт. (при необходимости) 1.5 Документация по продукции.

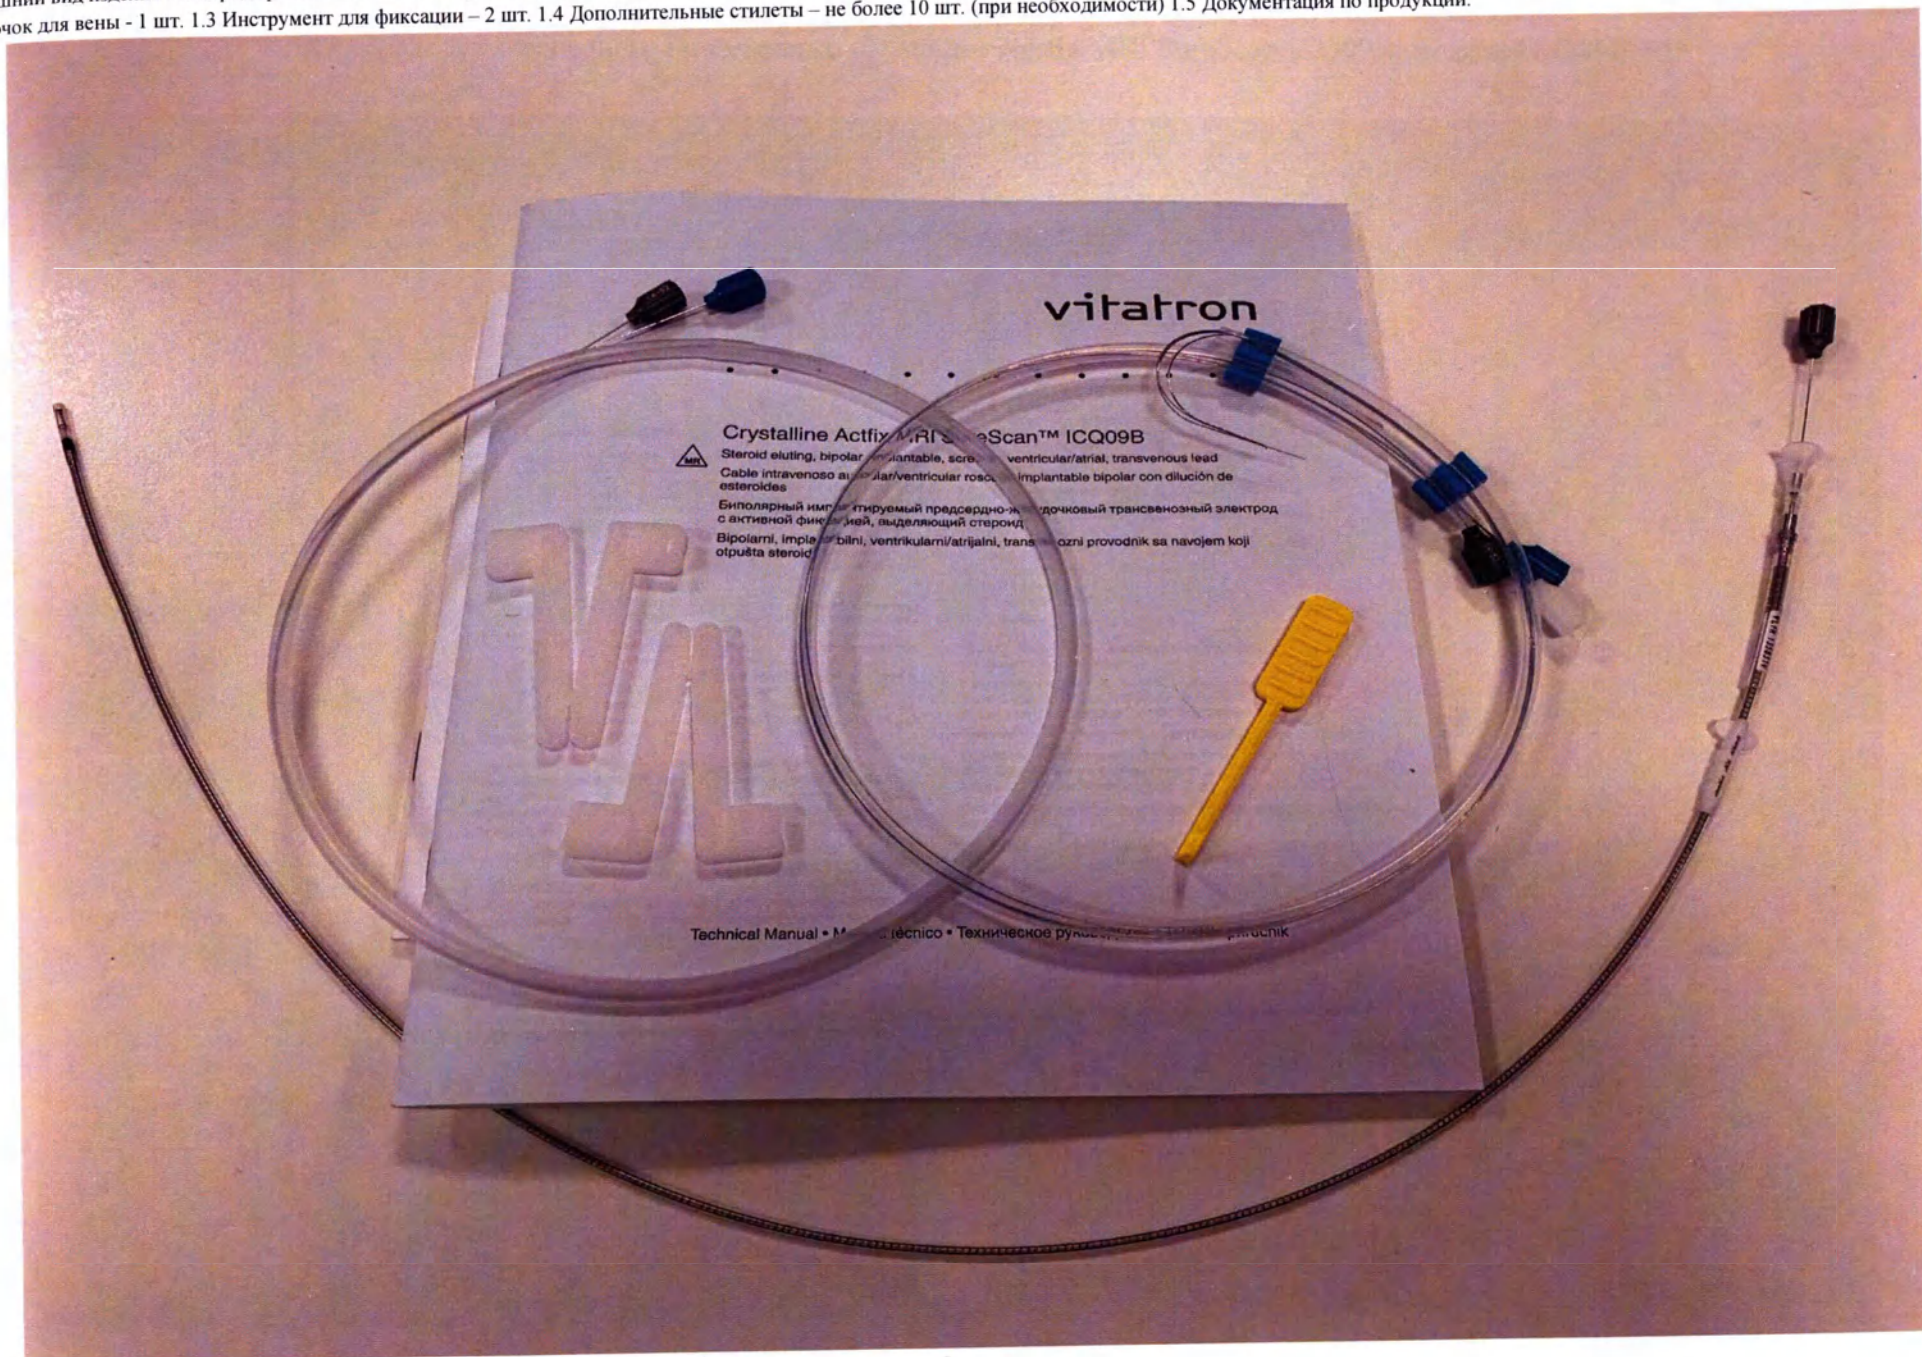

Внешний вид упаковки (коробки картонной)




Электроды трансвенозного биполярного Crystalline Actfix MRI SureScan ICQ09B, модель ICQ09B-52

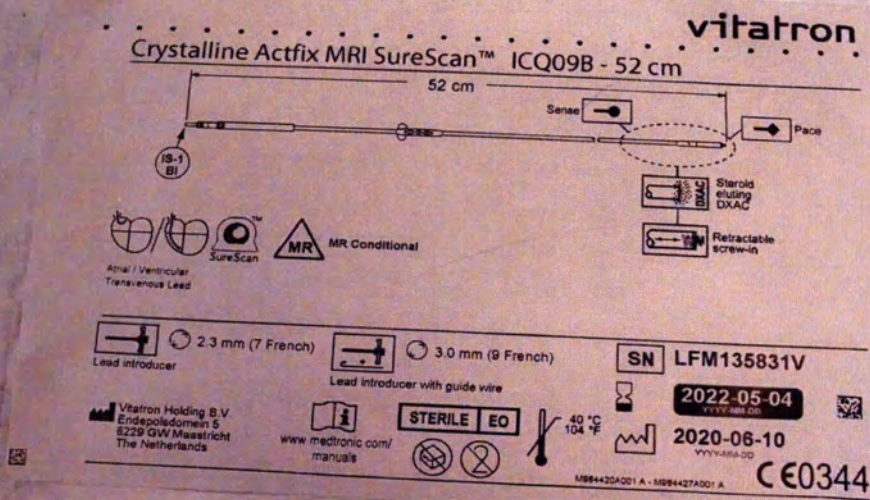


vitatron

Crystalline Actfix MRI SureScan™ ICQ09B - 52 cm

en Lead / fr Sonde / de Elektrode / es Cable / nl Geleidingsdraad / it Elettrocattetere / no Ledning / sv Elektrod /
el Ηλεκτρόδιο / da Elektrode / pt Eléctrodo / hu Vezeték / pl Elektroda / cs Elektroda / ru Электрод / sk Elektroda /
tr Lead / ro Derivație / bg Електрод / sr Elektroda / sl Elektroda / hr Elektrodni kateter / et Elektroodijuhe / lt Elektrodas /
lv Pievads / pt-br Electrodo

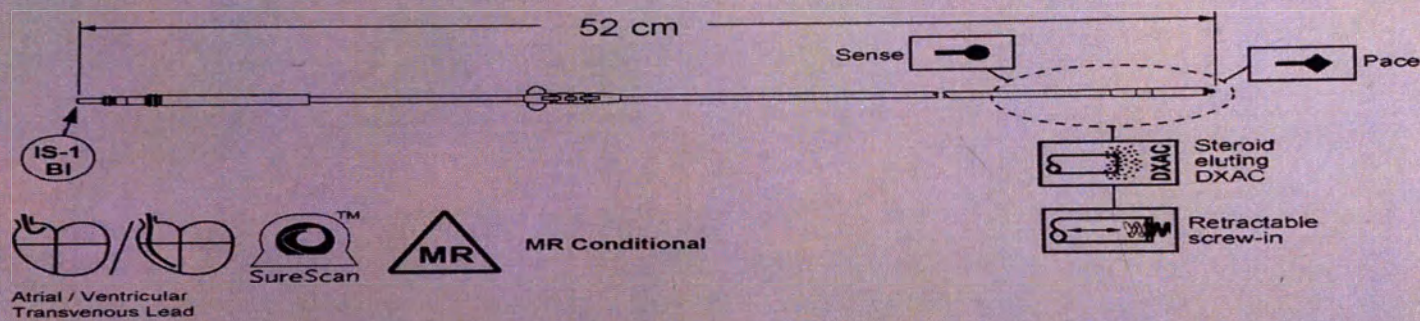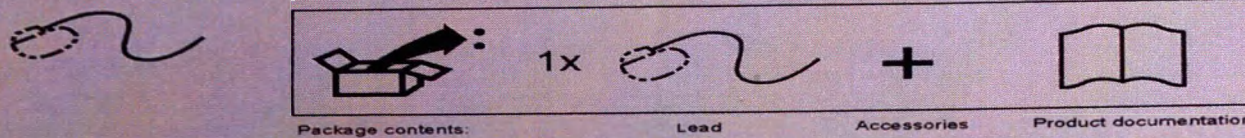

2.3 mm (7 French)



3.0 mm (9 French)

REF ICQ09B52

SN LFM135831V

2022-05-04
YYYY-MM-DD

2020-06-10
YYYY-MM-DD


PIN: ICQ09B0035

Vitatron Holding B.V.
Endepolsdomein 5
6229 GW Maastricht
The Netherlands

Manufactured in:
Villalba, Puerto Rico, USA
Product of USA

www.medtronic.com/
manuals

STERILE EO



CE0344

M964420A001 A - M964427A001 A


Маркировка упаковки (коробки картонной)

Электроды трансвенозного биполярного Crystalline Actfix MRI SureScan ICQ09B, модель **ICQ09B-52**




Внешний вид стерильной упаковки Electroда трансвенозного биполярного Crystalline Actfix MRI SureScan ICQ09B, модель **ICQ09B-52**



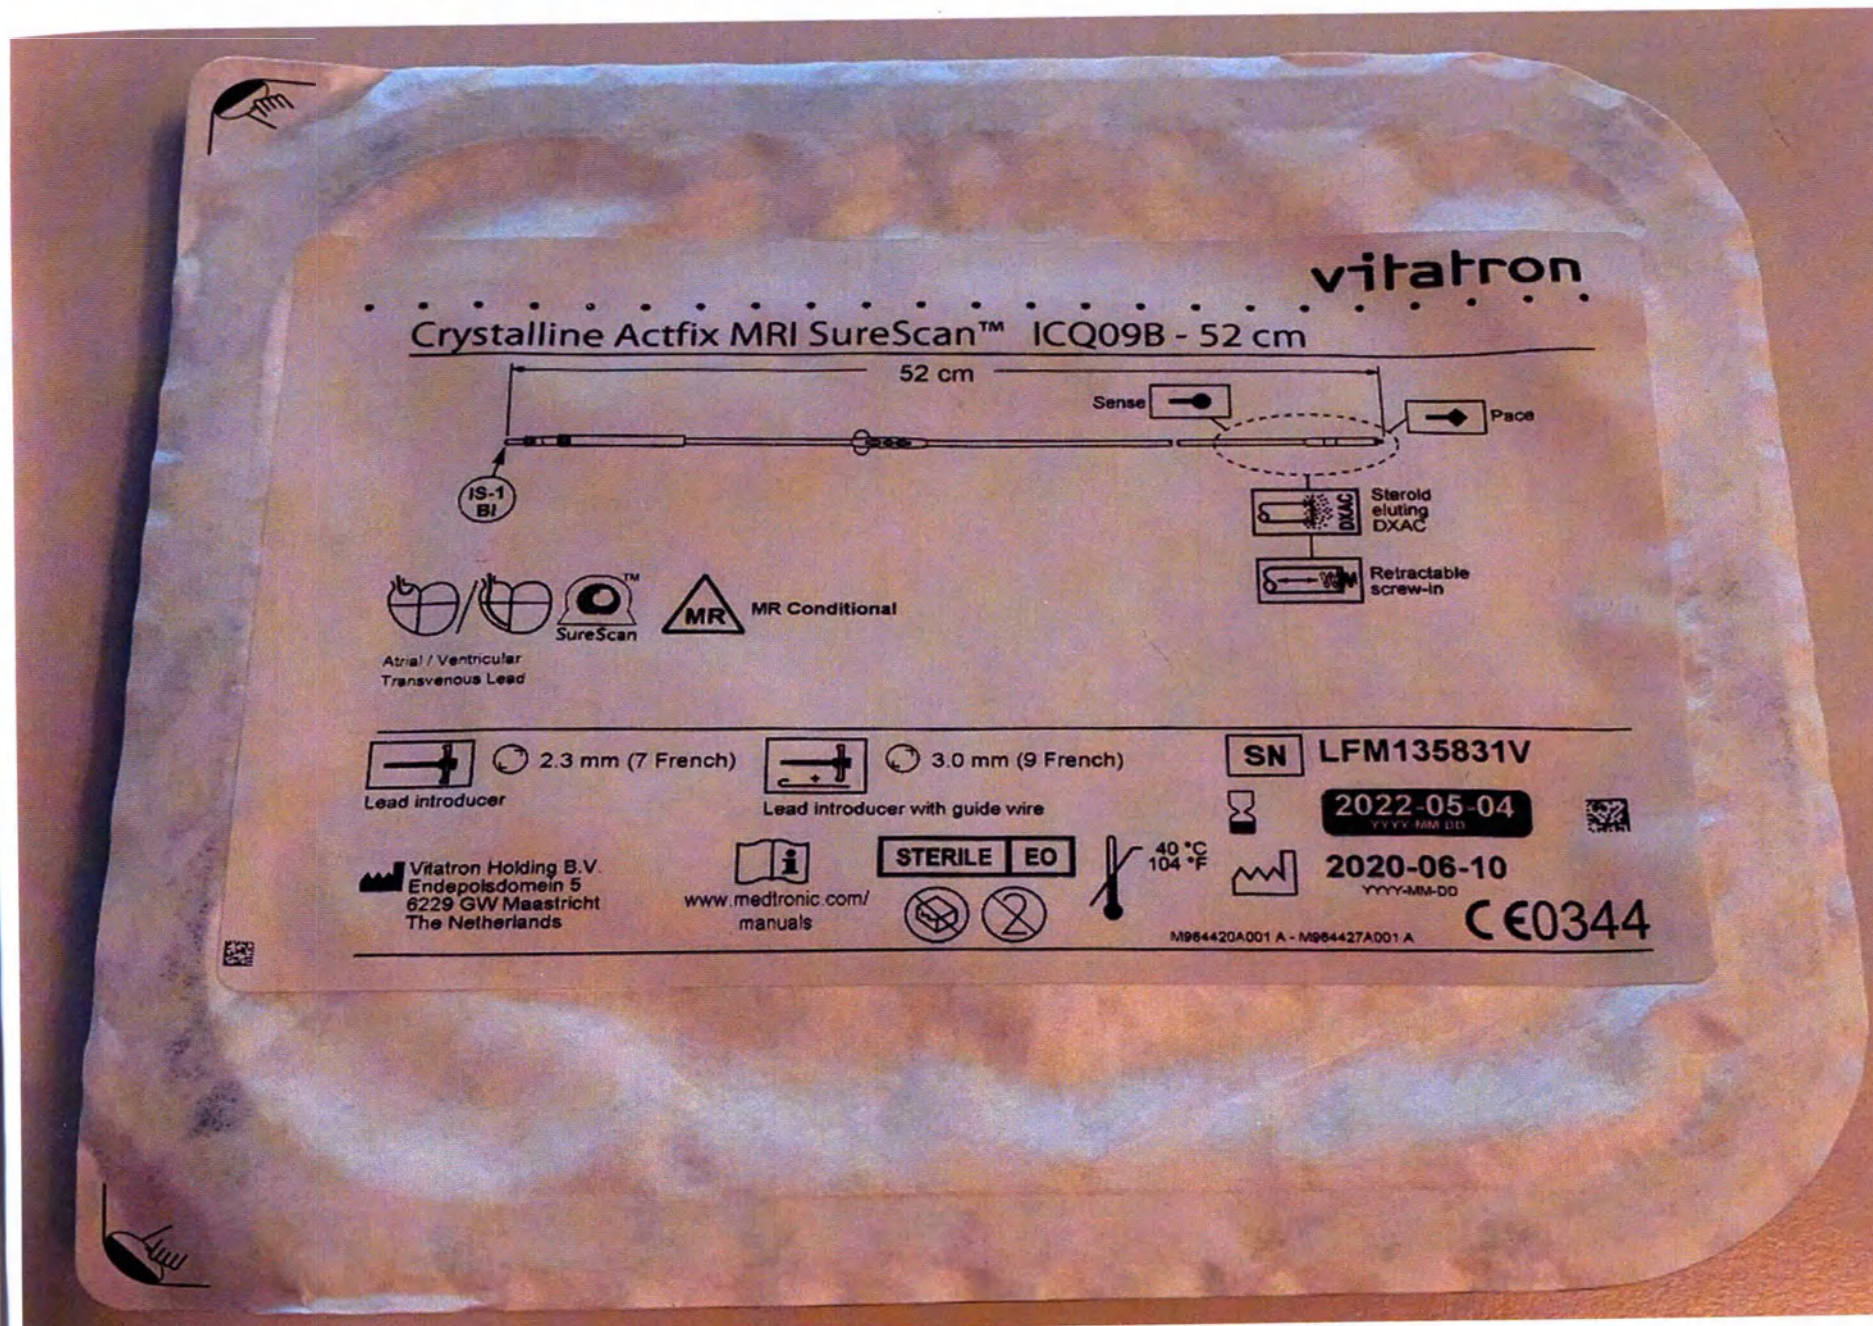


Электрод с фиксирующей муфтой, стилетом и проводником стилета изделия Электрод трансвенозный биполярный Crystalline Actfix MRI
SureScan ICQ09B, модель ICQ09B-52

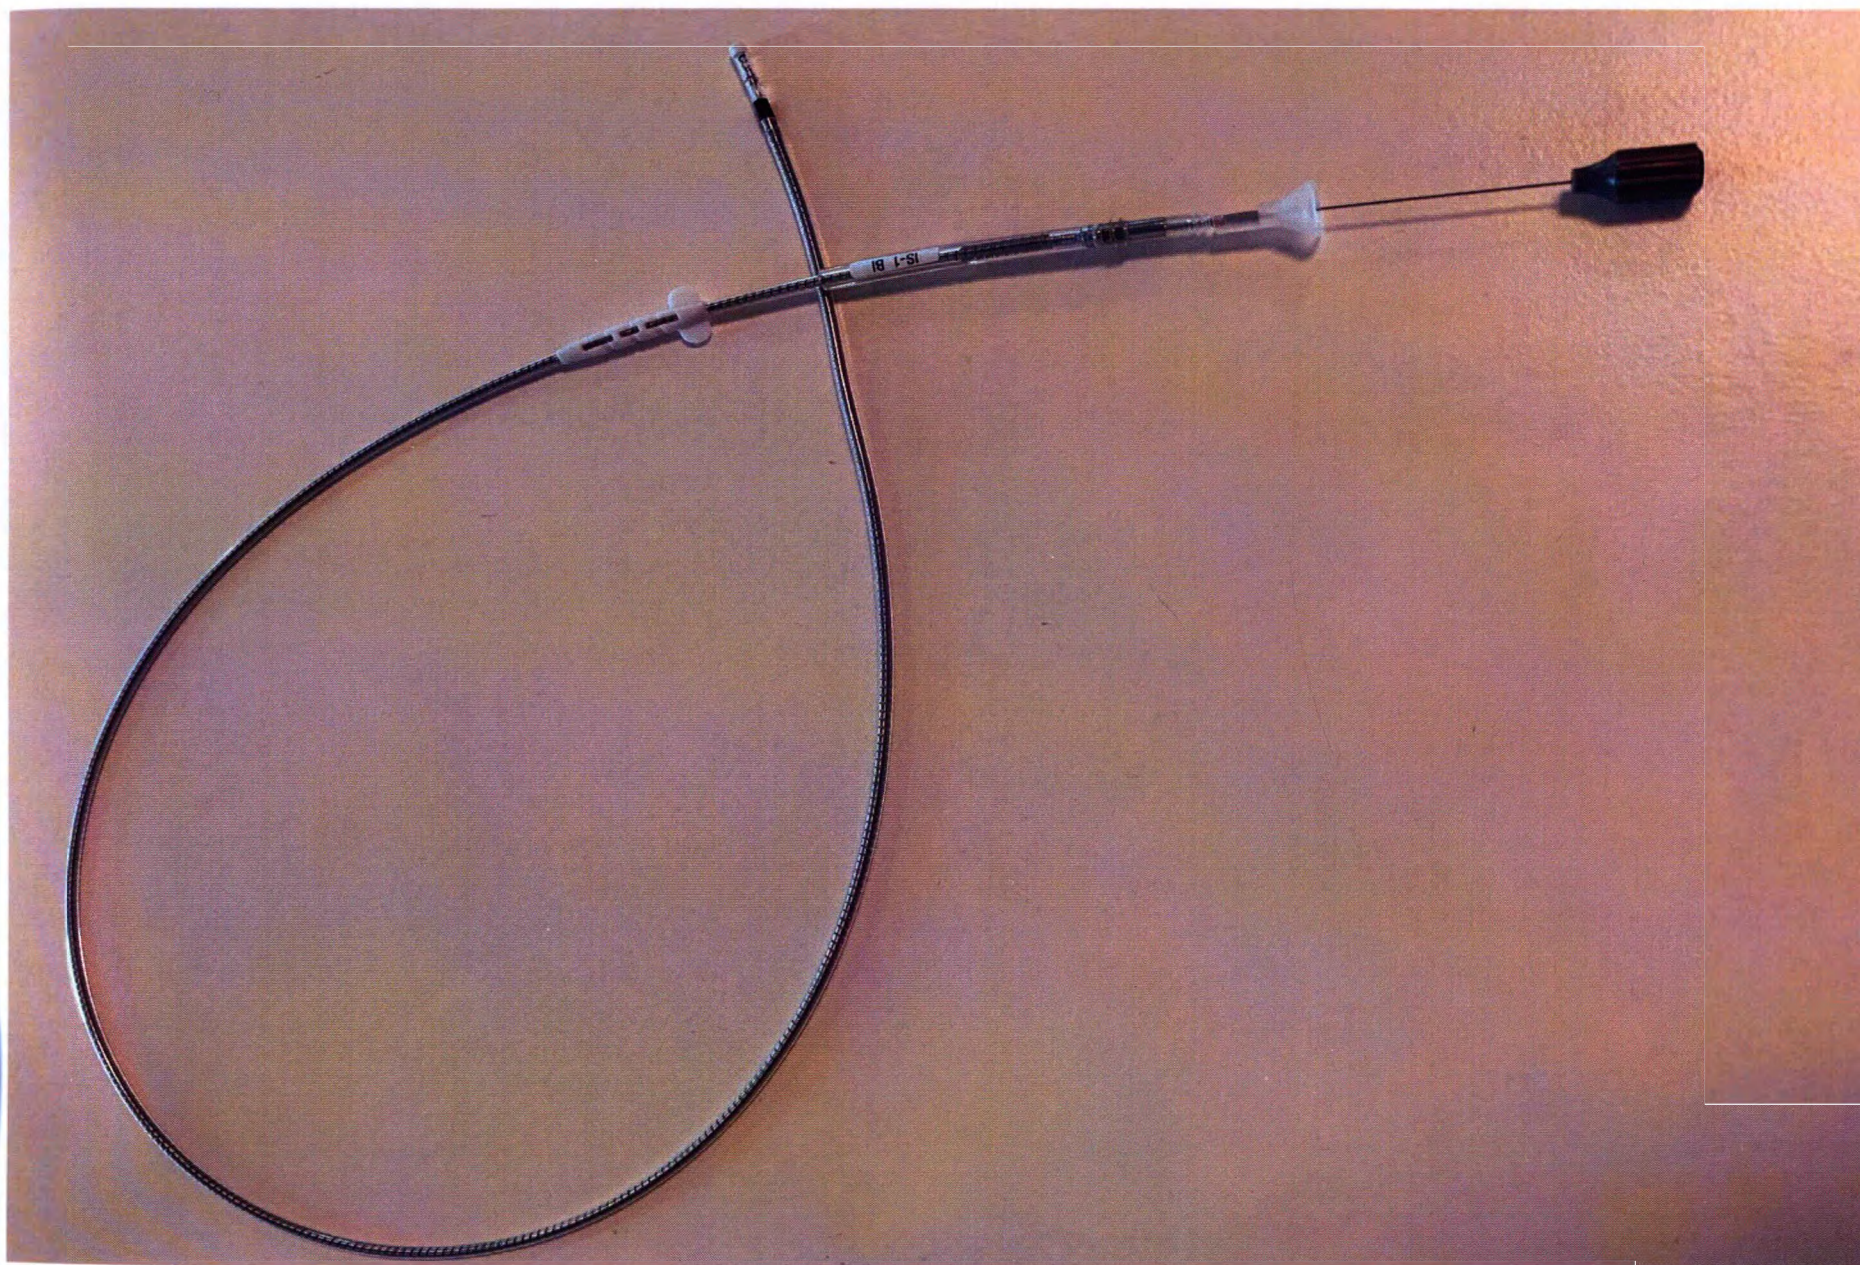







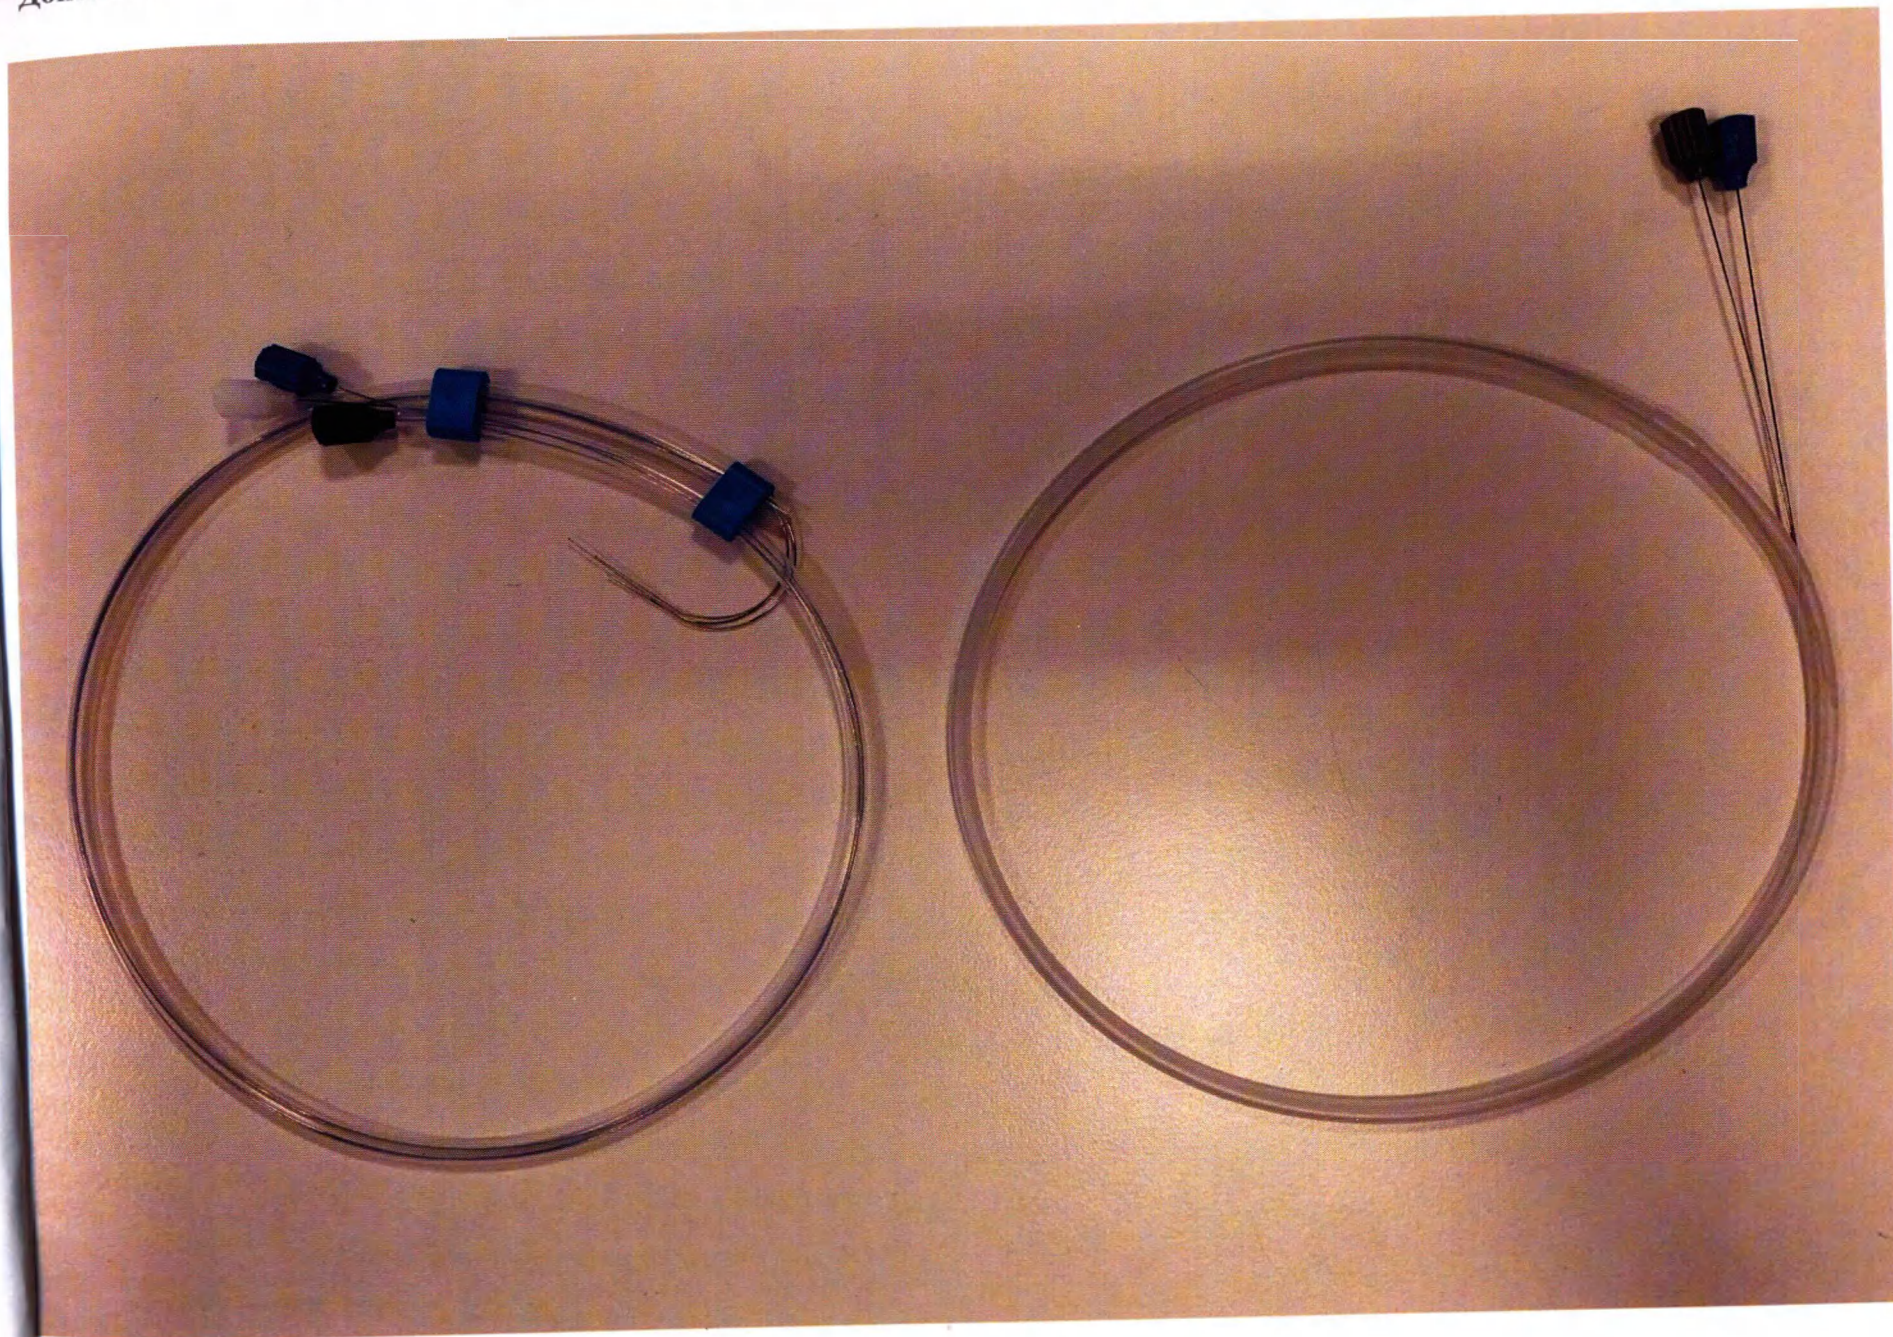

внешний вид изделия Электрод трансвенозный биполярный Crystalline Actfix MRI SureScan ICQ09B, модель ICQ09B-58, в составе:

Электрод с фиксирующей муфтой, стилетом и проводником стилета - 1 шт. 2.2 Крючок для вены - 1 шт. 2.3 Инструмент для фиксации - 2 шт. 2.4 Дополнительные стилеты - не более 10 шт. (при необходимости)
Документация по продукции.

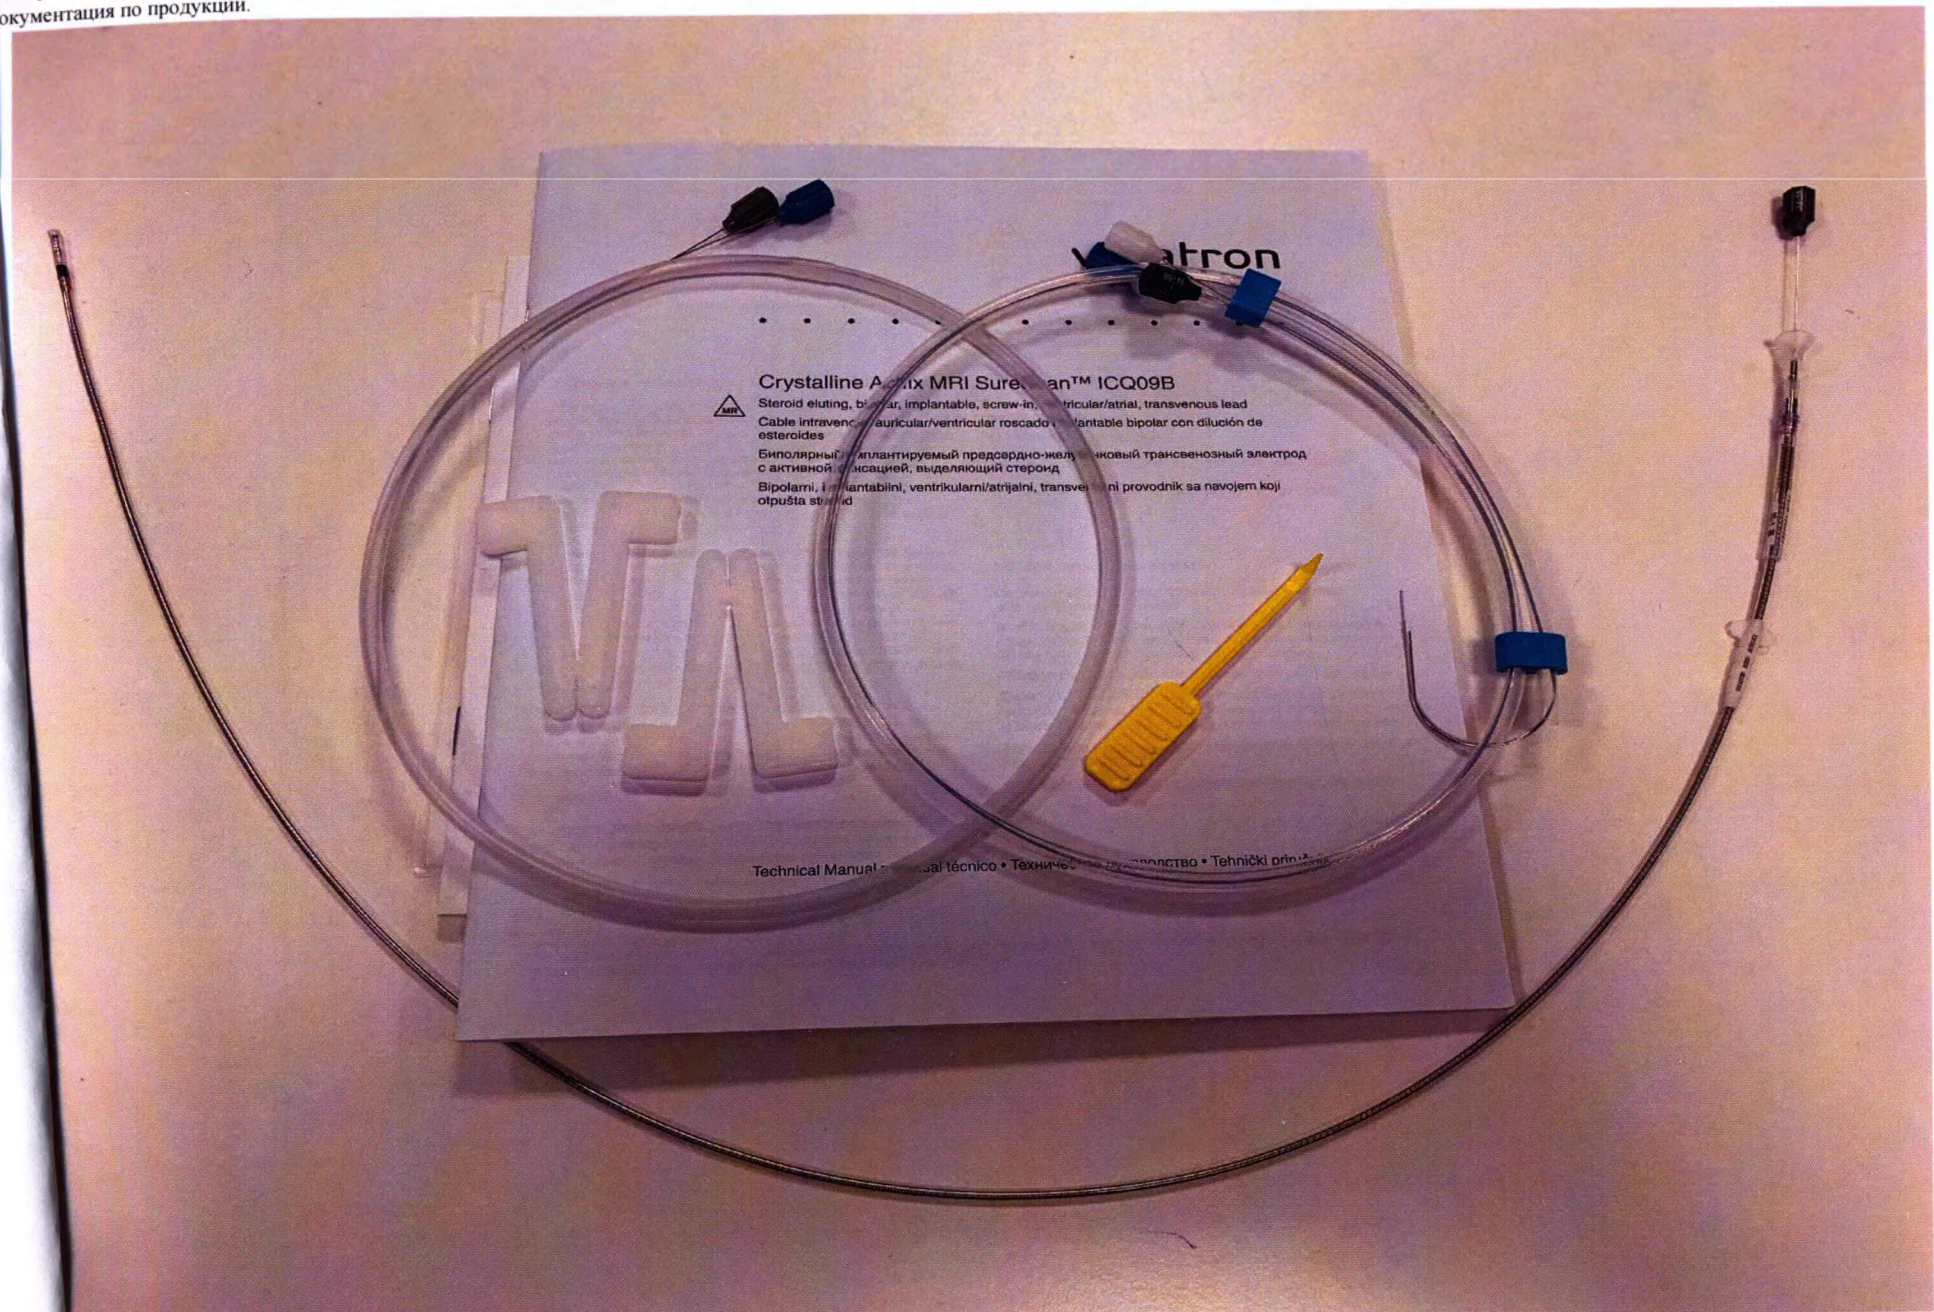


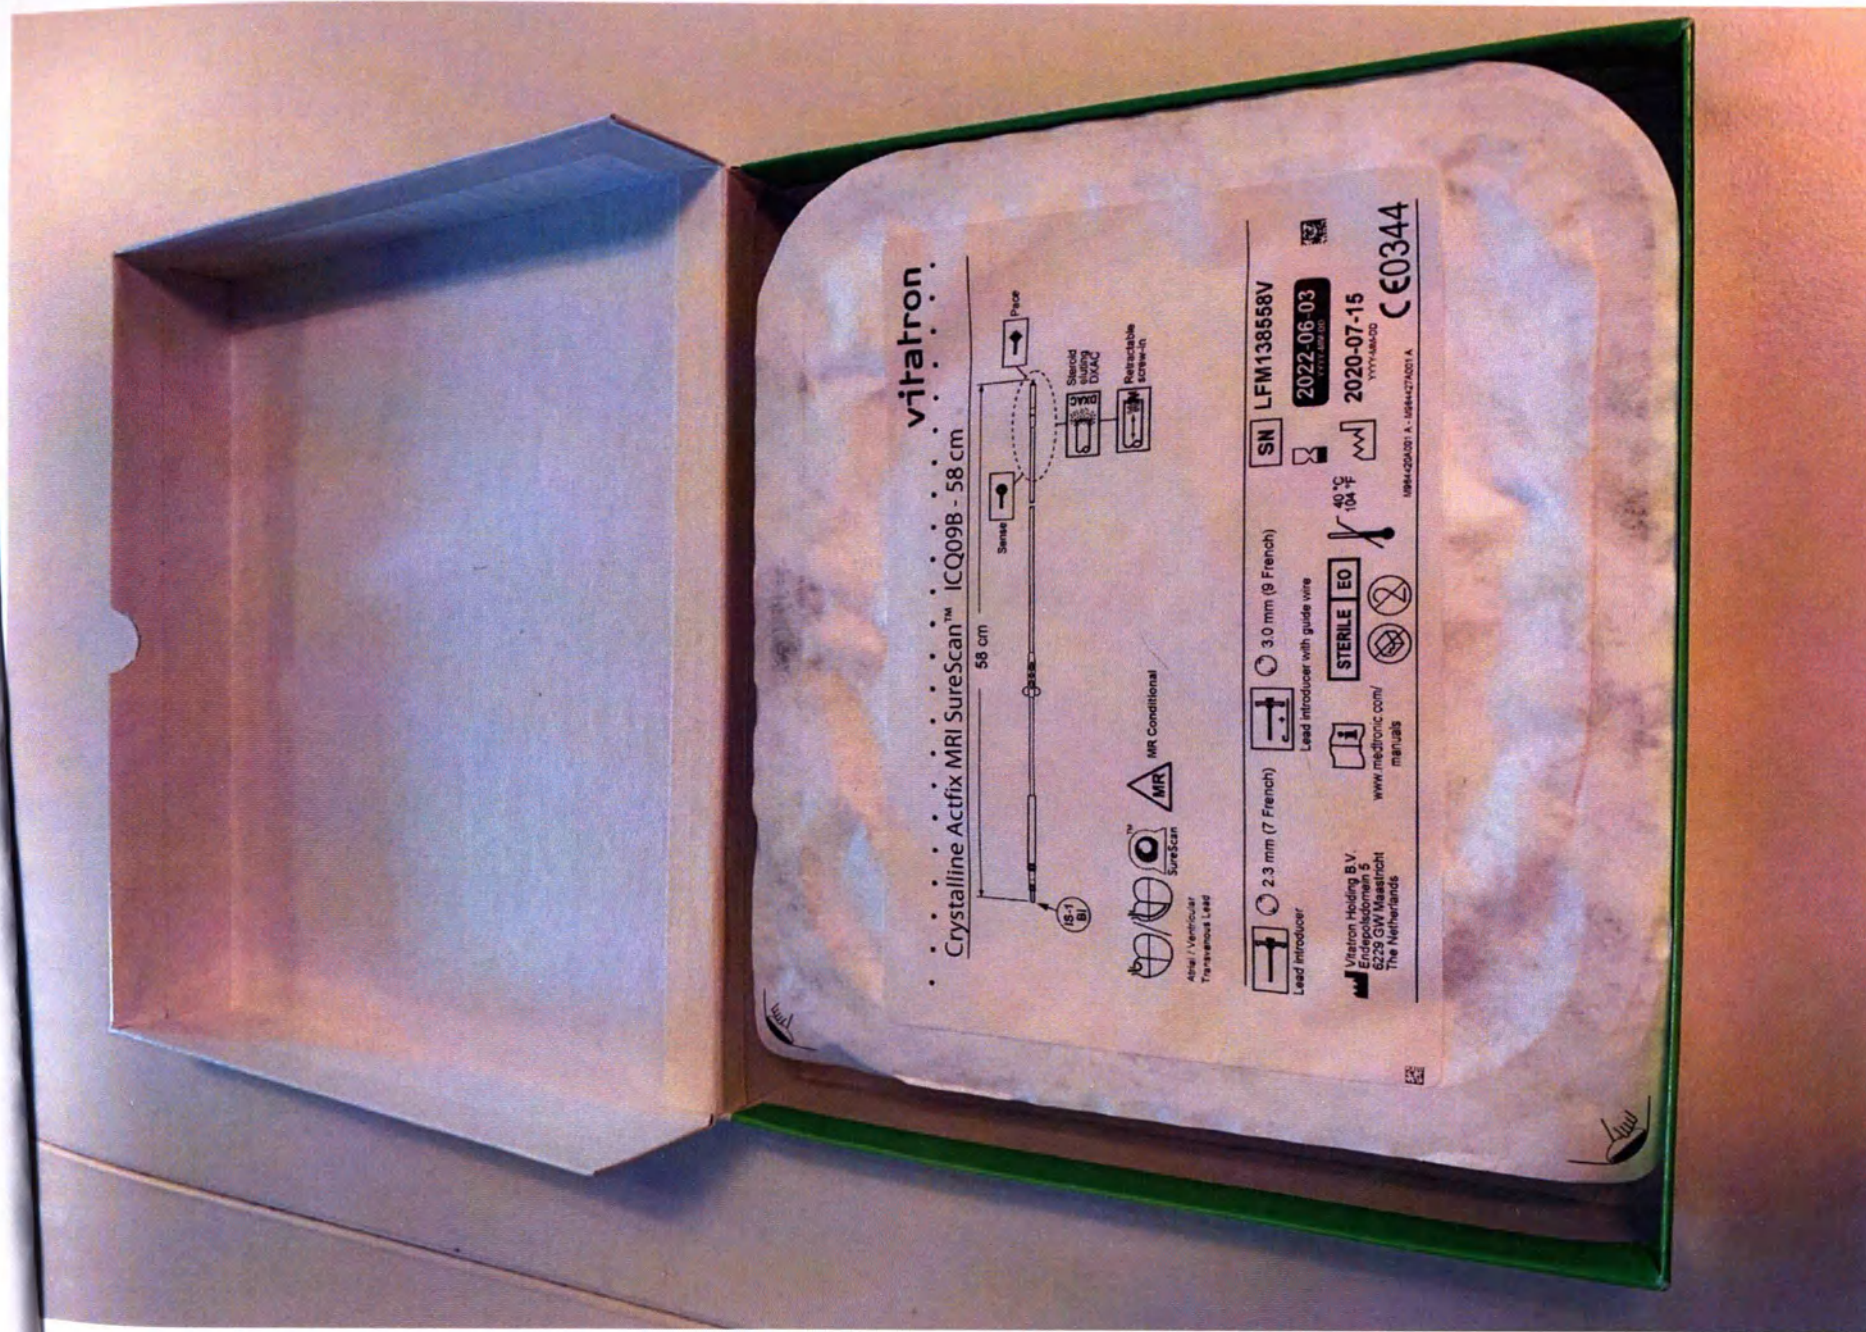


vitatron

Crystalline Actfix MRI SureScan™ ICQ09B - 58 cm

en Lead / fr Sonde / de Elektrode / es Cable / nl Geleidelingsdraad / it Elettrocattolere / no Ledning / sv Elektrod /
el Ηλεκτρόδιο / da Elektrode / pt Electrodo / hu Vezeték / pl Elektroda / es Elektroda / ru Электрод / sk Elektroda /
fr Lead / no Dervasje / bg Електрод / sr Elektroda / sr Elektroda / hr Elektrodi kateter / et Elektroodijuhne / it Elektrodaa /
lv Plevads / pt-br Electrodo




Package contents: Catheter + Accessories + Product documentation

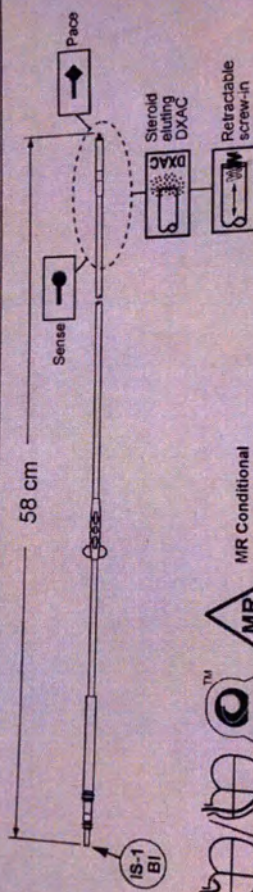

Atrial / Ventricular
Transvenous Lead



Lead introducer



2.3 mm (7 French)

REF


ICQ09B58

SN

LFM138558V



Lead introducer
with guide wire



3.0 mm (9 French)



2022-06-03
YYYY-MM-DD



2020-07-15
YYYY-MM-DD

PIN: ICQ09B0036

Vitatron Holding B.V.
Endepolsdomein 5
6229 GW Maastricht
The Netherlands

Manufactured in:
Villalba, Puerto Rico, USA
Product of USA



www.vitatron.com/
manuals



40 °C
104 °F


STERILE EO

CE0344

MSR-ICQ09B-001 A - MSR-ICQ09B-001 A

vitaliron

Crystalline Actfix MRI SureScan™ ICQ09B - 58 cm



IS-1BI



(01)00643169782112(17)220603(21)LFM138558V


GTIN

YYMMDD




SN




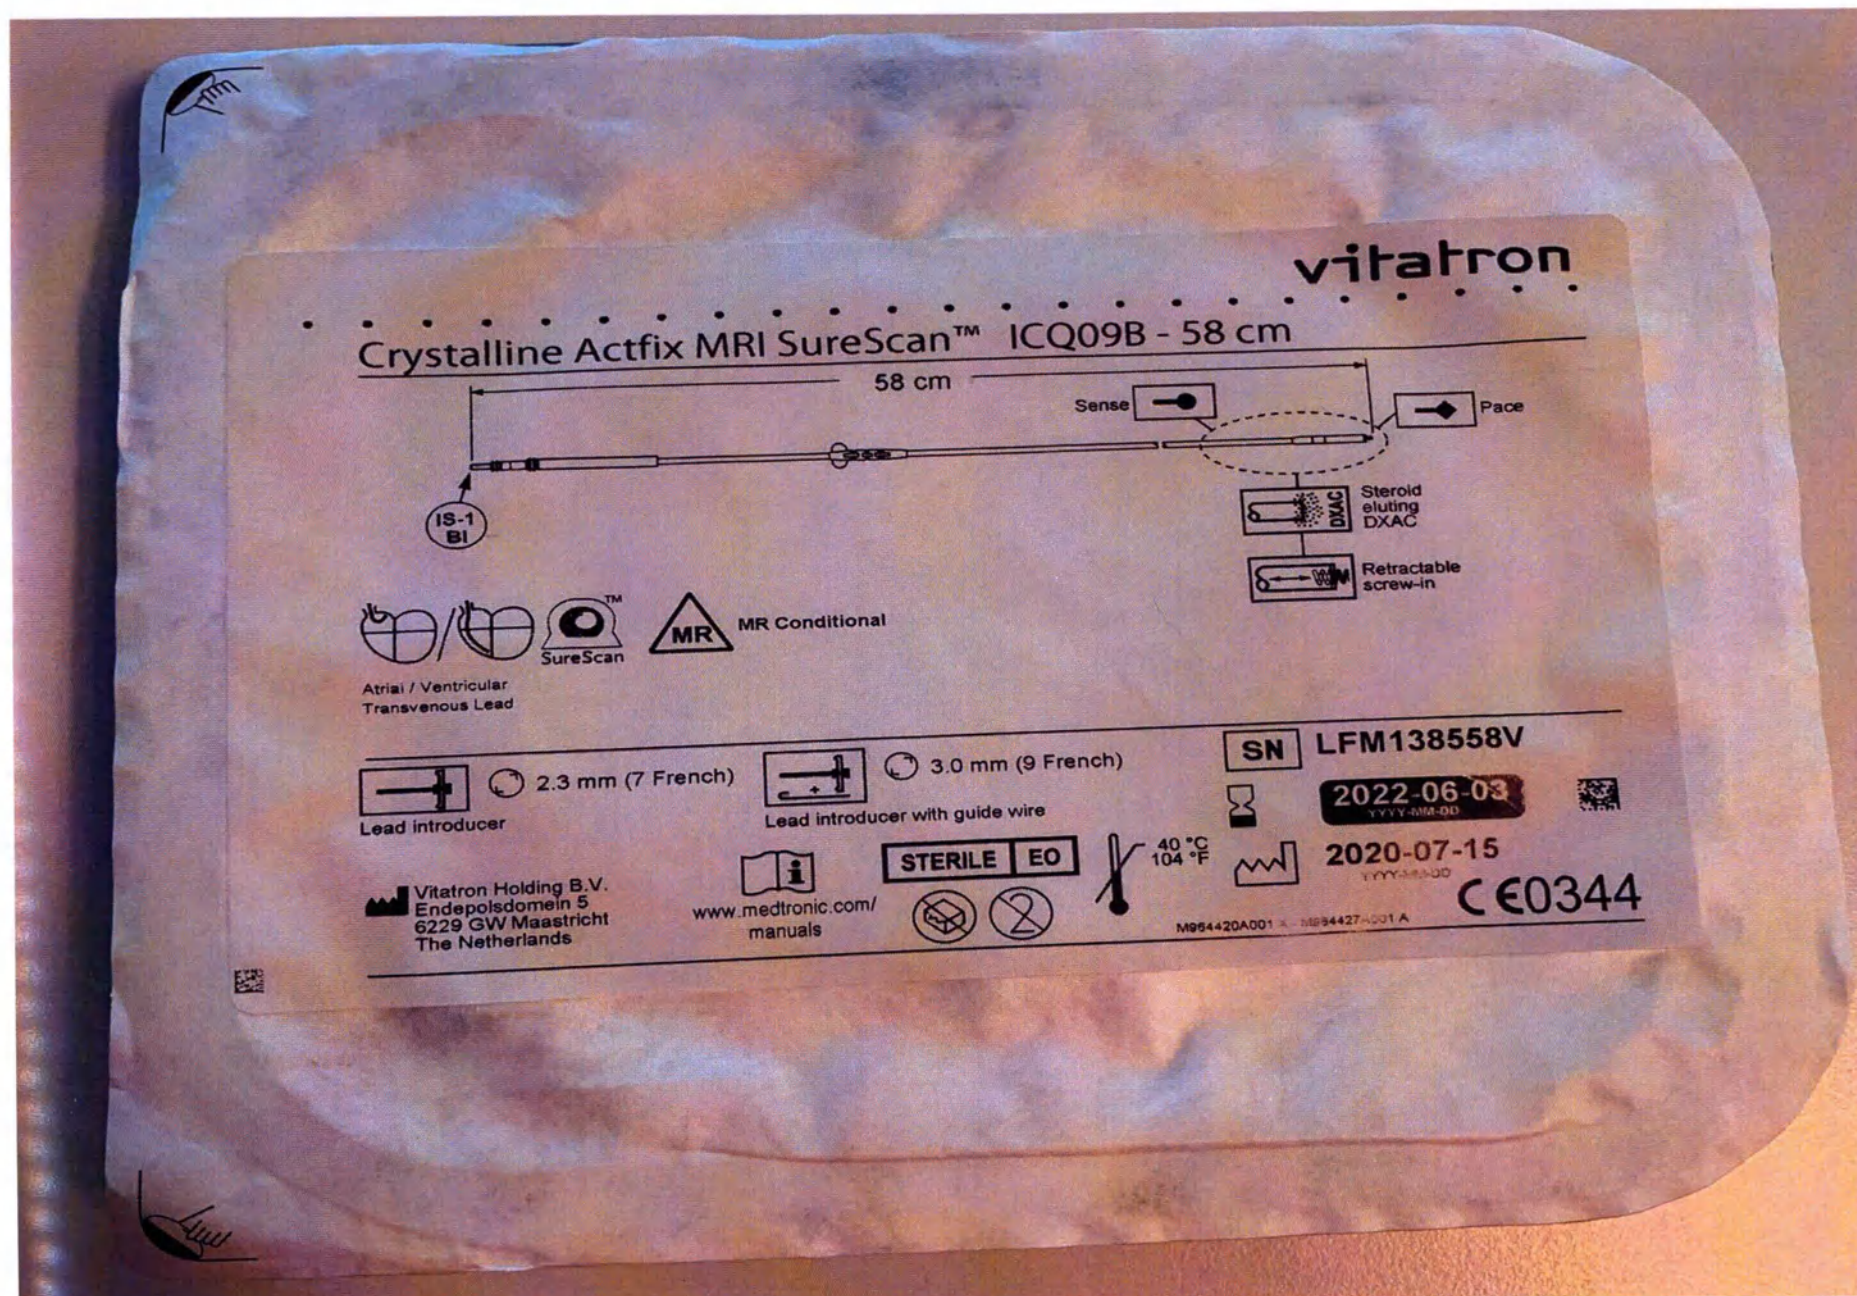



Электрод с фиксирующей муфтой, стилетом и проводником стилета изделия Электрод трансвенозный биполярный Crystalline Actfix MRI
SureScan ICQ09B, модель ICQ09B-58

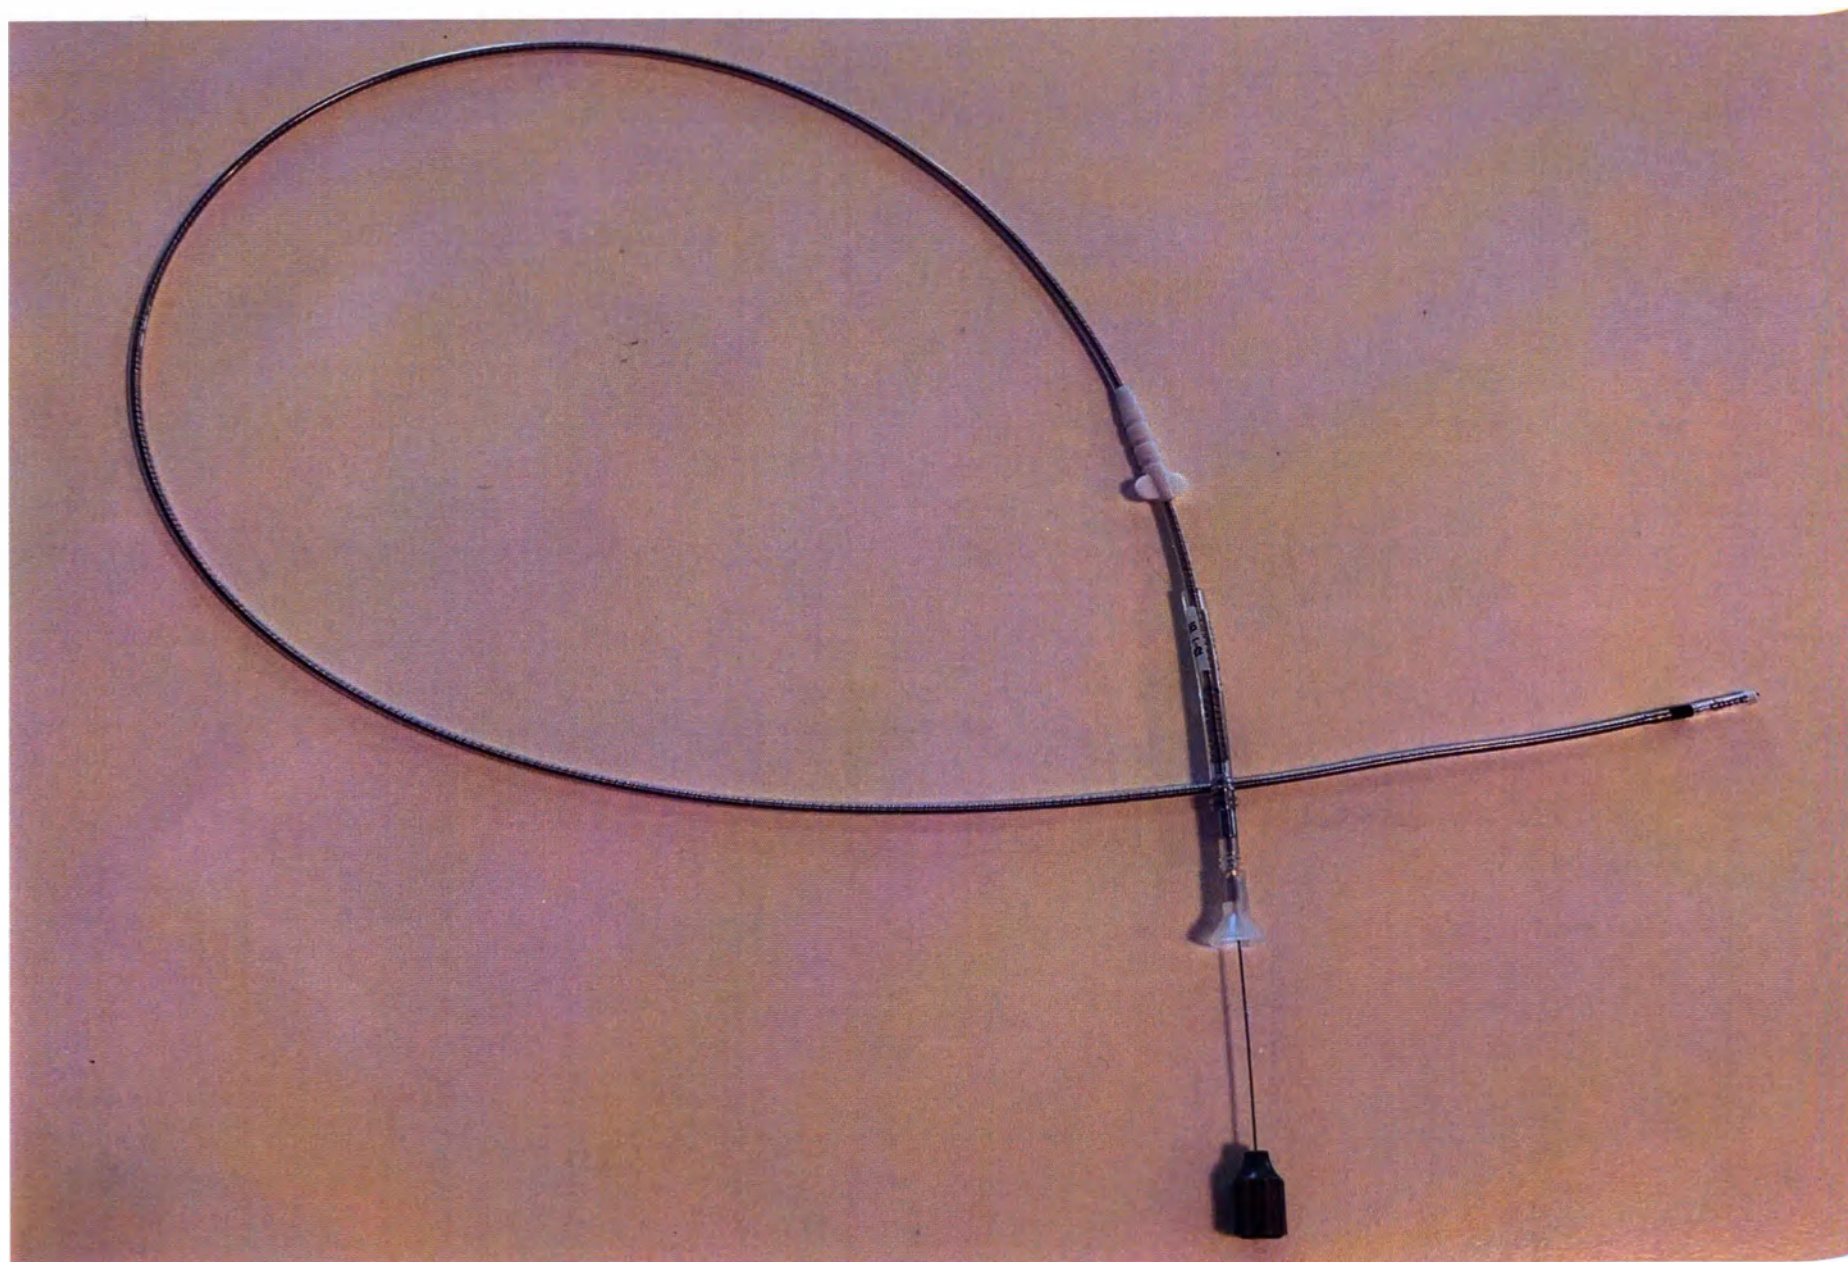

Крючок для вены изделия Электрод трансвенозный биполярный Crystalline Actfix MRI SureScan ICQ09B, модель ICQ09B-58

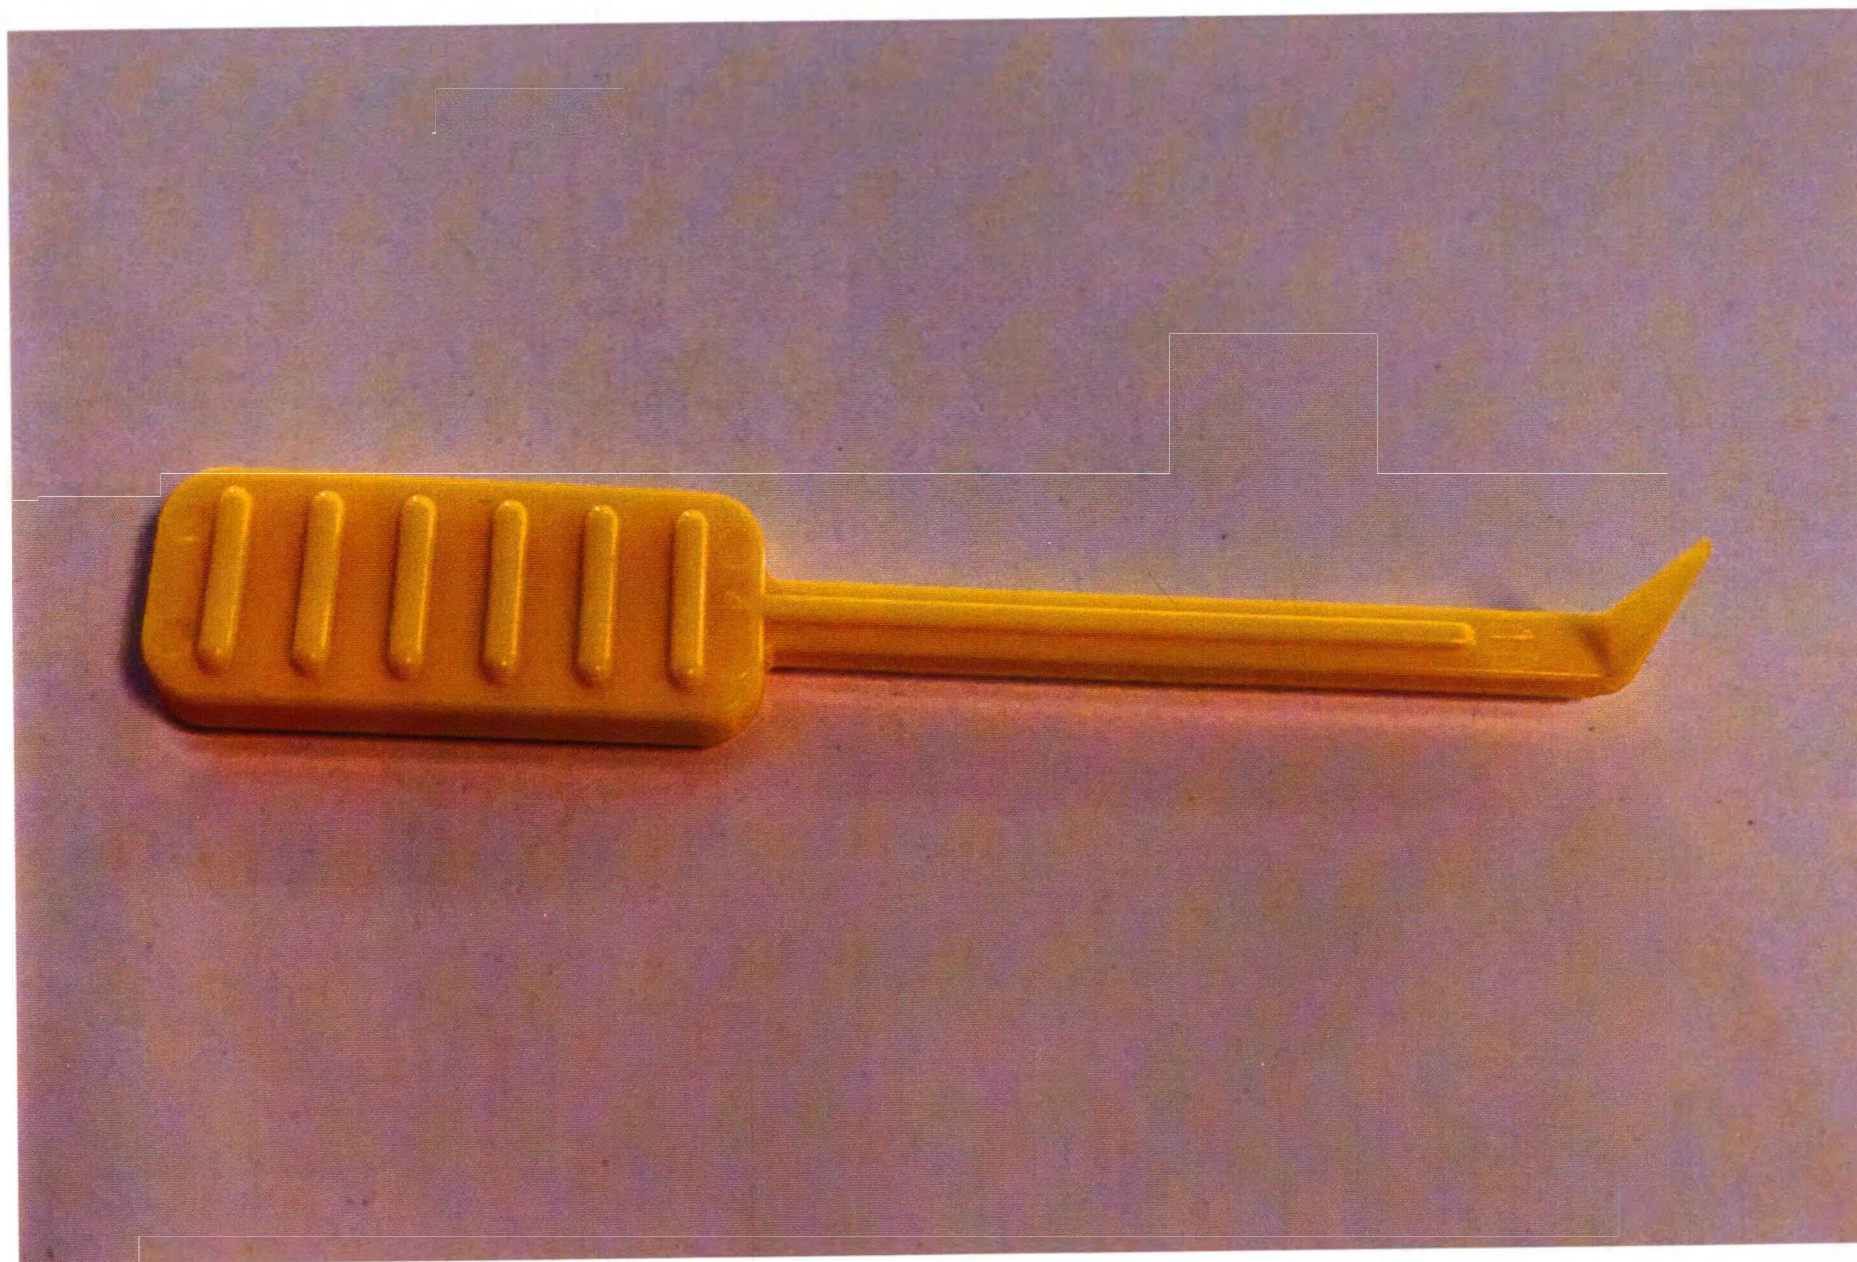

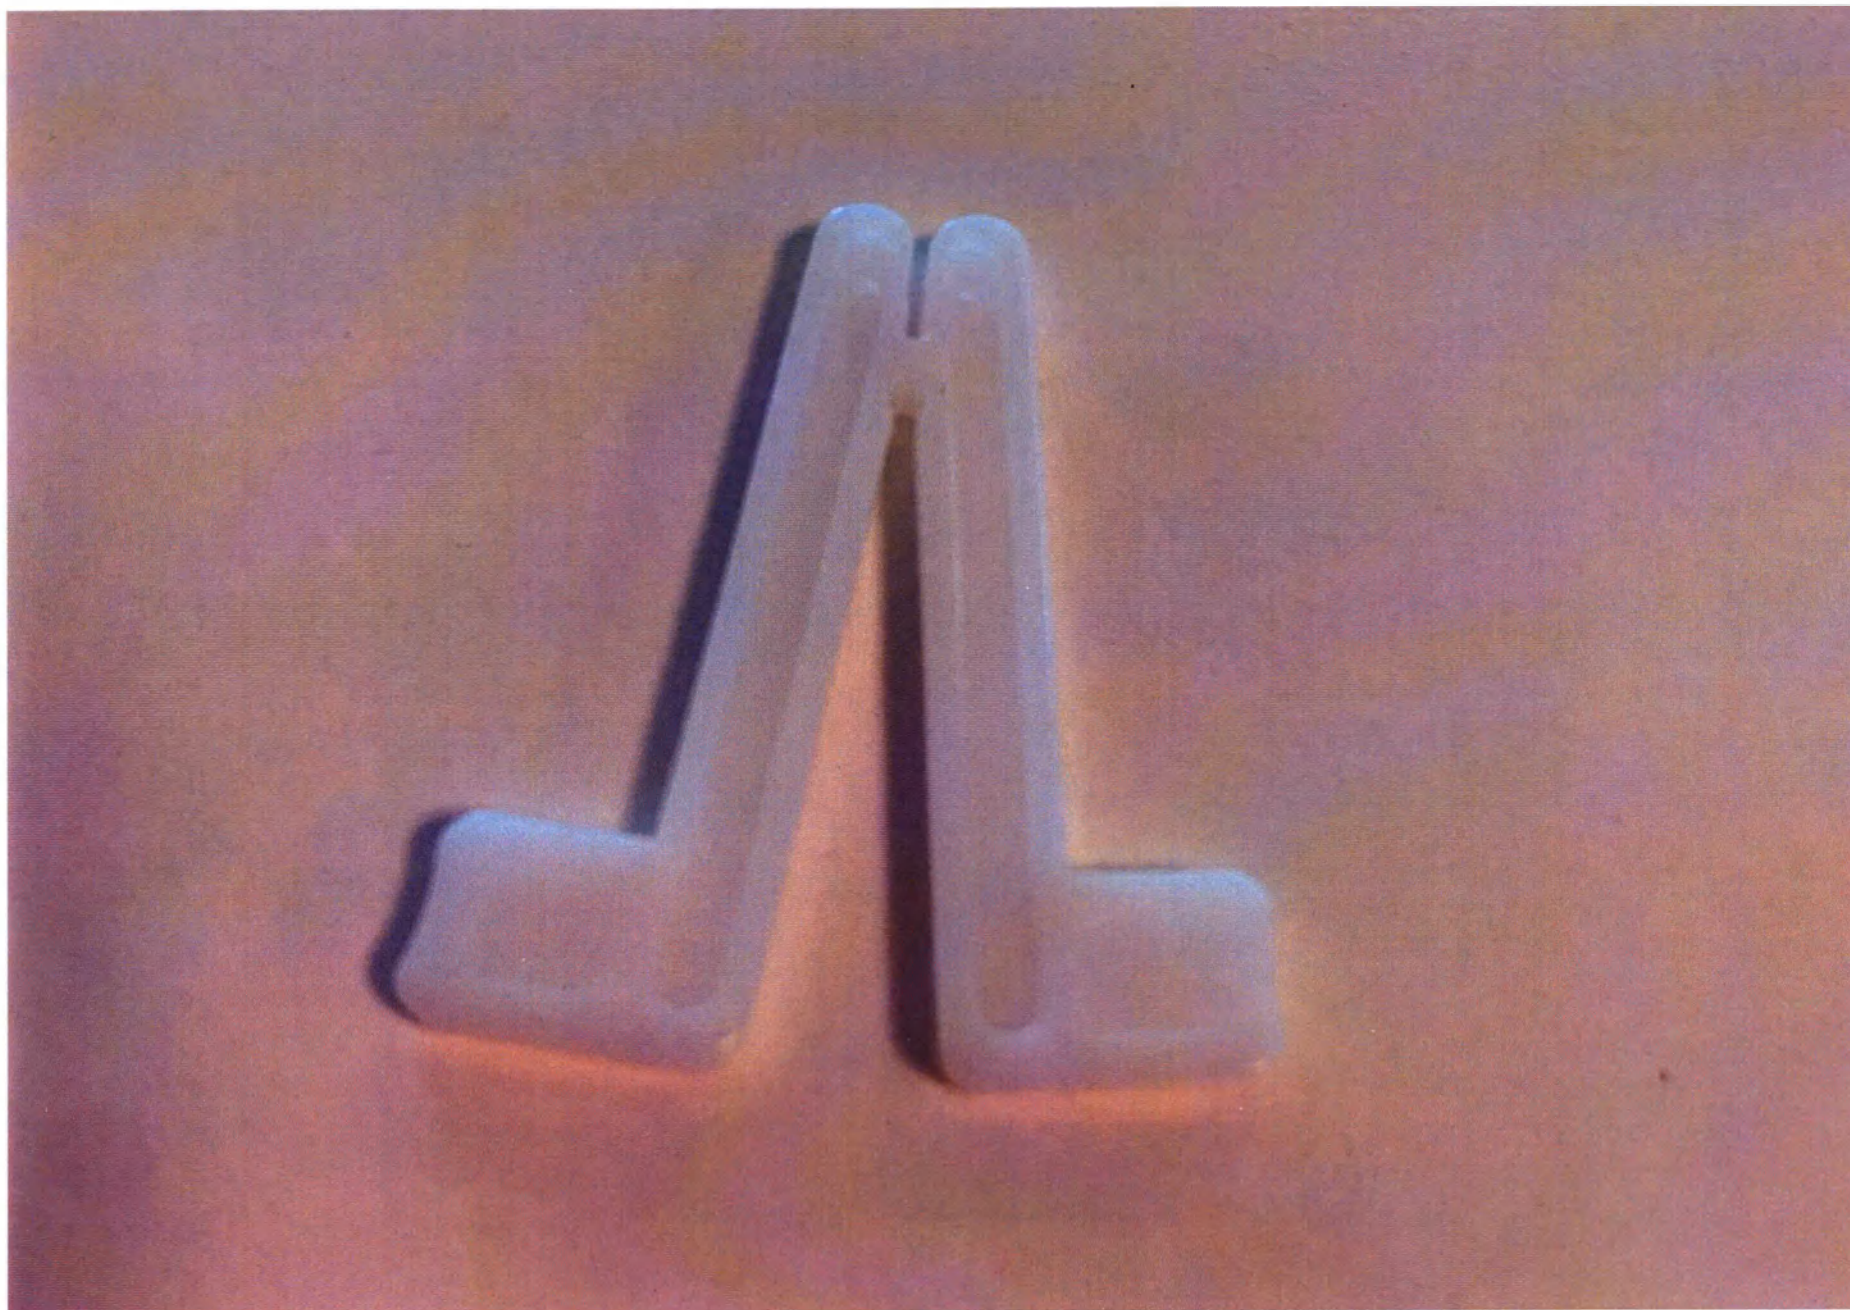

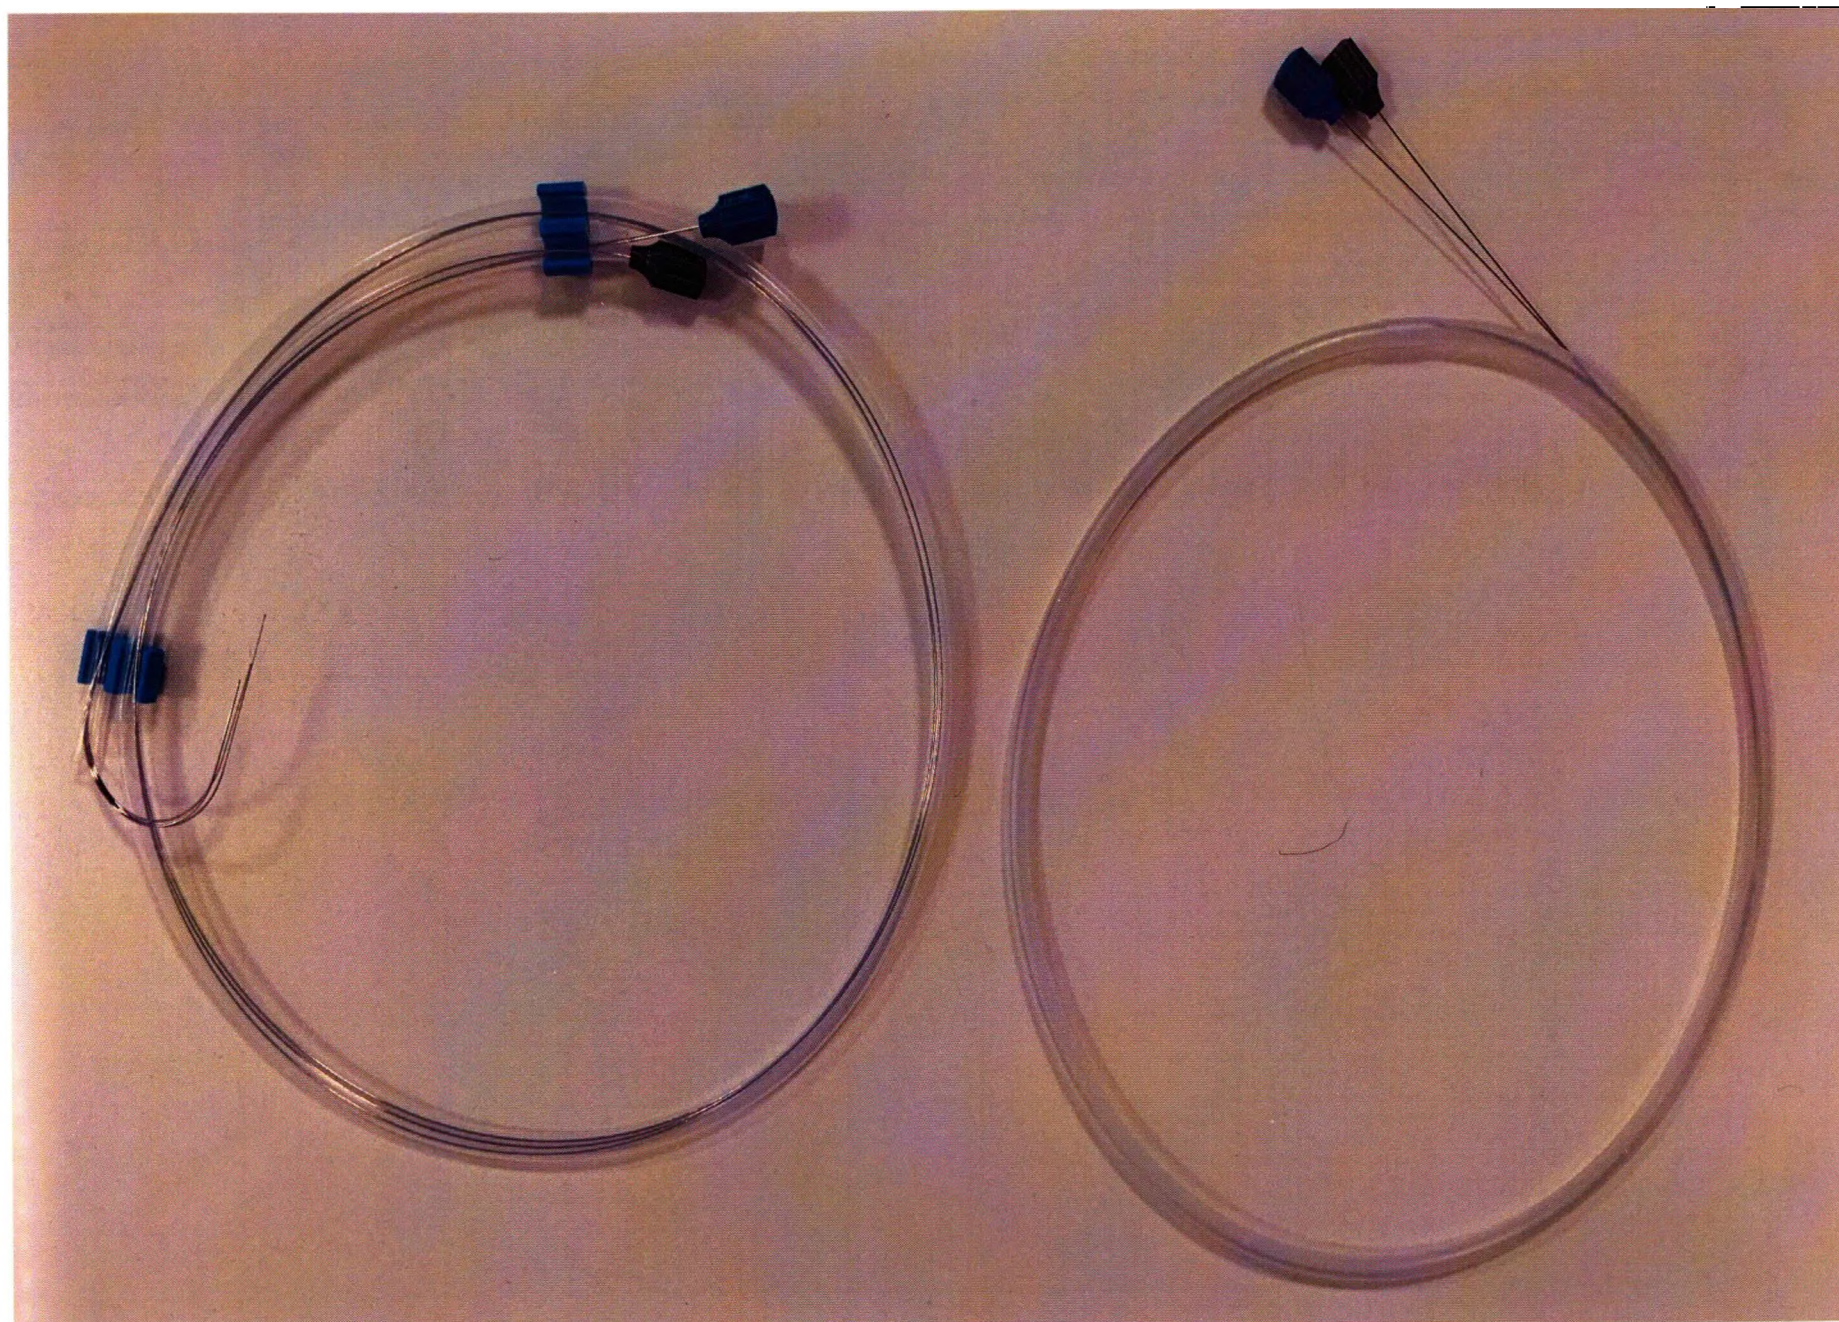

Образец стикера на русском языке для Electrode transvenous bipolar Crystalline Actfix MRI SureScan ICQ09B

Наименование медицинского изделия: Electrode transvenous bipolar Crystalline Actfix MRI SureScan ICQ09B, модель	
Производитель: «Витатрон Холдинг Б.В.», Нидерланды, Vitatron Holding B.V., Endepolsdomein 5, 6229 GW Maastricht, The Netherlands	Код UPN
Страна происхождения:	Код CFN
Официальный представитель производителя: ООО «Медтроник», 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, эт.9, пом. III, ком. 41	
Регистрационное удостоверение № _____ от _____	
Дата произв./серия/использовать до: см. на упаковке	См. инструкцию по эксплуатации См. символы на упаковке

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью ООО "Медтроник"
22 листа(ов)

