

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "ИНТРАДЕЙ-К"

Курбаналиев А.В.

« 28 » *Сентябрь* 2022 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

«Система ультразвуковой визуализации портативная, модель Q7»



Кейс для переноски



Кейс для переноски




Система ультразвуковой визуализации портативная, модель Q, в кейсе для переноски



Система ультразвуковой визуализации портативная, модель Q, в кейсе для переноски



Аппарат ультразвуковой портативный, модель Q7

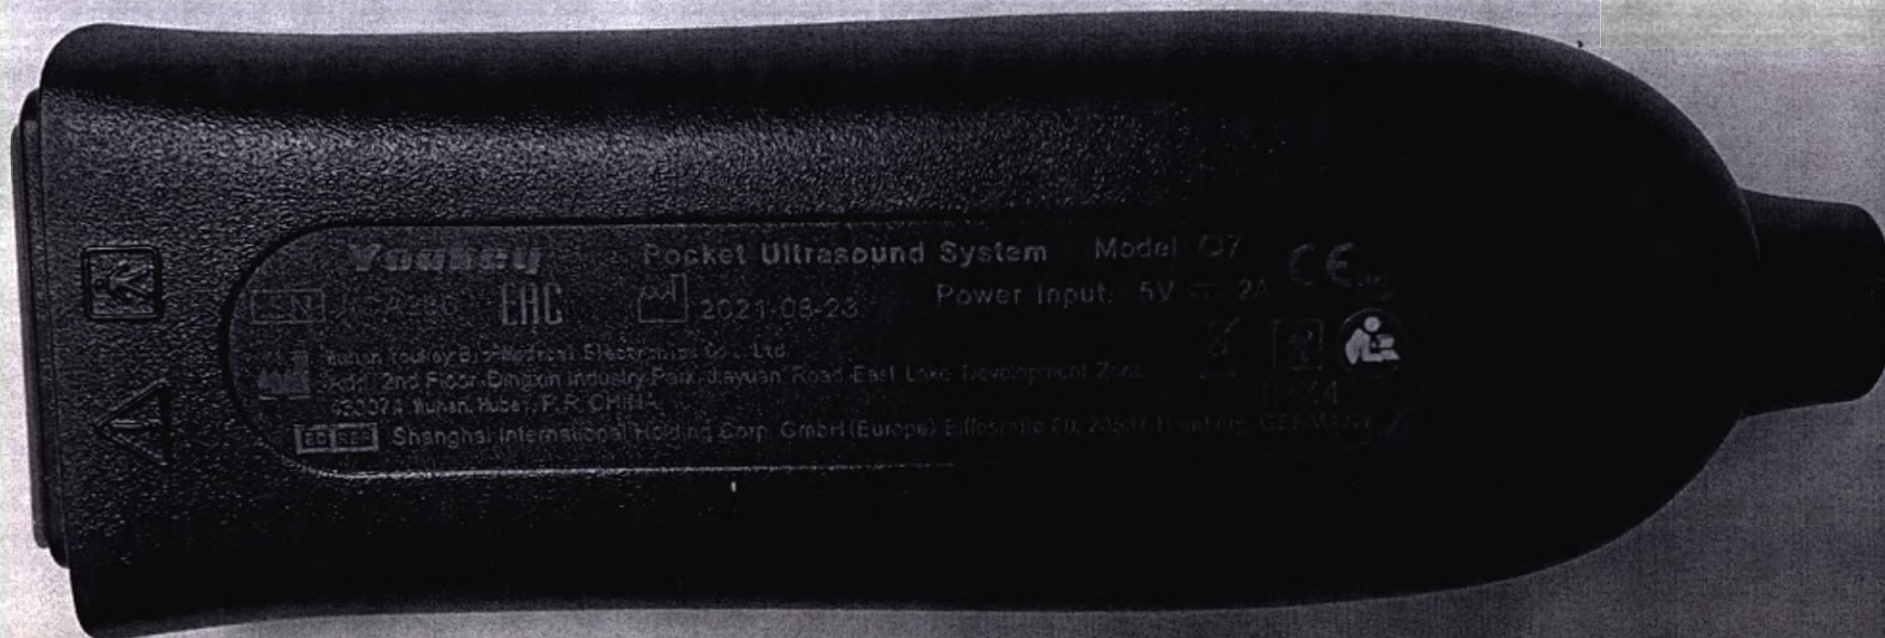

Аппарат ультразвуковой портативный, модель Q7



Аппарат ультразвуковой портативный, модель Q7




Датчик С5-2Fs (фазированный)



Датчик С5-2Fs (фазированный)



Датчик C5-2Fs (фазированный) - маркировка

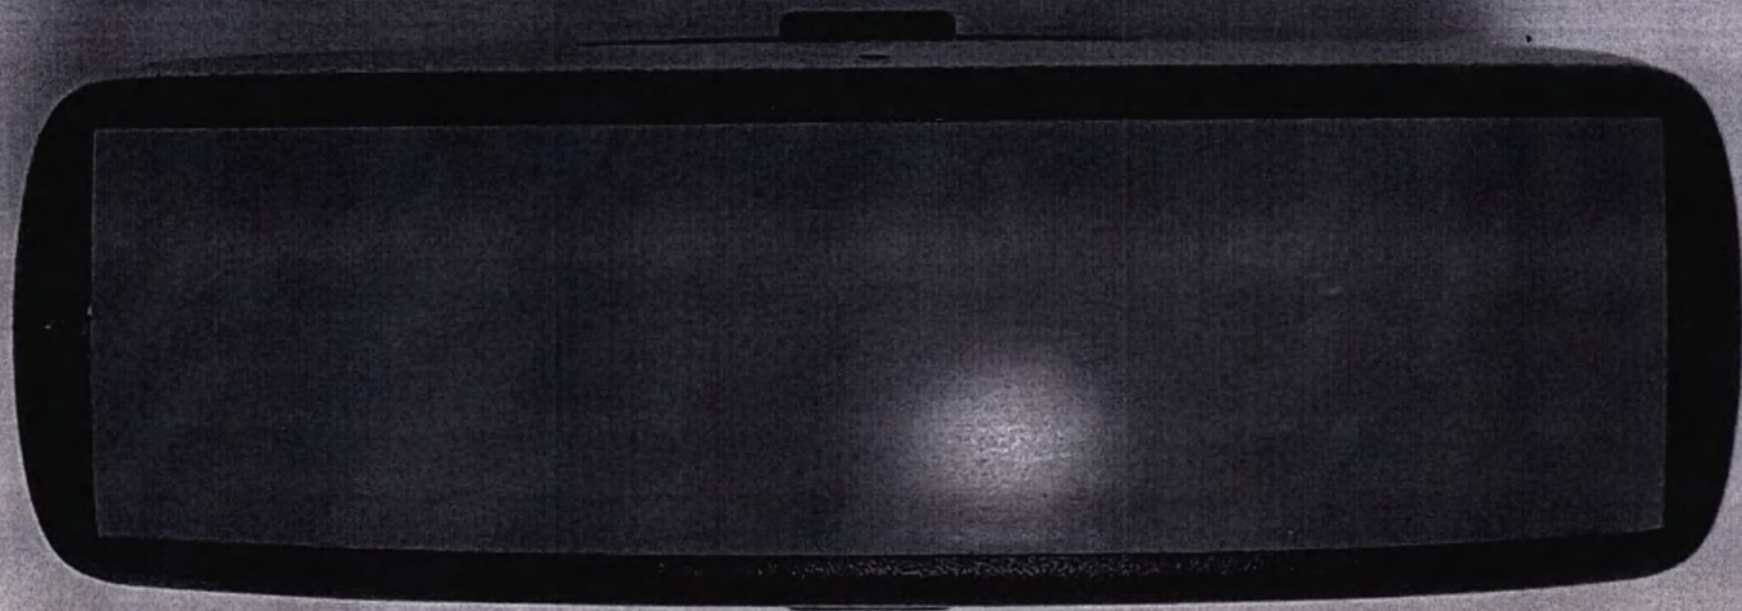


Датчик С5-2Кs (конвексный)




Датчик С5-2Кs (конвексный)




Датчик C5-2Ks (конвексный) - маркировка

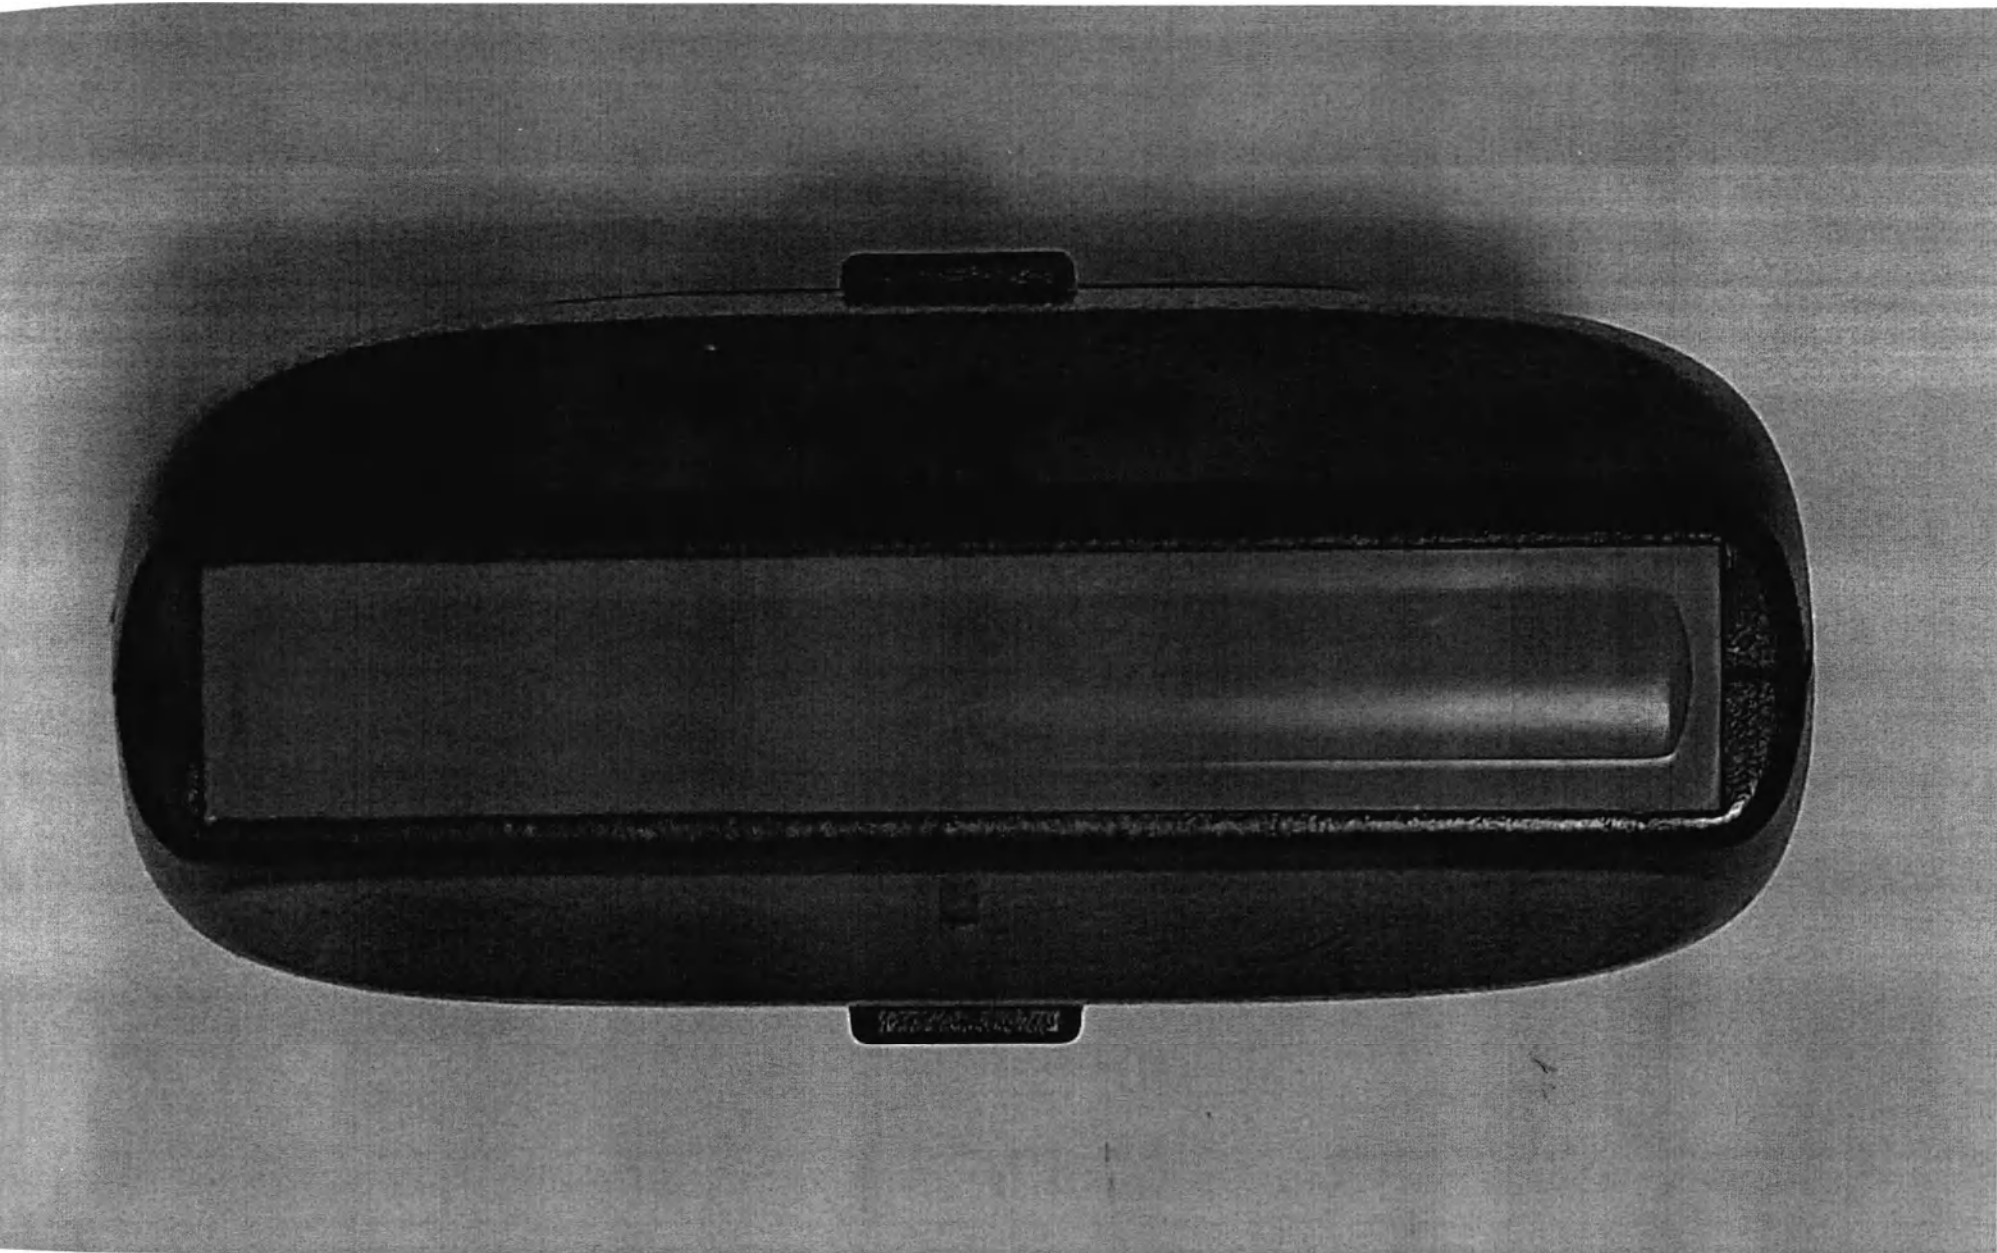

Датчик L11-4Ks (линейный)

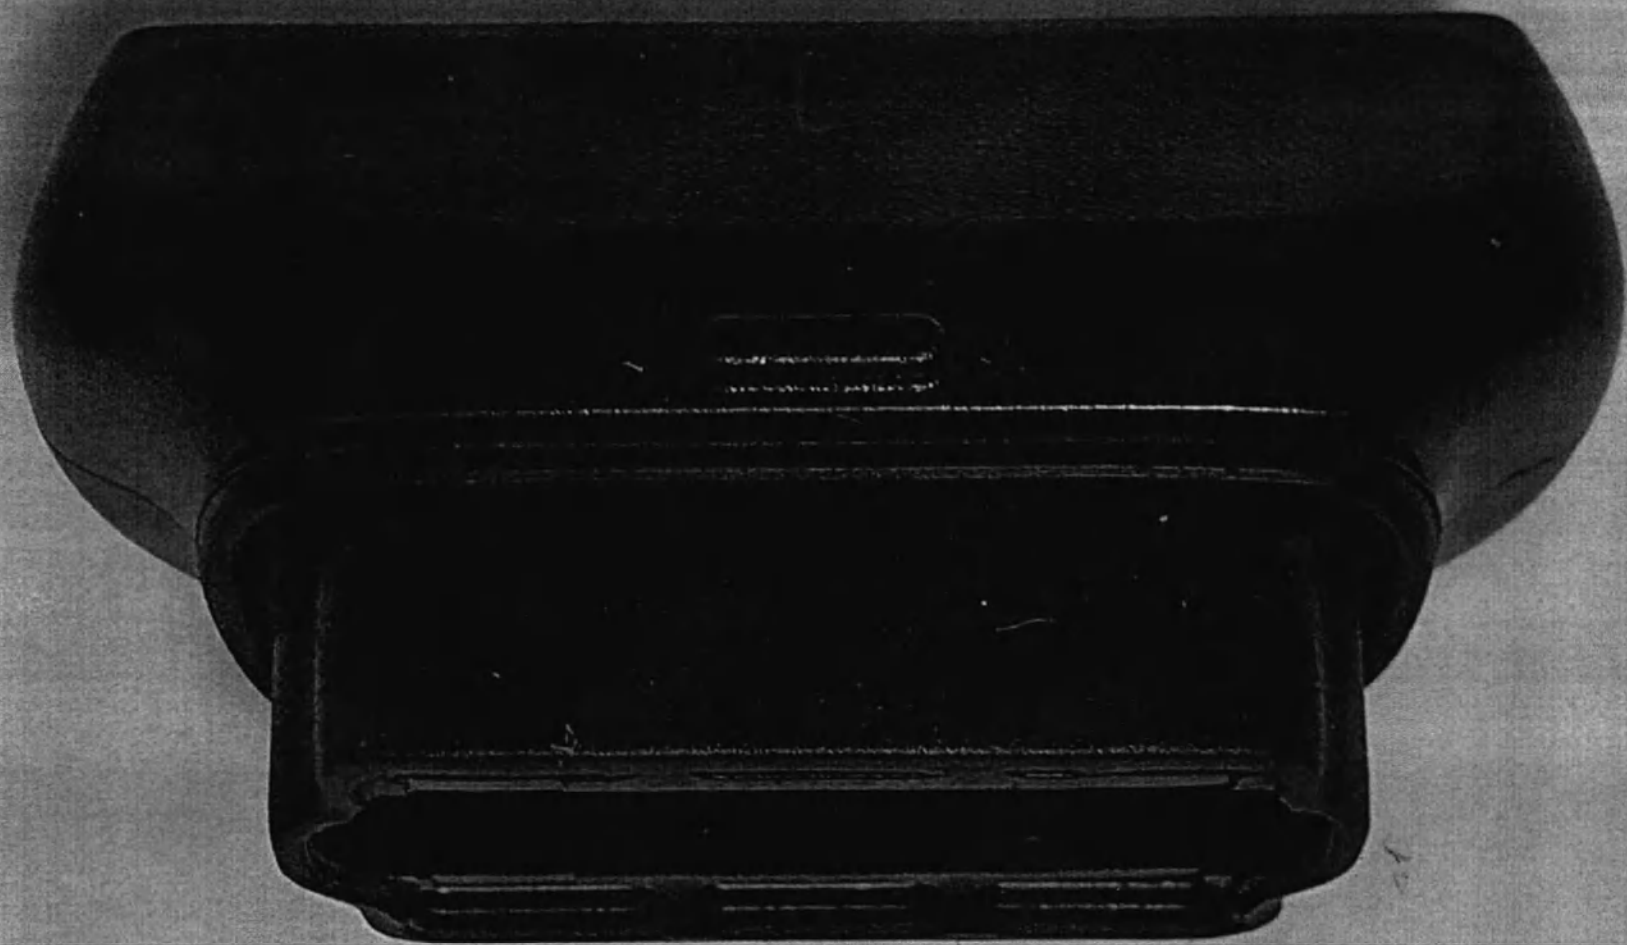

Датчик L11-4Ks (линейный)

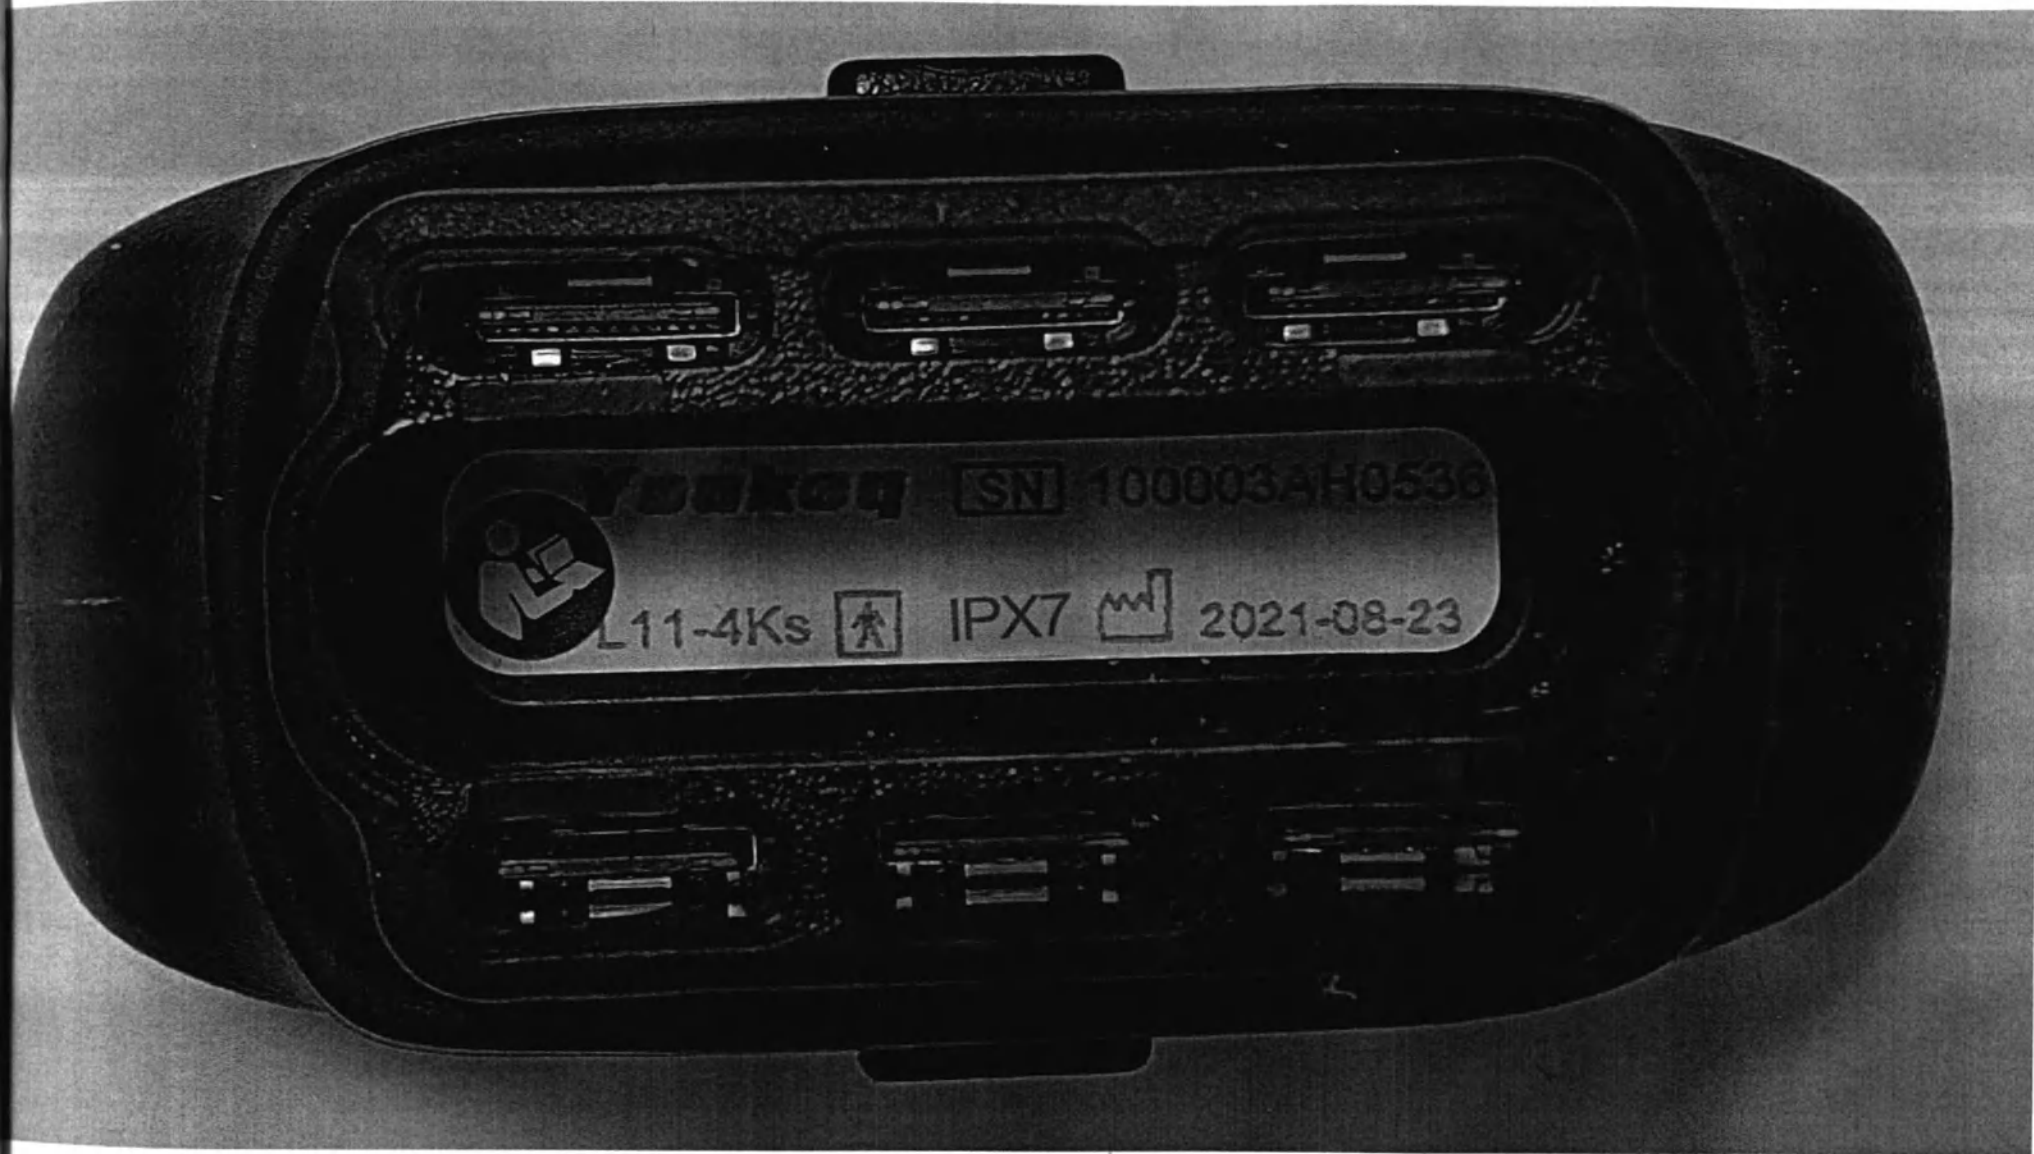

Датчик L11-4Ks (линейный) - маркировка




Датчик L11-4Gs (малый линейный)




Датчик L11-4Gs (малый линейный)




Датчик L11-4Gs (малый линейный) - маркировка

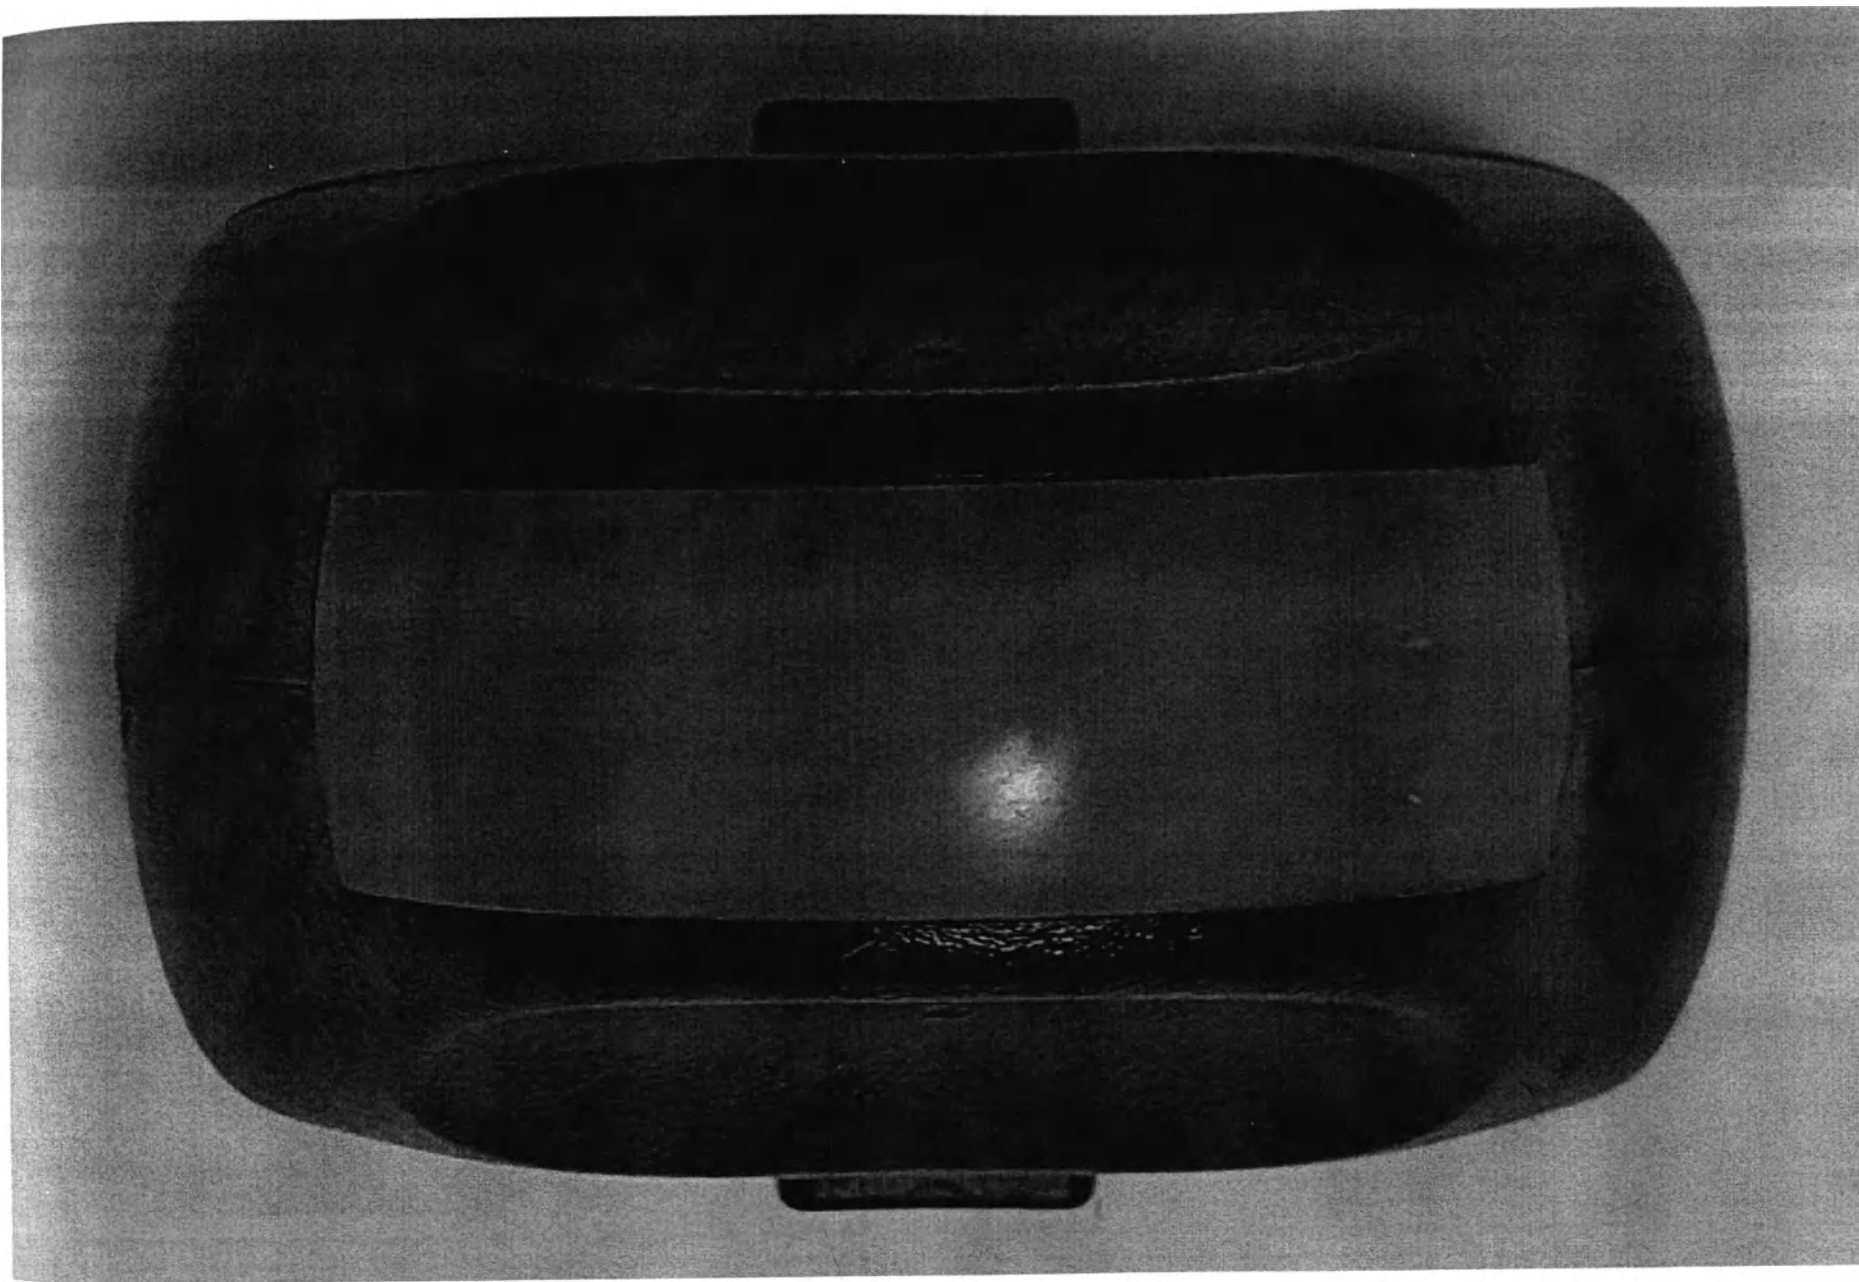


Датчик C8-5Ks (микроконвексный)

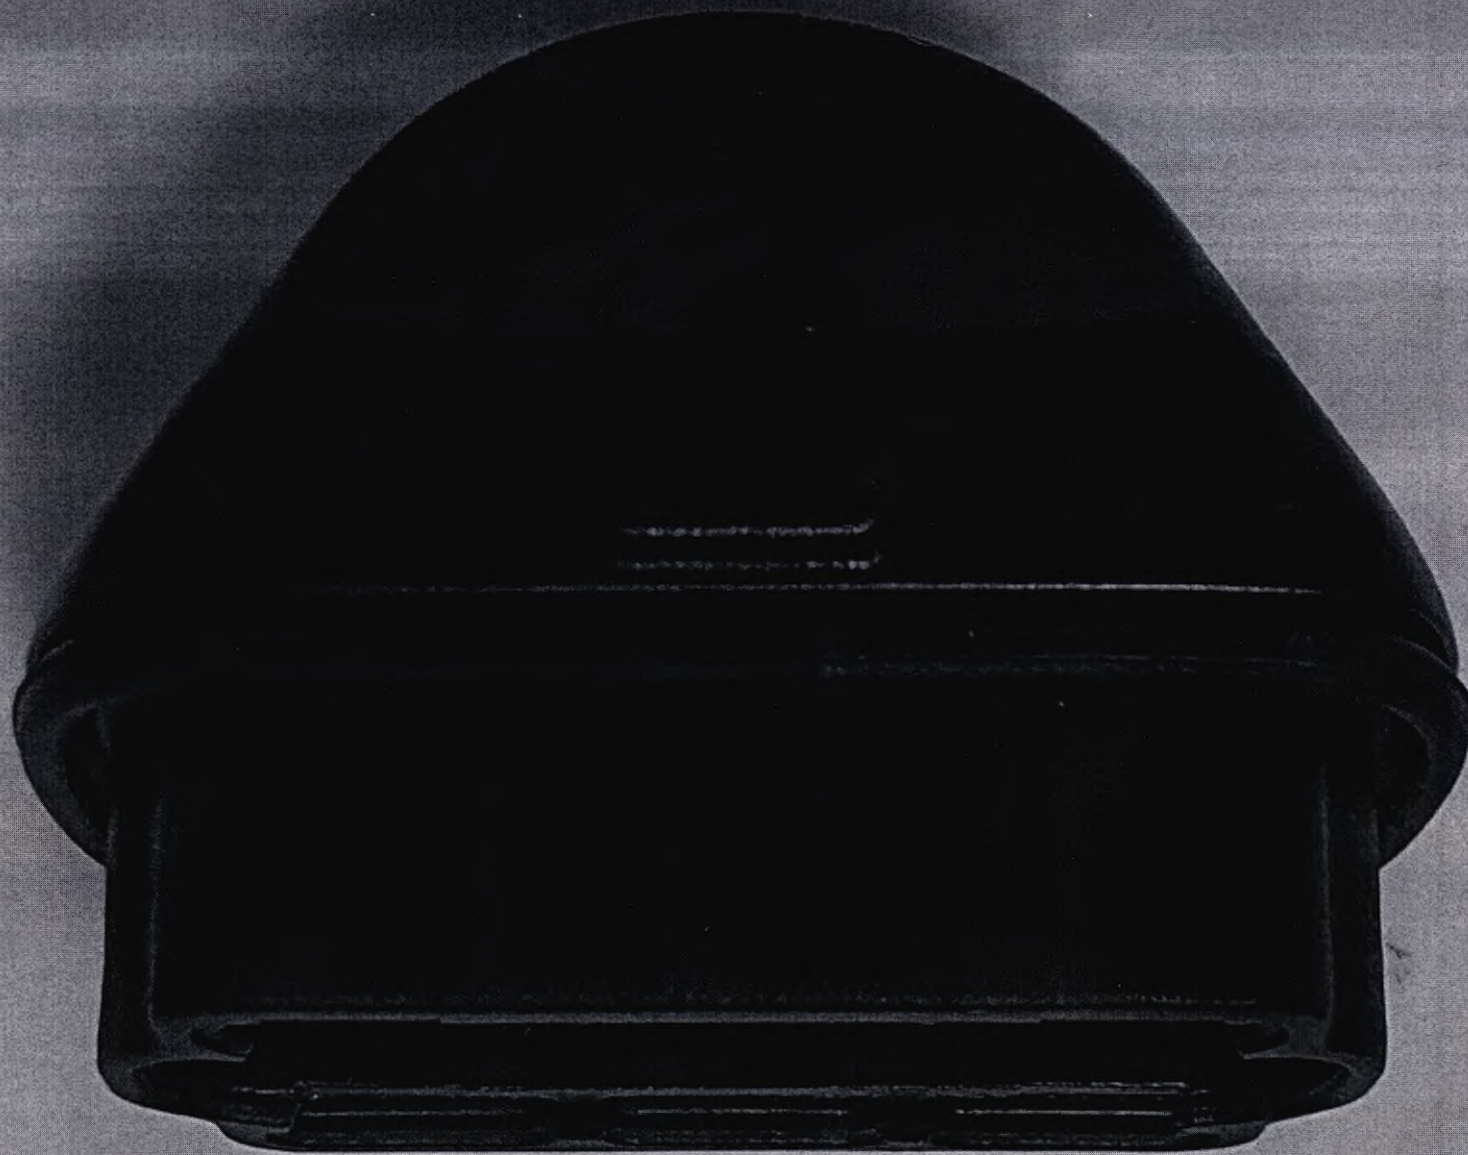


Датчик С8-5Кs (микроконвексный)

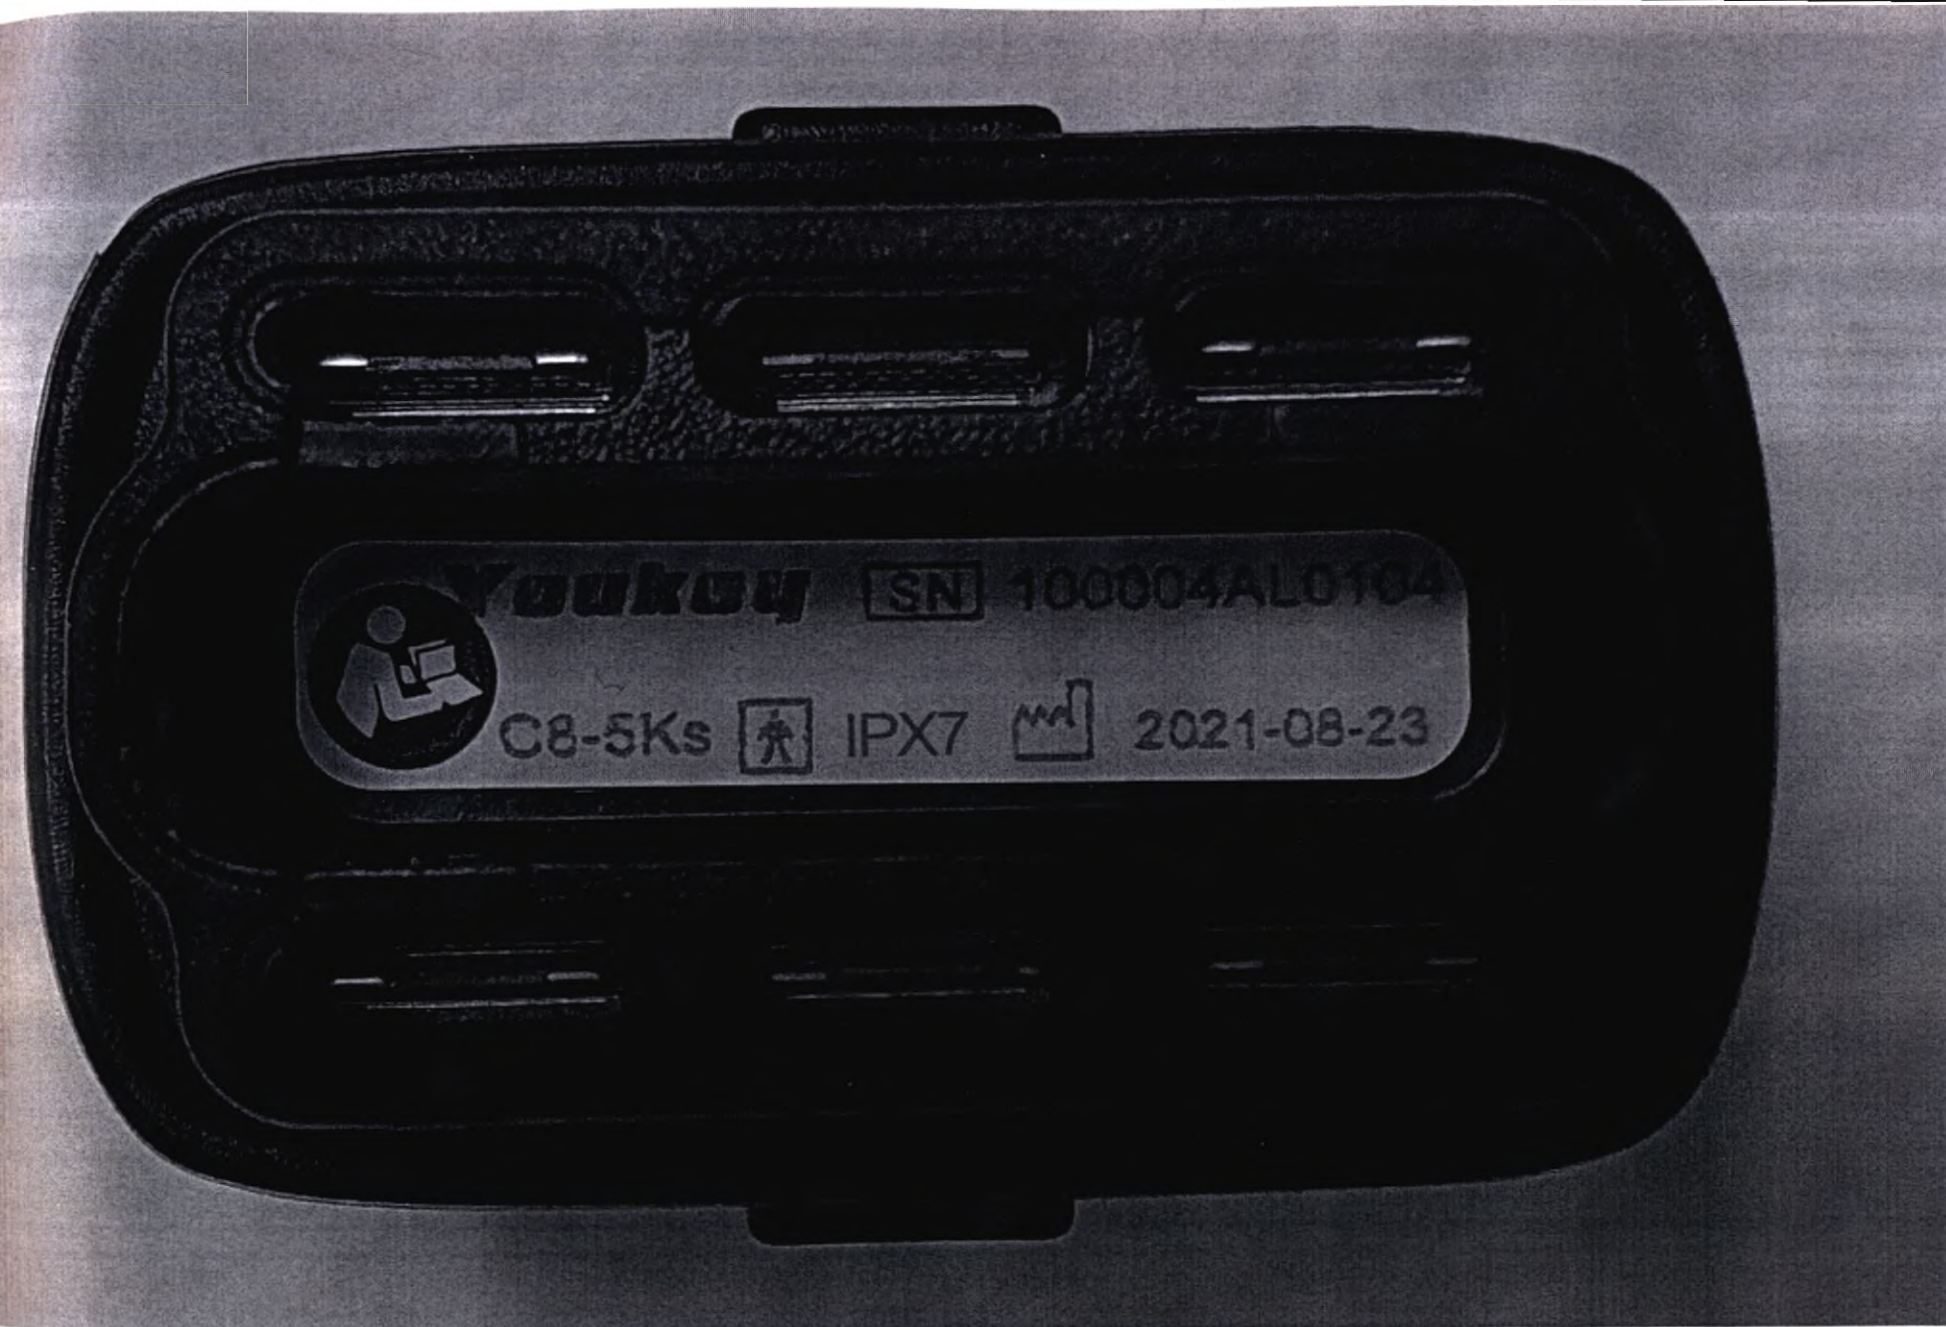


Датчик C8-5Ks (микроконвексный) - маркировка

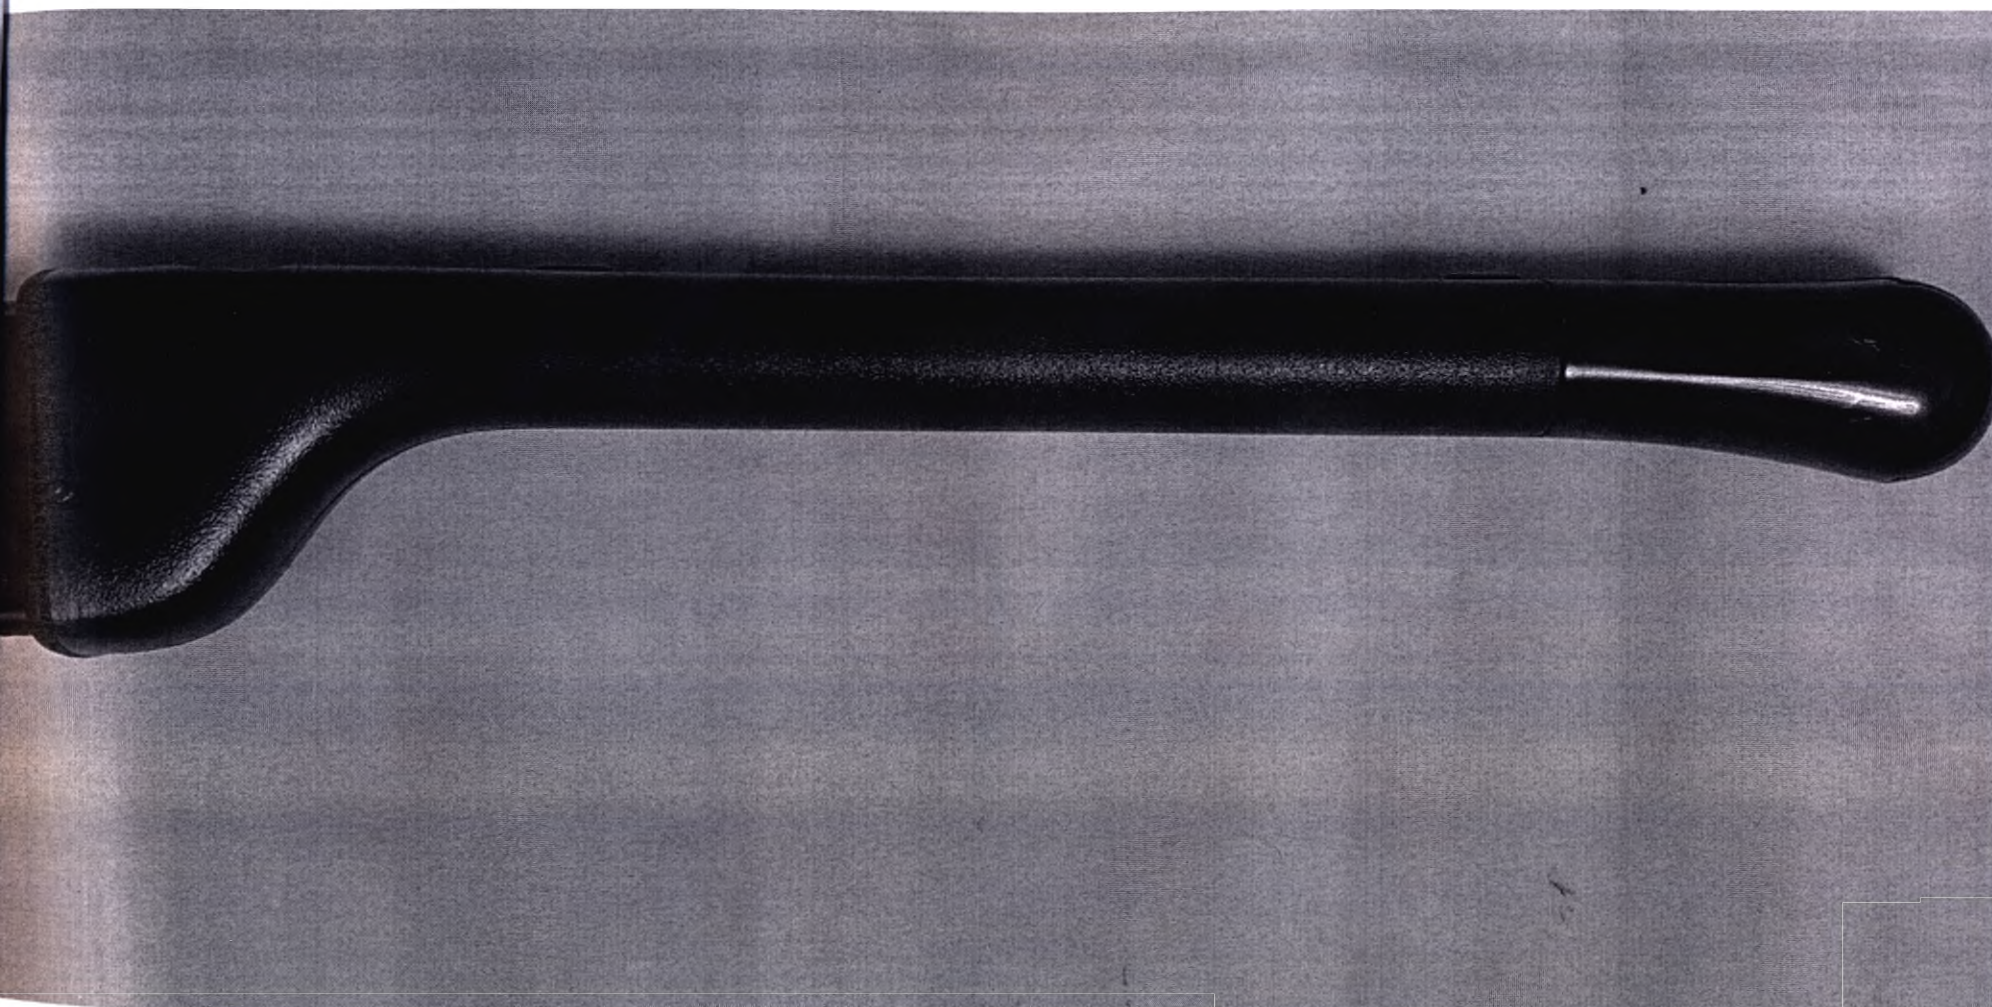

Датчик E10-4Ks (трансвагинальный)

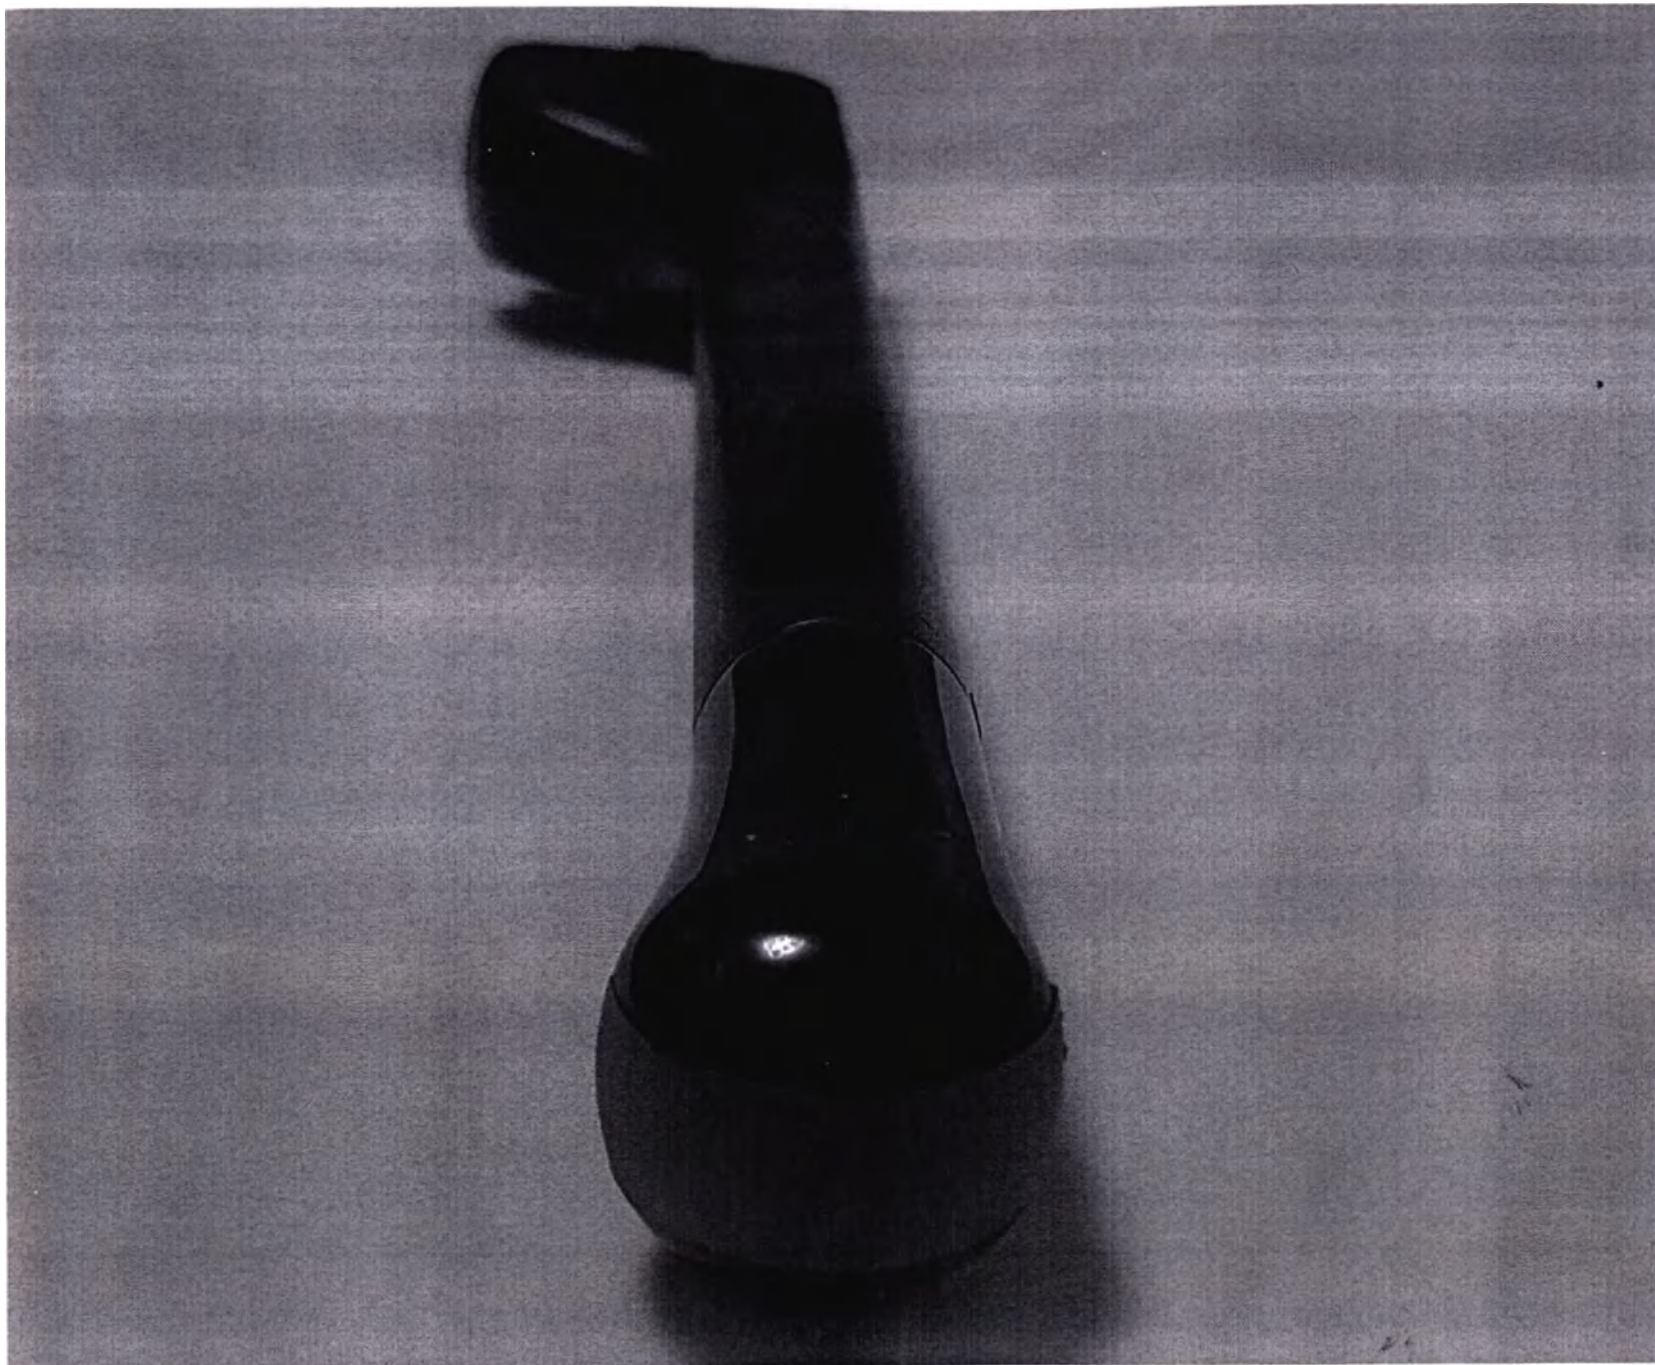


Датчик E10-4Ks (трансвагинальный)

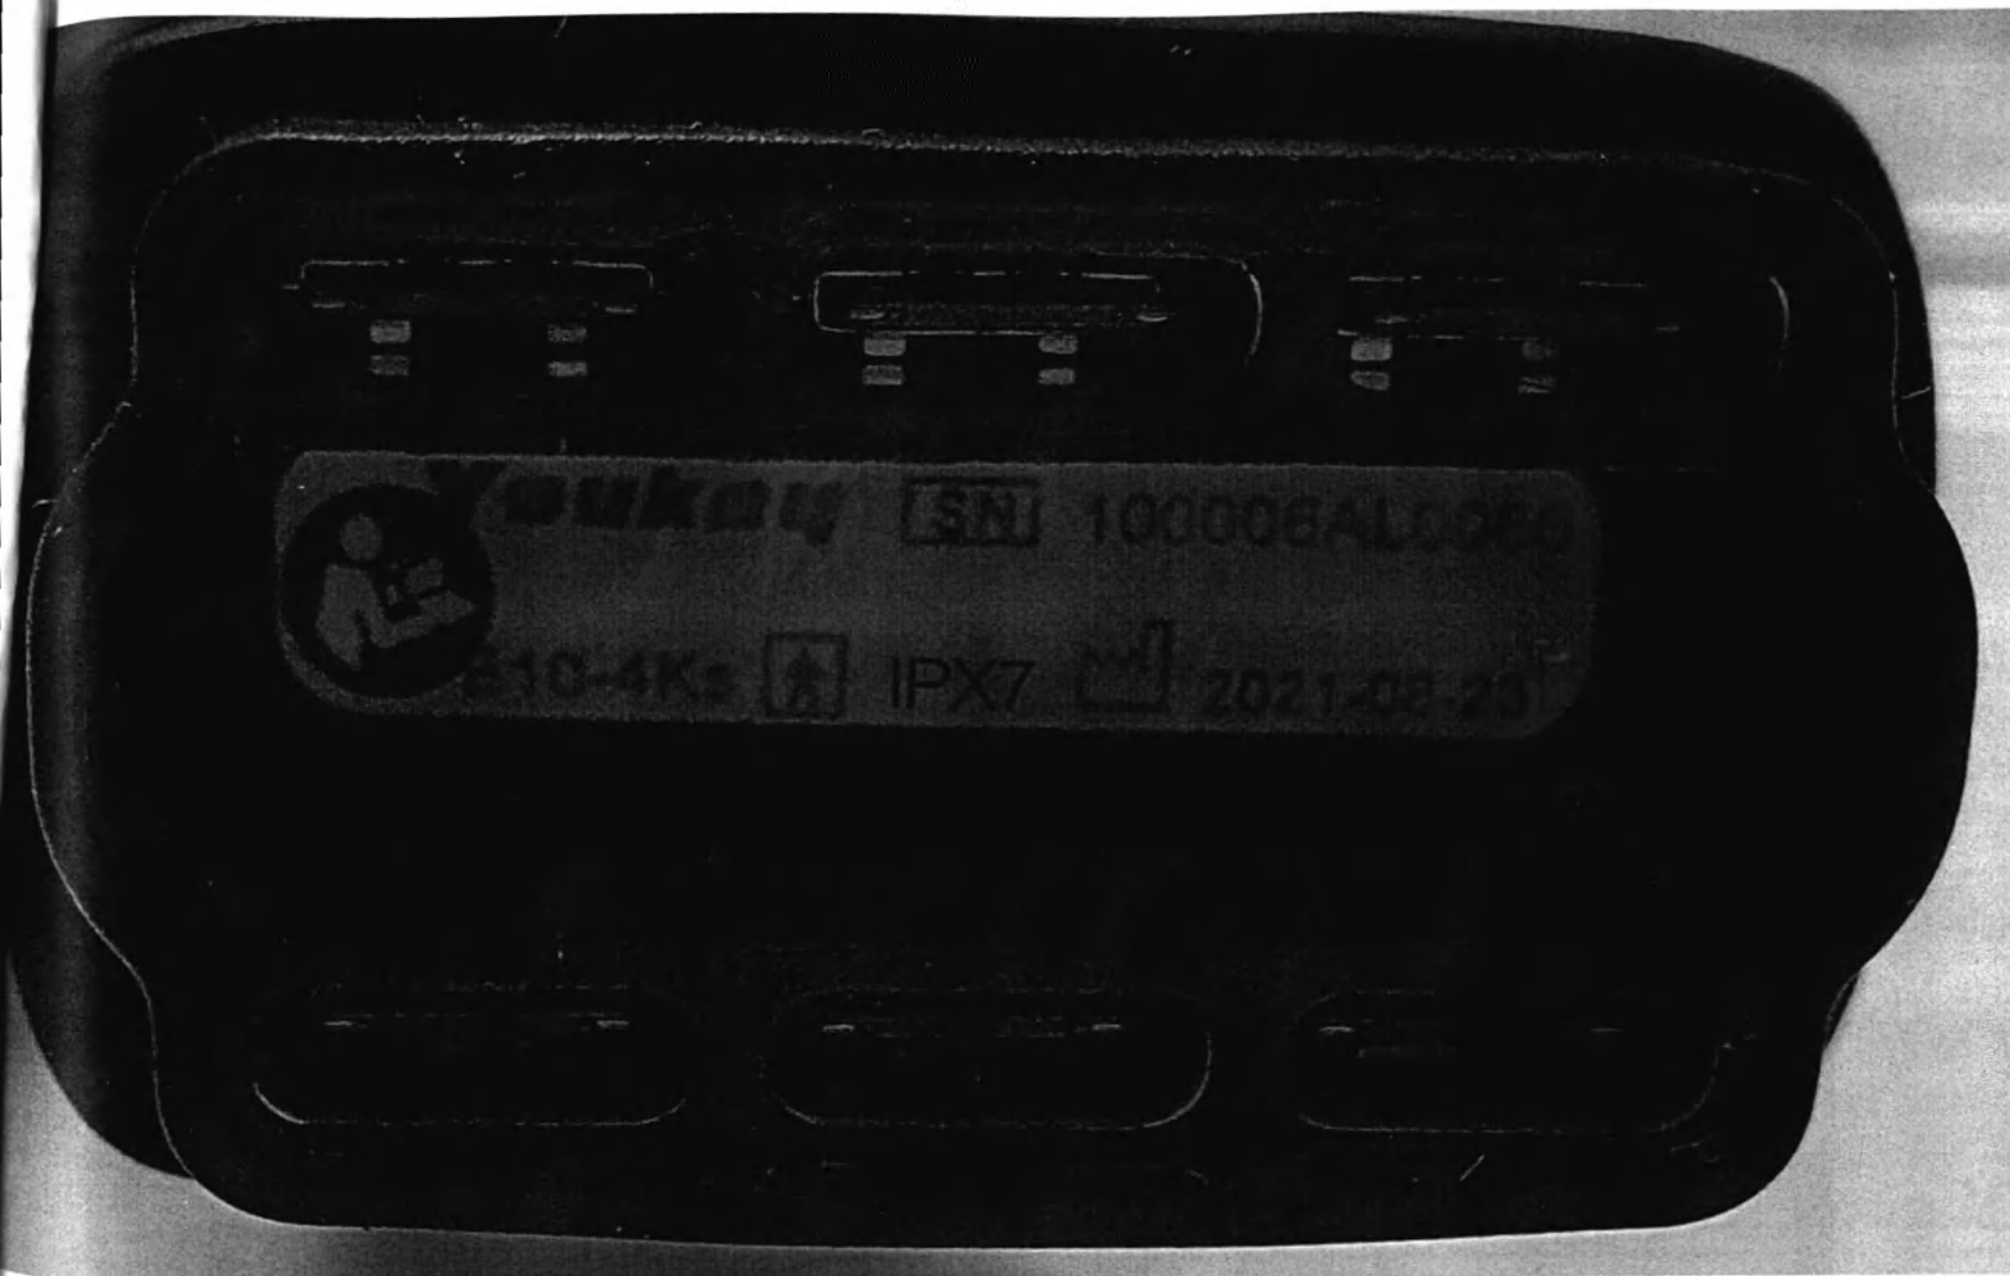

Датчик E10-4Ks (трансвагинальный) - маркировка



Адаптер питания

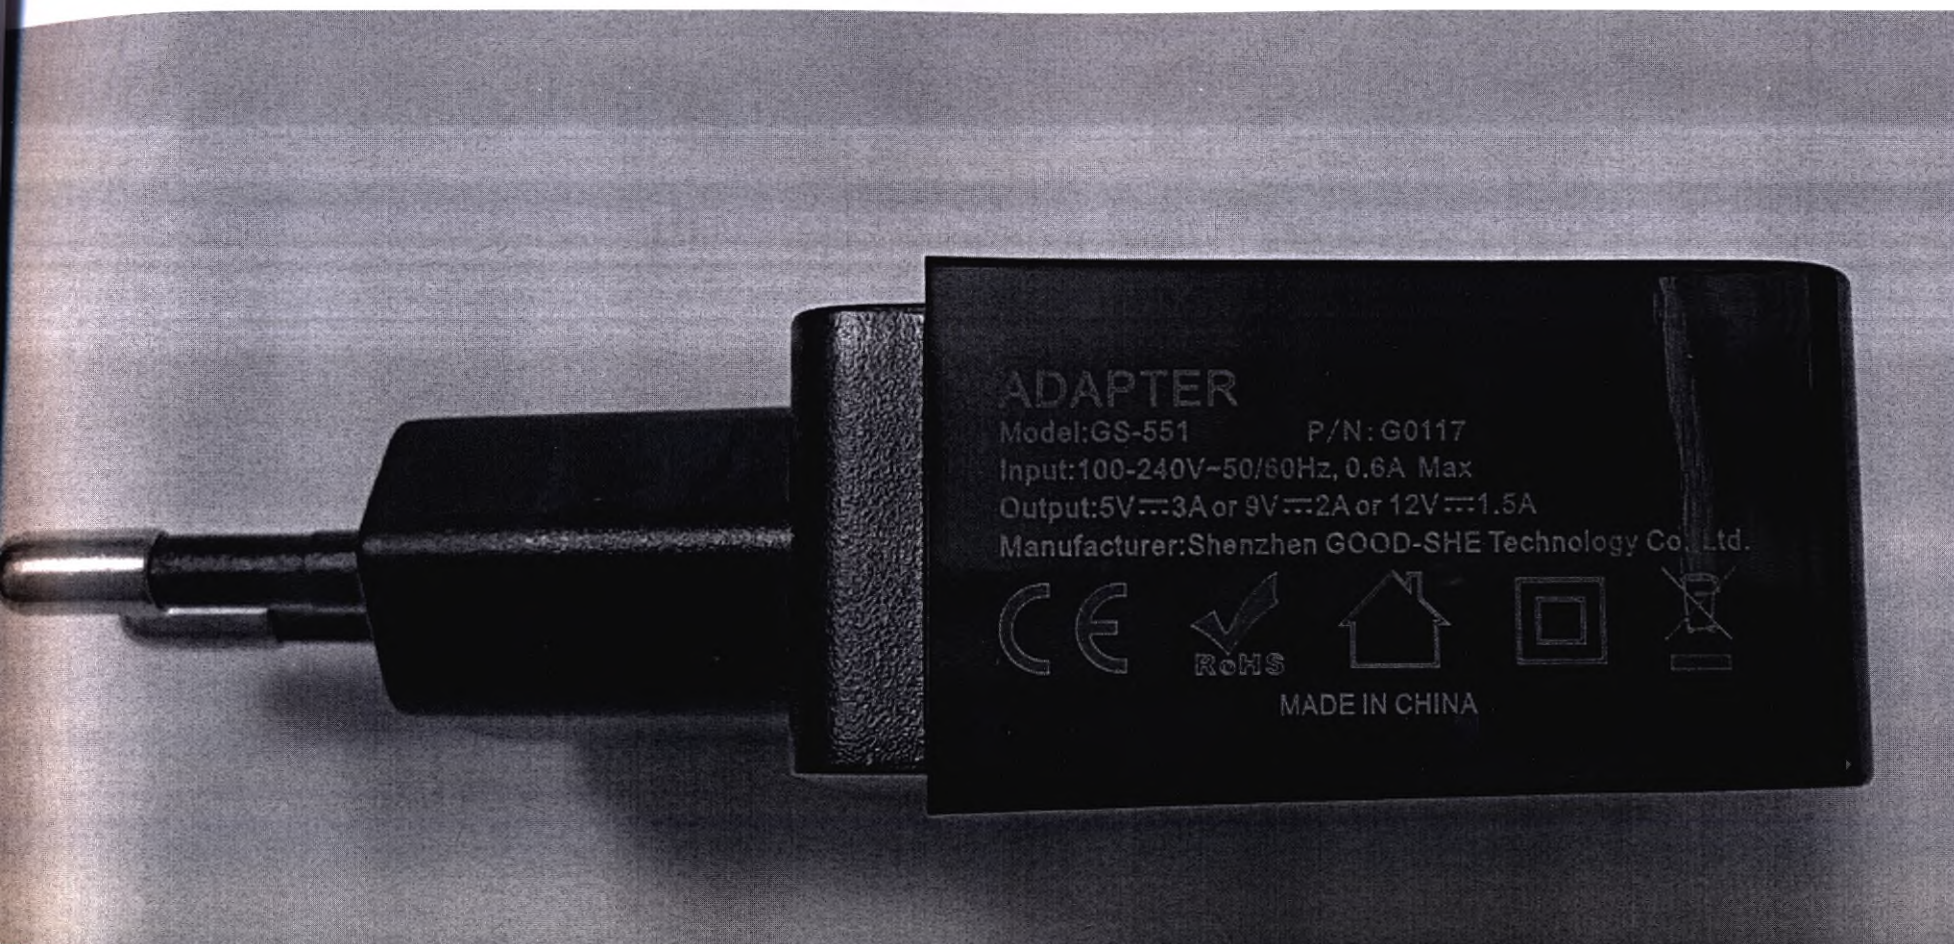

Адаптер питания- маркировка




Адаптер питания



Кабель питания



Внешний вид транспортной упаковки

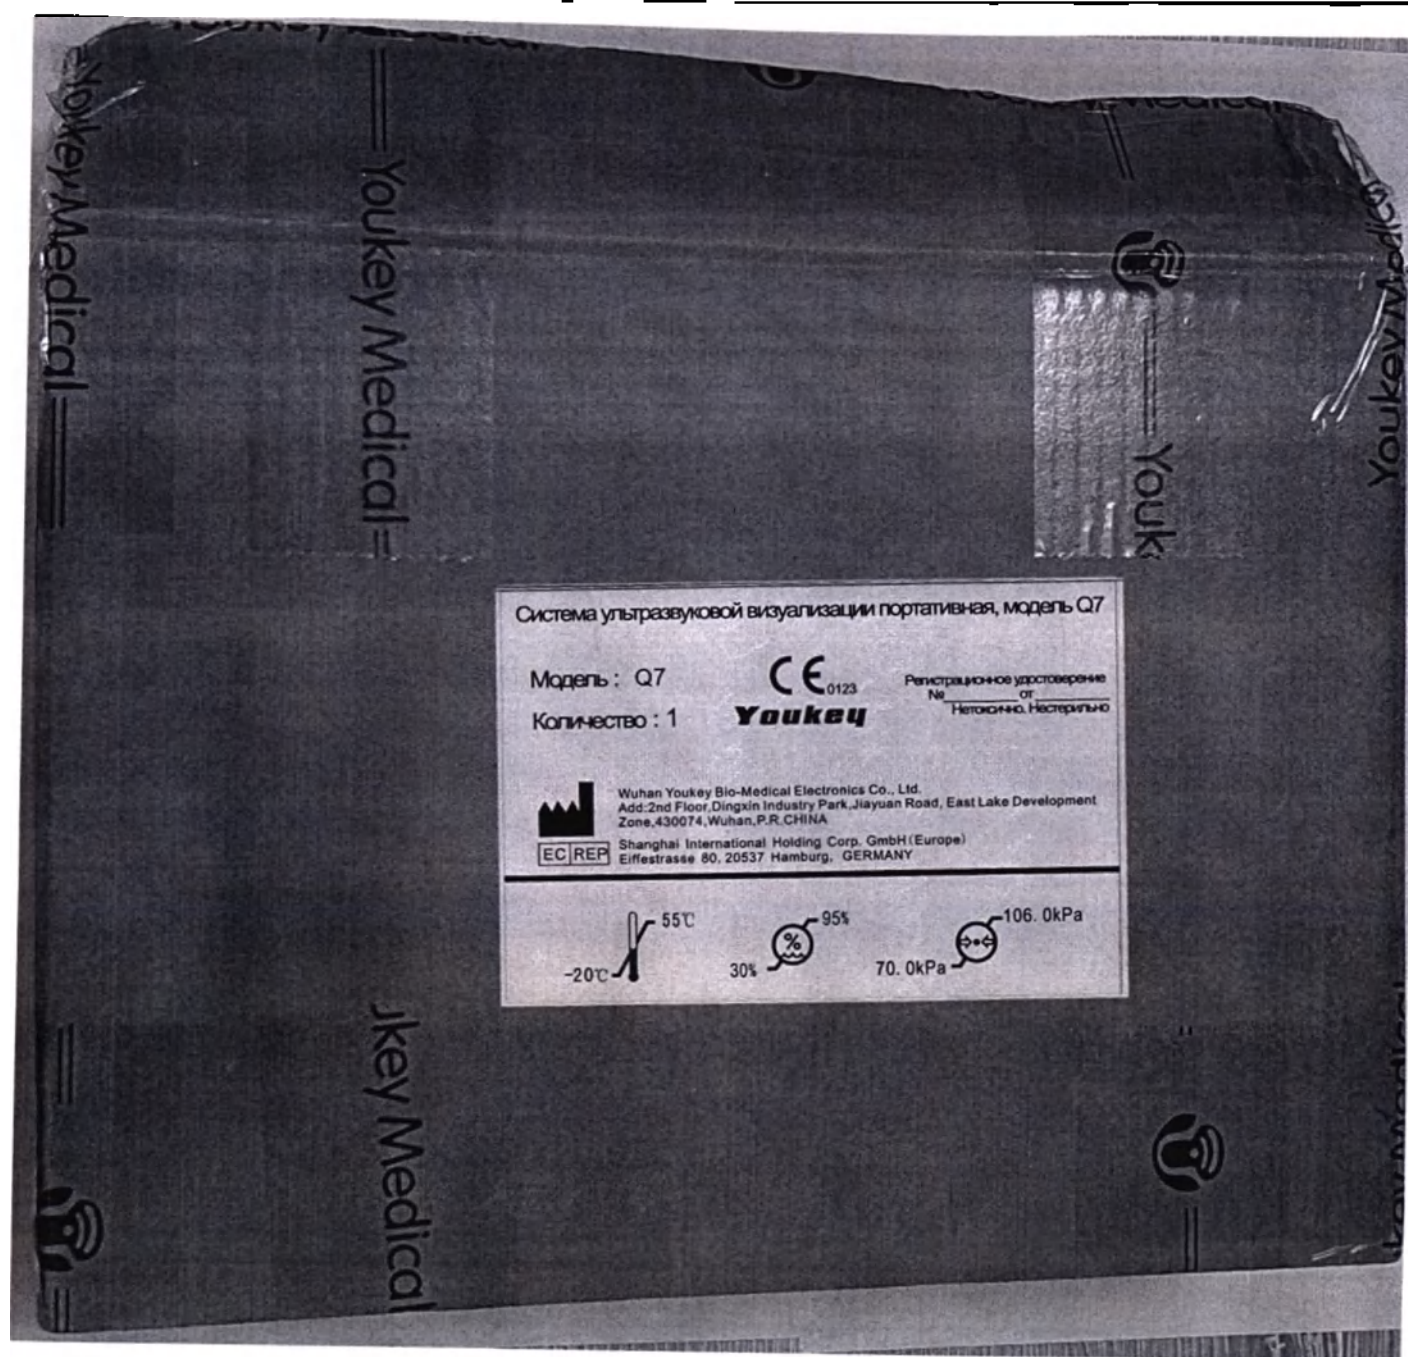

Внешний вид транспортной упаковки с этикеткой

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
32 листа(ов)
Директор ООО "ИНТРАДЕЙ-К"
Курбаналиев А.В.

