


«ОГД»


«РОТНА»
«ROTANA»

МОСКВА


Фотографические изображения медицинского изделия
Набор для быстрого определения антигена SARS-CoV-2
(в мазках из носоглотки и ротоглотки)
иммунофлуоресцентным методом (SARS-CoV-2 Antigen
Fast Test Kit)




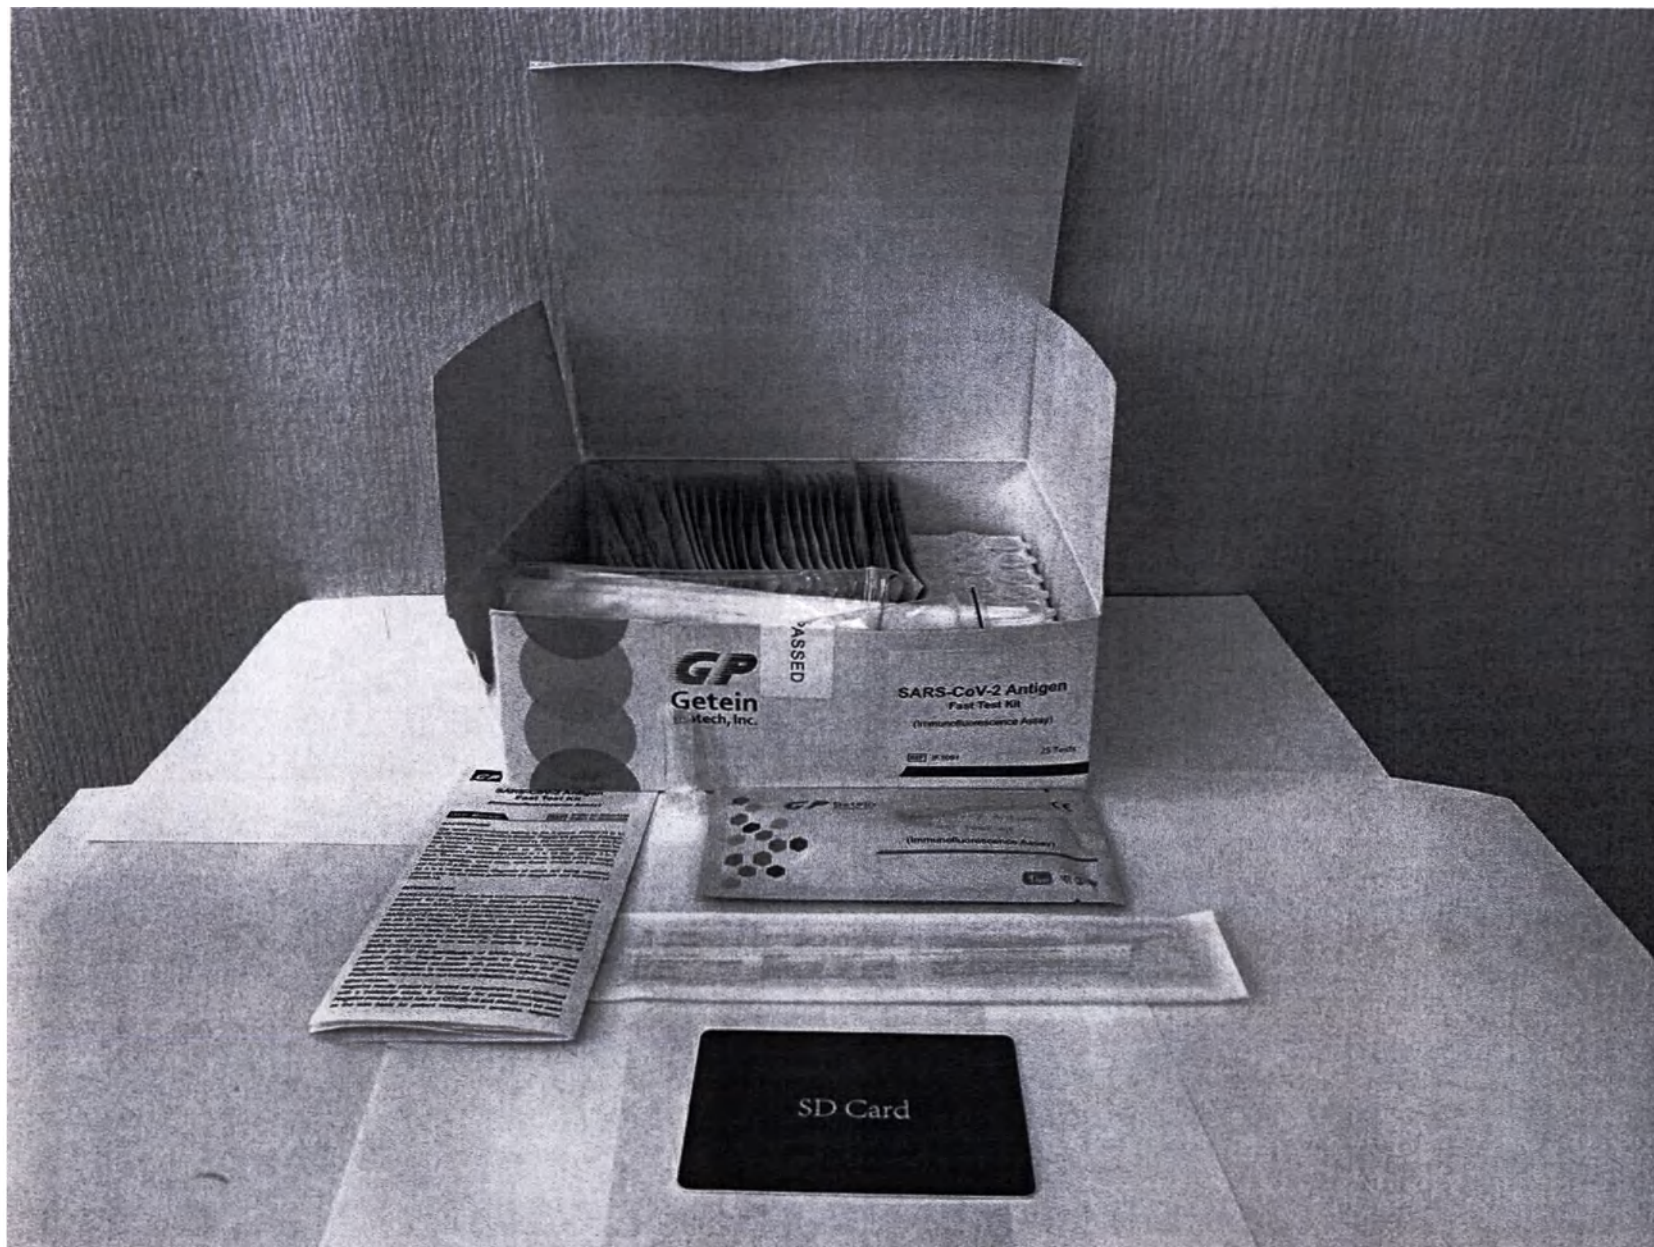

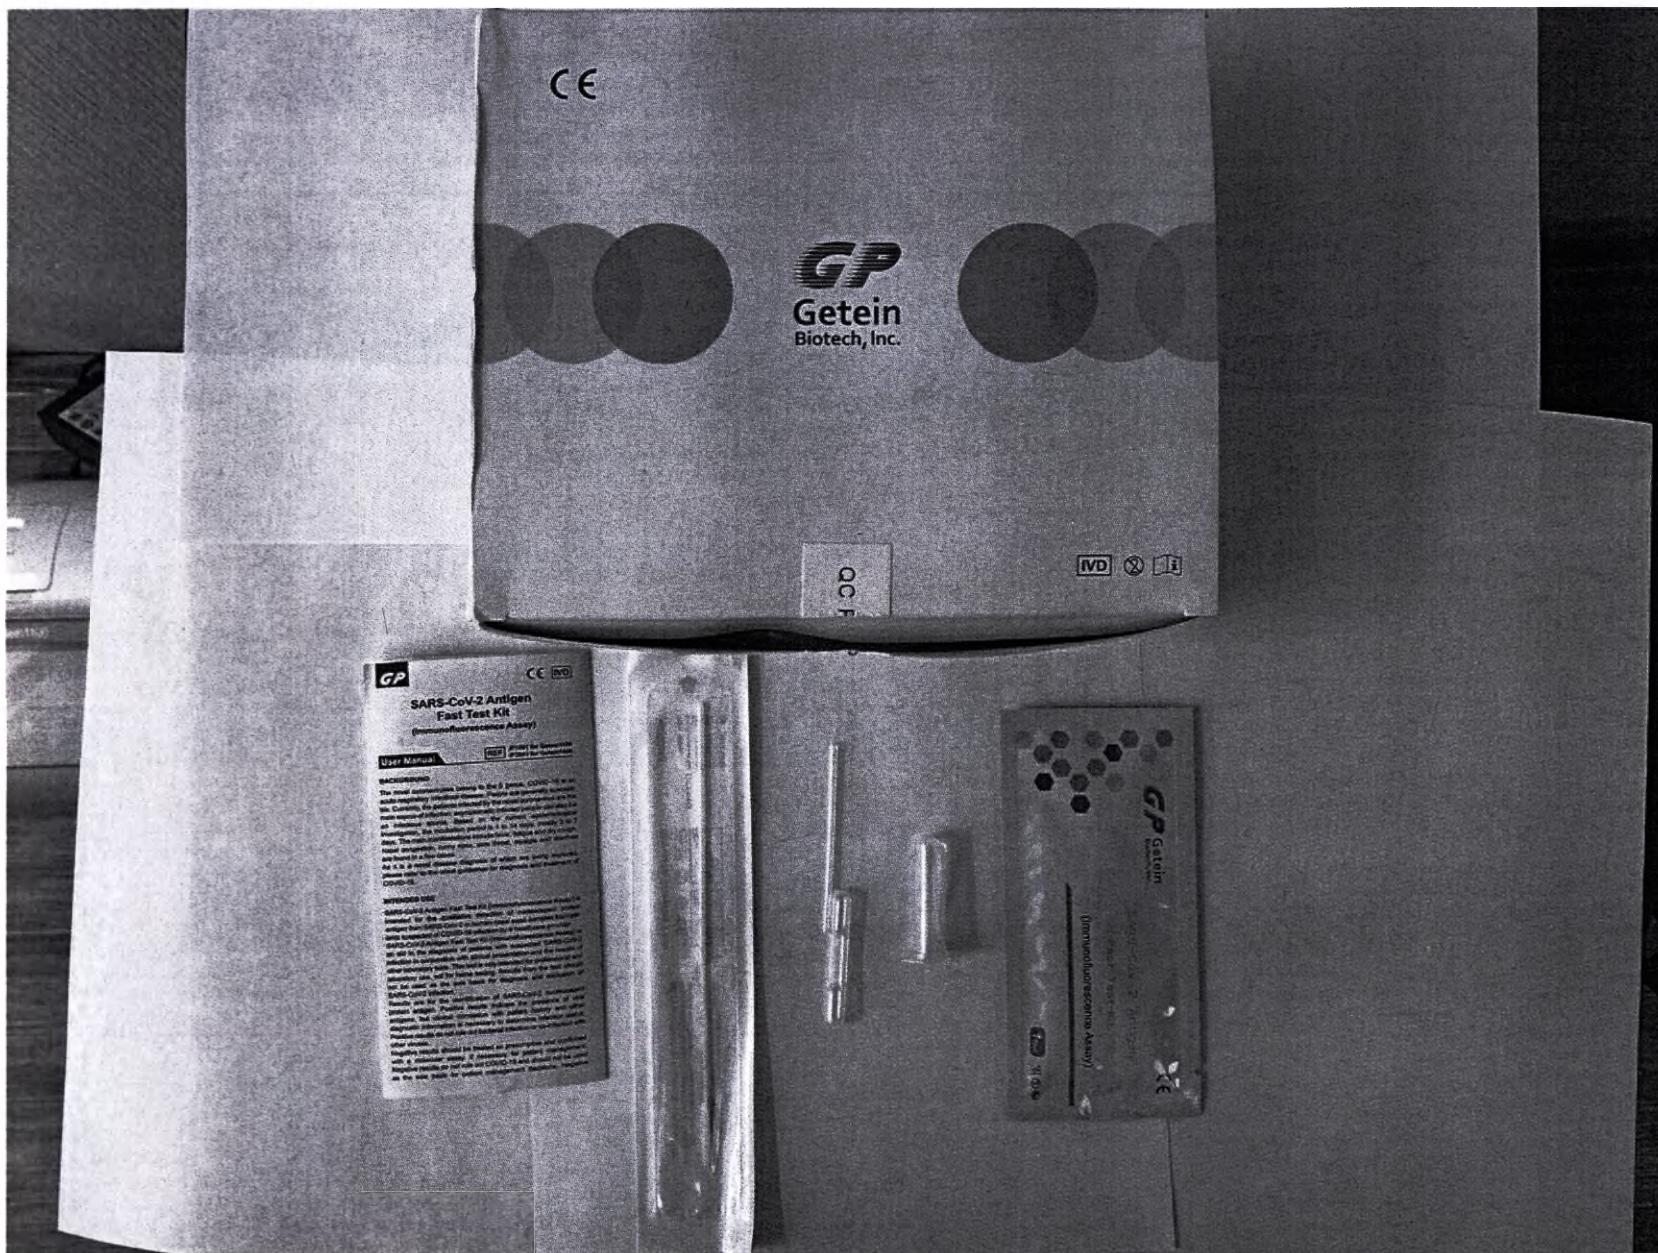



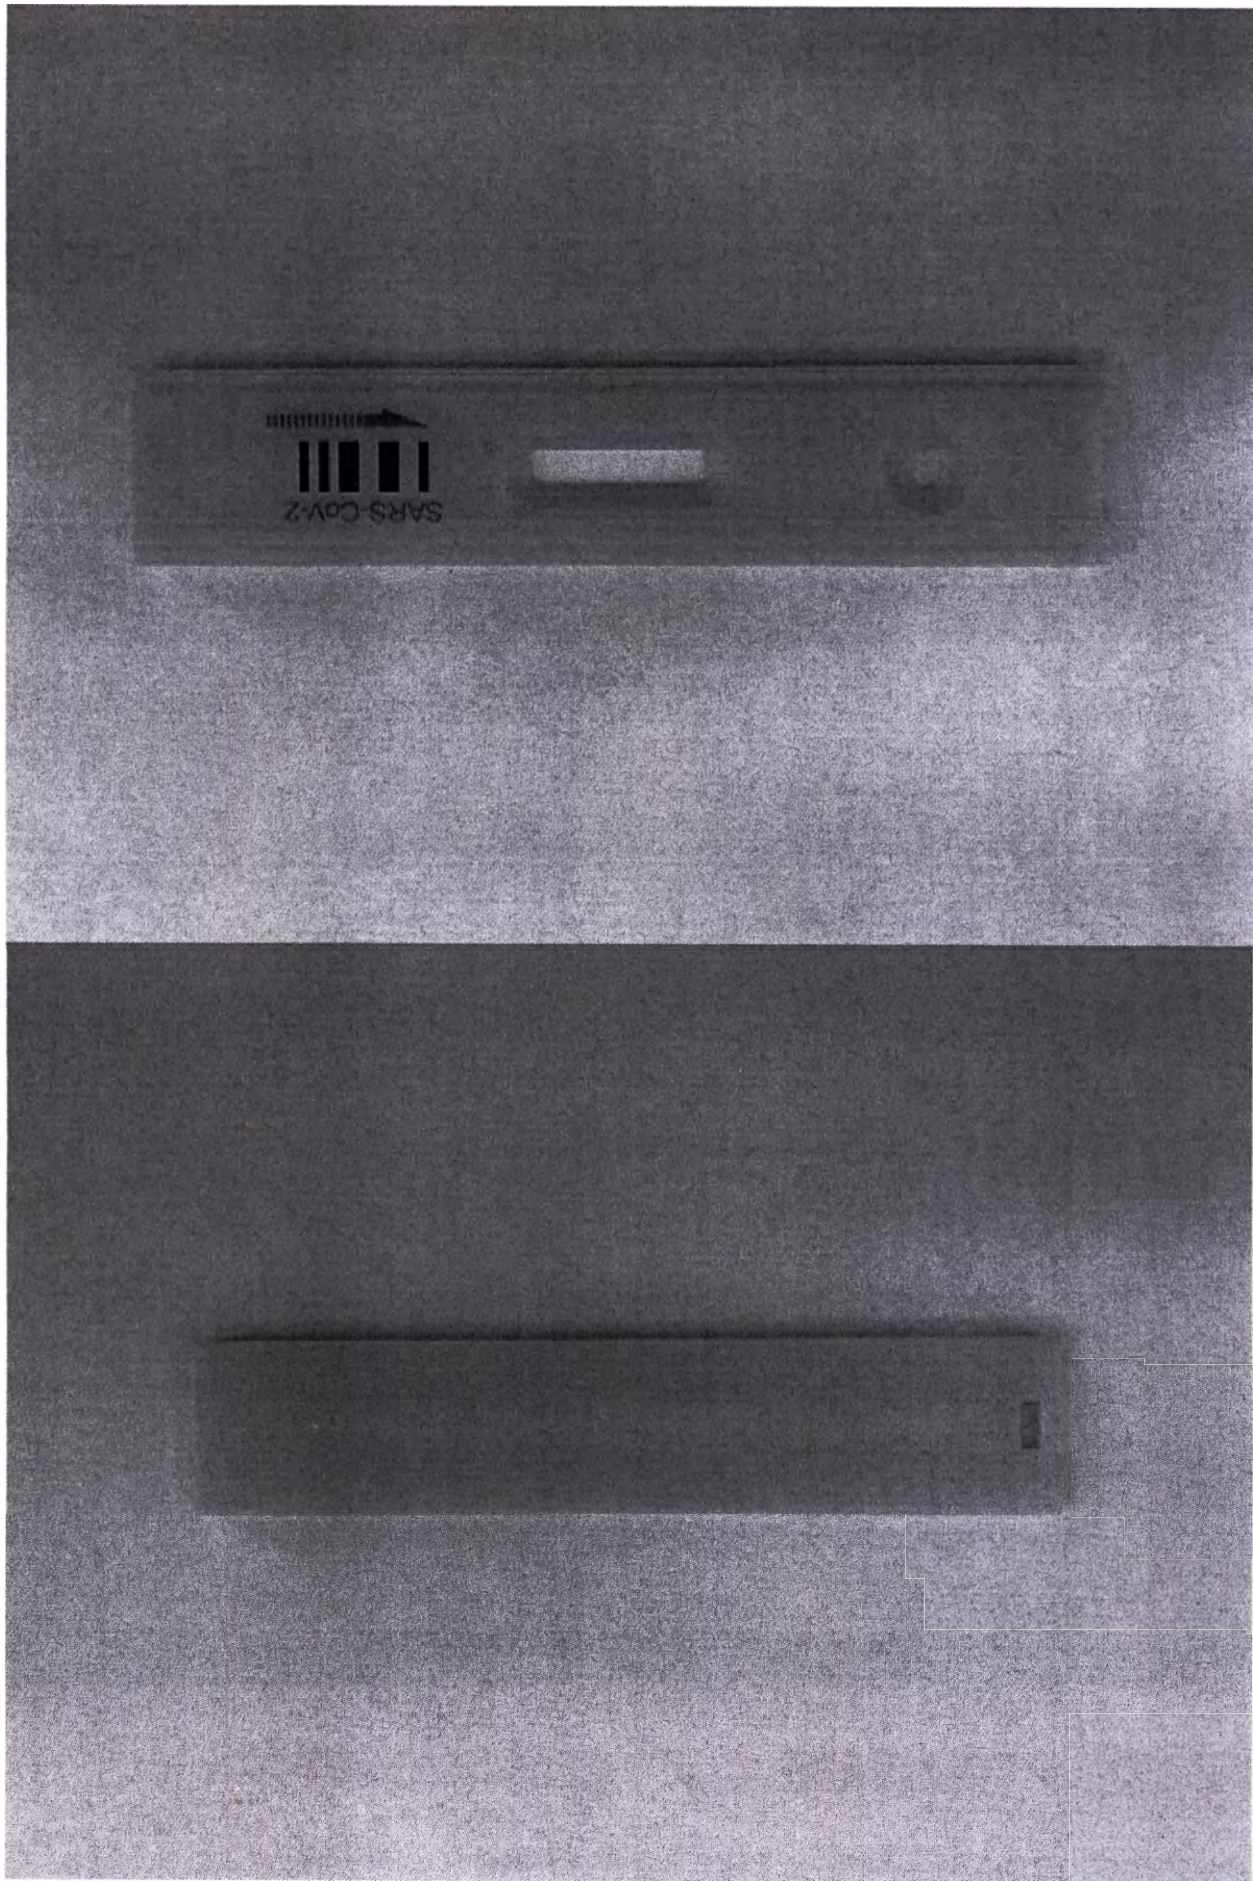

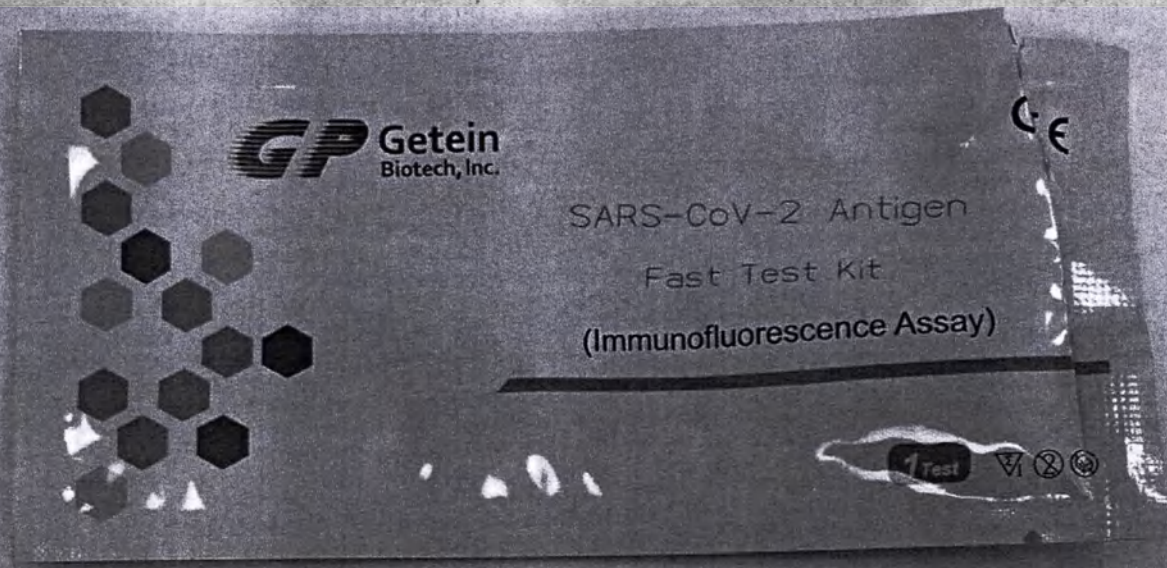

SARS-CoV-2 Antigen

Storage Condition:

* Keep the test card sealed at 4~30°C ^{4°C} ^{30°C} within expiry time (24 months).

* Use the test card within 1 hour once the foil bag is opened.

 LOT: YSC200005W

 MFG: 2020-12-22

 EXP: 2022-12-22



WIF93-HT-01

EC REP

Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e
Verd, 2595AA, The Hague,
Netherlands.



GP
Getein
Biotech, Inc.

PASSED

SARS-CoV-2 Antigen
Fast Test Kit

(Immunofluorescence Assay)

REF IF1091

25 Tests

GP Getein Biotech, Inc.



Add: No.9 Bofu Road, Luhe District, Nanjing, 211505, China

Tel: +86-25-68568508

Fax: +86-25-68568500

E-mail: overseas@getein.com.cn

Website: <http://www.bio-GP.com.cn>



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

11 лист 28
Генеральный директор
ООО «Ротана»

« 28 » дек 2021 г.

 В.Г. Фирсов

