

 УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НСК РУС»
Романова М.Е.
«29» декабря 2021 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**«Микромоторы электрические и воздушные для стоматологических
наконечников в составе, в вариантах исполнения»**

Производитель:
«Наканиши Инк.» Nakanishi Inc., Япония
700 Shimohinata, Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan (Япония)

2021 г.

1. Микромоторы электрические для стоматологических наконечников в составе:

1.1. Микромоторы: M40 XS, M40N XS.

1.2. Комплект колец уплотнительных 4шт.

1.3. Инструкция по применению.


2. Микромоторы воздушные для стоматологических наконечников моделей: Ti-Max X, DynaLED, S-Max M, FX, в составе:

1.1. Микромоторы: Ti-Max X205L, DynaLED M205LG M4, DynaLED M205LG B2, S-Max M205, FX205 M4, FX205 B2.

1.2. Комплект колец уплотнительных 4шт. (по необходимости).


1.3. Масло с насадкой для смазки уплотнительных колец.

1.4. Инструкция по применению.

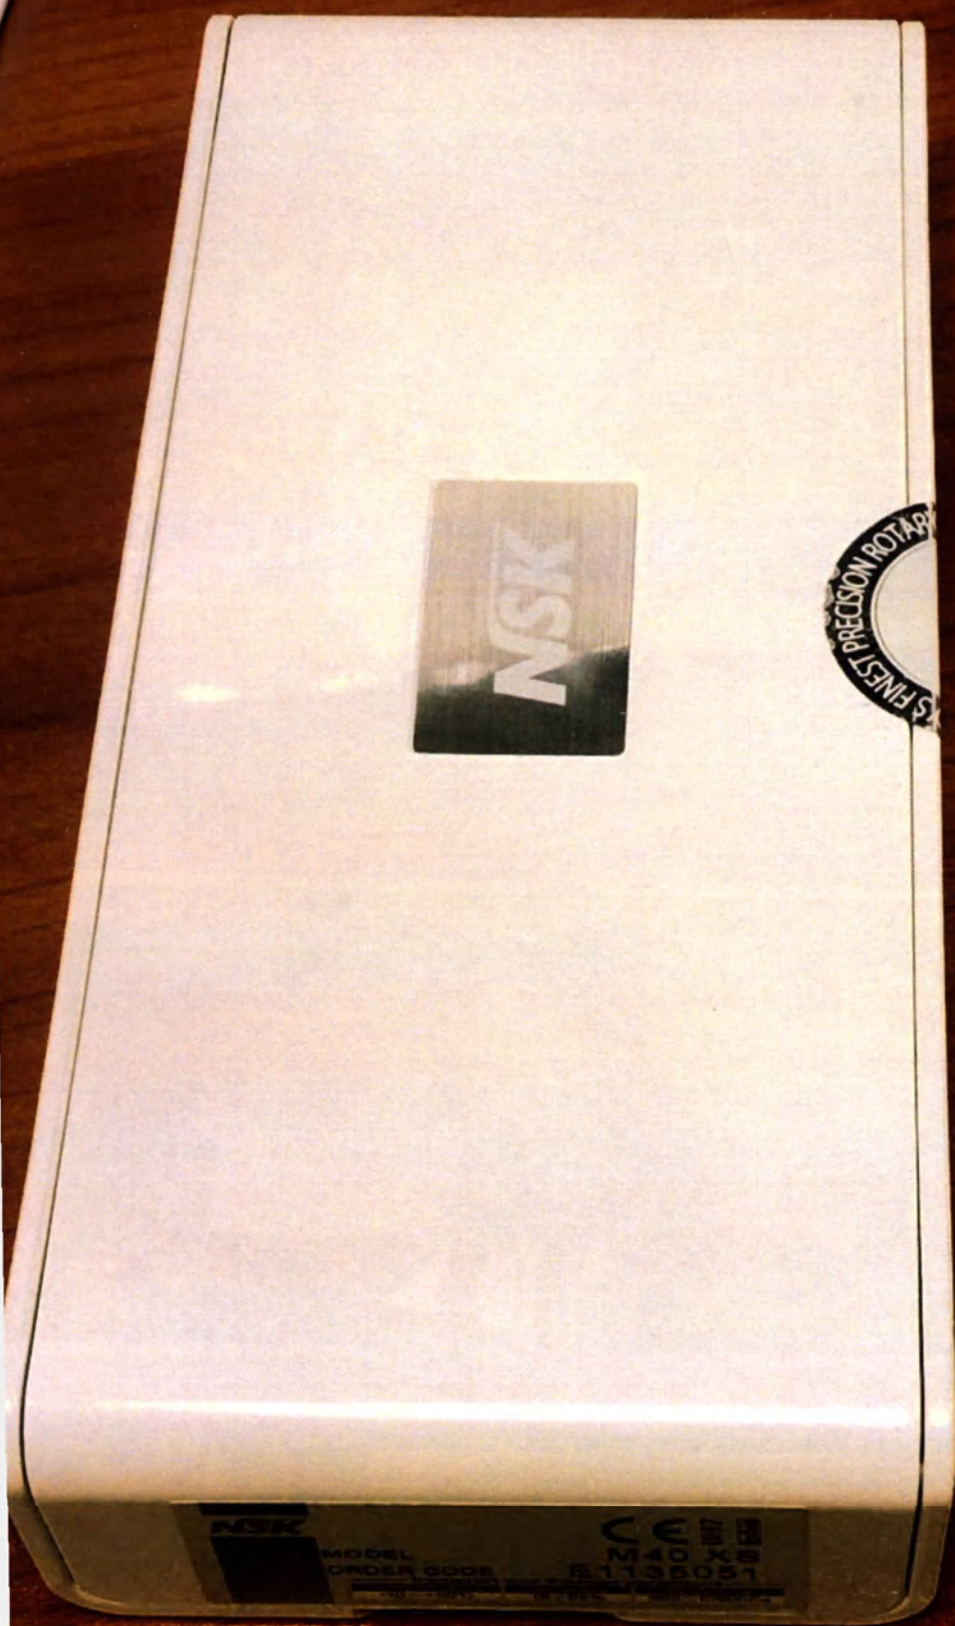

Микромоторы электрические для
стоматологических наконечников M40 XS в составе:

Микромоторы электрические для
стоматологических наконечников M40 XS в составе:

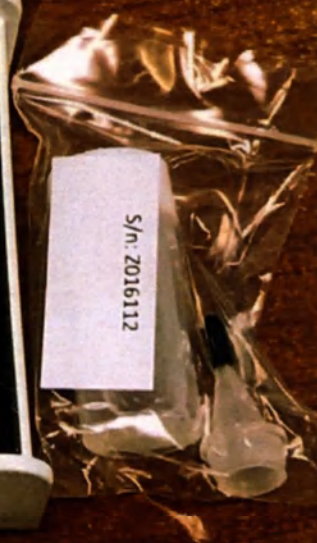

Микромоторы электрические для
стоматологических наконечников M40 XS в составе:



Микромоторы электрические для
стоматологических наконечников M40N XS в составе:



Микромоторы электрические для
стоматологических наконечников M40N XS в составе:



OPERATION
MANUAL



CE 0197 MADE IN JAPAN

OM-E0634E 001

Микромоторы электрические для
стоматологических наконечников M40N XS в составе:



Микромоторы воздушные для стоматологических
наконечников моделей Ti-Max X205L в составе:

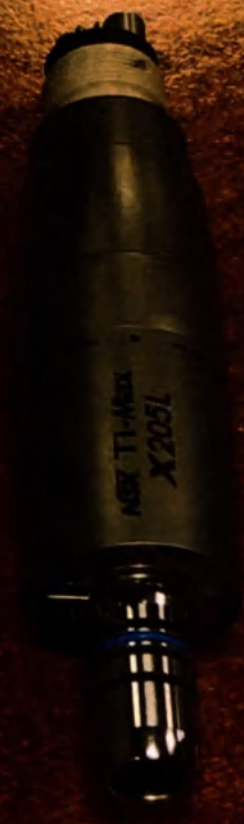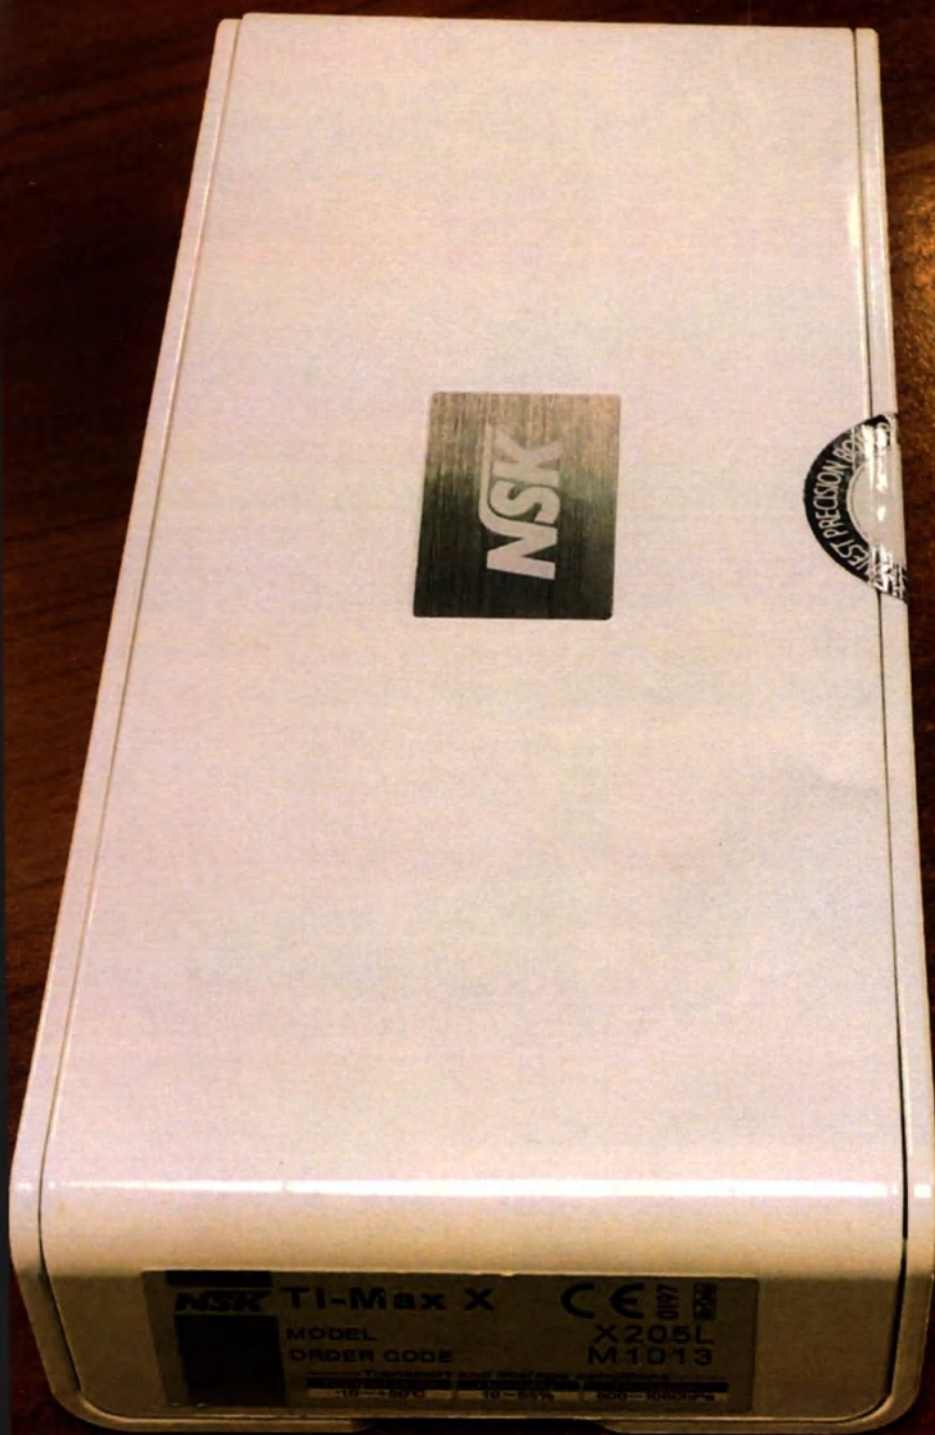

Микромоторы воздушные для стоматологических
наконечников моделей Ti-Max X205L в составе:



NSK

Air Motor

Ti-Max X205L

X205L

OPERATION
MANUAL

CE 0197 MADE IN JAPAN

CM-M1127E


Микромоторы воздушные для стоматологических
наконечников моделей Ti-Max X205L в составе:



Микромоторы воздушные для стоматологических
наконечников DynaLED M205LG M4 в составе:




Микромоторы воздушные для стоматологических
наконечников DynaLED M205LG M4 в составе:

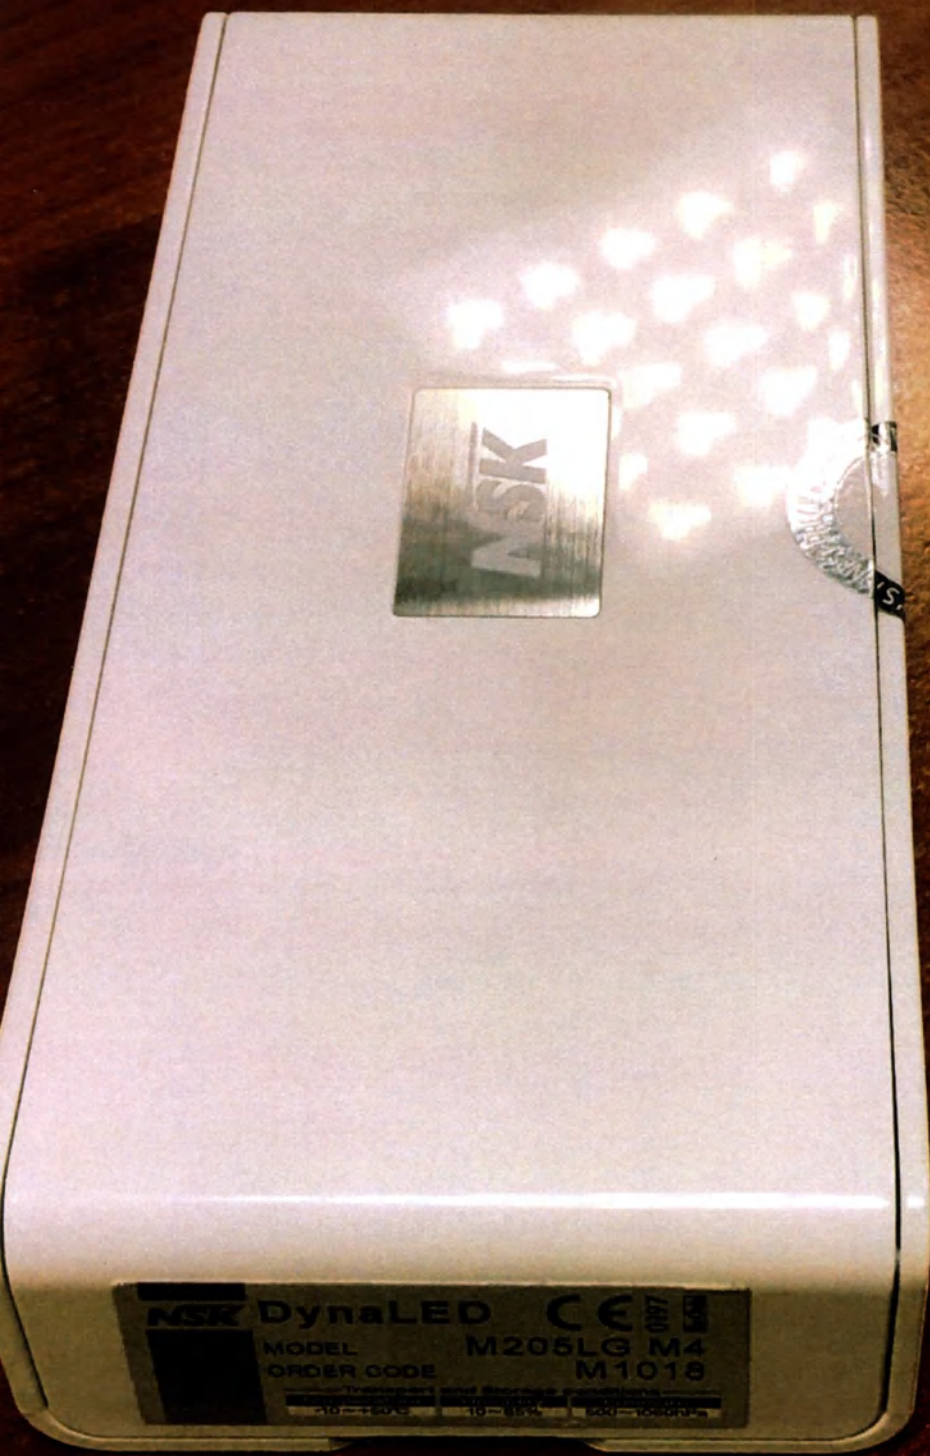

Микромоторы воздушные для стоматологических
наконечников DynaLED M205LG M4 в составе:




Микромоторы воздушные
для стоматологических наконечников
моделей DynaLED M205LG B2 в составе:

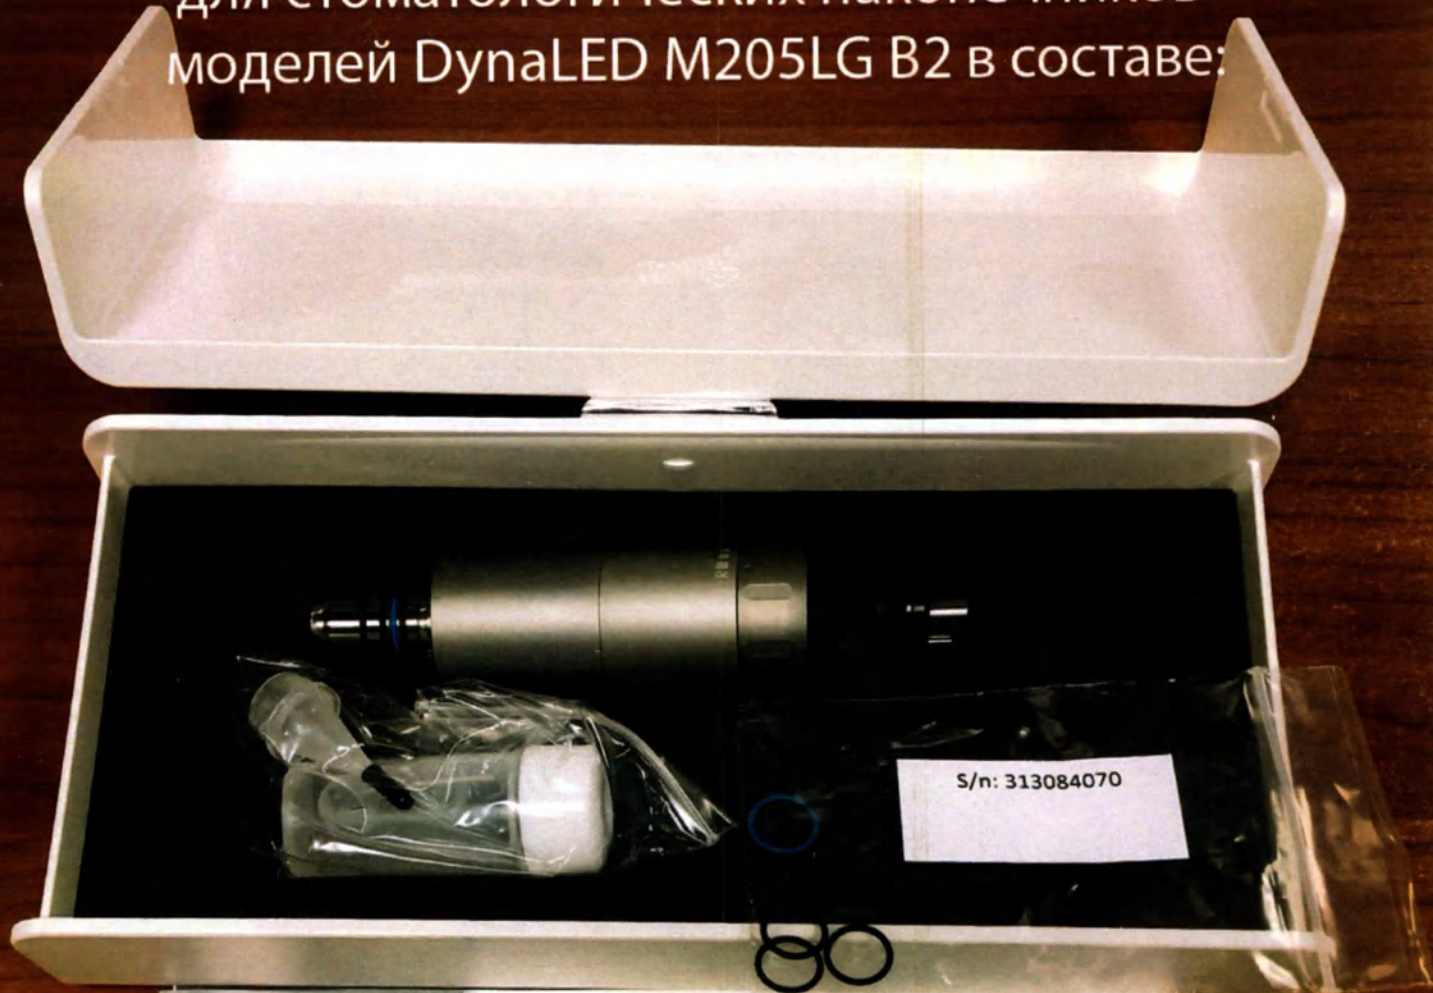





Микромоторы воздушные
для стоматологических наконечников
моделей DynaLED M205LG B2 в составе:

Микромоторы воздушные
для стоматологических наконечников
моделей DynaLED M205LG B2 в составе:

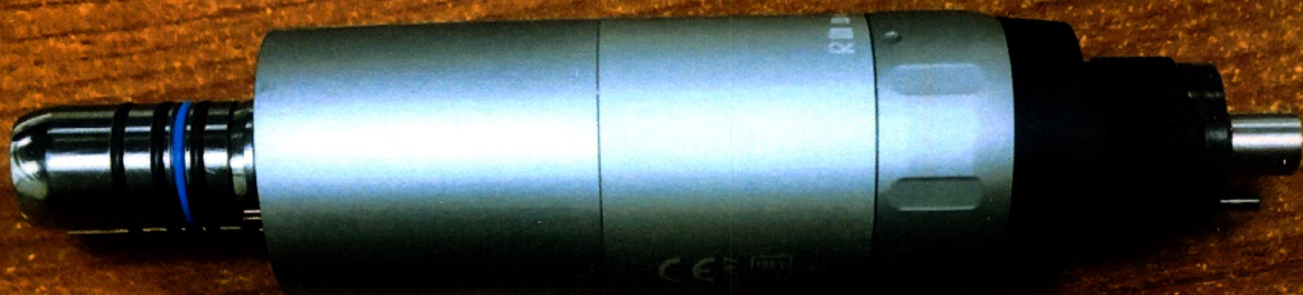

Микромоторы воздушные
для стоматологических наконечников моделей
S-Max M205 в составе:

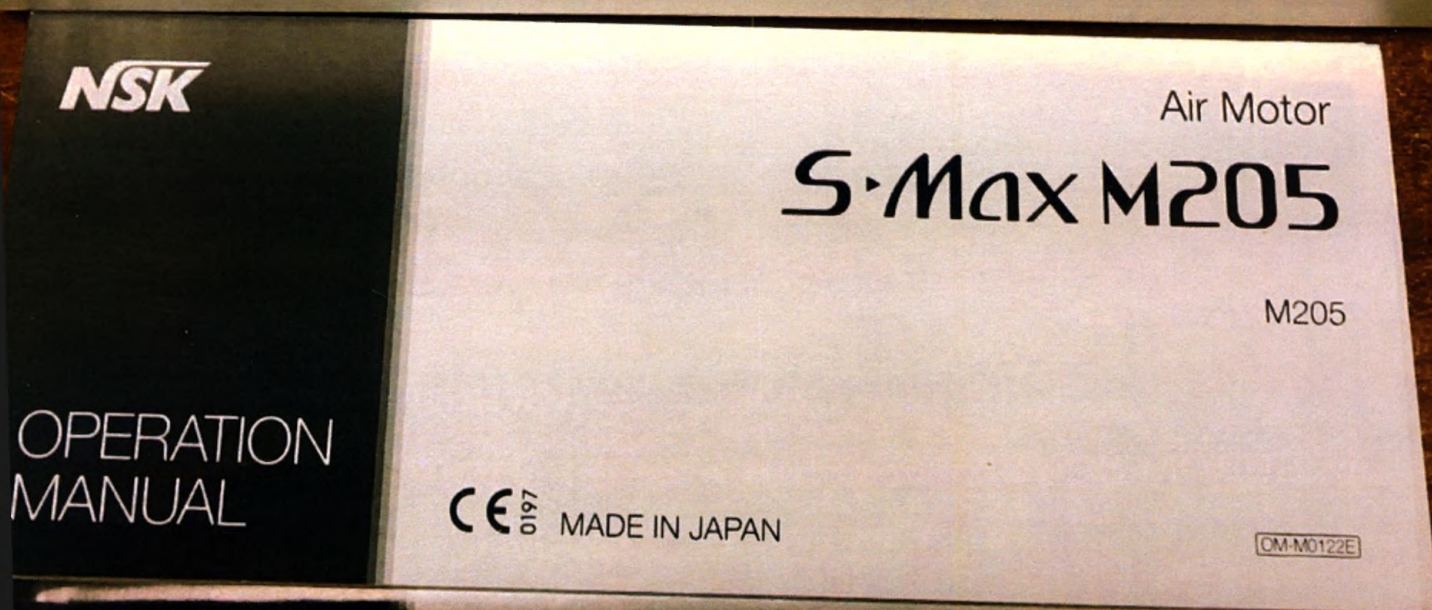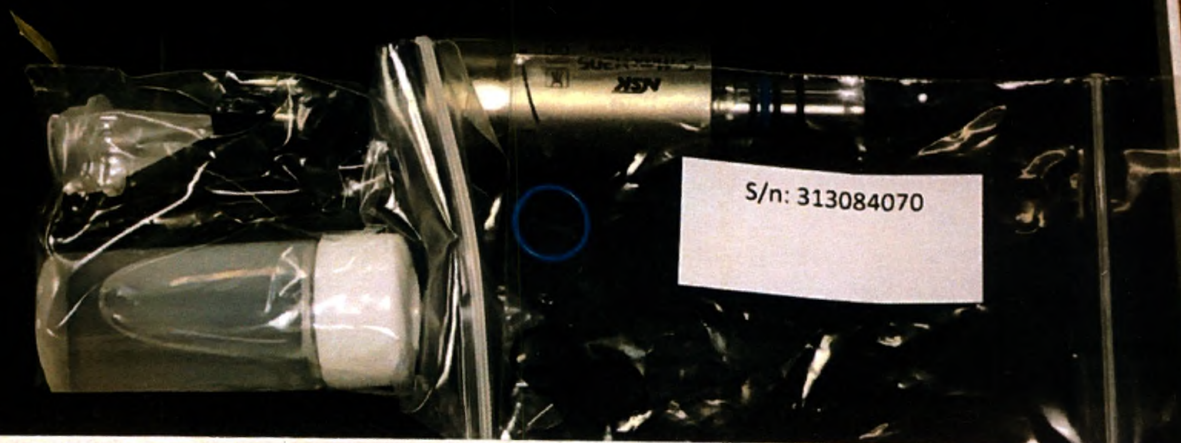



Микромоторы воздушные
для стоматологических наконечников моделей
S-Max M205 в составе:

Микромоторы воздушные
для стоматологических наконечников моделей
S-Max M205 в составе:



Микромоторы воздушные для стоматологических
наконечников моделей FX205 M4, в составе:



Микромоторы воздушные для стоматологических наконечников FX205M4 в составе:



Микромоторы воздушные для стоматологических
наконечников FX205M4 в составе:





Микромоторы воздушные
для стоматологических наконечников
моделей FX205 B2 в составе:




Микромоторы воздушные
для стоматологических наконечников
моделей FX205 B2 в составе:

Микромоторы воздушные
для стоматологических наконечников
моделей FX205 B2 в составе:



Комплект колец уплотнительных 4шт. (по необходимости).

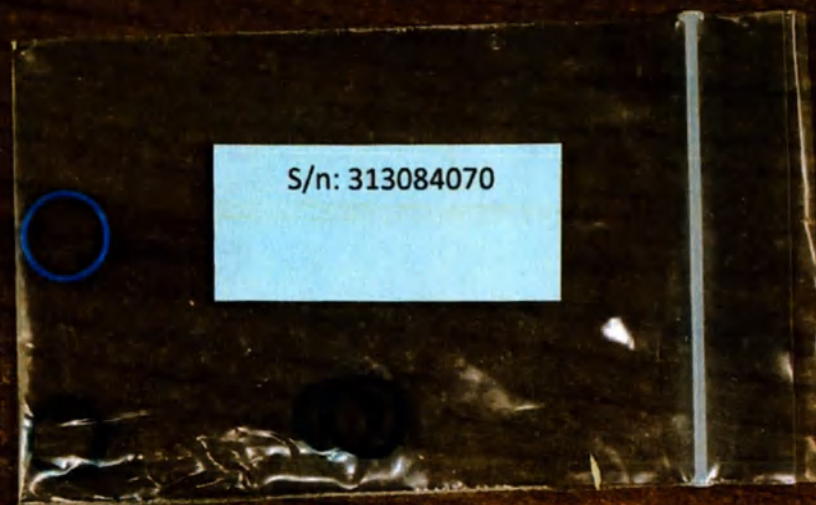



Масло с насадкой для смазки уплотнительных колец.

X205 B2



X205 M4



-Max M205



ynaLED M205LG B2



ynaLED M205LG M4




M40N XS



M40 XS



ti-Max X205L

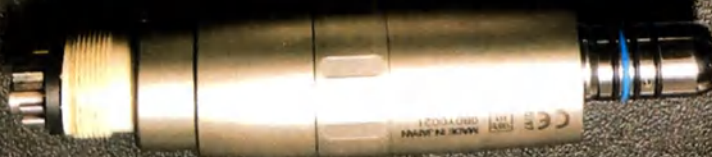

Прошито и скреплено

печатью 29 листов

(подпись)
Рек. директор ООО ПК
Виноградова

