

Согласовано

Общество с ограниченной ответственностью КАРЛ ШТОРЦ –
Эндоскопы ВОСТОК (ООО КШТЭ ВОСТОК)

Организация

Россия, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, 7, стр. 4
Адрес

Генеральный директор
Должность

Мартин Пьер Колас
Фамилия, Имя

Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись/Signature



Фотографические изображения

Эндоскоп жесткий HOPKINS для колоректальной хирургии в вариантах исполнения с принадлежностями

2021



Рис. 1. Эндоскоп жесткий HOPKINS для колоректальной хирургии в вариантах исполнения. Транспортная упаковка.



Рис. 2. Эндоскоп жесткий НОРКИНС для колоректальной хирургии в вариантах исполнения. Маркировка на транспортной упаковке.

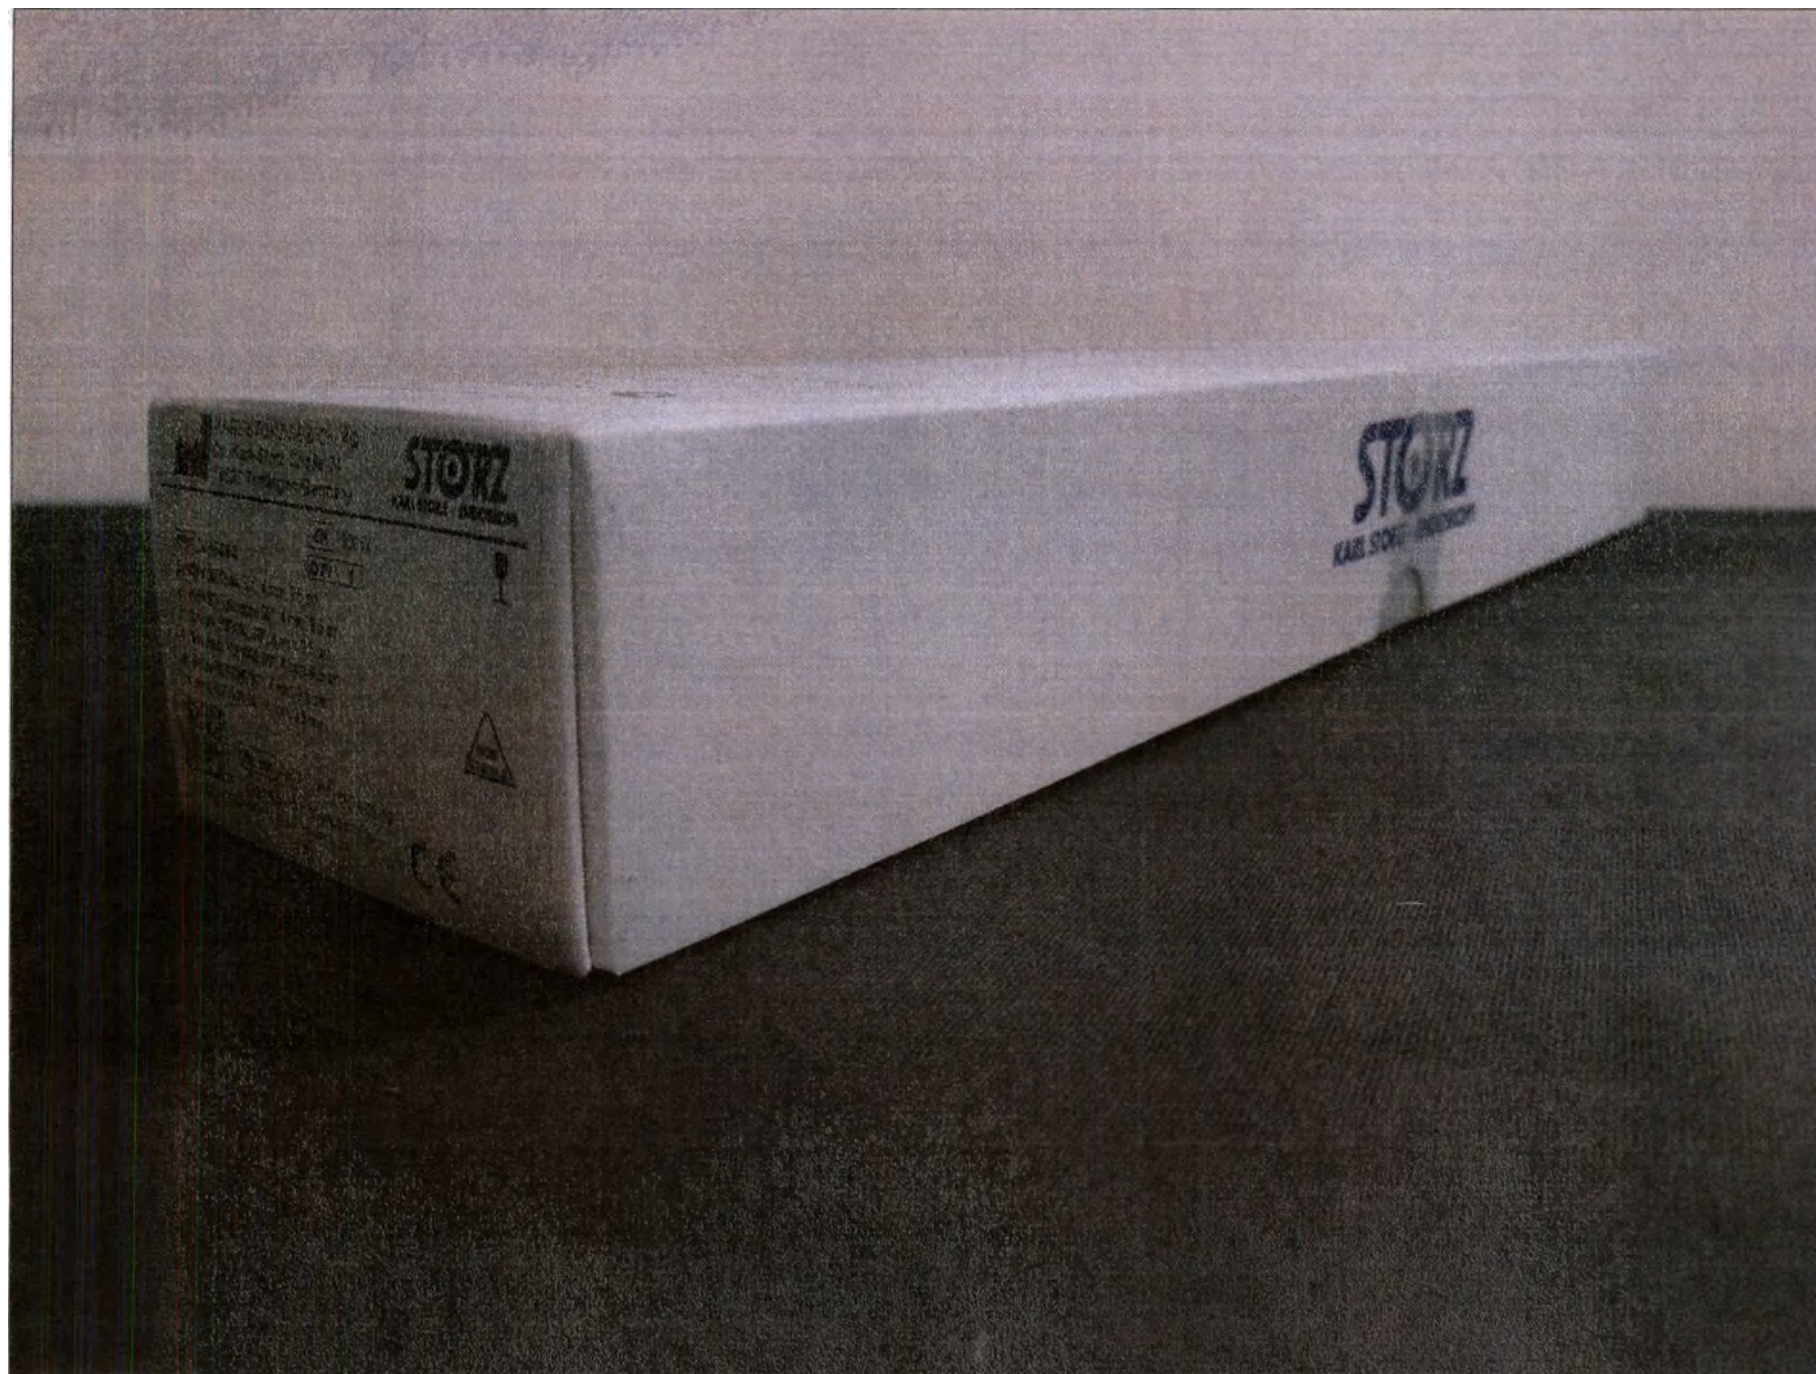


Рис. 3. Эндоскоп жесткий HOPKINS для проктоскопии (вид 288870), направление наблюдения 30°, диаметр 4 мм, длина 9,5 см. Упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

SN 10005X

REF 24954BA

QTY 1

de HOPKINS Optik 30°, 4 mm, 9.5 cm
en HOPKINS Telescope 30°, 4 mm, 9.5 cm
fr Optique HOPKINS 30°, 4 mm, 9.5 cm
it Sist.ottico HOPKINS 30°, 4 mm, 9.5 cm
es Óptica HOPKINS 30°, 4 mm, 9.5 cm
pt Ótica HOPKINS 30°, 4 mm, 9.5 cm



020002

Rx only

MD



2021-03-19



www.karlstorz.com/ifu



UDI (01)04048551084369(11)2103122(1)10005X(42)2278

Рис. 4. Эндоскоп жесткий HOPKINS для проктоскопии (вид 288870), направление наблюдения 30°, диаметр 4 мм, длина 9,5 см. Маркировка на упаковке.



Рис. 5. Эндоскоп жесткий НОРKINS для проктоскопии (вид 288870), направление наблюдения 30°, диаметр 4 мм, длина 9,5 см.



Рис. 6. Эндоскоп.

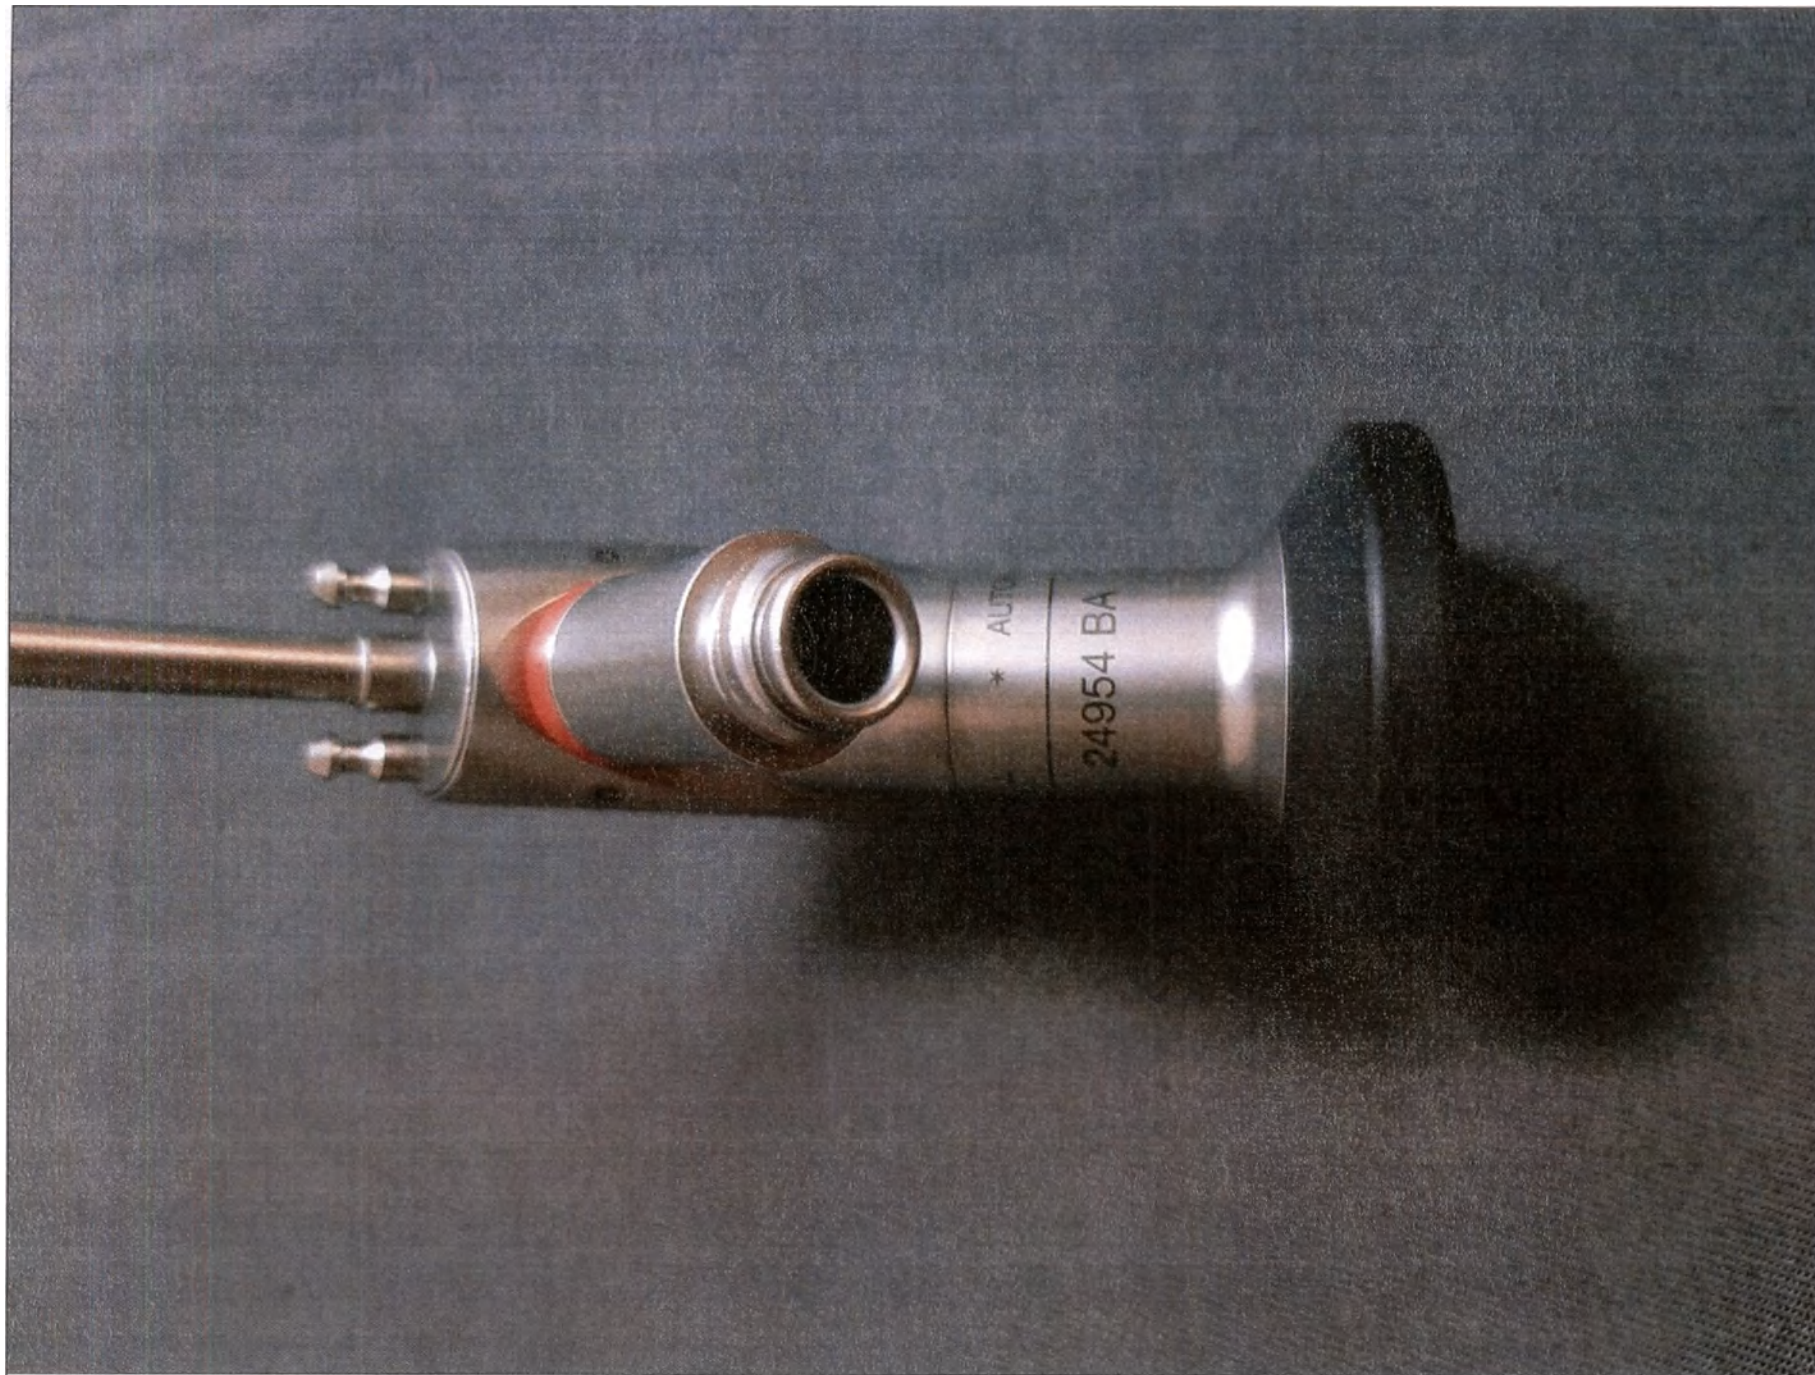


Рис. 7. Эндоскоп.

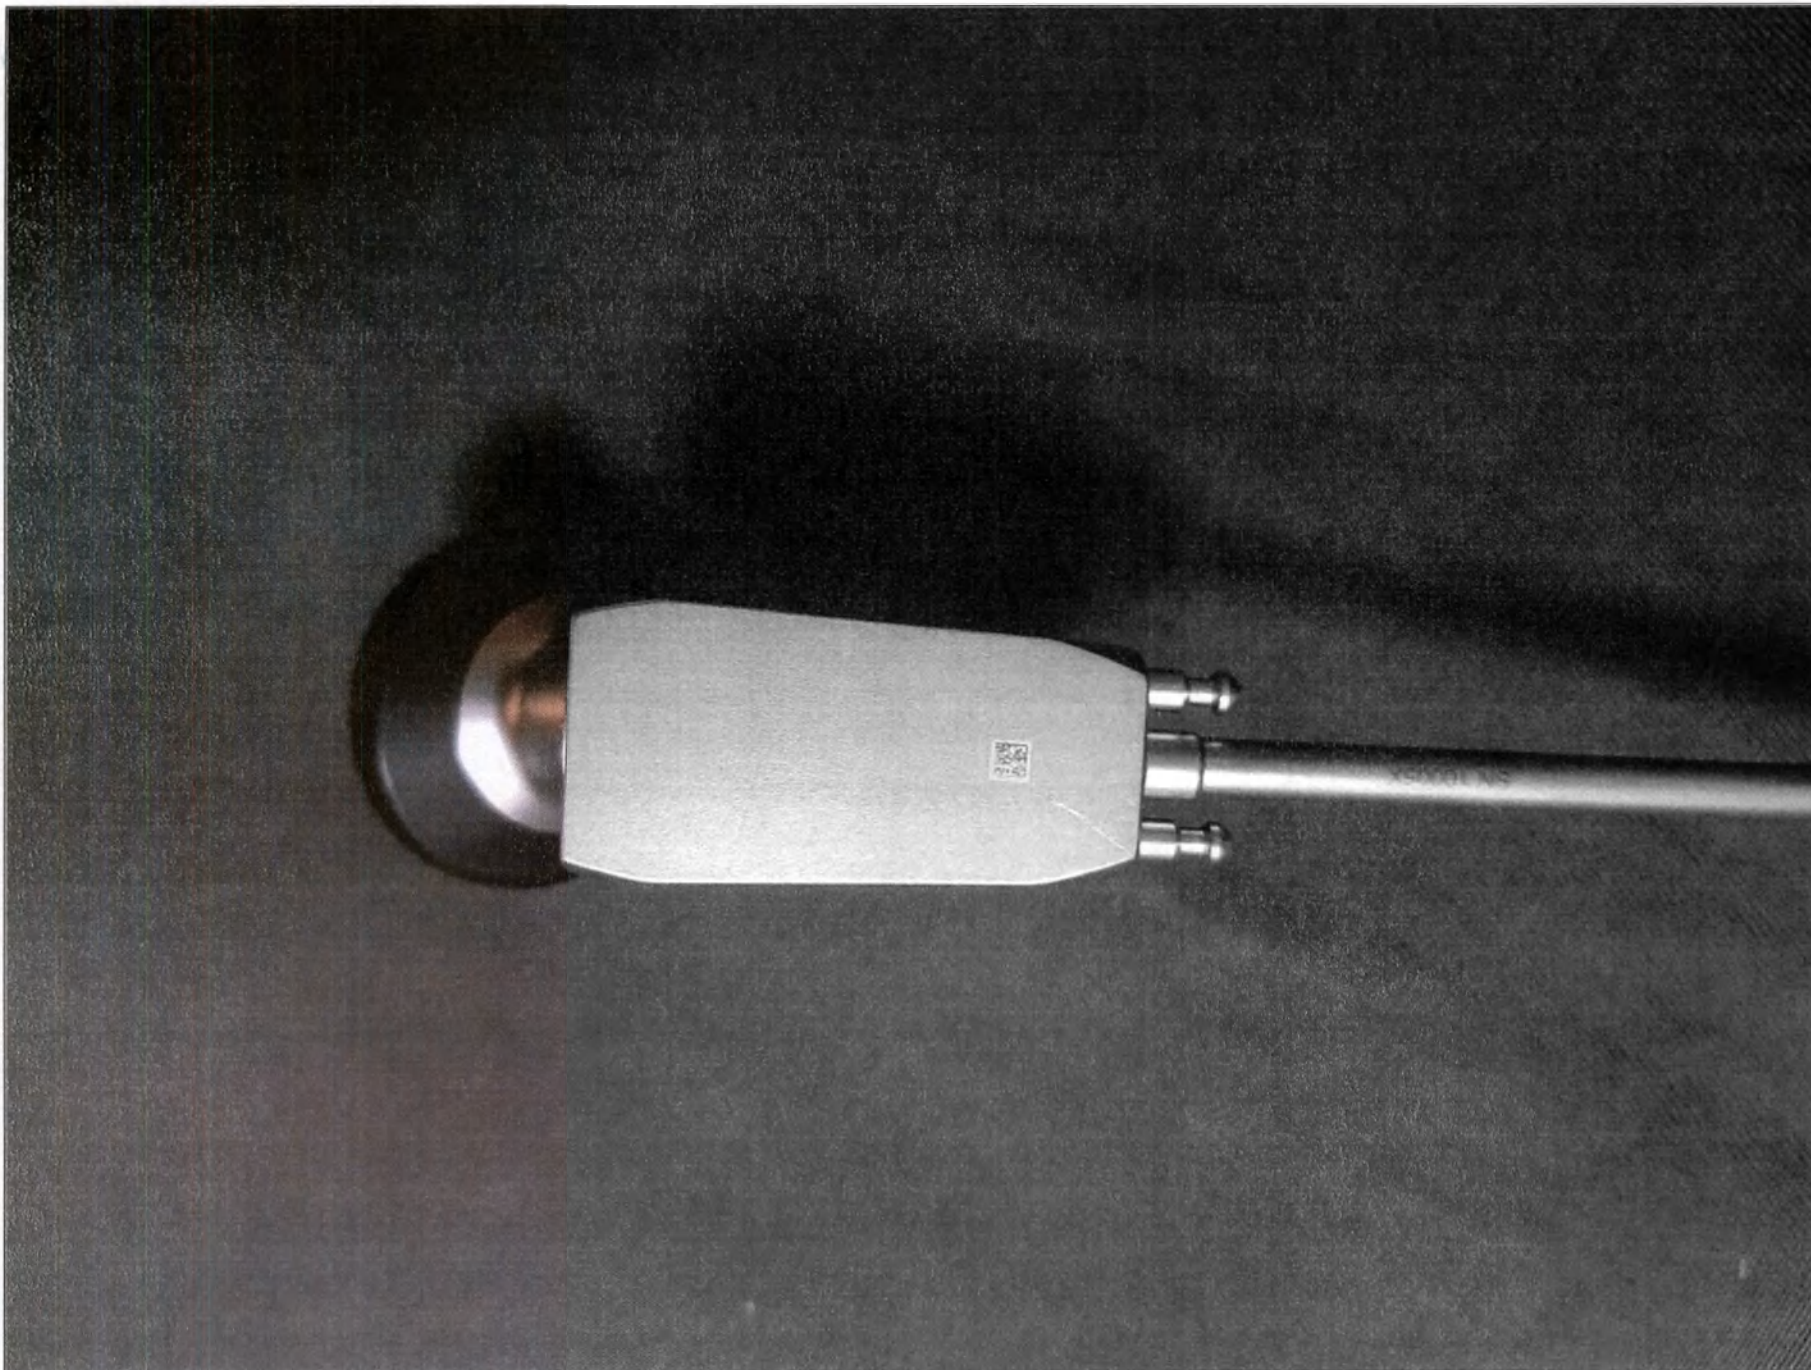


Рис. 8. Эндоскоп.



Рис. 9. Эндоскоп.

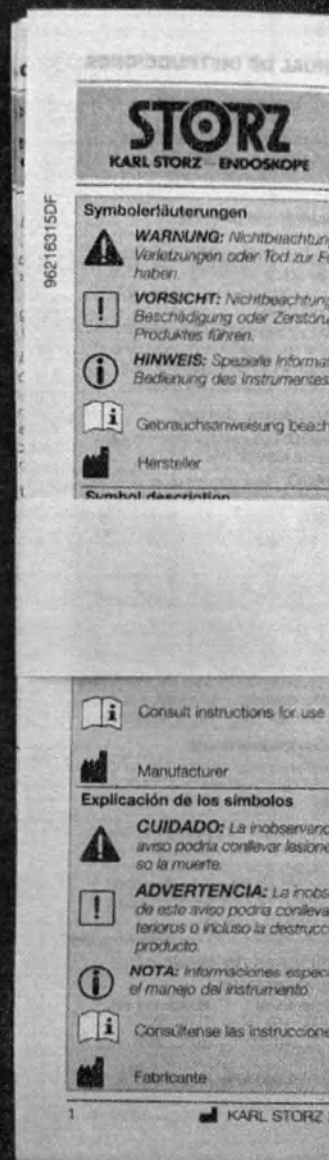


Рис. 10. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.

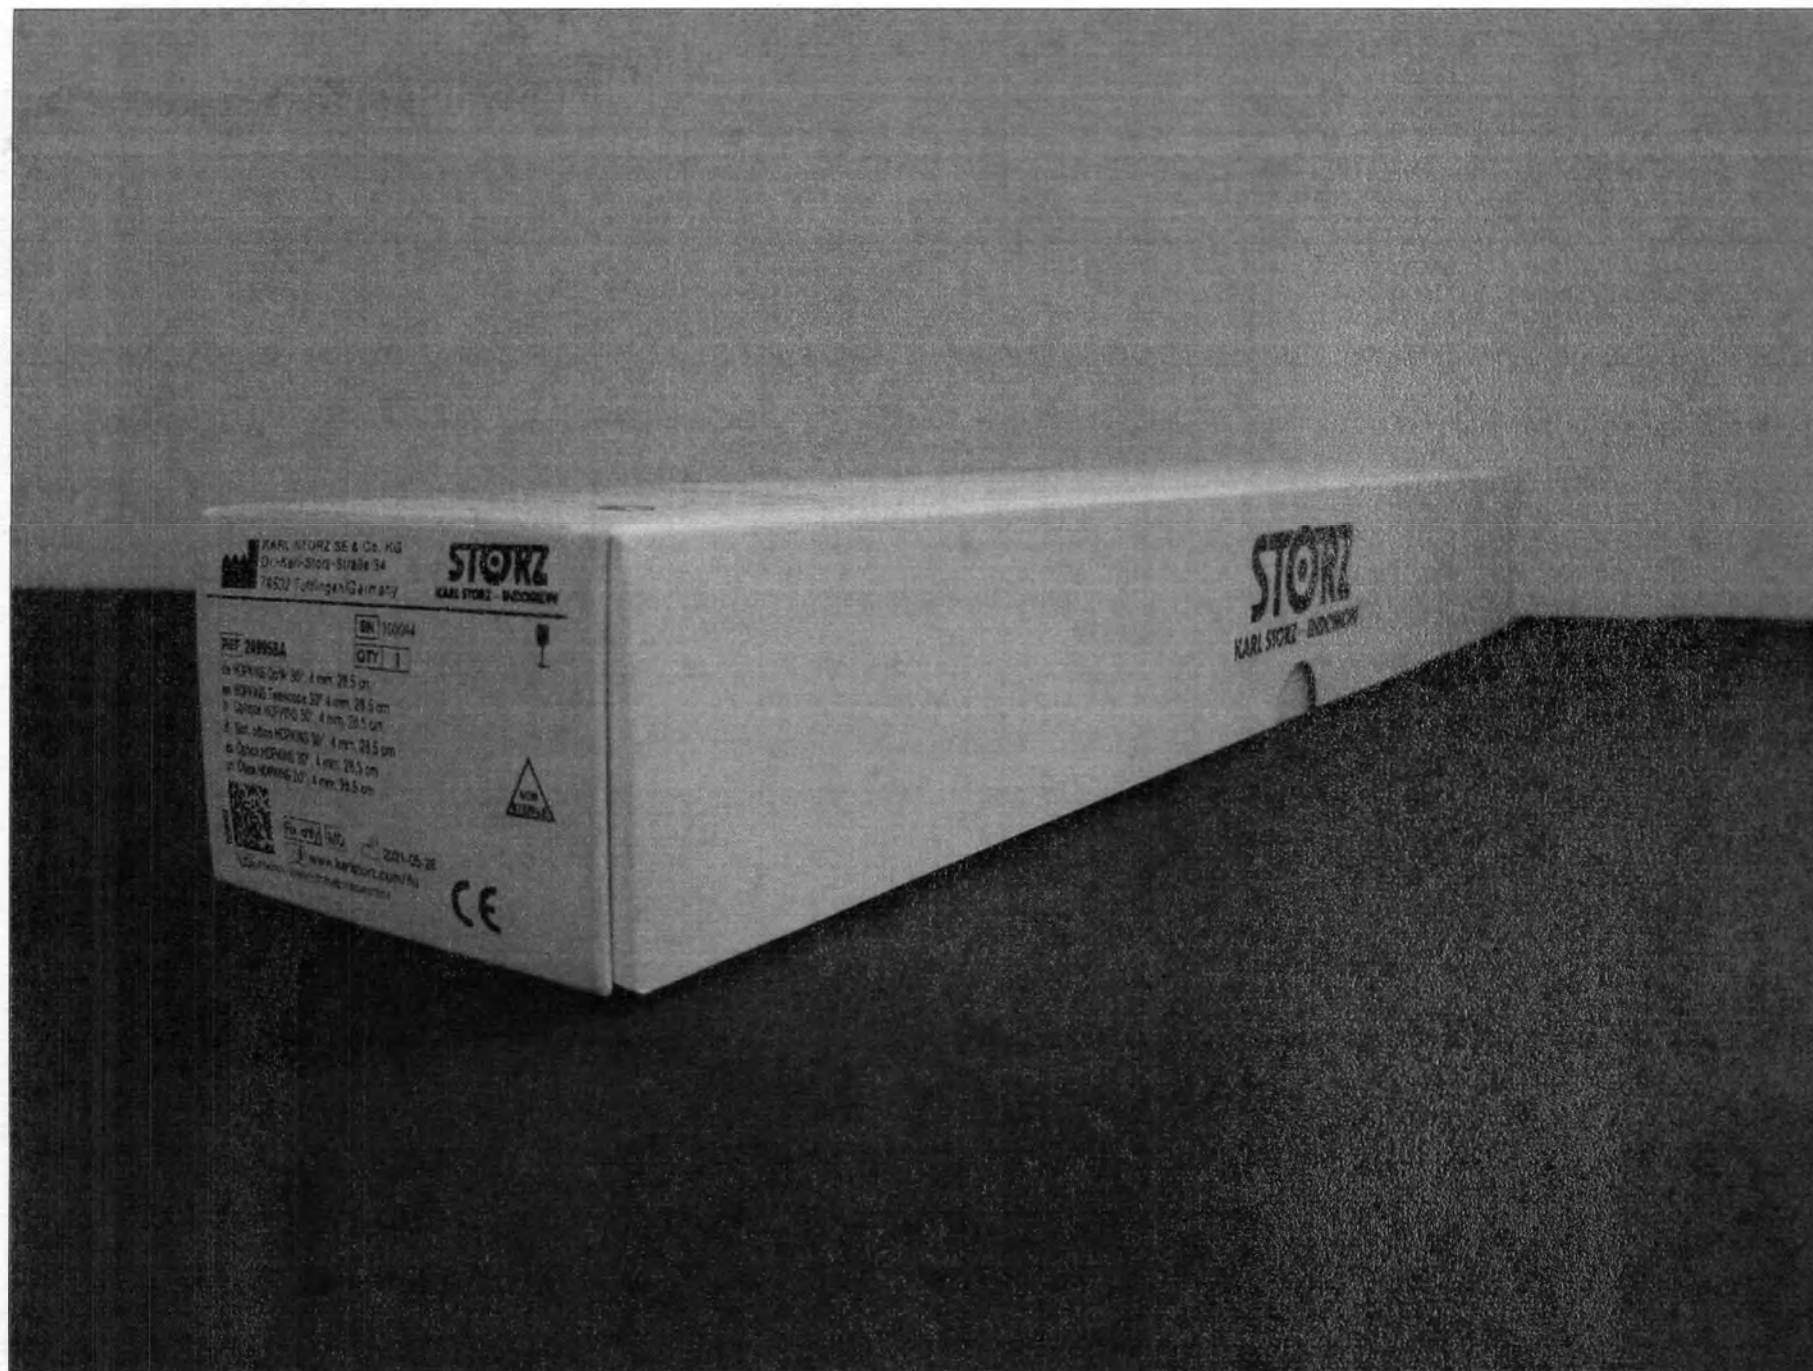


Рис. 11. Эндоскоп жесткий НОРКИНС для ректоскопии (вид 248650), направление наблюдения 30°, диаметр 4 мм, длина 28,5 см. Упаковка.

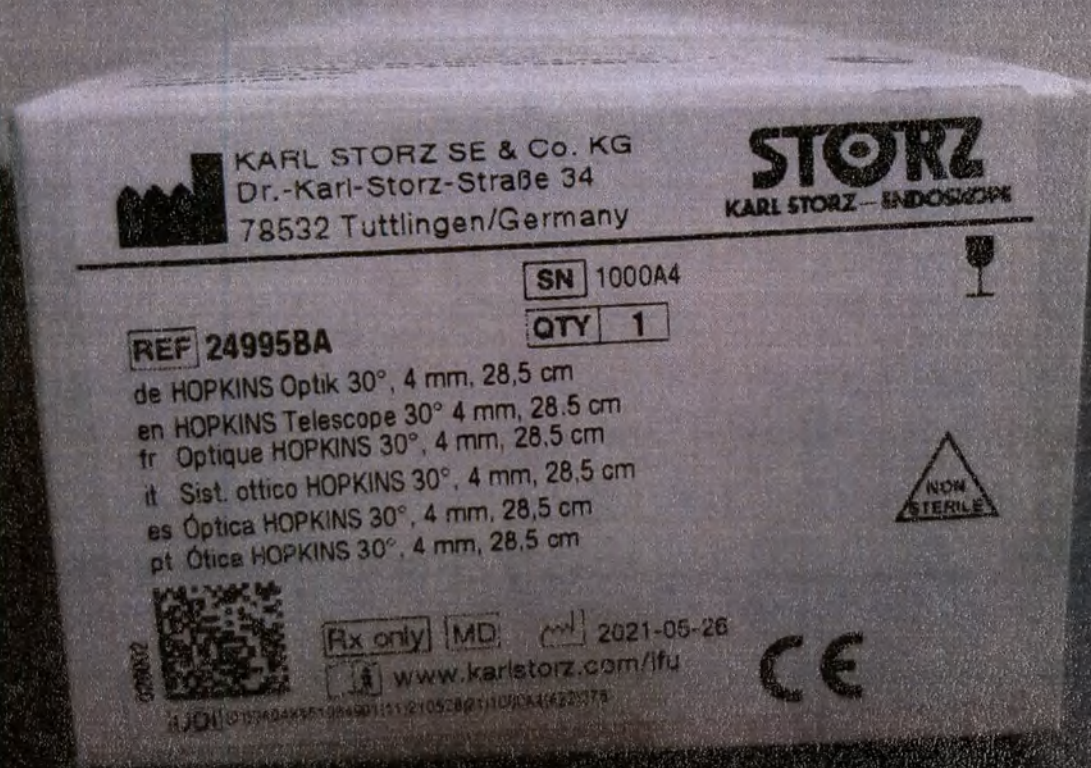


Рис. 12. Эндоскоп жесткий HOPKINS для ректоскопии (вид 248650), направление наблюдения 30°, диаметр 4 мм, длина 28,5 см. Маркировка на упаковке

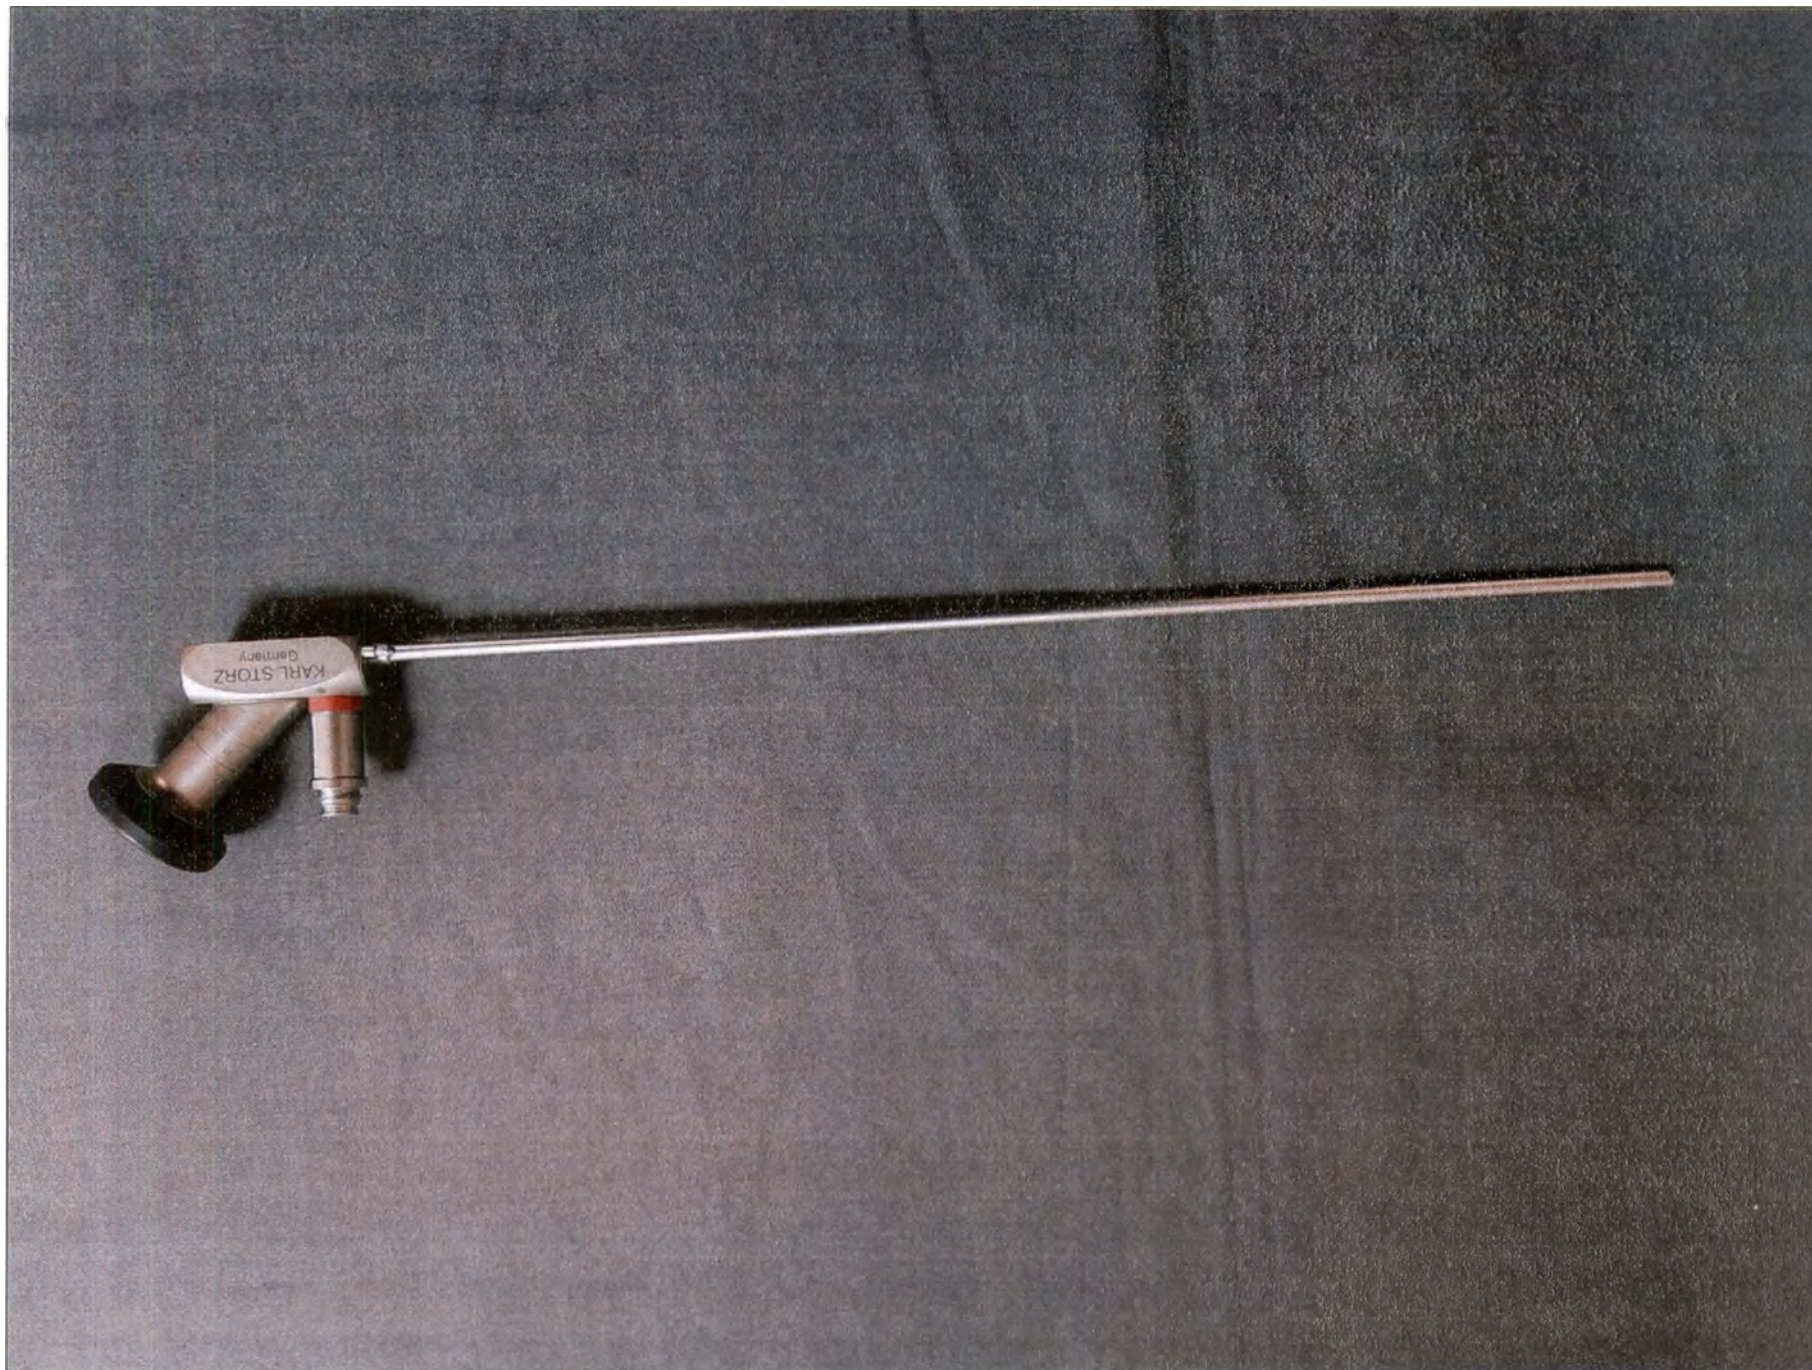


Рис. 13. Эндоскоп

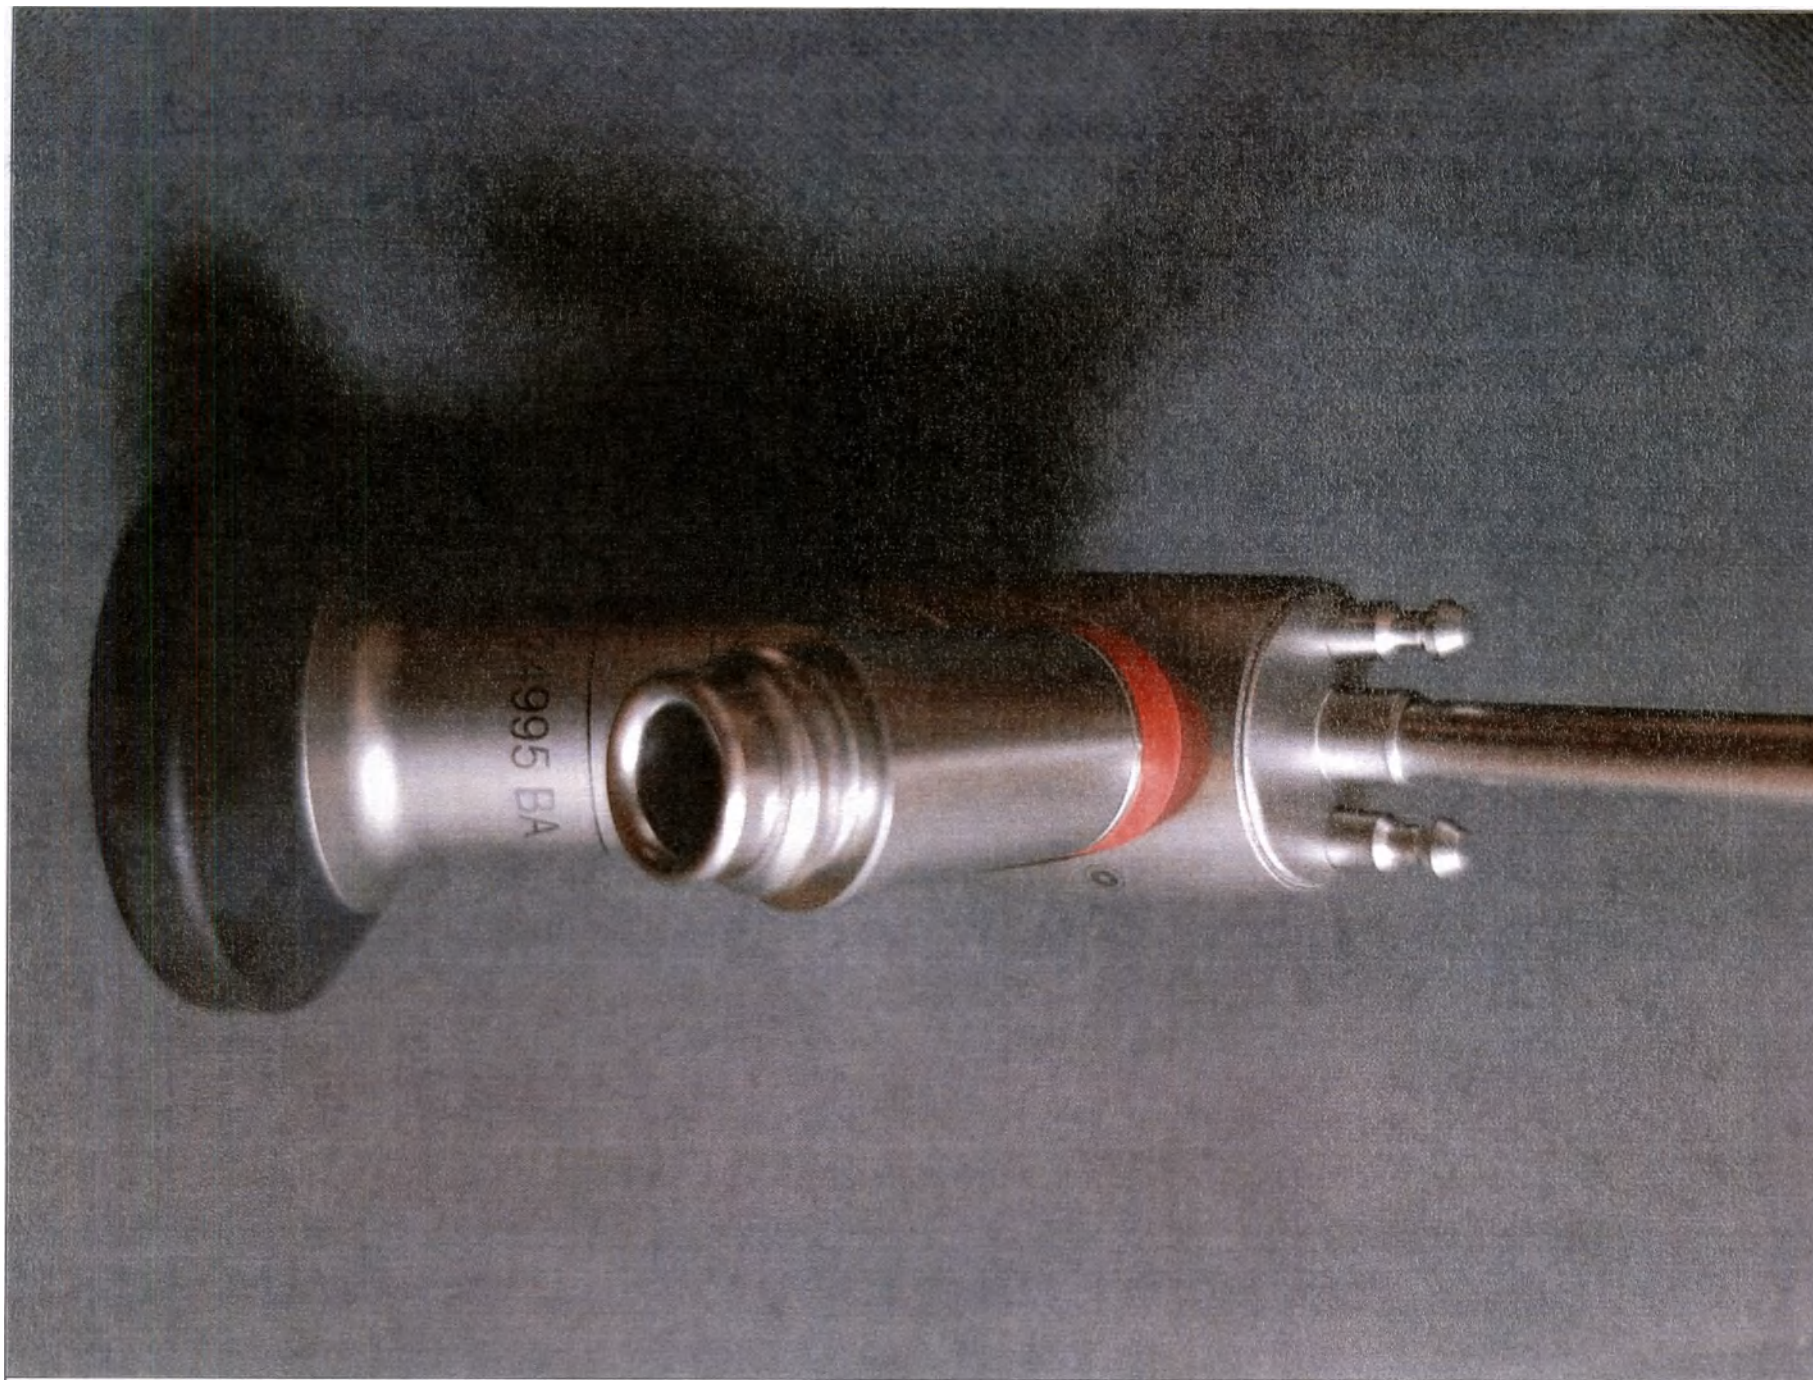


Рис. 14. Эндоскоп

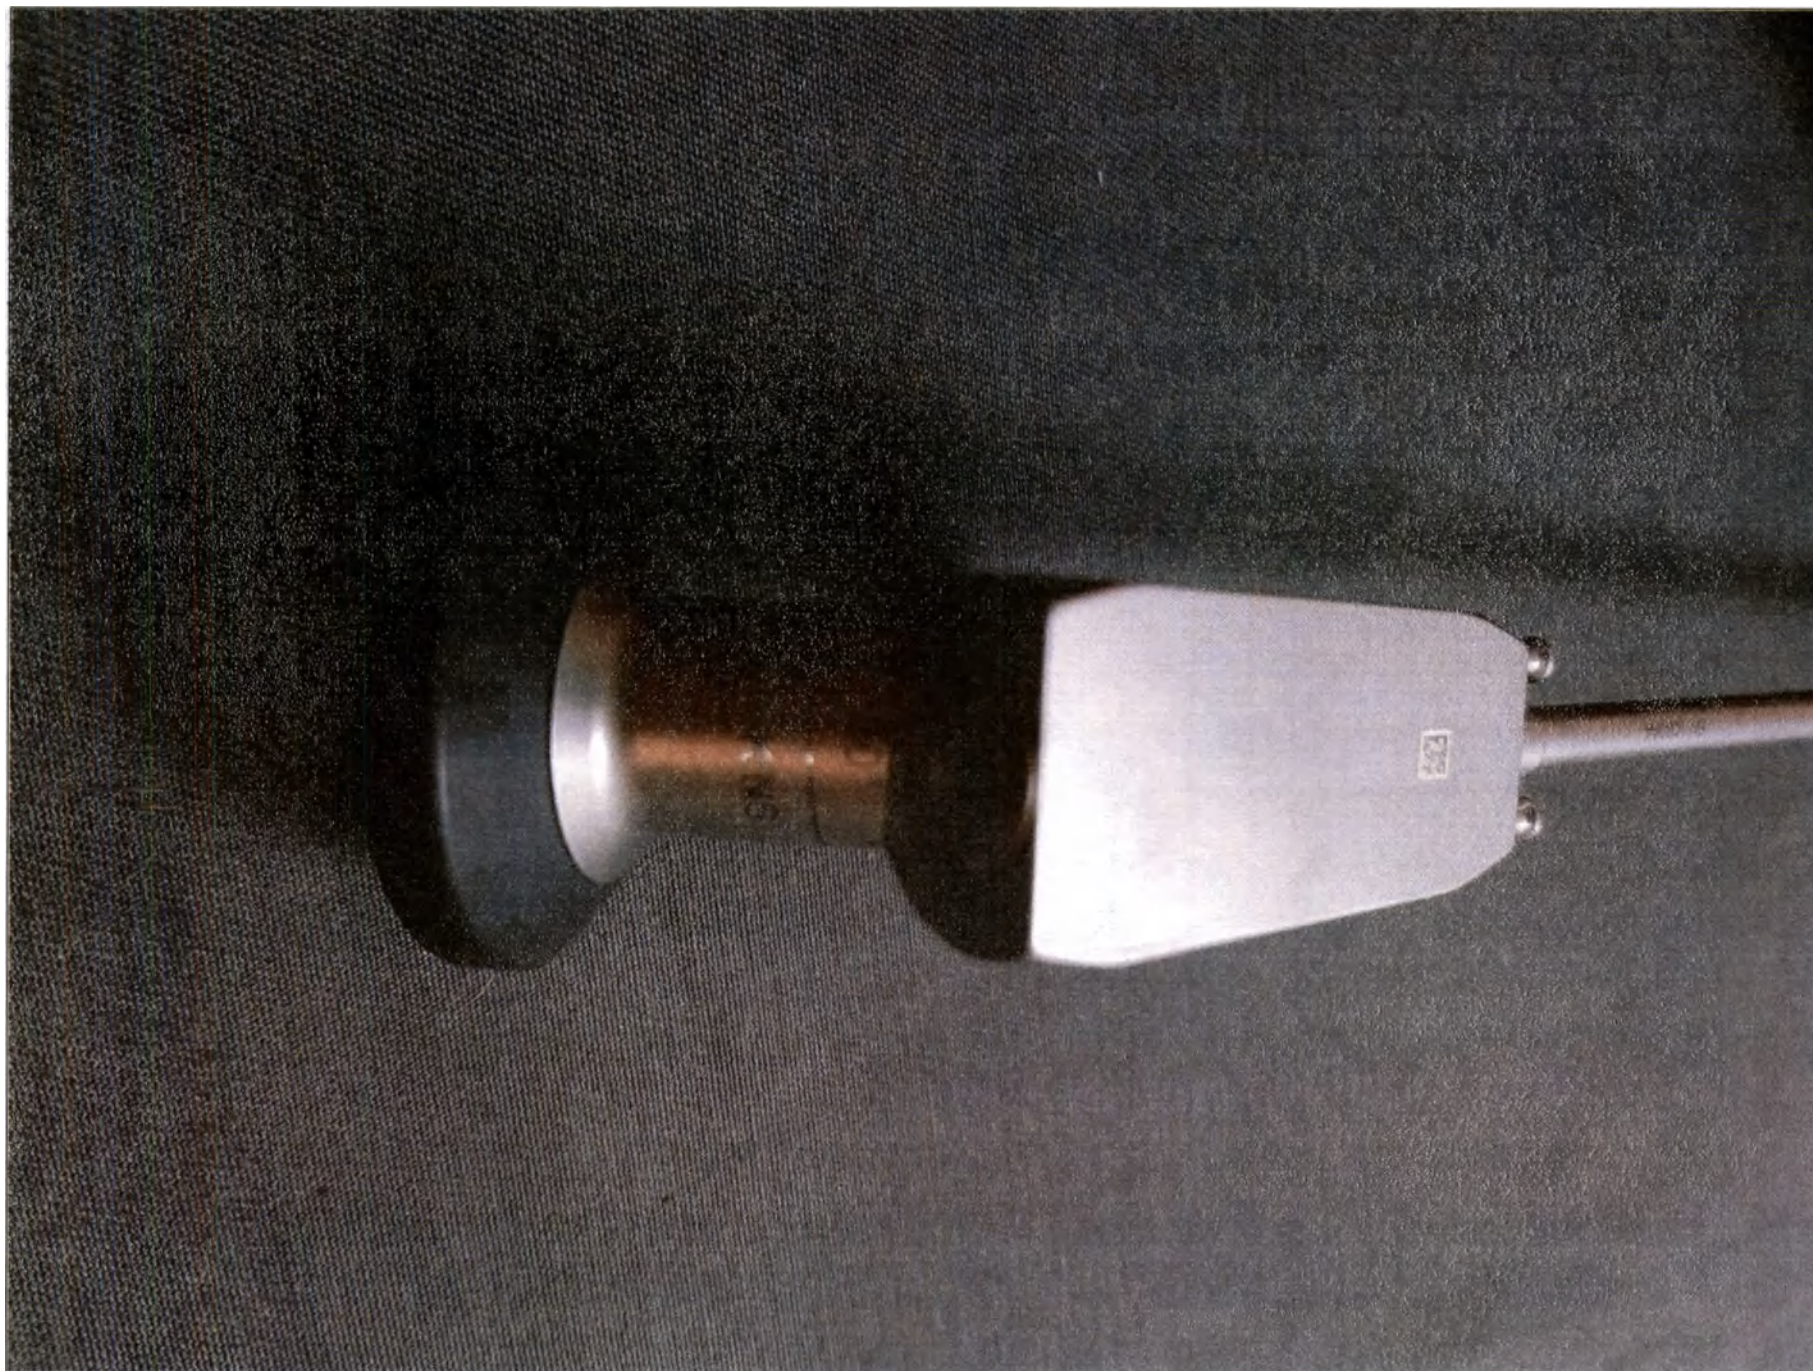


Рис. 15. Эндоскоп

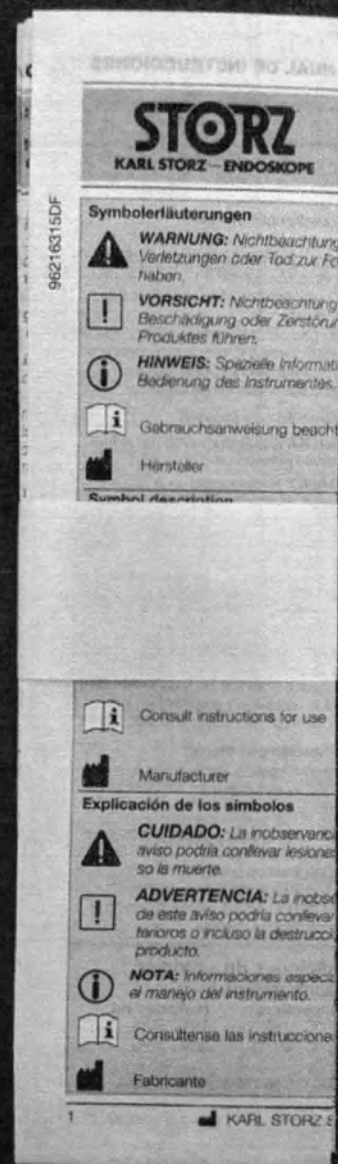


Рис. 16. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.



Рис. 17. Эндоскоп жесткий HOPKINS для трансанальных операций, типоразмер: направление наблюдения 30°, диаметр 5 мм, длина 28 см Упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSCOPE

REF 24941BAL

SN 10001V

QTY 1

HOPKINS® Optik 30°, 5mm, 28cm
HOPKINS® Telescope 30°, 5mm, 28cm
Optique HOPKINS® 30°, 5mm, 28cm
Sis.att.HOPKINS® 30°.5mm. 28cm
Óptica HOPKINS® 30°, 5 mm, 28 cm
Telescópio HOPKINS® 30°, 5mm, 28cm



Rx ONLY

CE 0123

Рис. 18. Эндоскоп жесткий HOPKINS для трансанальных операций, типоразмер: направление наблюдения 30°, диаметр 5 мм, длина 28 см. Маркировка на упаковке



Рис. 19. Эндоскоп жесткий HOPKINS для трансанальных операций, типоразмер: направление наблюдения 30°, диаметр 5 мм, длина 28 см.



Рис. 20. Эндоскоп



Рис. 21. Эндоскоп

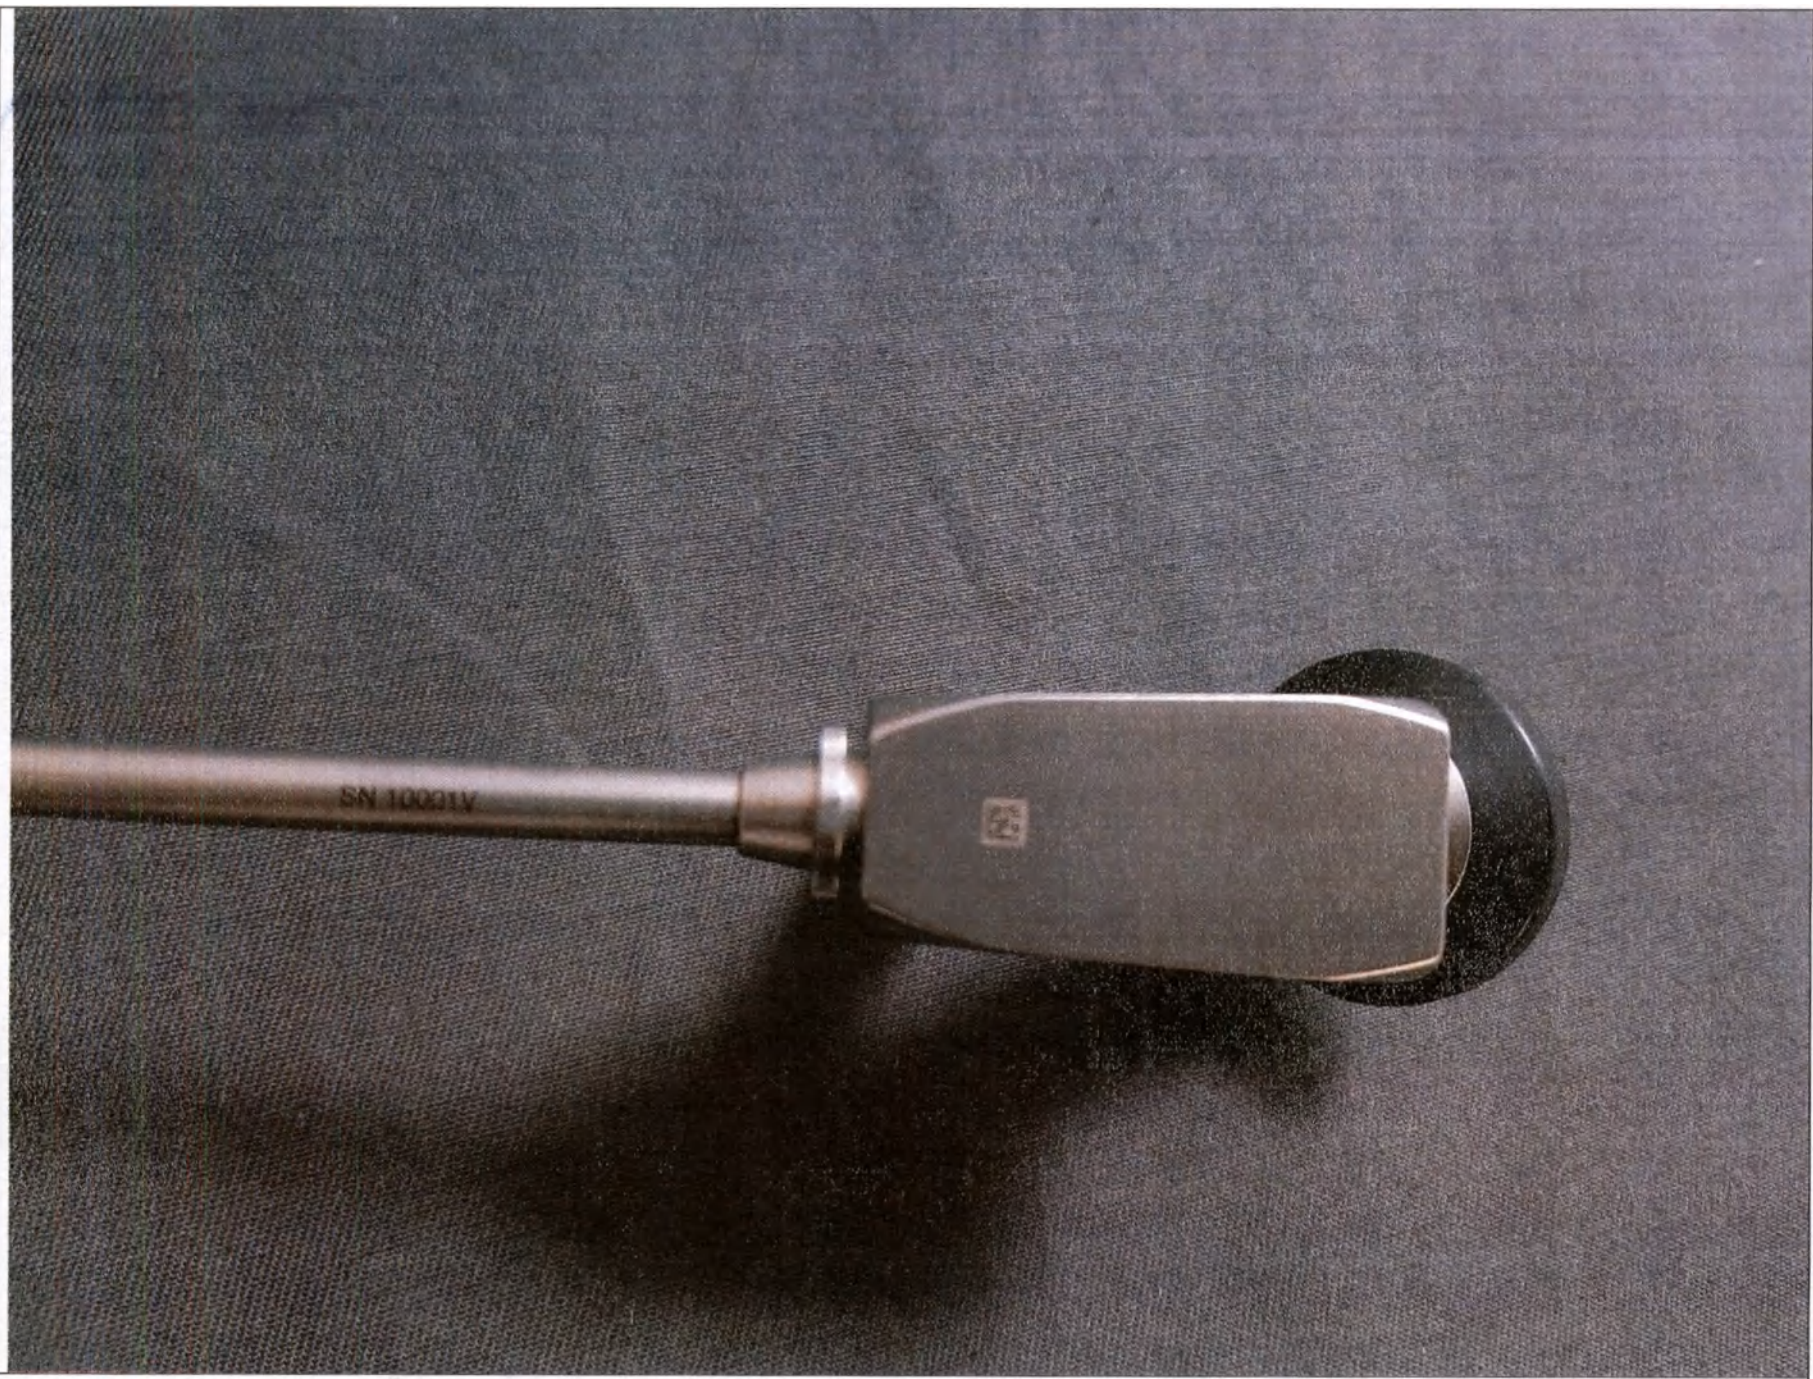


Рис. 22. Эндоскоп

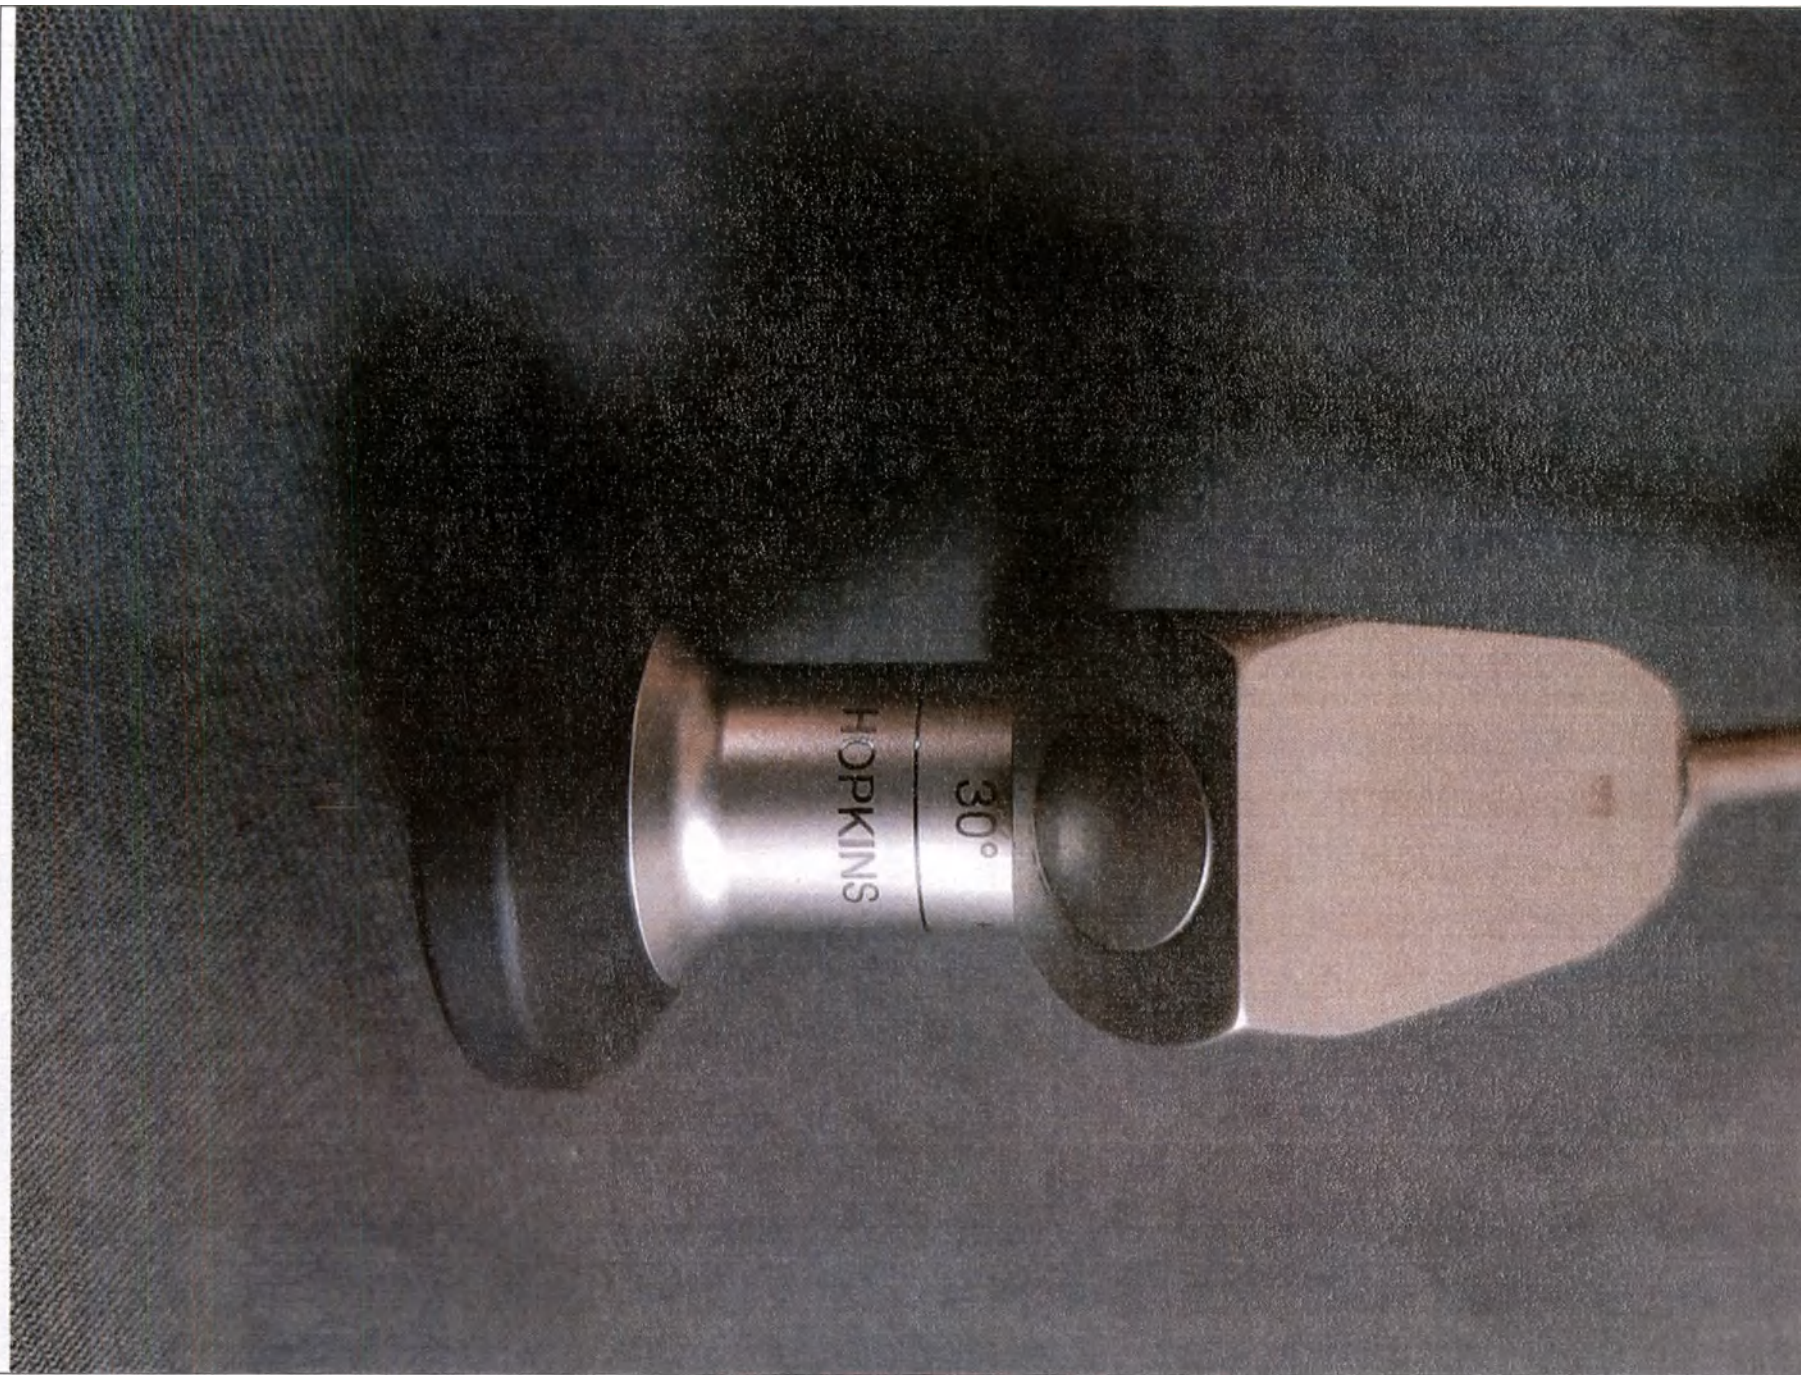


Рис. 23. Эндоскоп

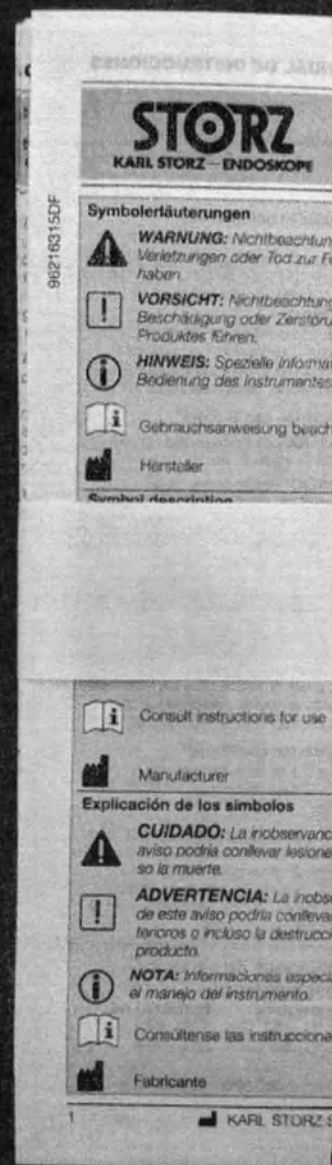


Рис. 24. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.

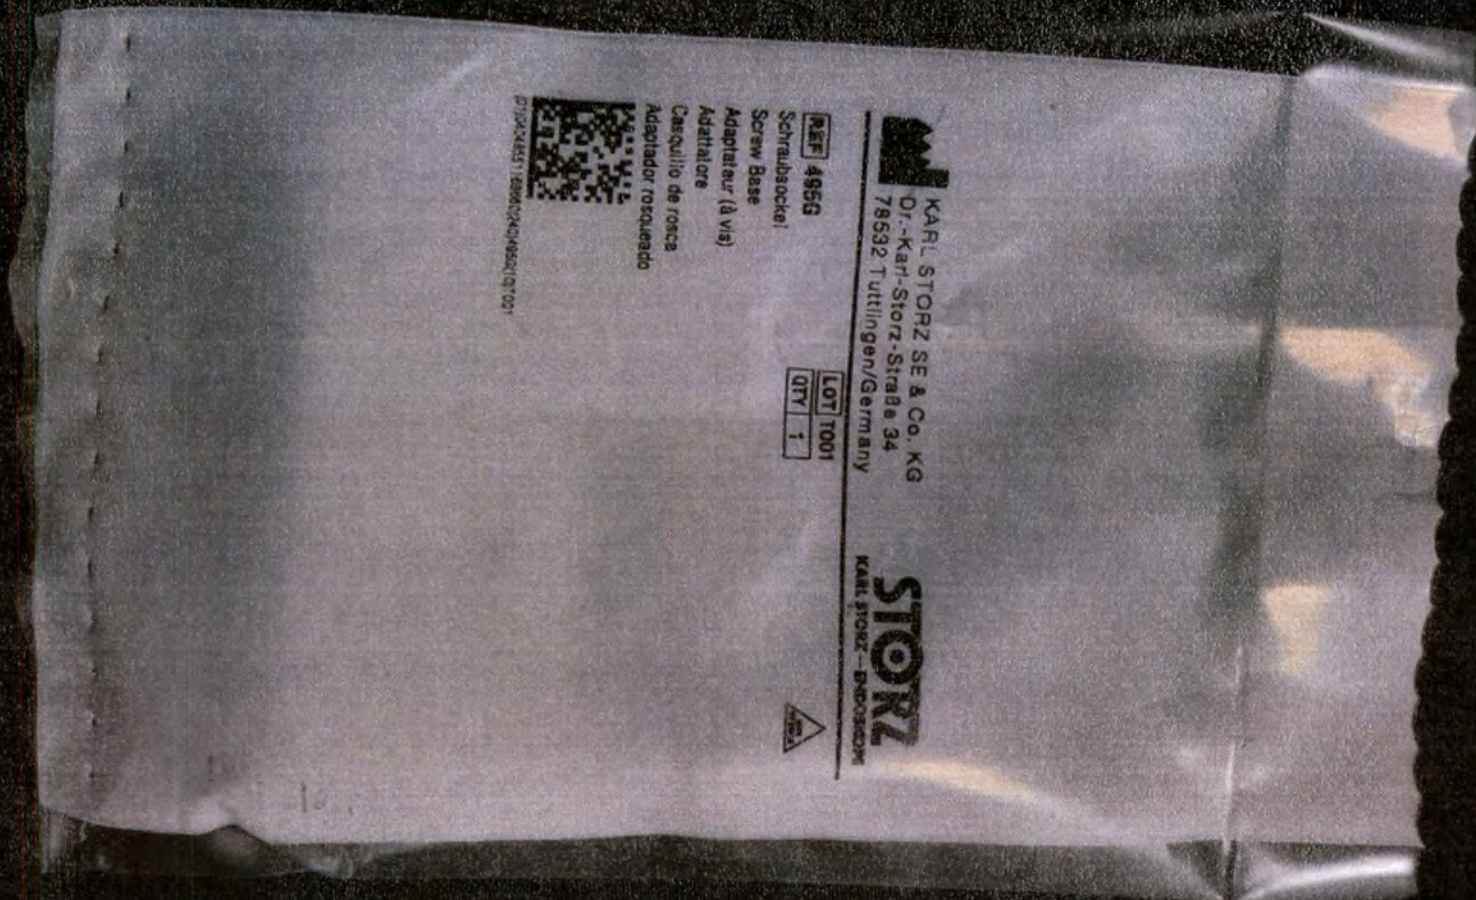


Рис. 25. Адаптер световодов KARL STORZ и Olympus. Первичная упаковка.



Рис. 26. Адаптер световодов KARL STORZ и Olympus.

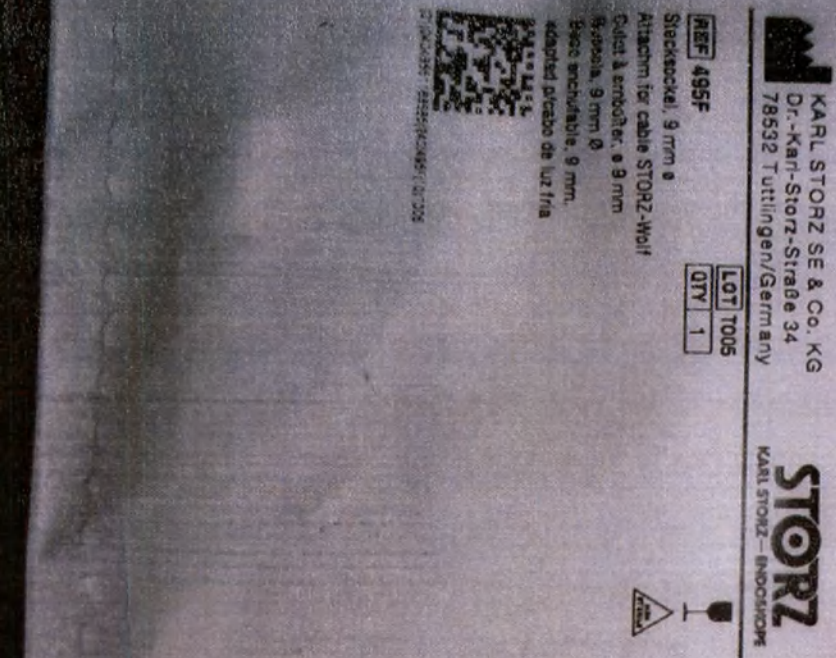


Рис. 27. Адаптер световодов Richard Wolf. Первичная упаковка.

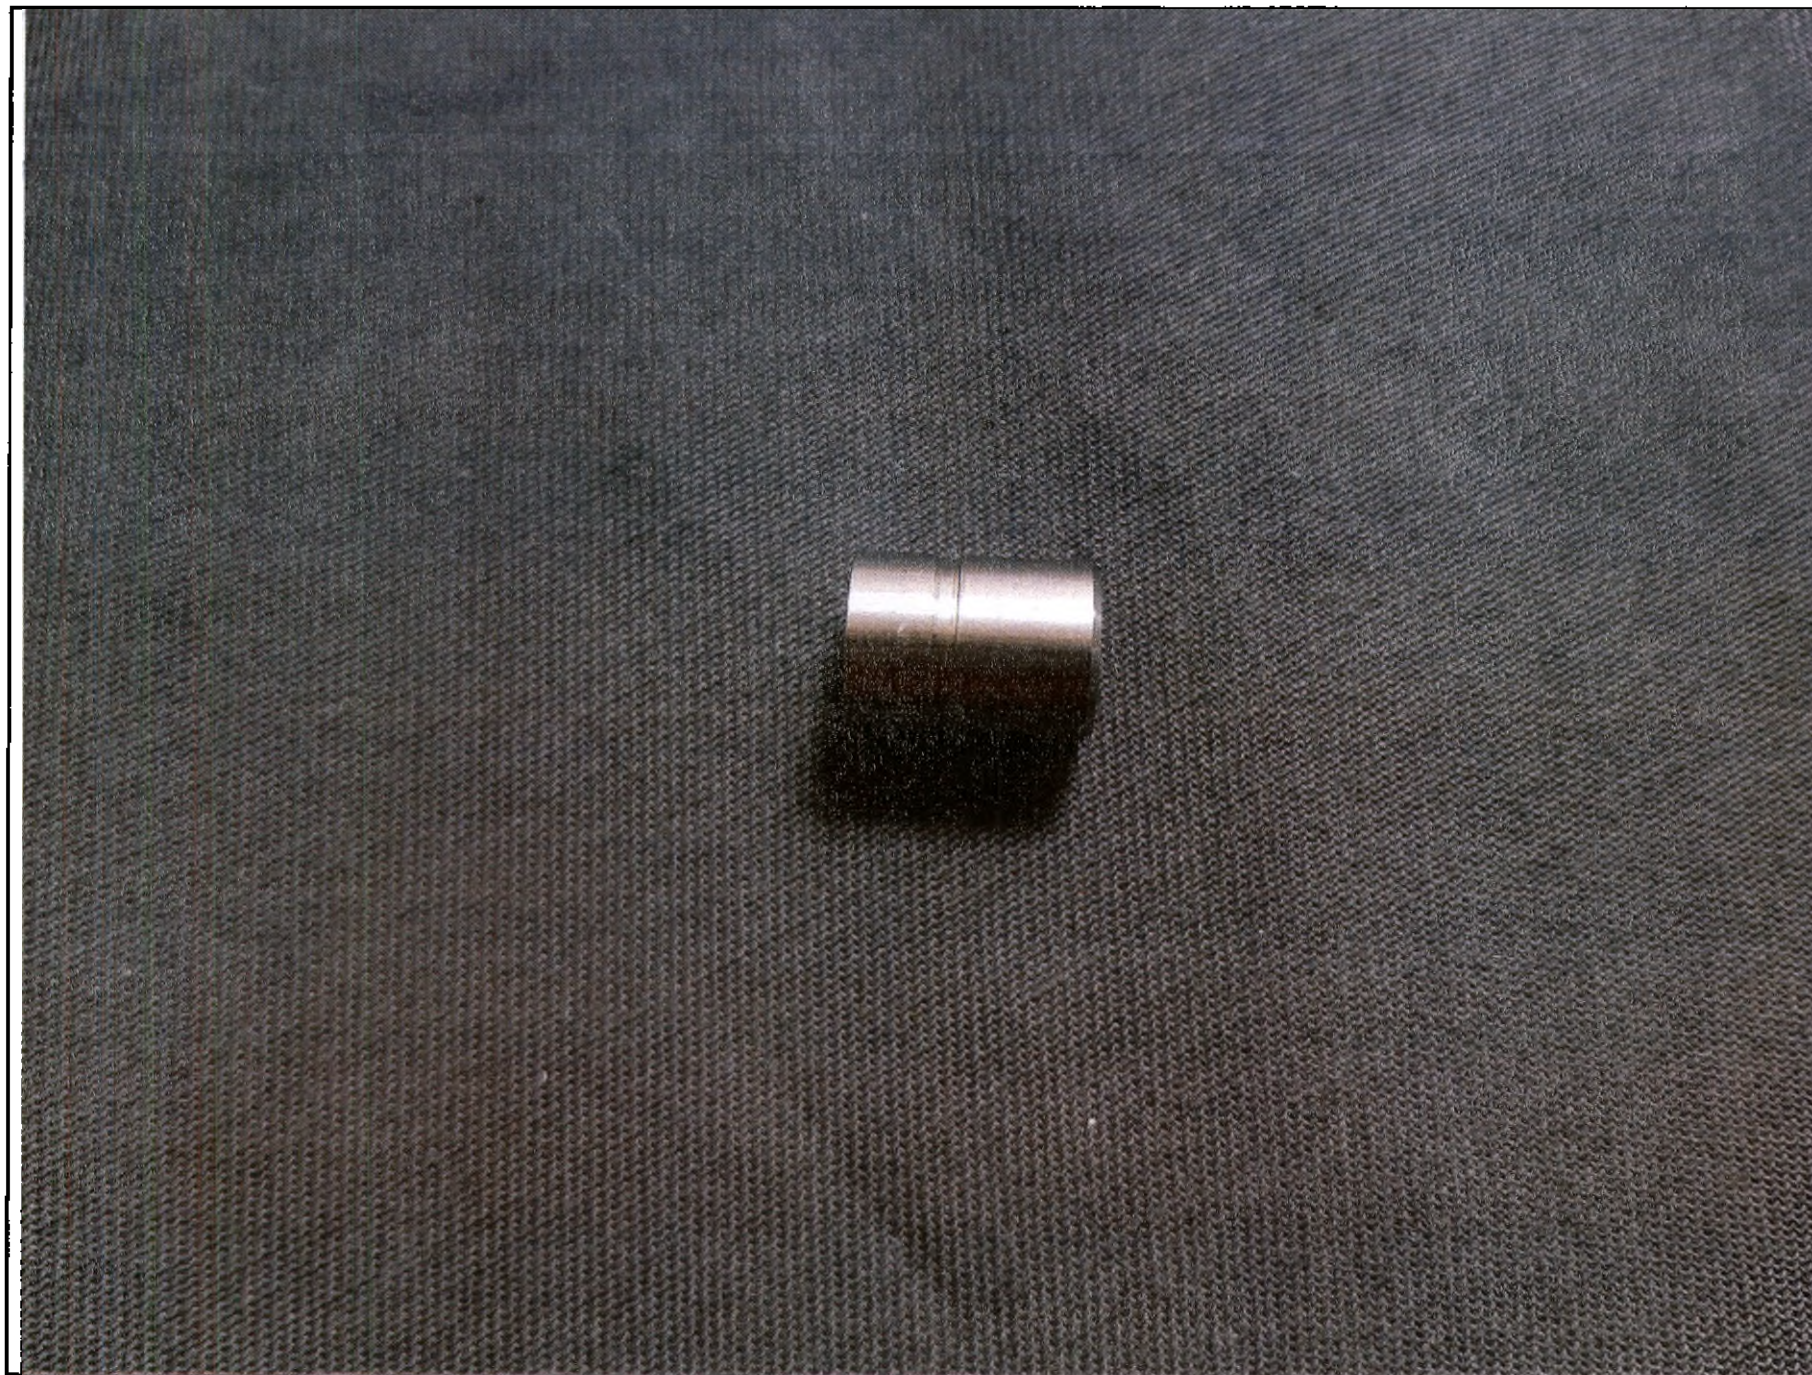


Рис. 28. Адаптер световодов Richard Wolf

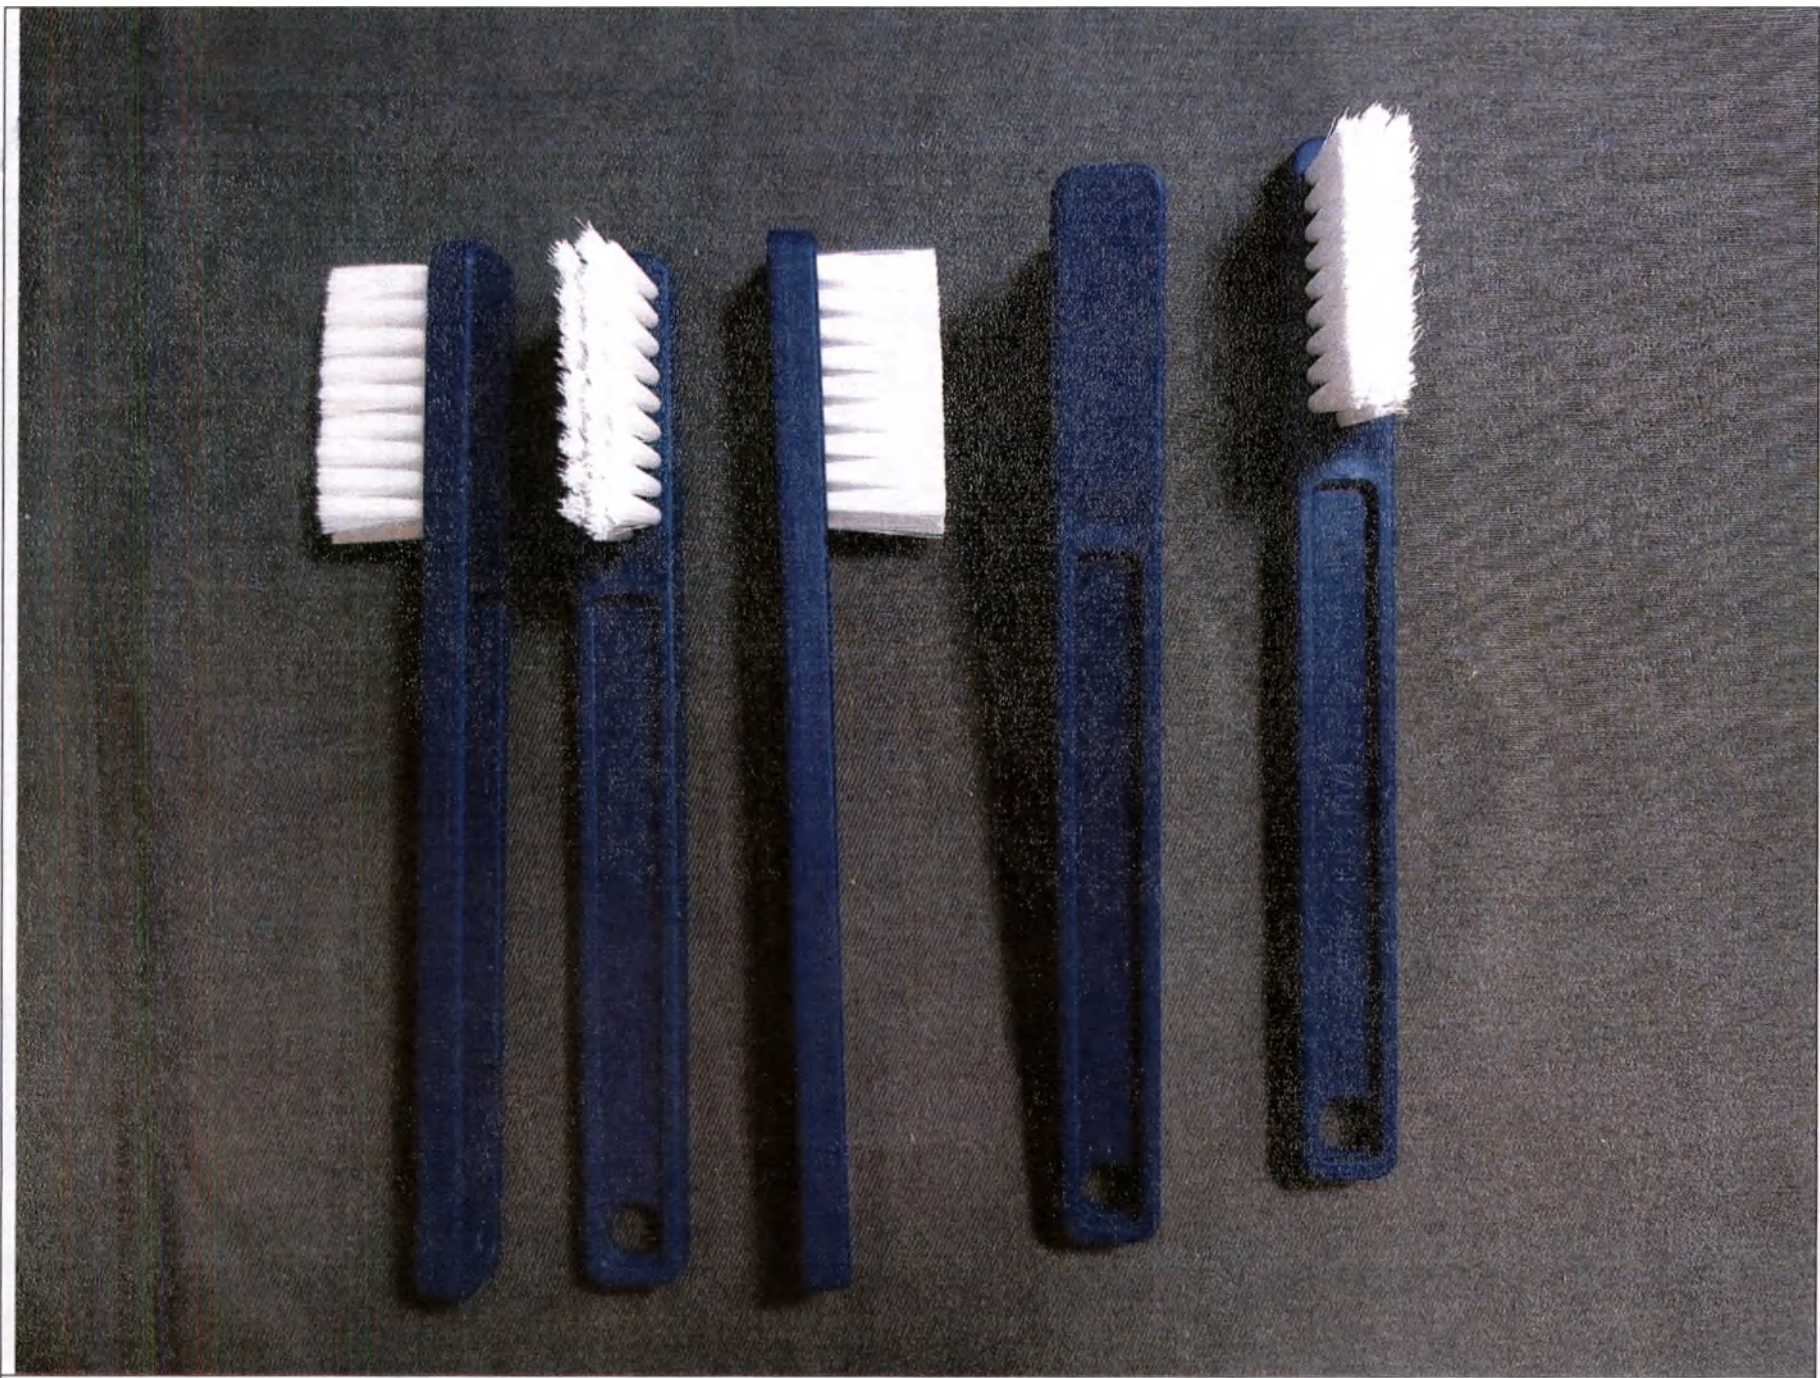


Рис. 30. Щетка плоская для очистки - 5 шт./уп

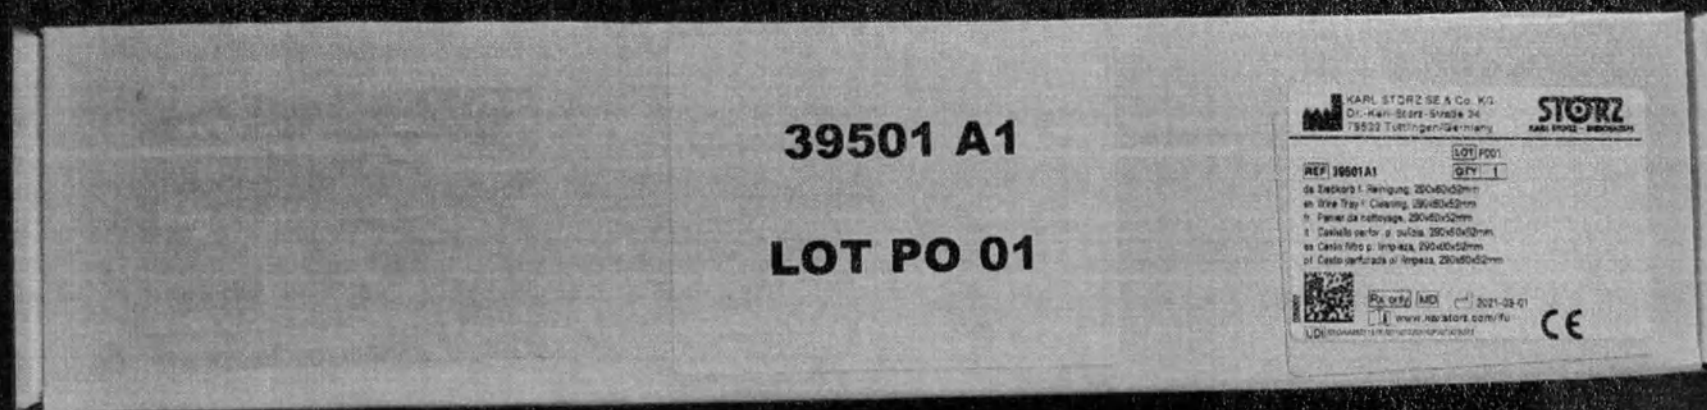


Рис. 31. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 290 x 60 x 52 мм. Упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSCOPE

LOT P001

REF 39501A1

QTY 1

de Siebkorb f. Reinigung, 290x60x52mm
en Wire Tray f. Cleaning, 290x60x52mm
fr Panier de nettoyage, 290x60x52mm
it Cestello perfor. p. pulizia, 290x60x52mm
es Cesto filtro p. limpieza, 290x60x52mm
pt Cesta perfurada p/ limpeza, 290x60x52mm



0200312

Rx only

MD



2021-03-01



www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)0404855*167619(11)210301(12)P001(422)278



Рис. 32. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 290 x 60 x 52 мм. Маркировка на упаковке.

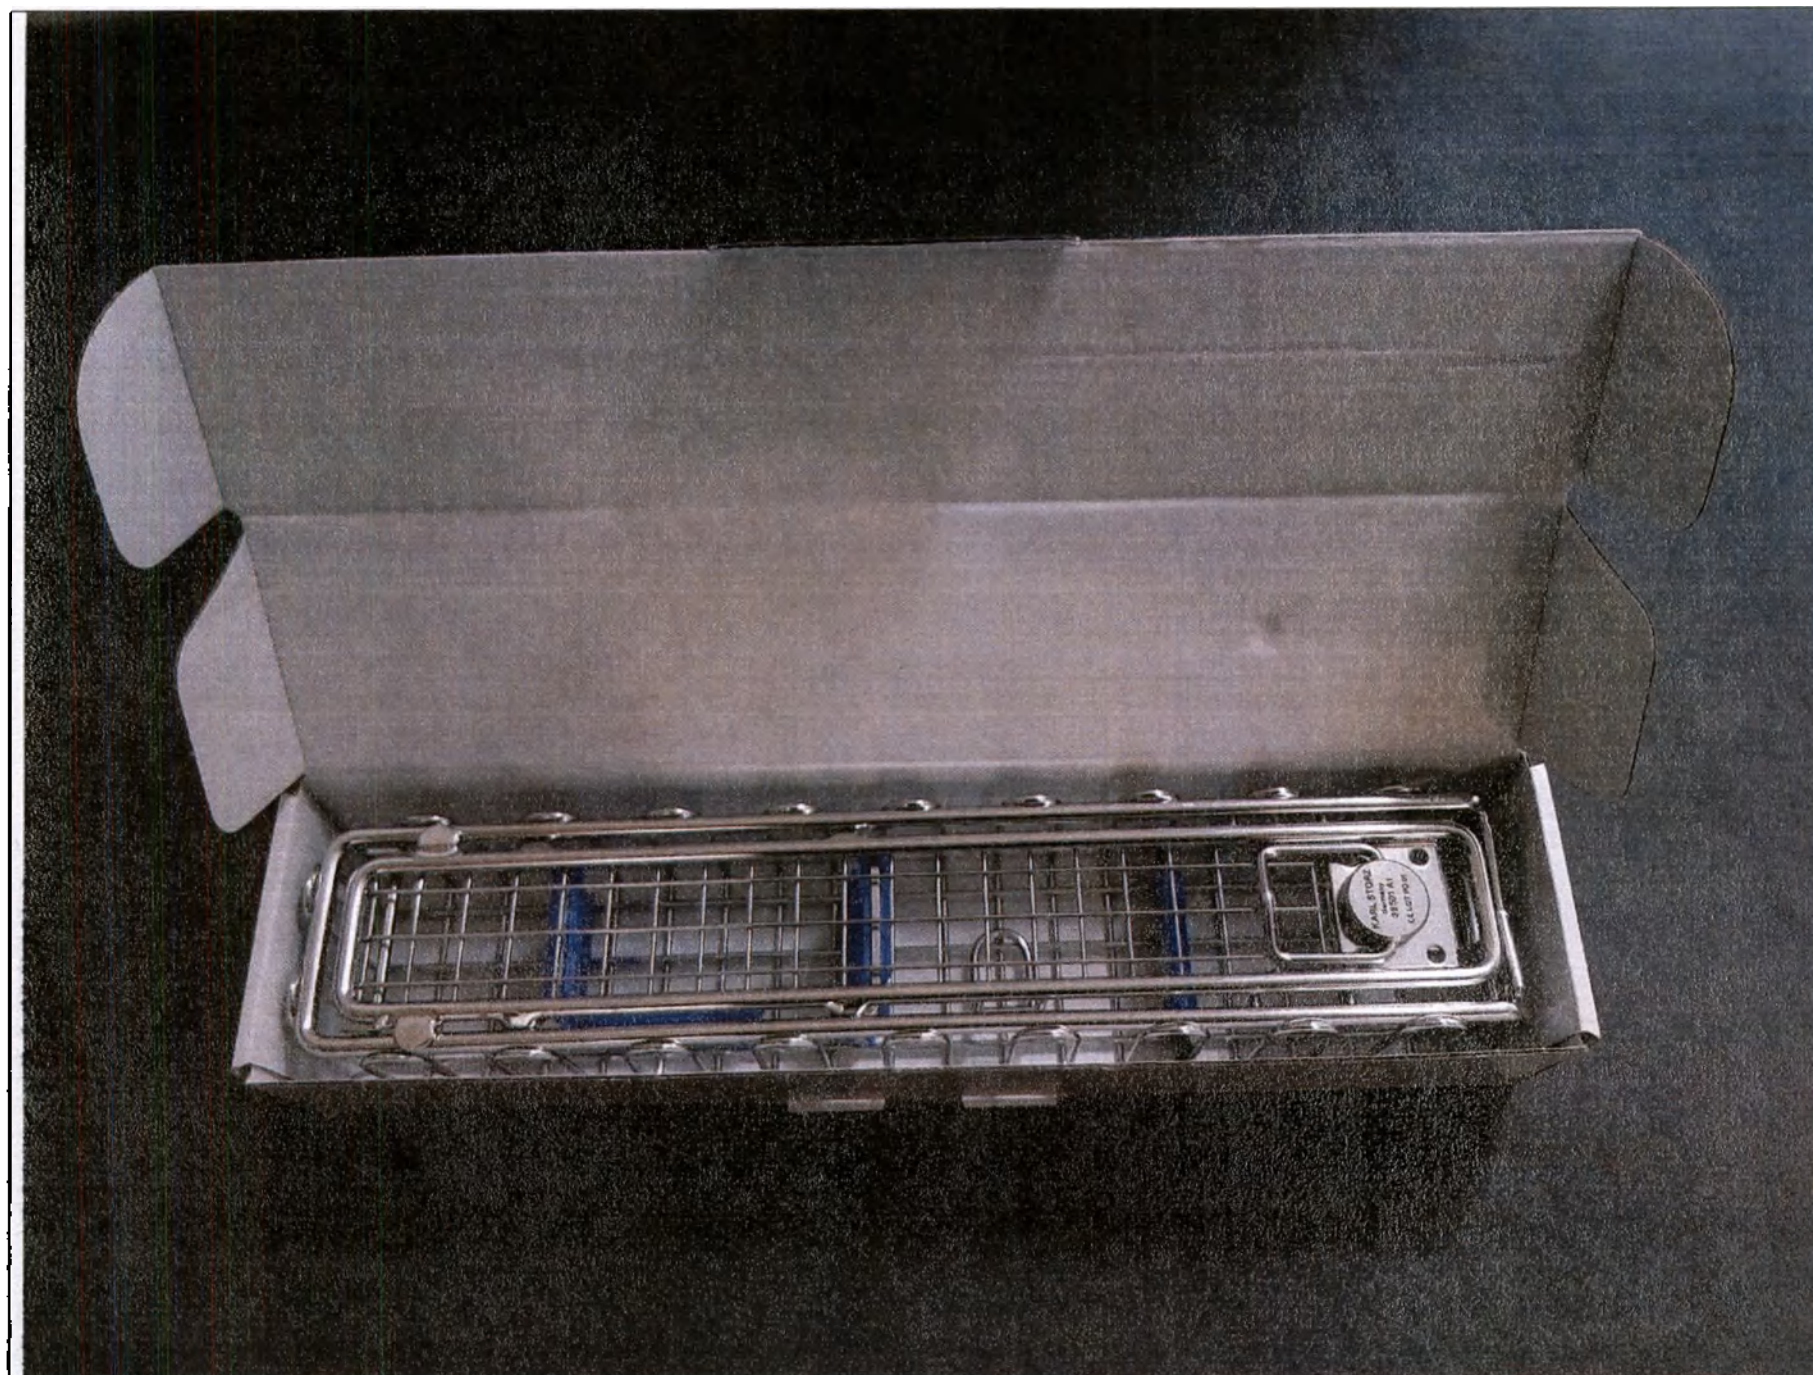


Рис. 33. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 290 x 60 x 52 мм

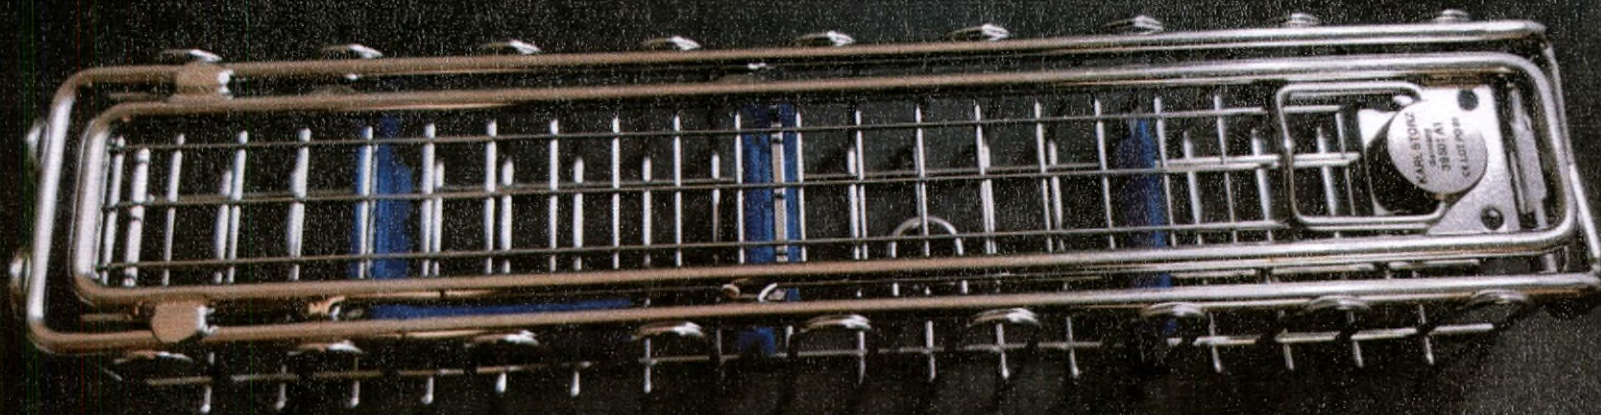


Рис. 34. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 290 x 60 x 52 мм

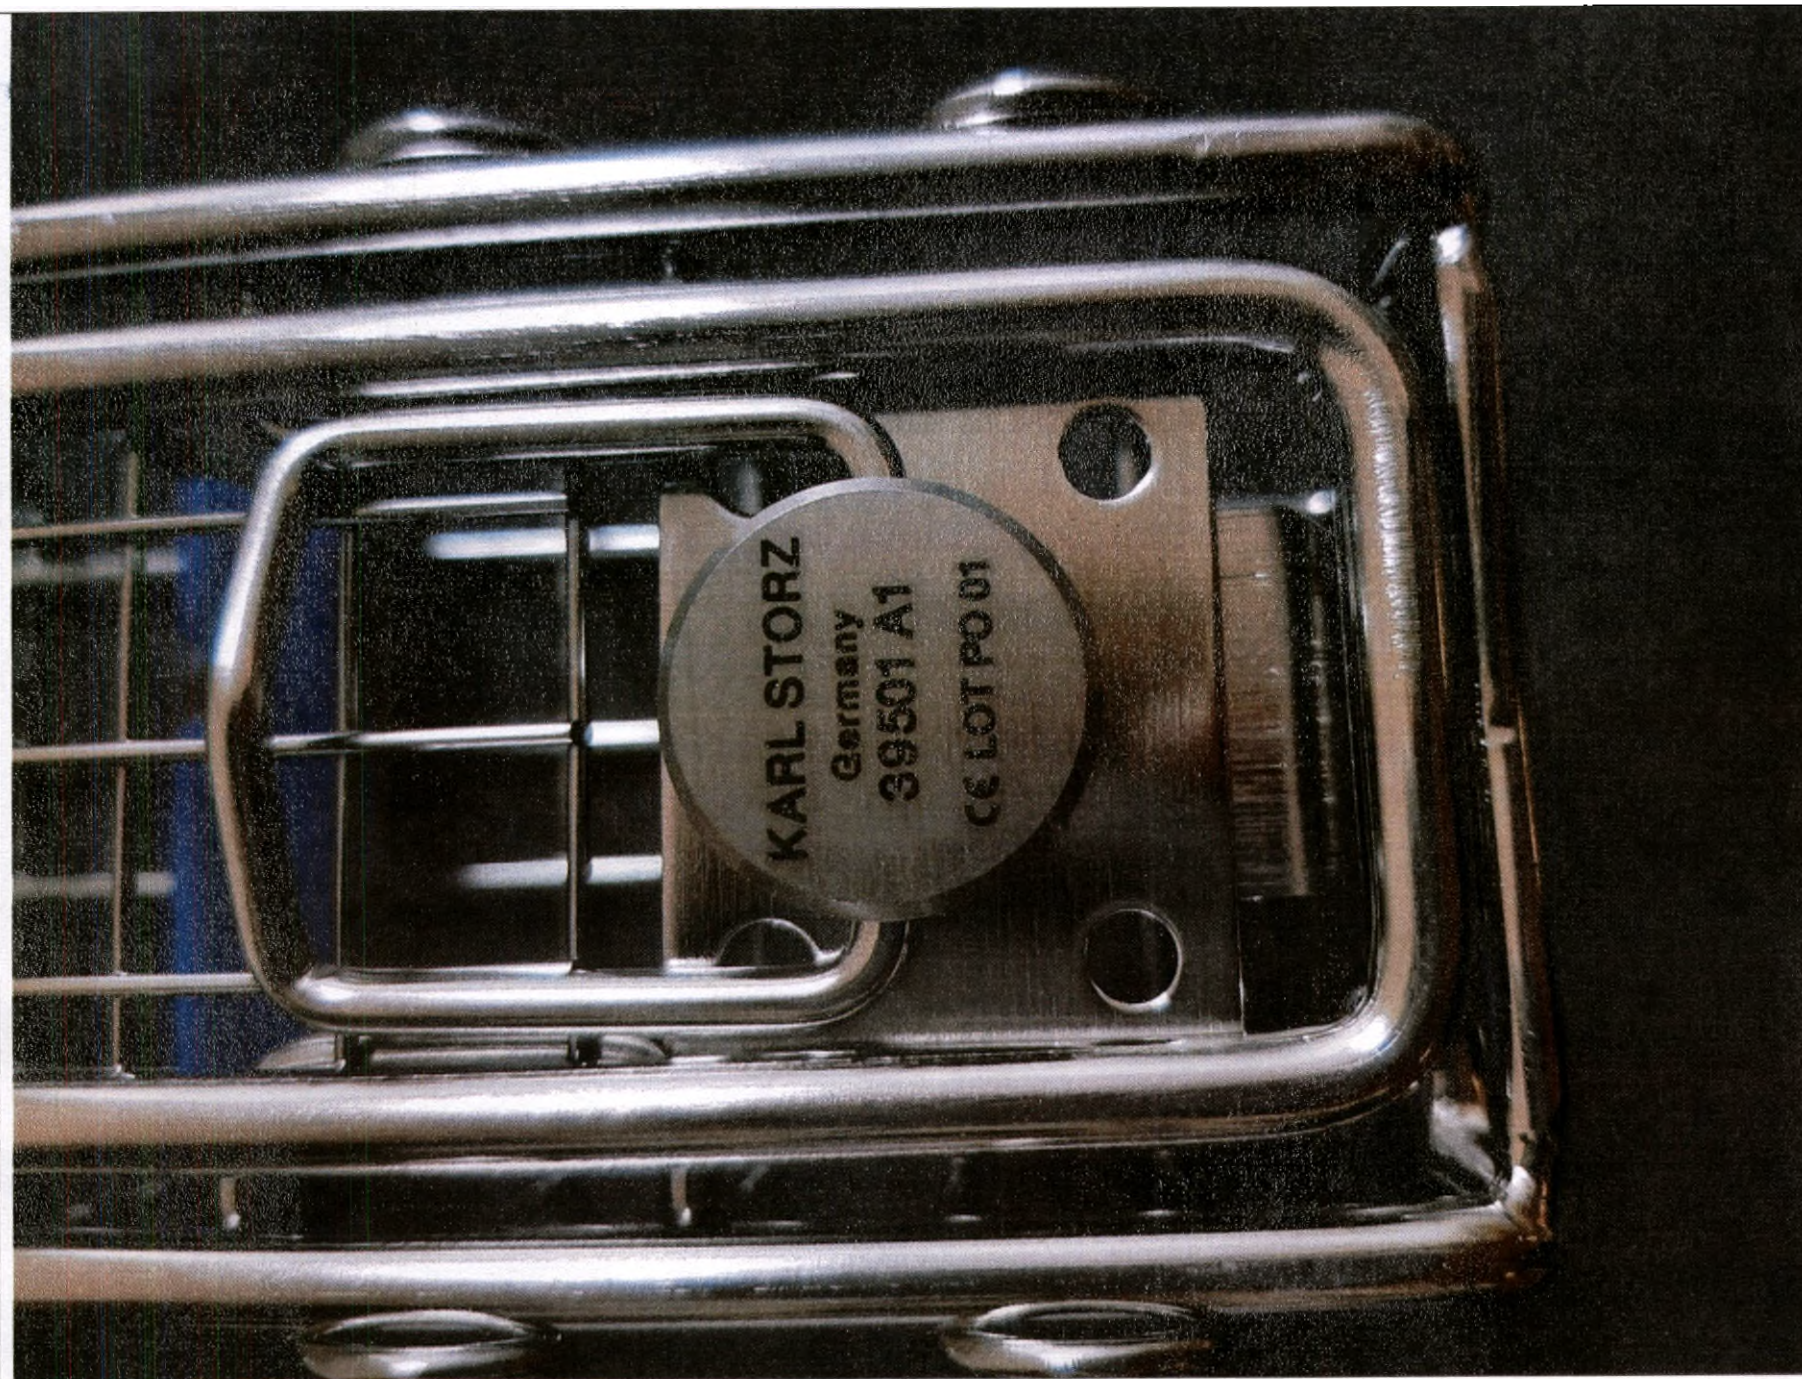


Рис. 35. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 290 x 60 x 52 мм

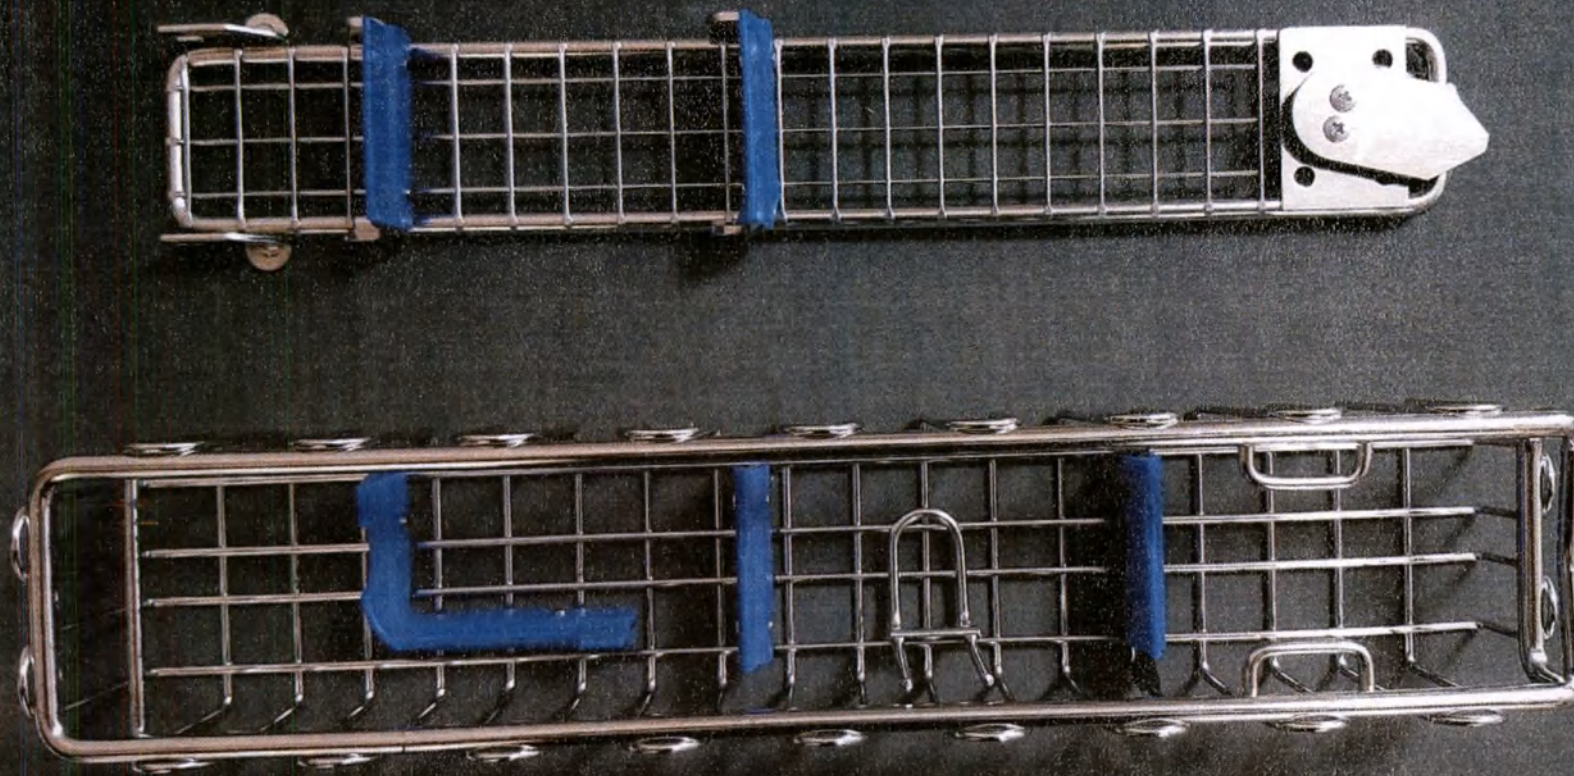


Рис. 36. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 290 x 60 x 52 мм

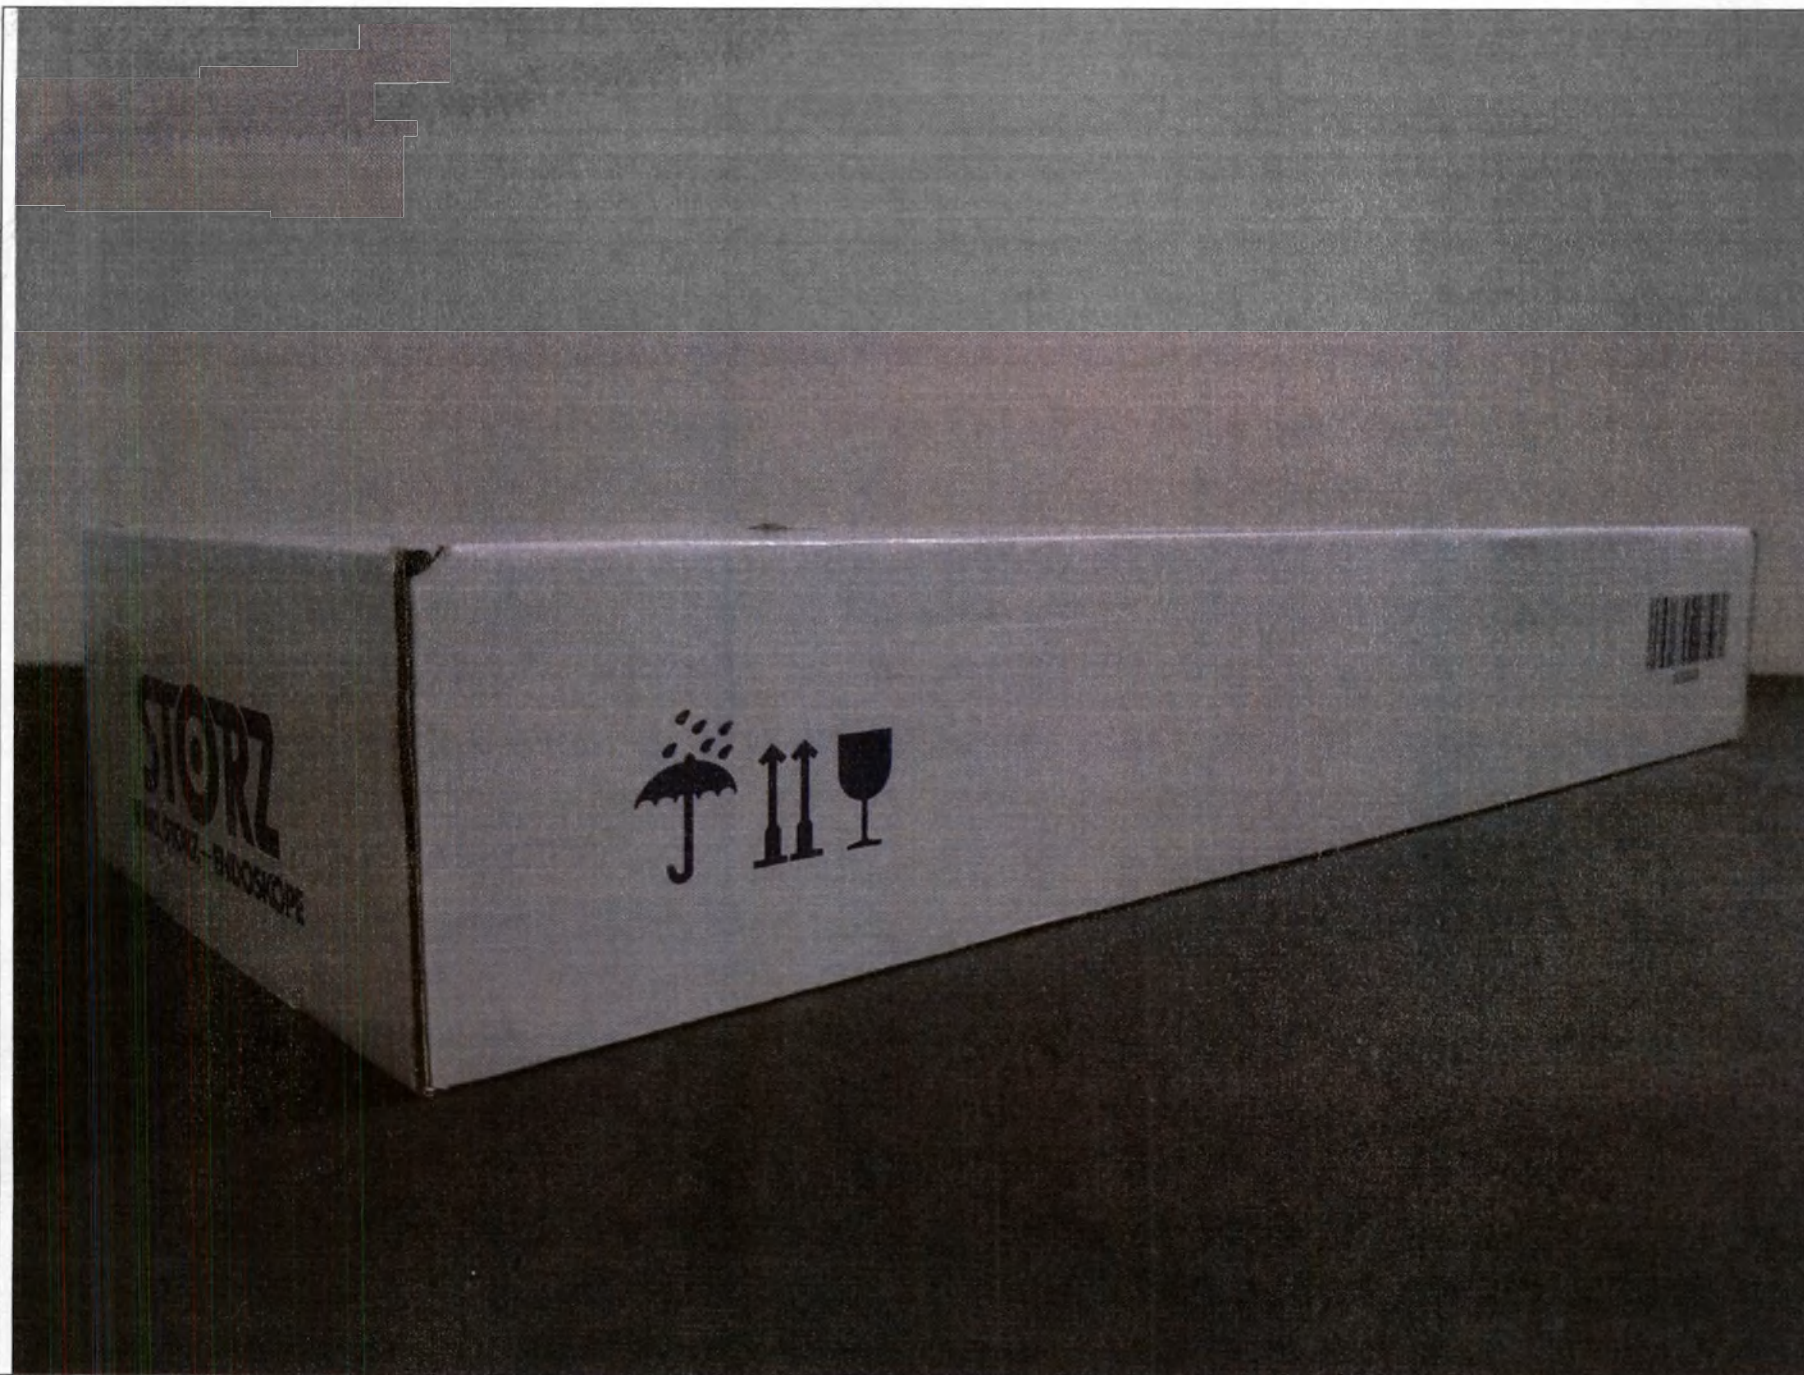


Рис. 37. Контейнер проволоочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 352 x 125 x 54 мм. Первичная упаковка.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

LOT T002

REF 39501 A2

QTY 1

de Siebkorb f. Reinigung, 352x125x54 mm
en Wire Tray f. Cleaning, 352 x 125 x 54 mm
fr Panier nettoyage, 352x125x54 mm
it Cestello per pulizia, 352x125x54 mm
es Bandeja quirúr. limpieza, 352x125x54 mm
pt Cesto aramado p/ limpeza, 352x125x54 mm

020002



Rx only

MD



2021-06-30



www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)04048551157826(11)210830(10)T002(42)278




Рис. 38. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 352 x 125 x 54 мм. Маркировка на первичной упаковке.

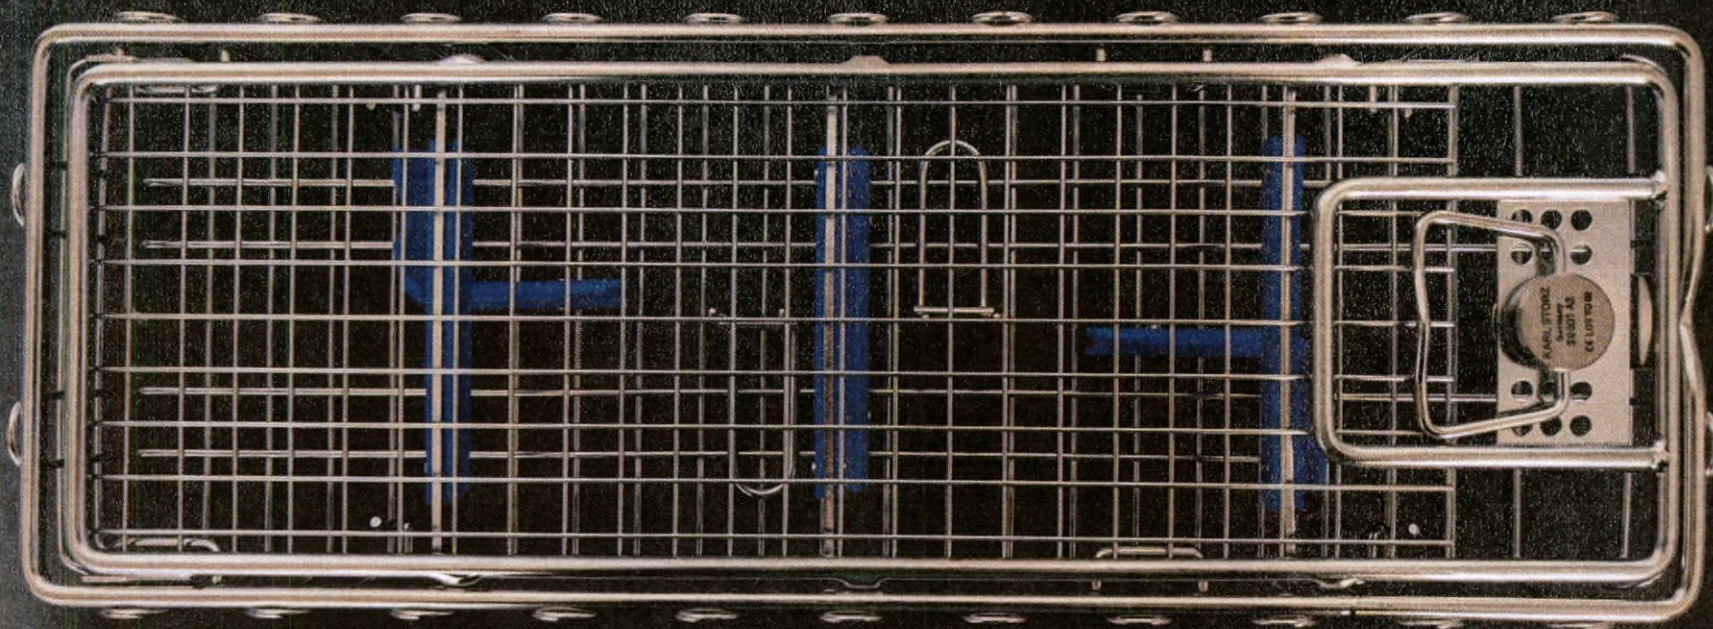


Рис. 39. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 352 x 125 x 54 мм

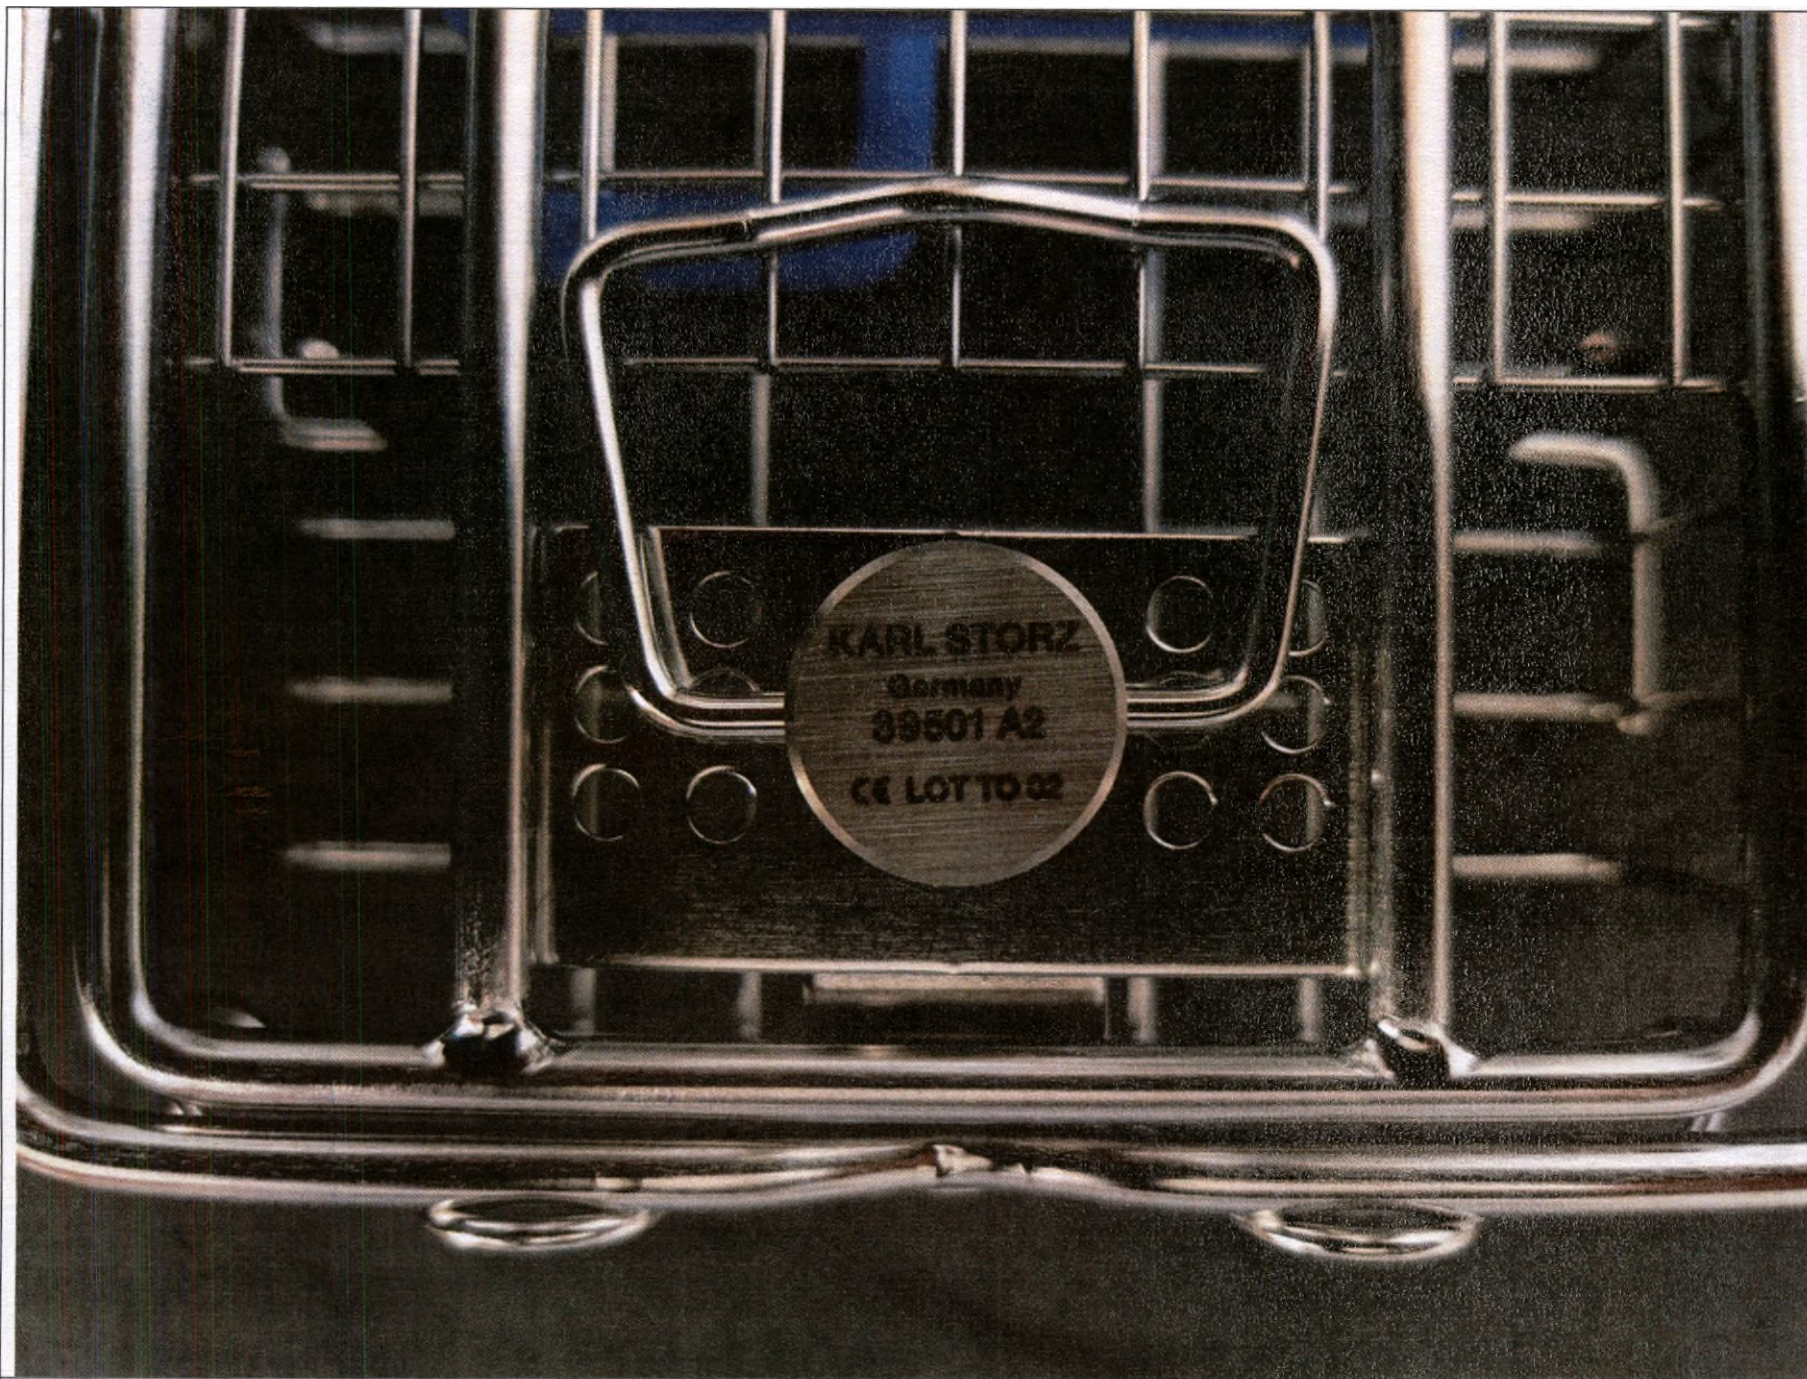


Рис. 40. Контейнер проволочный для дезинфекции/стерилизации/хранения, размеры: 352 x 125 x 54 мм



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ ENDOSCOPE

Эндоскоп жесткий HOPKINS для колоректальной хирургии в
вариантах исполнения с принадлежностями:
Эндоскоп жесткий HOPKINS для проктоскопии, направление
наблюдения 30°, диаметр 4 мм, длина 9,5 см

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Рис. 41. Пример русскоязычной маркировки на упаковке, на примере варианта исполнения: Эндоскоп жесткий HOPKINS для проктоскопии (вид 288870), направление наблюдения 30°, диаметр 4 мм, длина 9,5 см.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ ENDOSKOPE

Производитель	Karl Storz SE & Co KG Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen, Germany (Германия)
Уполномоченный представитель на территории РФ	Общество с ограниченной ответственностью «Карл Шторц – Эндоскопы Восток» (ООО КШТЭ ВОСТОК) Россия, 115114, Москва, Дербеневская набережная, 7, стр. 4.
Информация о сроке службы	– см. инструкцию по эксплуатации
Сайт	https://www.karlstorz.com/de/ru/index.htm
Сделано в:	Германия

Рис. 42. Пример русскоязычной маркировки на упаковке, на примере варианта исполнения: Эндоскоп жесткий HOPKINS для проктоскопии (вид 288870), направление наблюдения 30°, диаметр 4 мм, длина 9,5 см.

